

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Осипова В.В. \

2021 г.

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021»

Макет маркировки

2021

Комплект 1

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX




Состав:

1 Тест-кассета	1 шт
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	1 шт
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	1 шт
6 Микропробирка (1,8 мл)	1 шт
7 Подставка под микропробирки	1 шт
8 Инструкция по применению	1 шт

Готово к использованию

Для профессионального применения




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2,
8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Микропробирка (1,8 мл) - 1 шт.



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт




СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 1 шт



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 - 4 мл



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 - 4 мл




СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295–2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX




Состав:

1 Тест-кассета	2 шт	LOT	XXXXXX
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	XX-XXX/X
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	2 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	2 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6 Микропробирка (1,8 мл)	2 шт		
7 Подставка под микропробирки	1 шт		
8 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Микропробирка (1,8 мл) - 2 шт.



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт




СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Пипетка Пастера (0,25 мл) - 2 шт



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 - 4 мл



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 - 4 мл



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX




Состав:

1 Тест-кассета	10 шт	LOT	XXXXXX
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	XX-XXX/XX
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	10 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	10 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6 Микропробирка (1,8 мл)	10 шт		
7 Подставка под микропробирки	1 шт		
8 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Микропробирка (1,8 мл) - 10 шт.



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт




СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 10 шт



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 - 4 мл



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 - 4 мл



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295–2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX



Состав:

1 Тест-полоска	10 шт	LOT	XXXXXX
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	XX-XXX/XX
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	10 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5 Микропробирка (1,8 мл)	10 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6 Подставка под микропробирки	1 шт		
7 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 10 шт.

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 - 4 мл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

IVD

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 - 4 мл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

IVD

СтрептоВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX




Состав:

1 Тест-полоска	20 шт	LOT	XXXXXX
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	2 шт	REF	XX-XXX/XX
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	2 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	20 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5 Микропробирка (1,8 мл)	20 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6 Подставка под микропробирки	1 шт		
7 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Микропробирка (1,8 мл) - 20 шт.



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Тест-полоска - 1 шт



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 - 4 мл



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 - 4 мл



Комплект 6

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021
РУ № XXX XXXX/XXXXX



Состав:

- 1 Тест-полоска
- 2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)
- 3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)
- 4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)
- 5 Микропробирка (1,8 мл)
- 6 Подставка под микропробирки
- 7 Инструкция по применению

40 шт
3 шт
3 шт
40 шт
40 шт
2 шт
1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/XX



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 40 шт.

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 - 4 мл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 - 4 мл

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



**«СтрептоВ-
ИМБИАН-ИХА»**

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

Комплект №

Р/У № XXX XXXX/XXXXX
Т/У 21.20.23-058-41390295-2021

Количество

WT

Масса нетто

КГ

Масса брутто

КГ

Масса нетто
потребительской
упаковки

КГ

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/XX  ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Замораживать
не допускается
Допускается
транспортирование при
температуре от 2 до 30°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Счито и заверено печатью 8
(восемь) лист 06

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Осипова В.В.
2021г.

Фотографические изображения общего вида

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295–2021»

В состав наборов могут входить следующие компоненты:


Тест-кассета




Тест-полоска



Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)

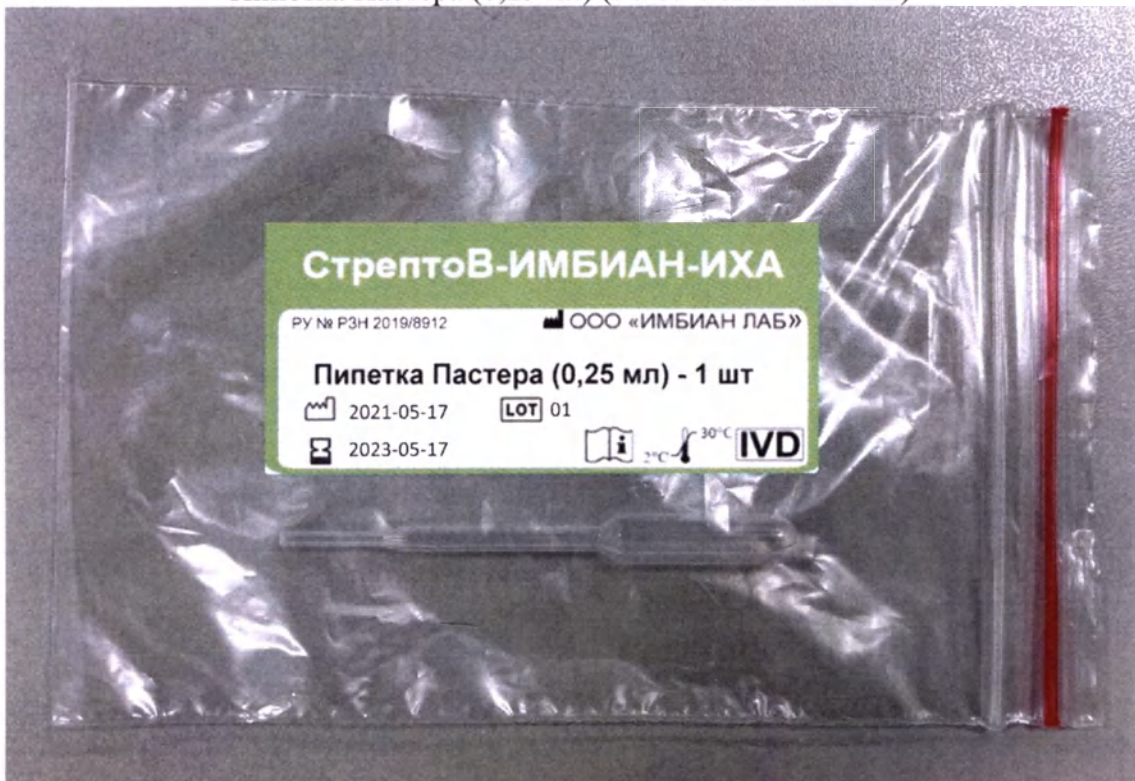

Микропробирка (1,8 мл)

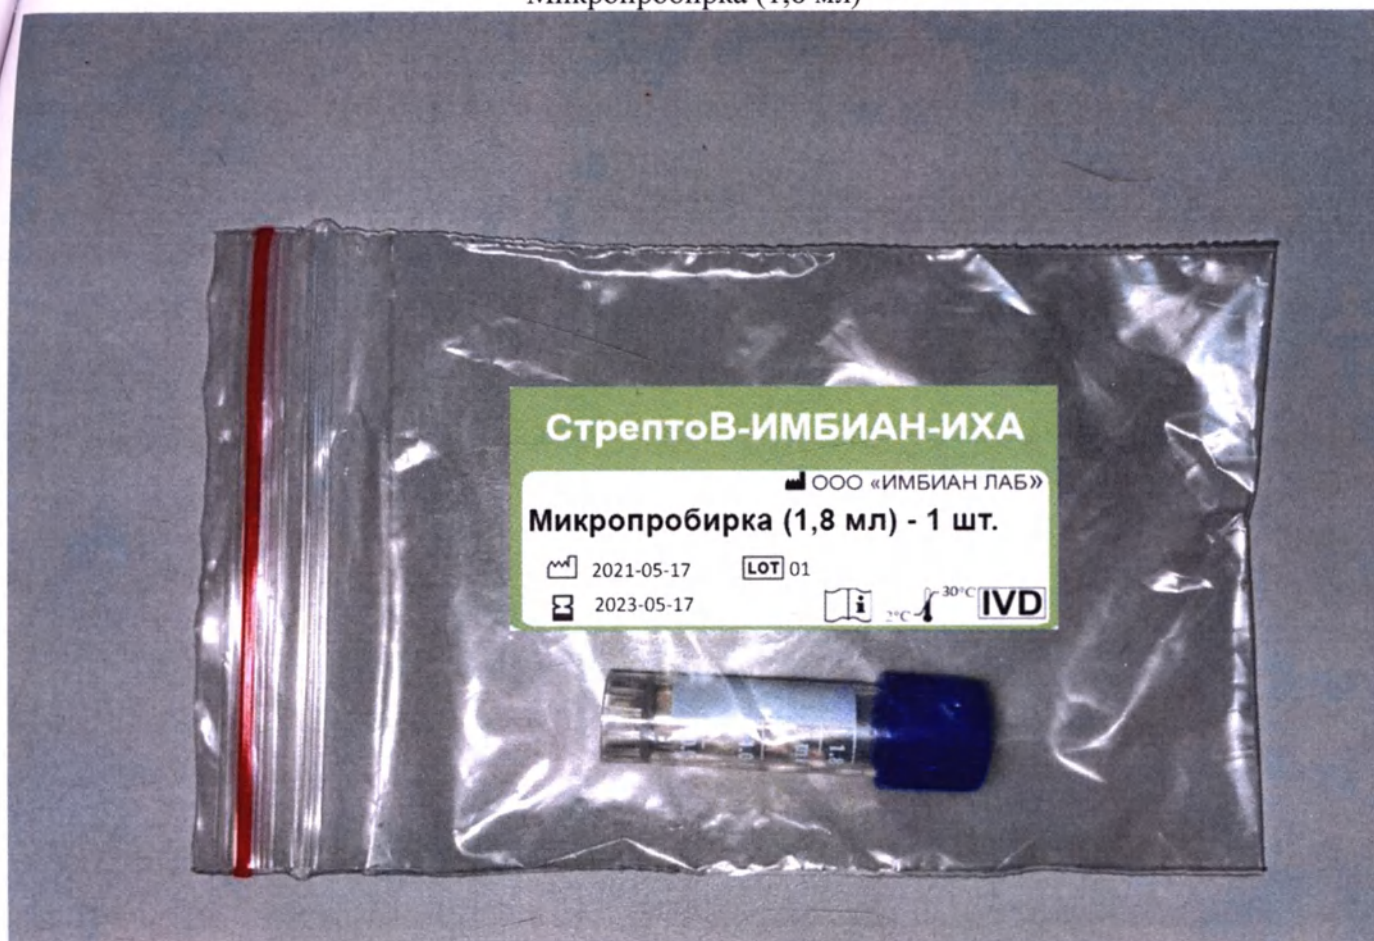


Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)




Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)



Подставка под микропробирки

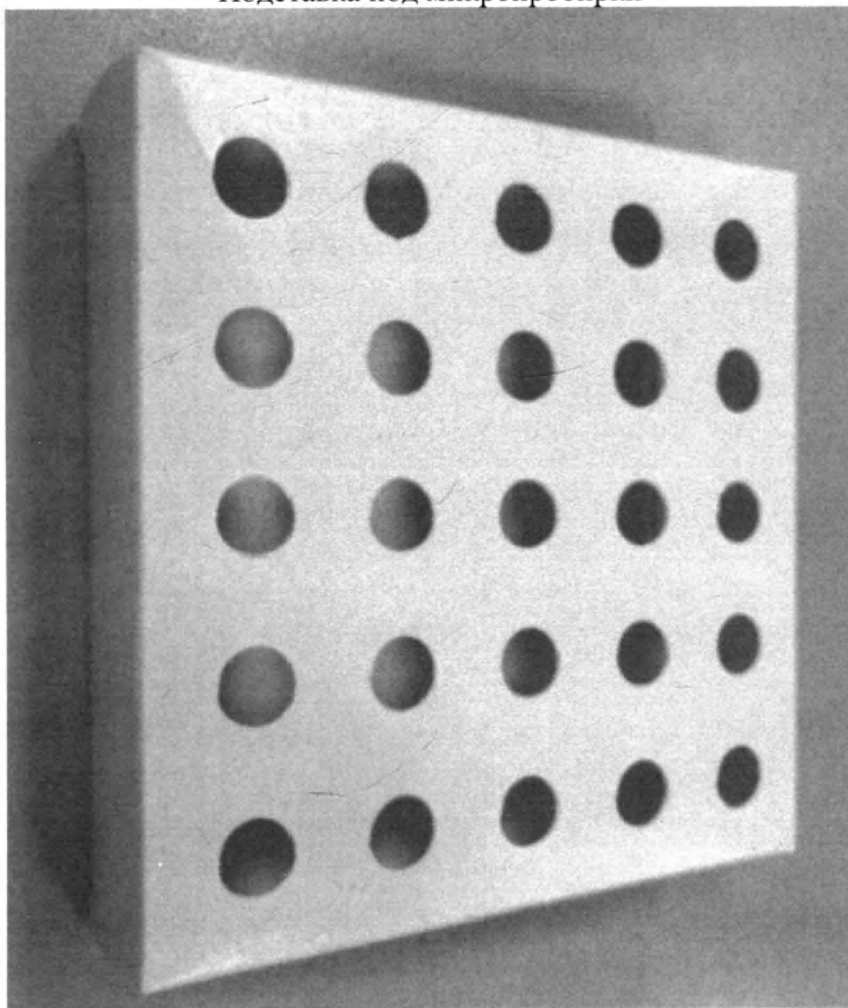

Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ
20.12/11857)

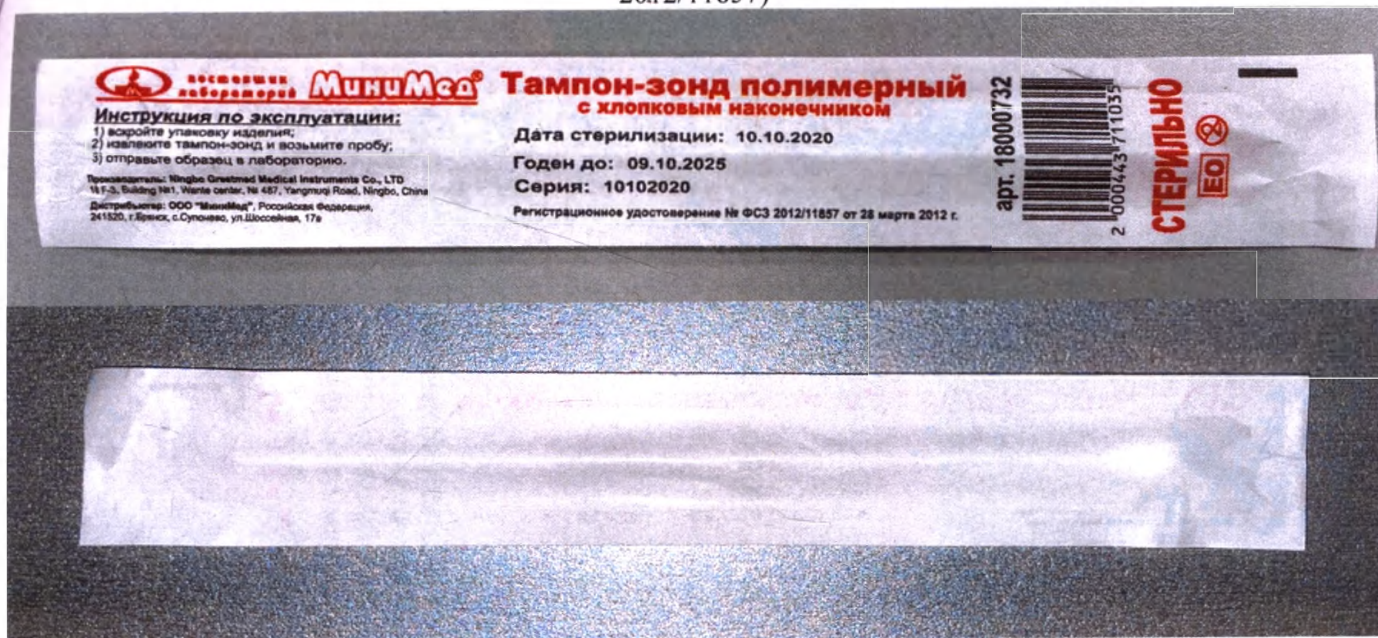

СтрептоВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021
 РУ № XXX XXXX/XXXXXX




Состав:

1 Тест-кассета	1 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	1 шт		2021-05-17
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	1 шт		2023-05-17
6 Микропробирка (1,8 мл)	1 шт		
7 Подставка под микропробирки	1 шт		
8 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская обл.,
 Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
 РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
 этаж 2, помещ. 2
 8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX


Imbian

Состав:




1 Тест-кассета	1 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	1 шт		2021-05-17
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	1 шт		2023-05-17
6 Микропробирка (1,8 мл)	1 шт		
7 Подставка под микропробирки	1 шт		
8 Инструкция по применению	1 шт		

Получено в аптеке/лаборатории

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
430001, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Колывань
РП Колывань, ул. Садовая д. 217
Эт. 2, пом. 2
8 (383) 219-34-54 info@imbian.ru

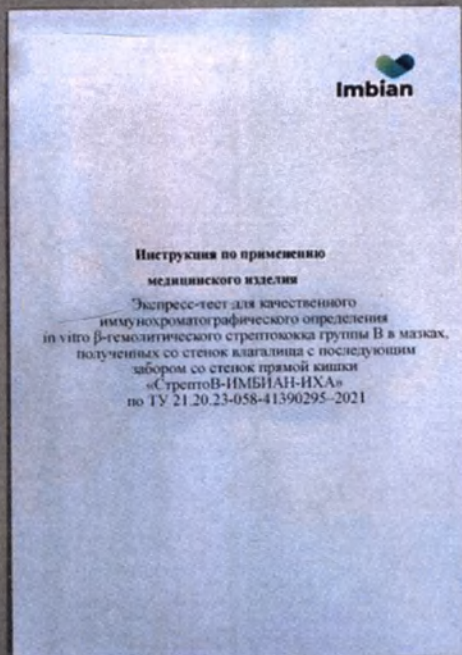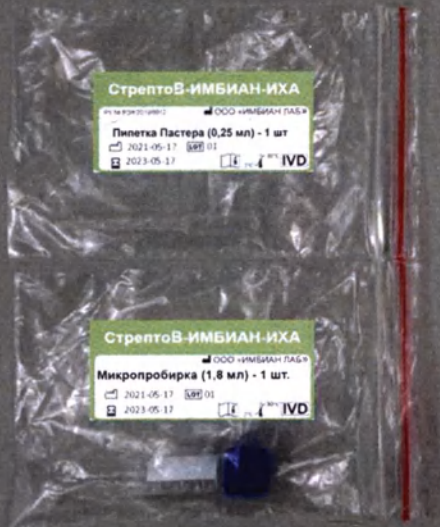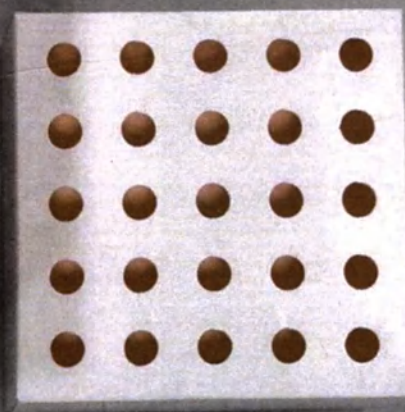

СтрептоВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX



Imbian

Состав:

1 Тест-кассета	2 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	2 шт		2021-05-17
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	2 шт		2023-05-17
6 Микропробирка (1,8 мл)	2 шт		
7 Подставка под микропробирки	1 шт		
8 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская обл.,
 Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
 РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
 этаж 2, помещ. 2,
 8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021
РУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

Состав:


1 Тест-кассета	2 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	2 шт		2021 05 17
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	2 шт		2023 05 17
6 Микропробирка (1,8 мл)	2 шт		
7 Подставка под микропробирки	1 шт		
8 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «Имбиан Лаб»
190019, Московская обл.,
г.о. Раковский пос.о-во, Колпино
П/О Колпино, ул. Садовая, д. 2/7
Эт. 2, пом. 2
т. (812) 206-54-54, e-mail: info@imbian.ru

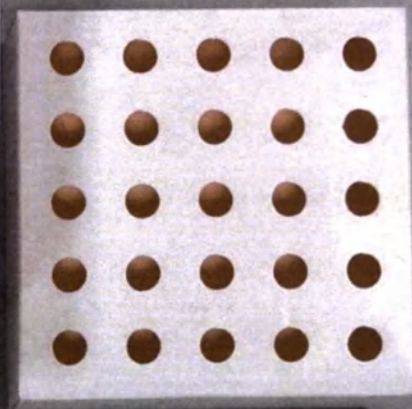

Imbian

Инструкция по применению медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

СтрептоВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β-гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX




Состав:





1 Тест-кассета	10 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	10 шт		2021-05-17
5 Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)	10 шт		2023-05-17
6 Микропробирка (1,8 мл)	10 шт		
7 Подставка под микропробирки	1 шт		
8 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

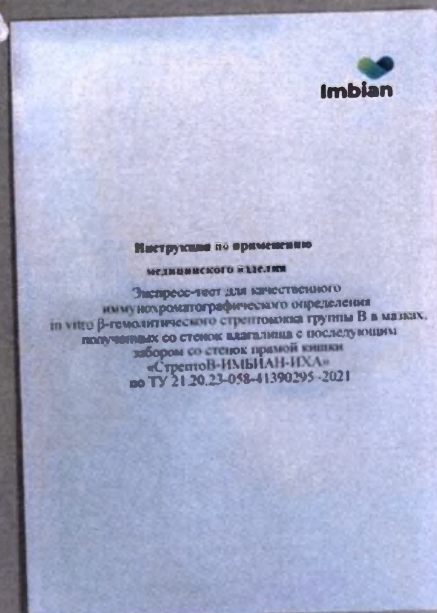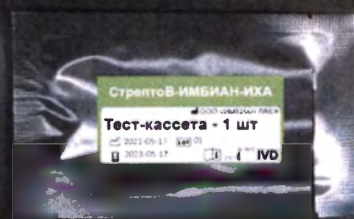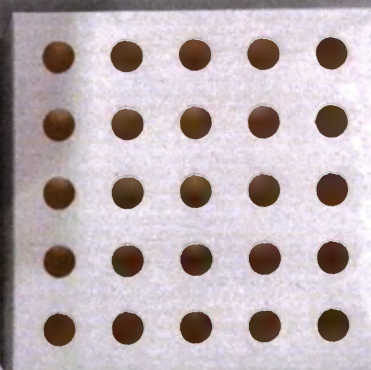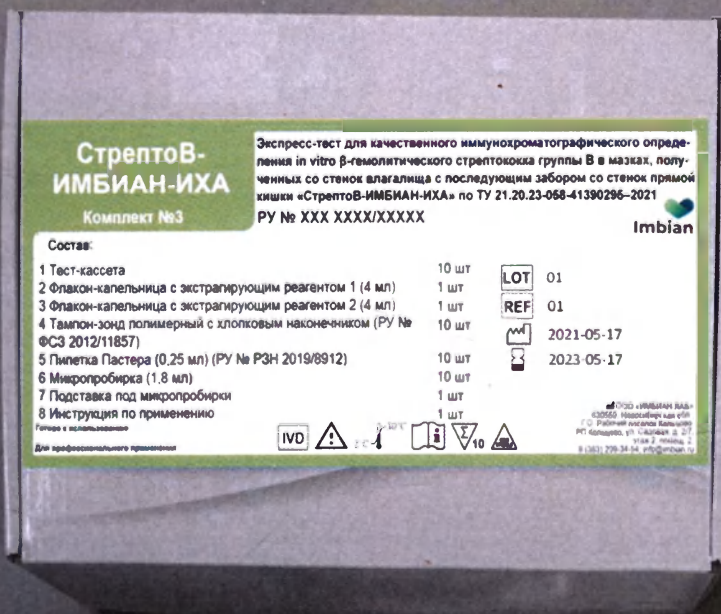

СтрептоВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX




Состав:




1 Тест-полоска	10 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	1 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	1 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	10 шт		2021-05-17
5 Микропробирка (1,8 мл)	10 шт		2023-05-17
6 Подставка под микропробирки	1 шт		
7 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

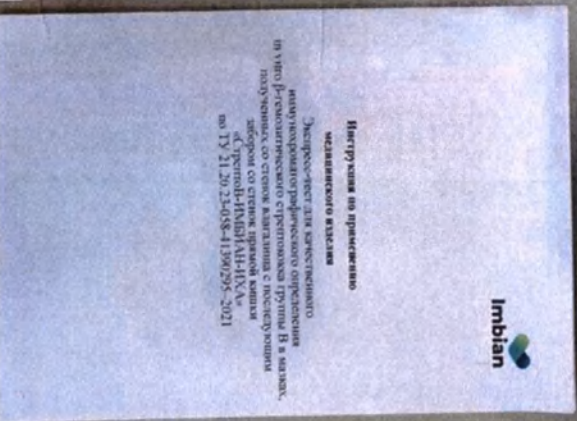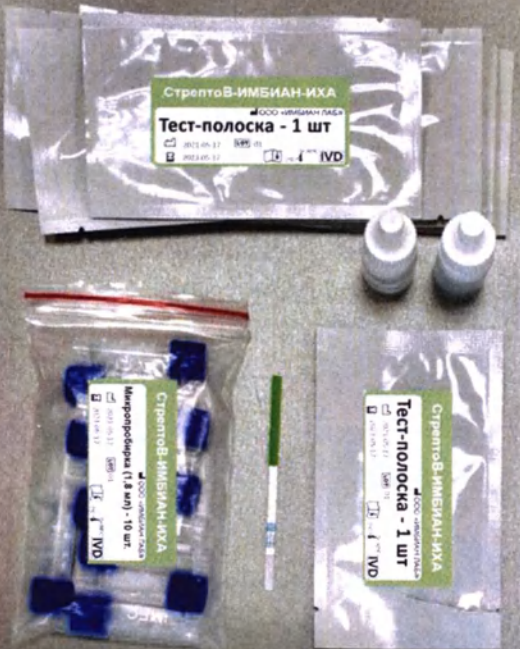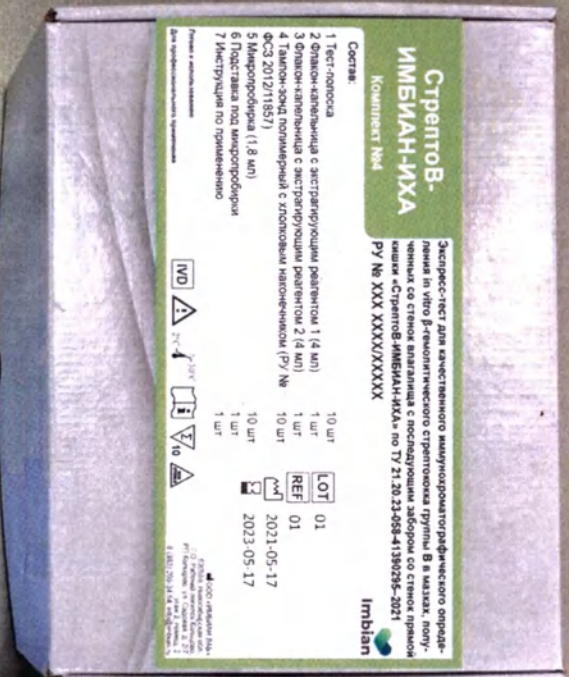

СтрептоВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX



Состав:




1 Тест-полоска	20 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	2 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	2 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	20 шт		2021-05-17
5 Микропробирка (1,8 мл)	20 шт		2023-05-17
6 Подставка под микропробирки	1 шт		
7 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2,
8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

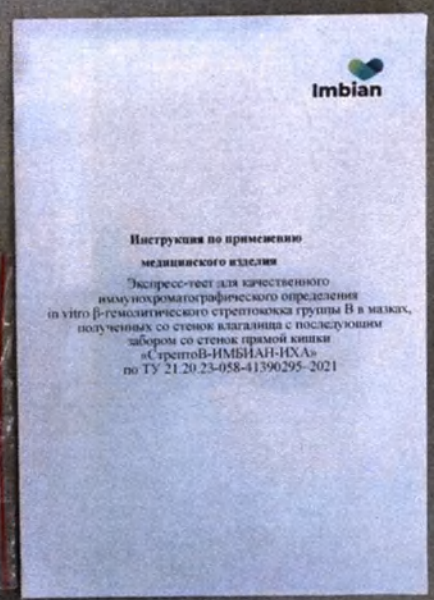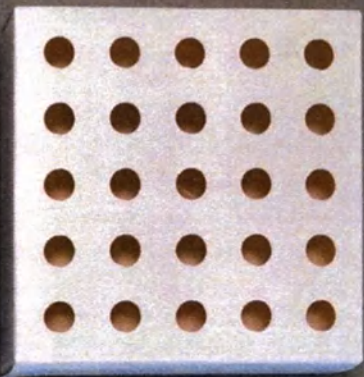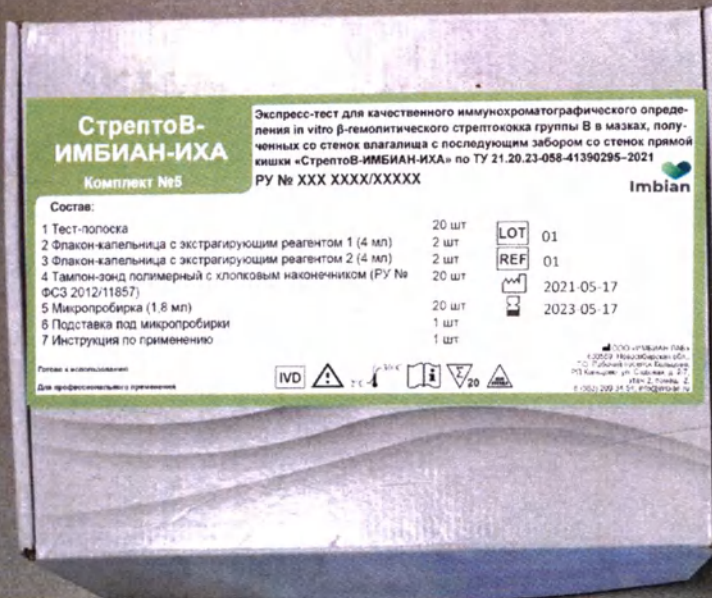

СтрептоВ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021
РУ № XXX XXXX/XXXXXX



Состав:




1 Тест-полоска	40 шт	LOT	01
2 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 1 (4 мл)	3 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с экстрагирующим реагентом 2 (4 мл)	3 шт		
4 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	40 шт		2021-05-17
5 Микропробирка (1,8 мл)	40 шт		2023-05-17
6 Подставка под микропробирки	2 шт		
7 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

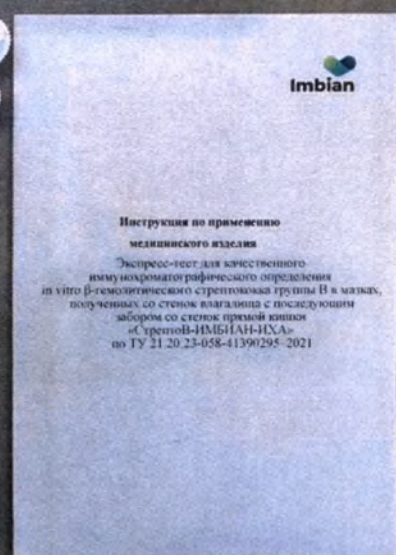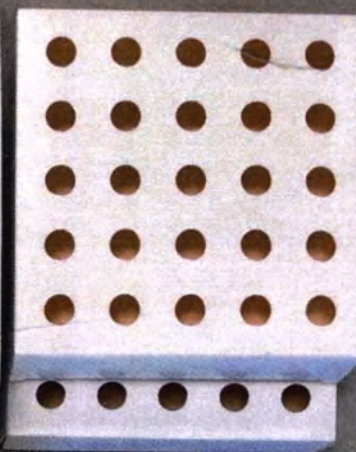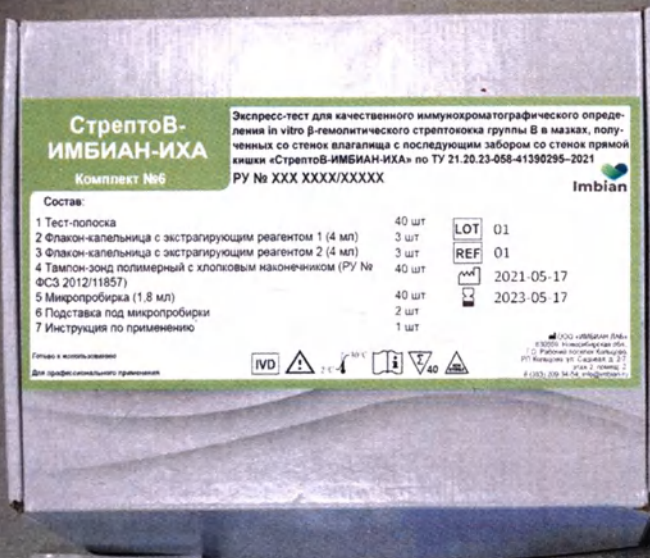

«СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА»

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* β -гемолитического стрептококка группы В в мазках, полученных со стенок влагалища с последующим забором со стенок прямой кишки «СтрептоВ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

Комплект № _____

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-058-41390295-2021

Количество

шт

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

LOT 01

2021-05-17

REF 01

2023-05-17

IVD

Замораживать не допускается
Допускается транспортирование при температуре от 2 до 30°C

2°C 30°C



Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
8 (383) 209-34-54; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 18
Восемьдесят

Генеральный директор ООО «Имблан лаб»
Осипова В.В.

