



ООО «ЦИЛИТА»
Юридический адрес: 390044, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д.20, офис. 702
Фактический адрес: 390044, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д.20, офис. 702
Тел./Факс.(4912)77-96-78
ИНН 6234002491, КПП 622901001, р/с 40702810700010002429 в
Прио-Внешторгбанке ОАО г. Рязань
БИК 046126708, к/с 301018100500000000708, ОКПО 72699224
ОГРН 1046209001332, Межрайонная ИФНС РФ №1 по г. Рязани
от 03.02.2004г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ООО «ЦИЛИТА»
Яковлев Д.А.

2022 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия
«Система офтальмологическая хирургическая Sophi для операций на переднем отрезке глаза в
вариантах исполнения с принадлежностями»



Рис 1 – Основной блок со встроенными дисплеем с сенсорным экраном, компрессором по типу Вентури, перистальтическим насосом, держателем ёмкости с инфузионным раствором, аккумулятором. Внешний вид



Рис 2 – Основной блок со встроенными дисплеем с сенсорным экраном, компрессором по типу Вентури, перистальтическим насосом, держателем ёмкости с инфузионным раствором, аккумулятором. Маркировка

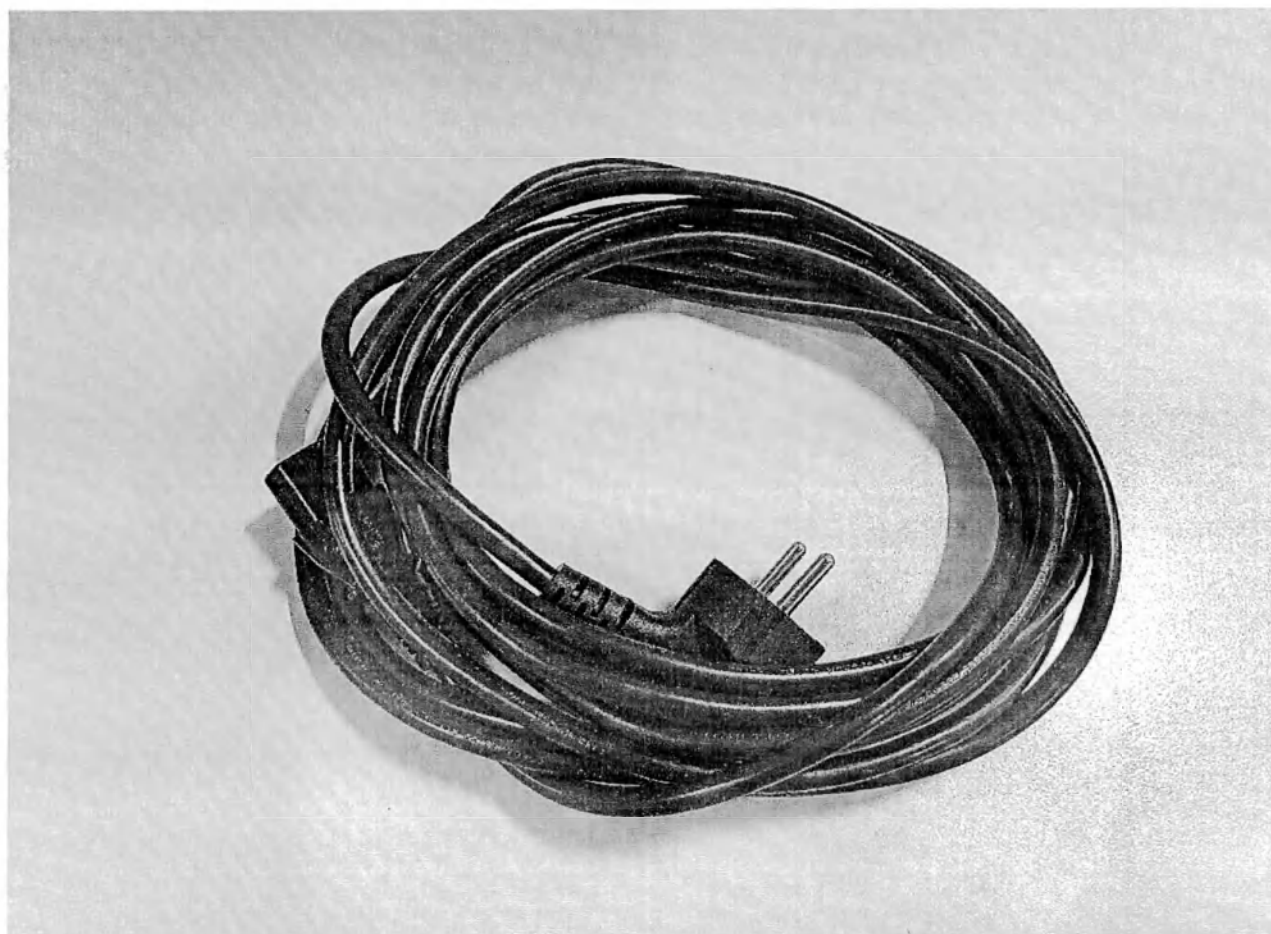


Рис 3 – Кабель питания для системы. Внешний вид



Рис 4 – Инструментальный столик. Внешний вид



Рис 5 – Инструментальный столик. Маркировка

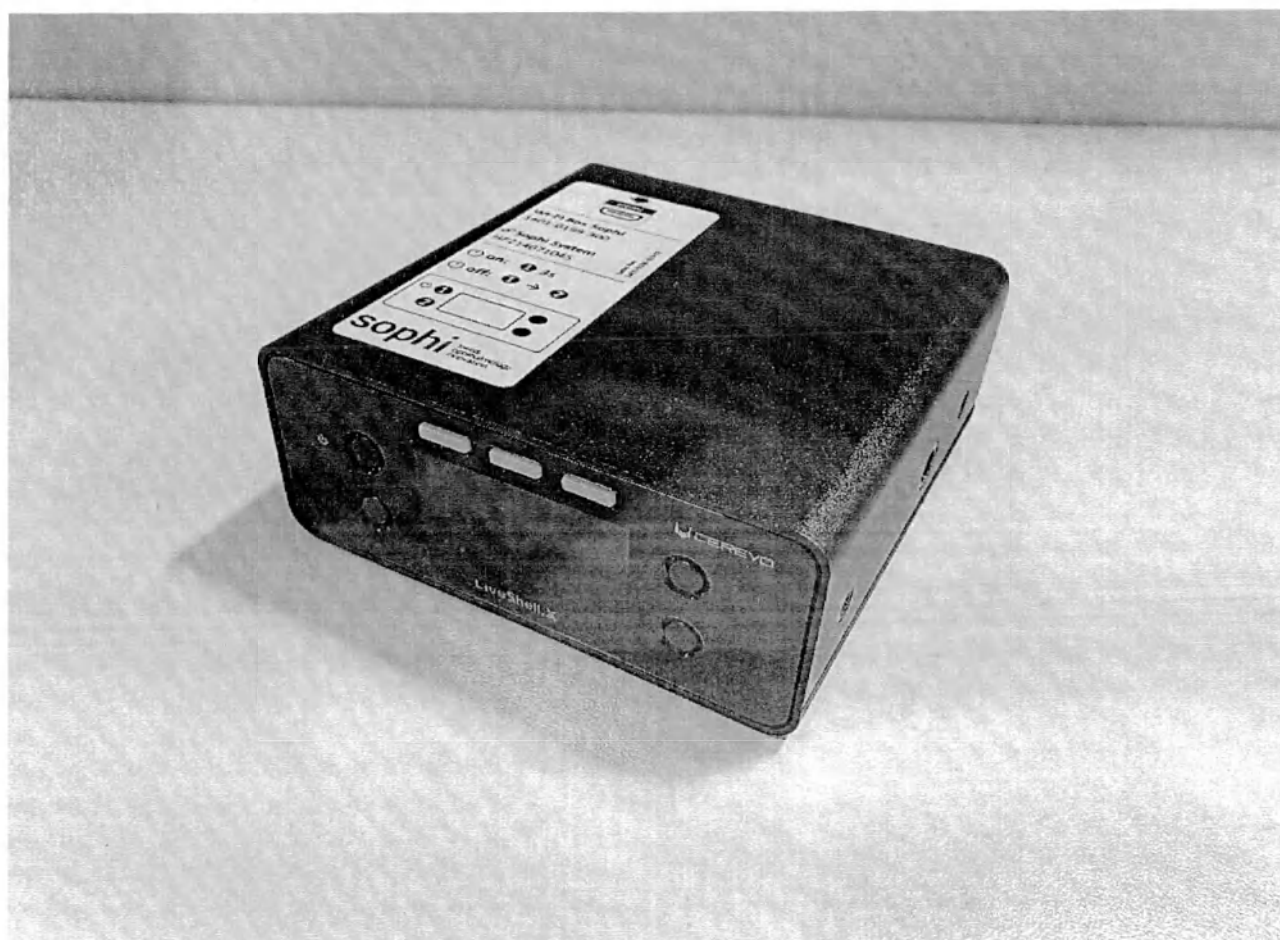


Рис 6 – Устройство для передачи видео по Wi-Fi. Внешний вид



Рис 7 – Устройство для передачи видео по Wi-Fi. Маркировка



Рис 8 – Ножная педаль. Внешний вид



Рис 9 – Ножная педаль. Маркировка

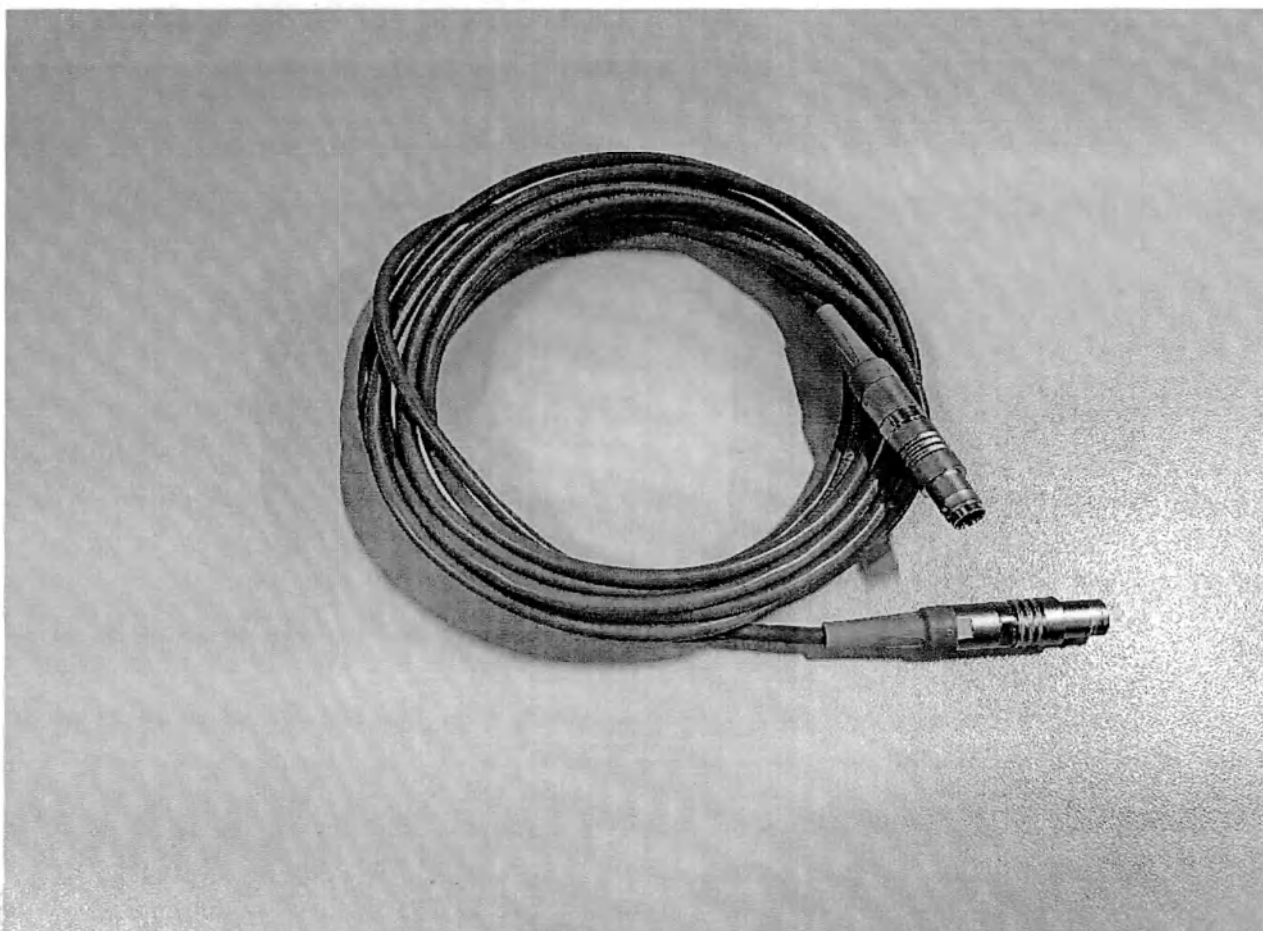


Рис 10 – Кабель для ножной педали. Внешний вид



Рис 11 – Чехол для консоли. Внешний вид

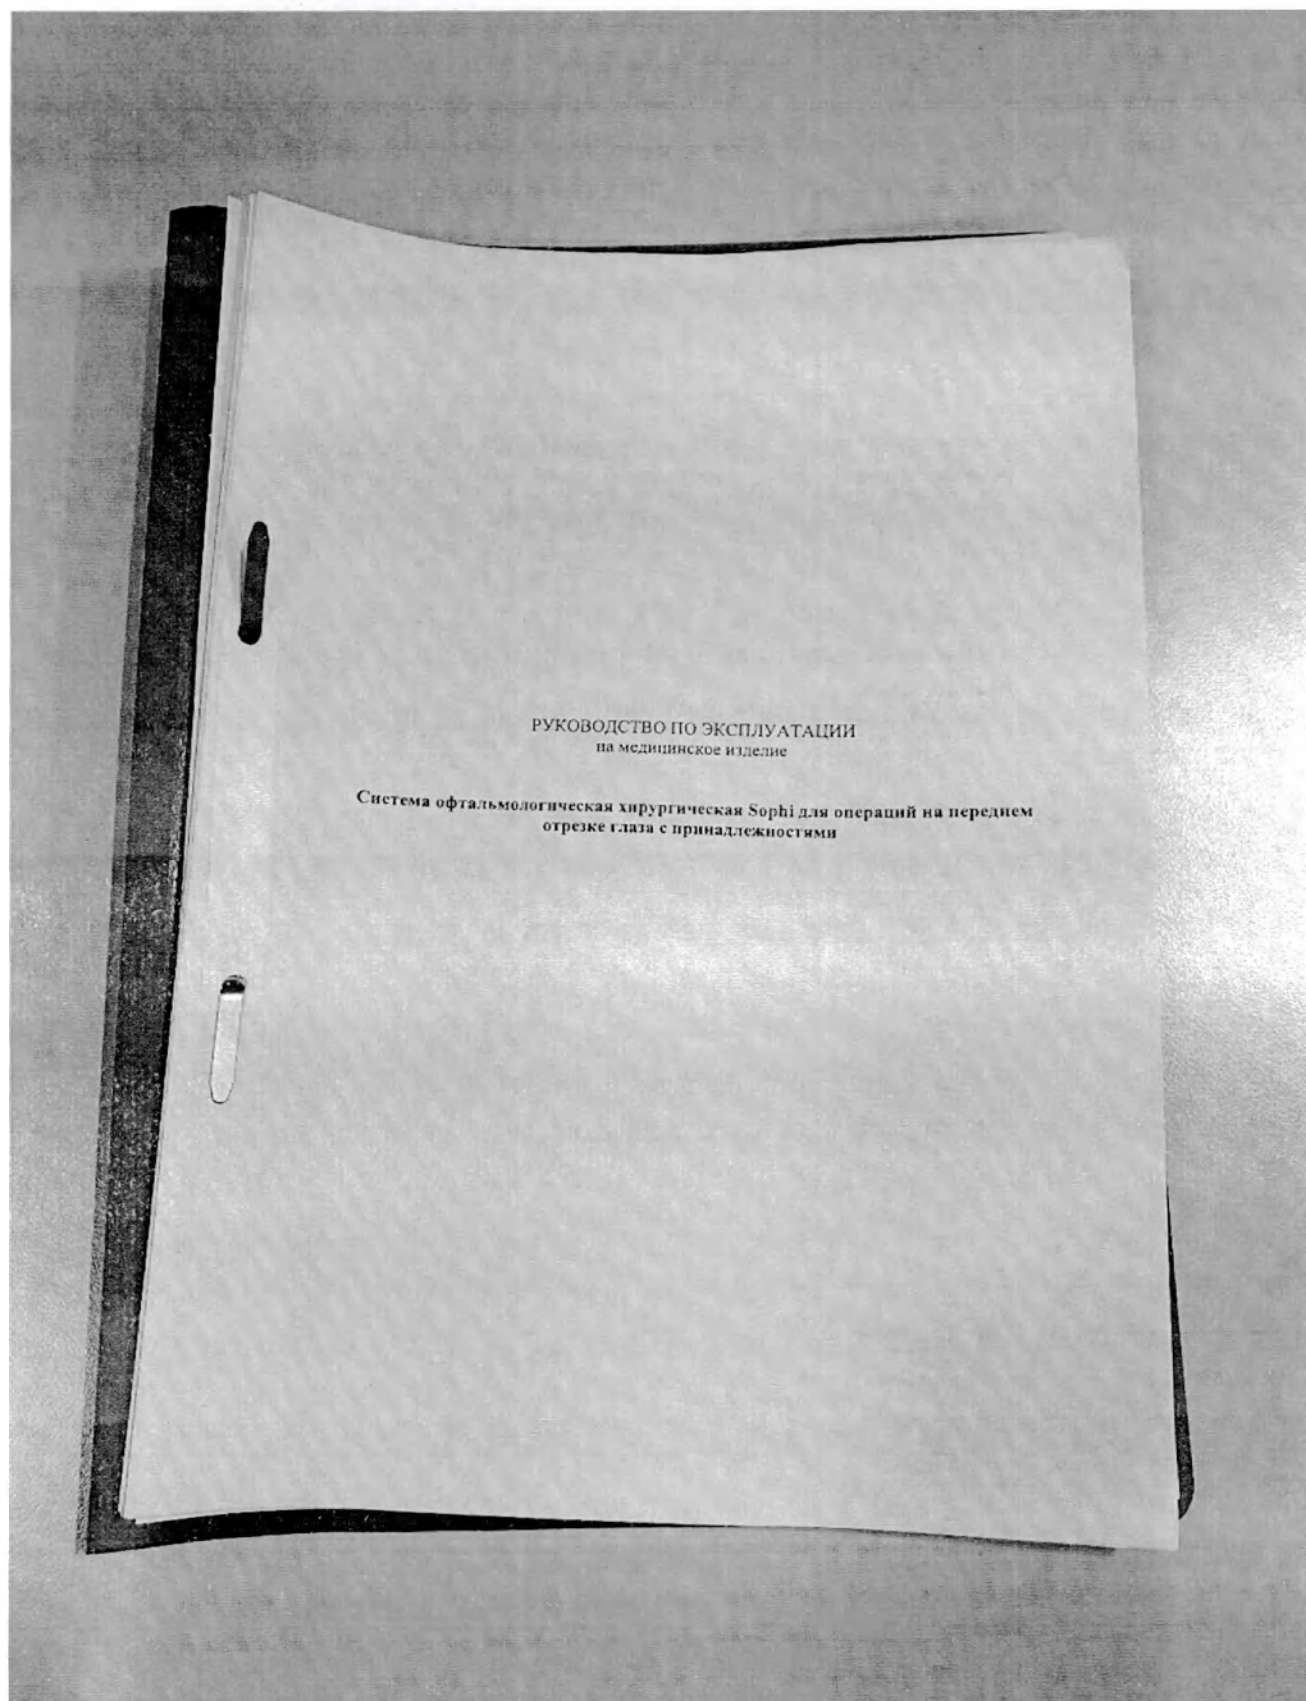


Рис 12 – Руководство по эксплуатации. Внешний вид

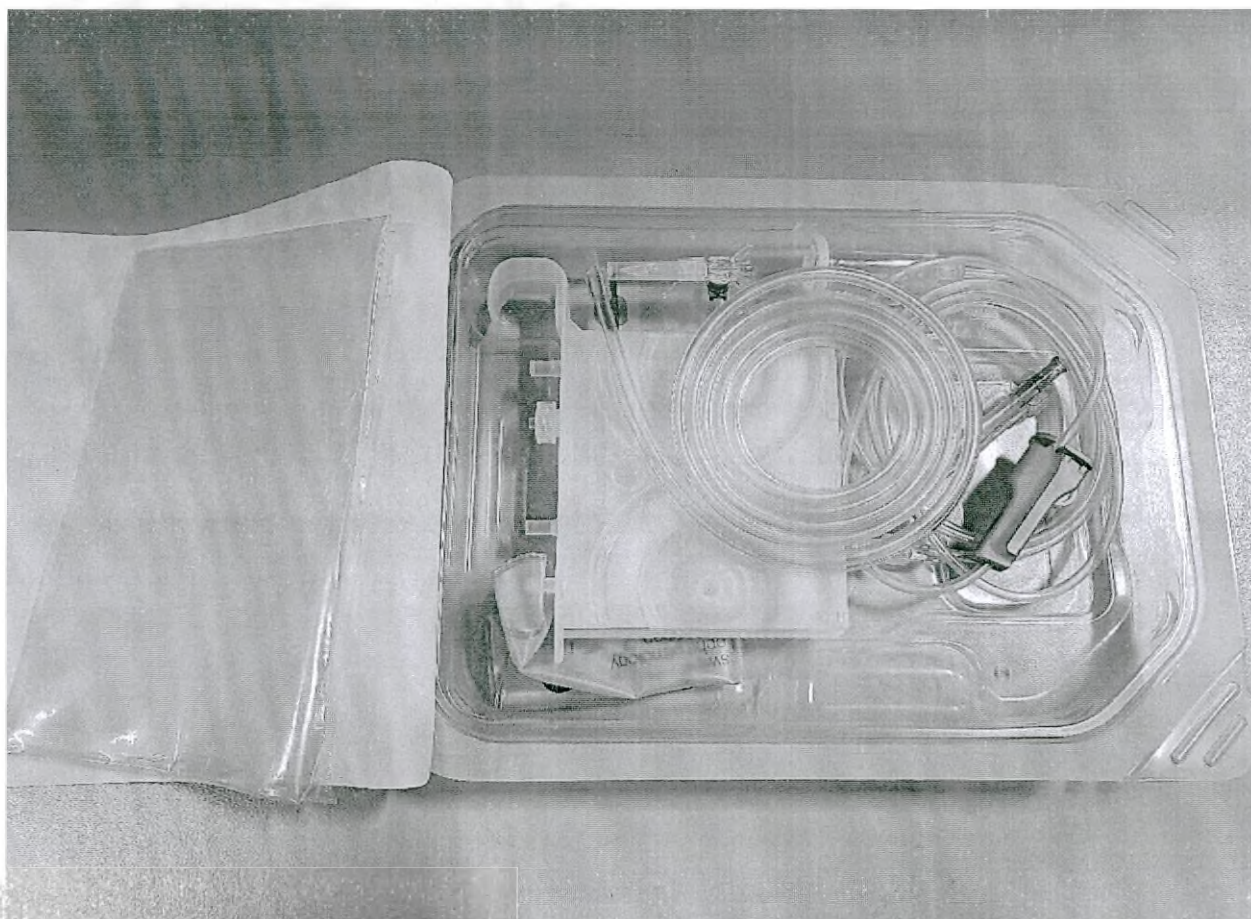


Рис 13 – Набор кассетный для Sophi с перистальтической помпой. Внешний вид

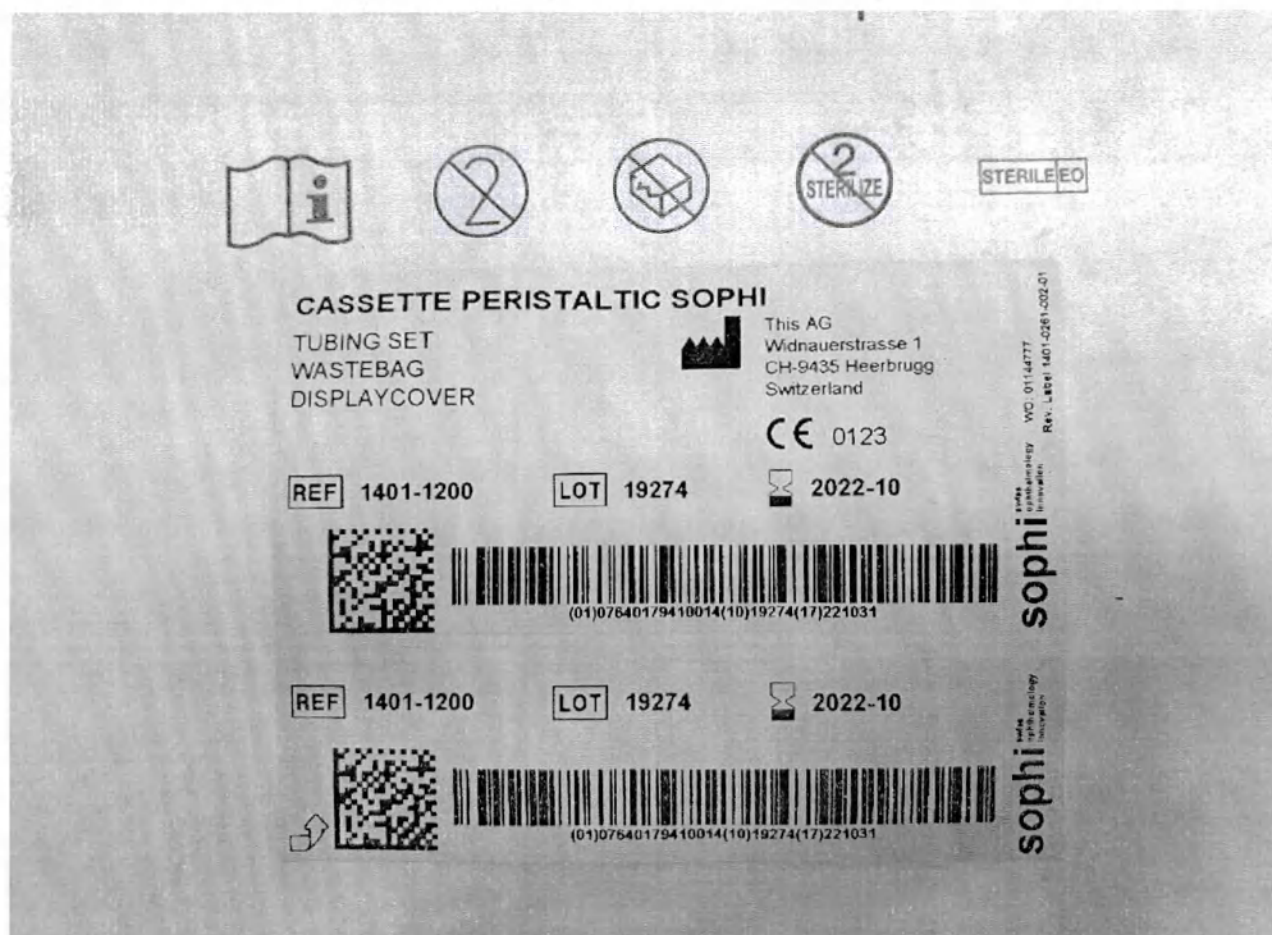


Рис 14 – Набор кассетный для Sophi с перистальтической помпой. Маркировка

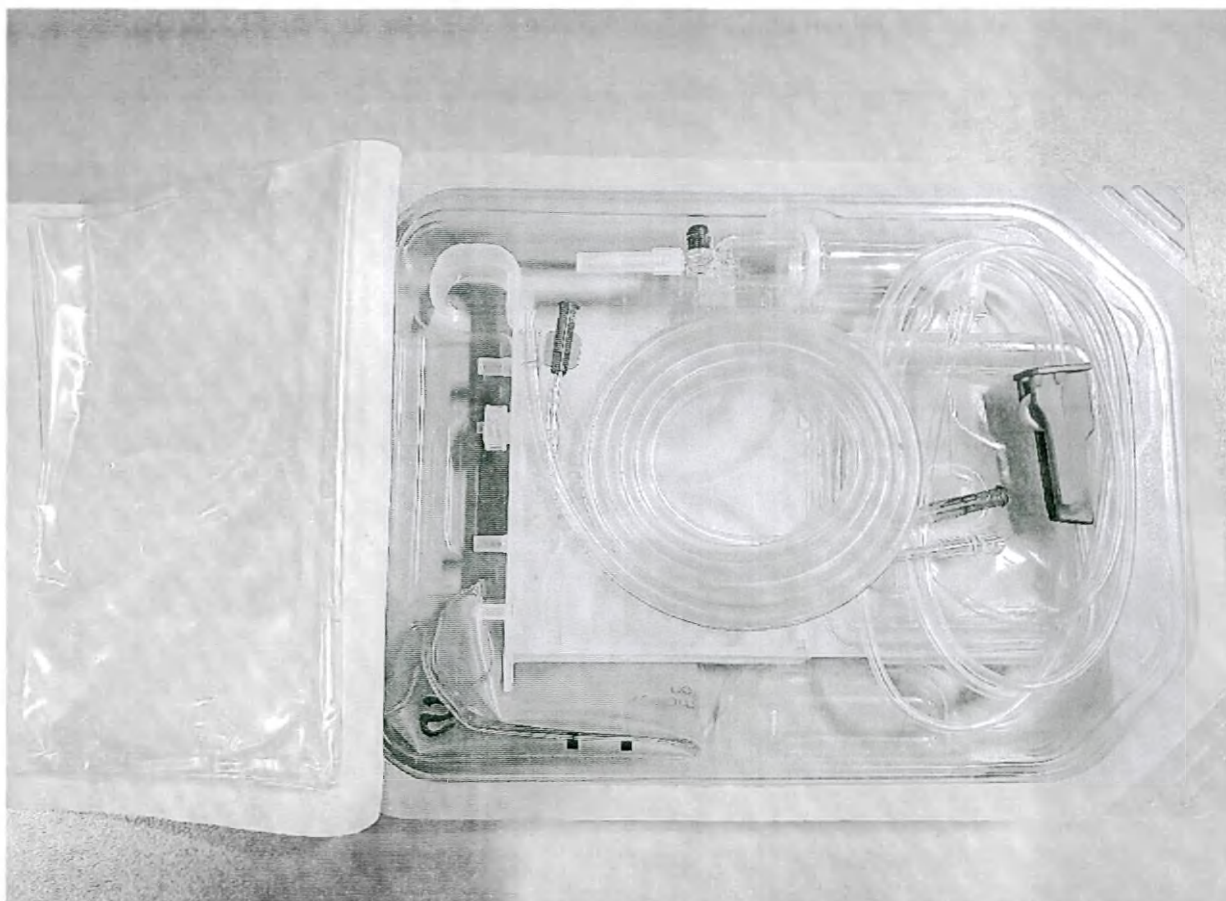


Рис 15 – Набор кассетный для Sophi с перистальтической помпой и помпой Вентури.
Внешний вид



Рис 16 – Набор кассетный для Sophi с перистальтической помпой и помпой Вентури.
Маркировка

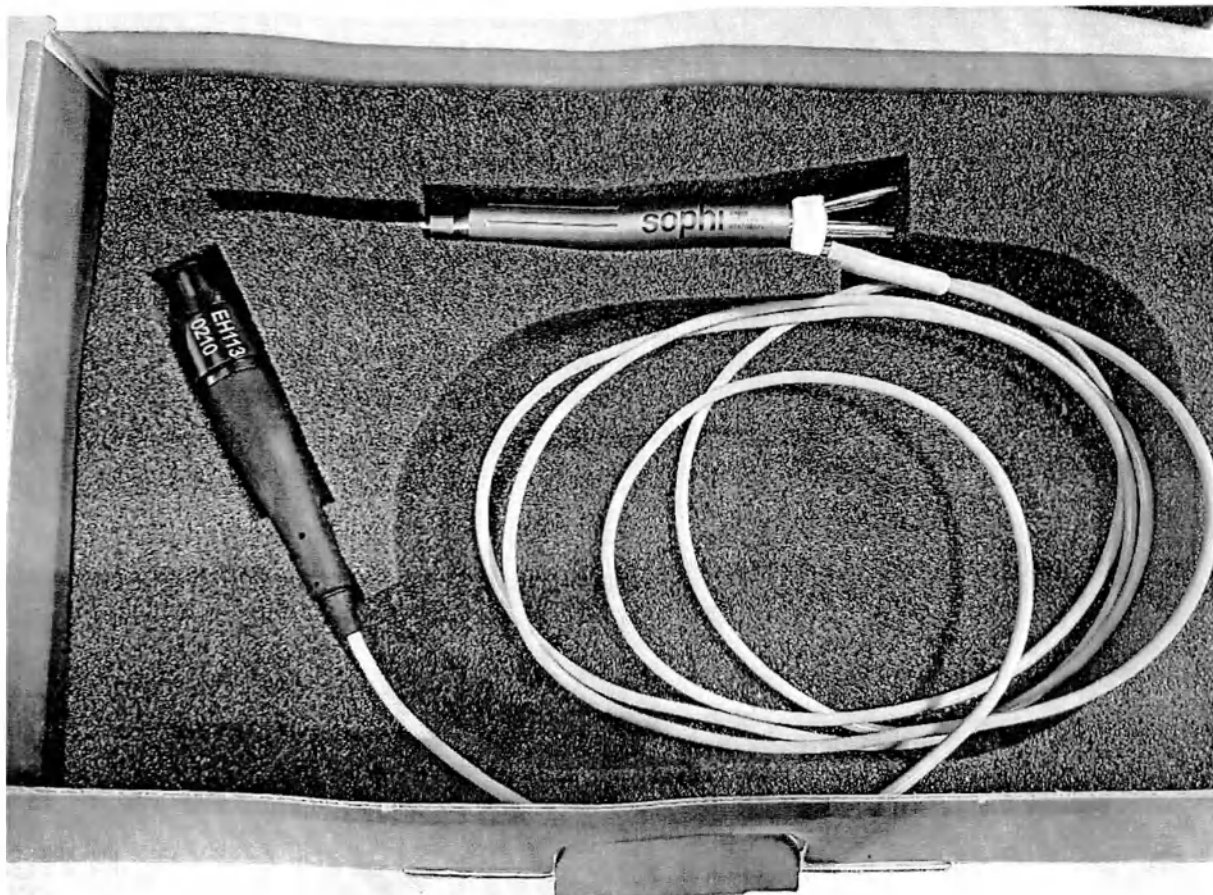


Рис 19 – Ультразвуковая фако рукоятка. Внешний вид



Рис 20 – Ультразвуковая фако рукоятка. Маркировка

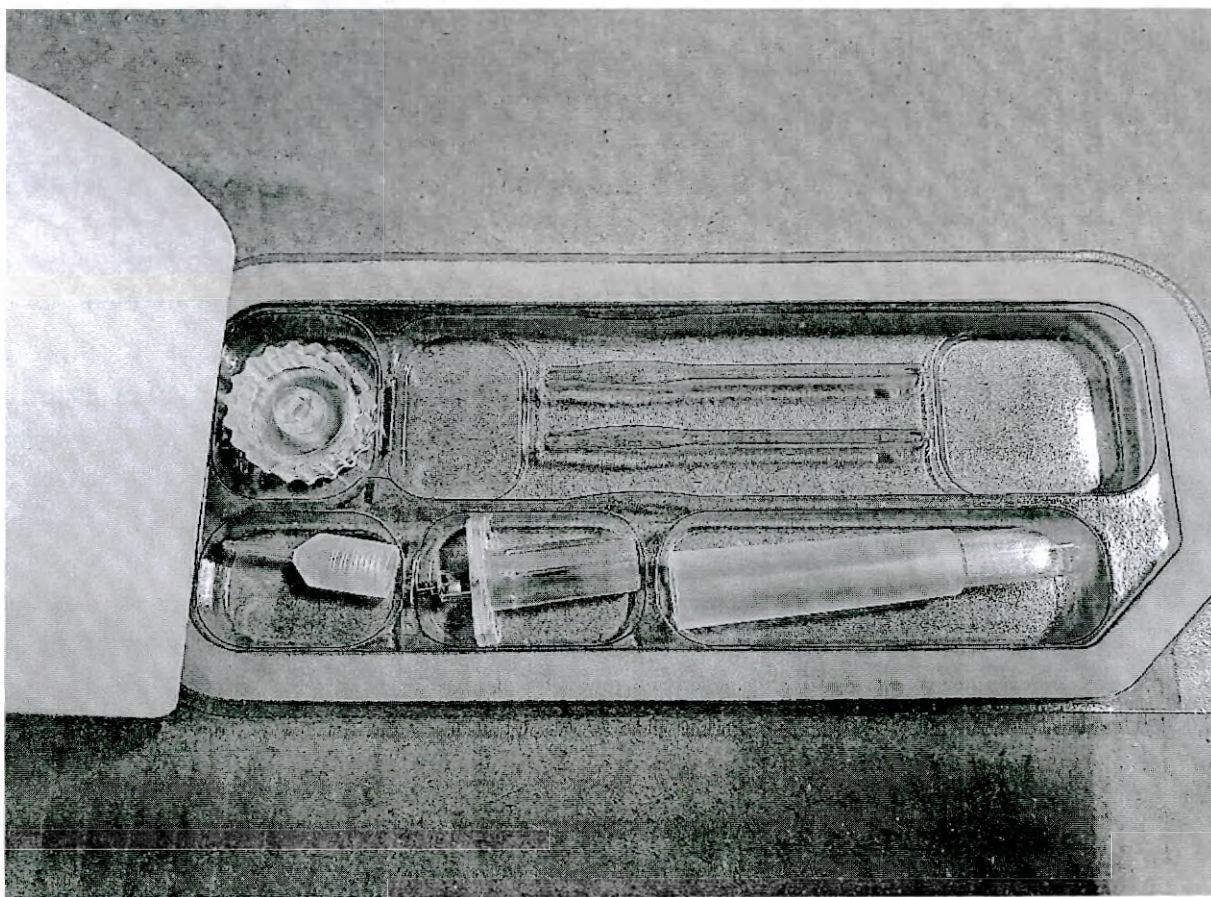


Рис 21 – Набор одноразовый для факэмульсификации 20G/30° на разрез 2.5–2.75 мм.
Внешний вид



Рис 22 – Набор одноразовый для факэмульсификации 20G/30° на разрез 2.5–2.75 мм.
Маркировка

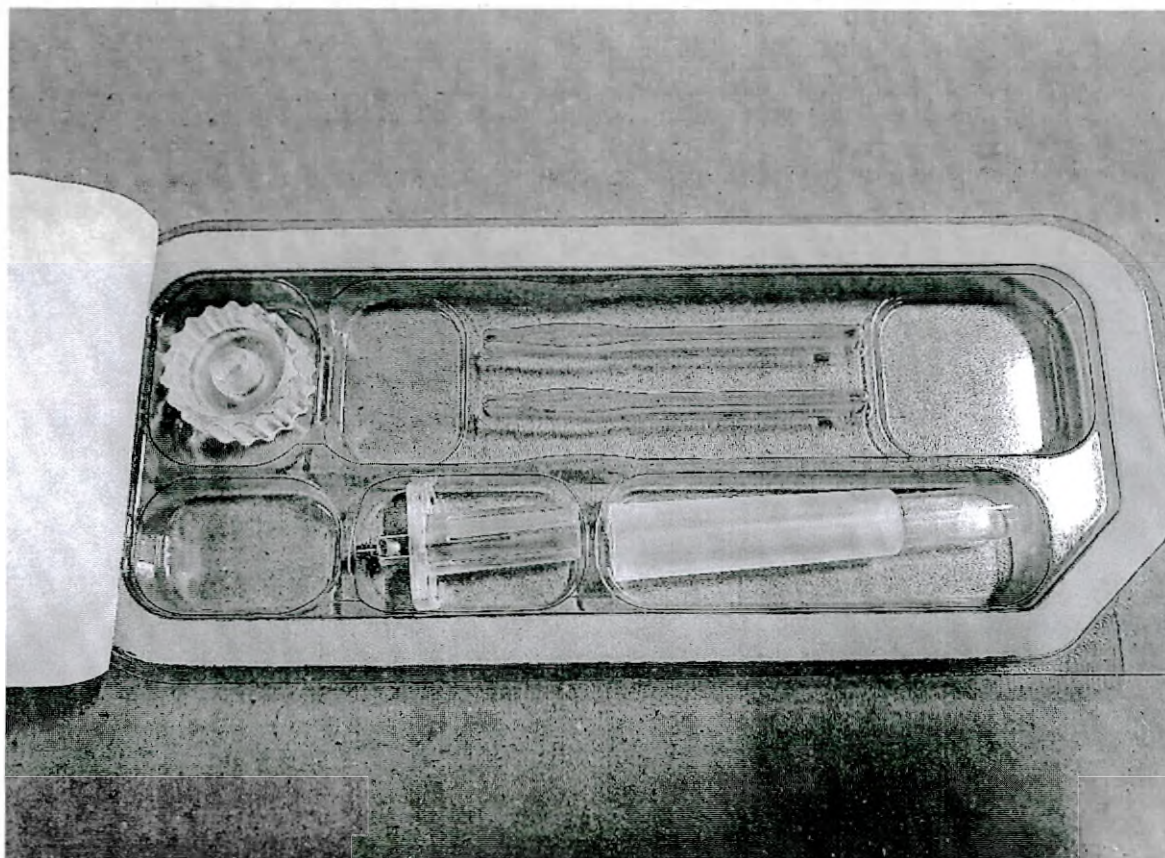


Рис 23 – Набор одноразовый для факэмульсификации 21G/30° на разрез 2.2–2.4 мм.
Внешний вид

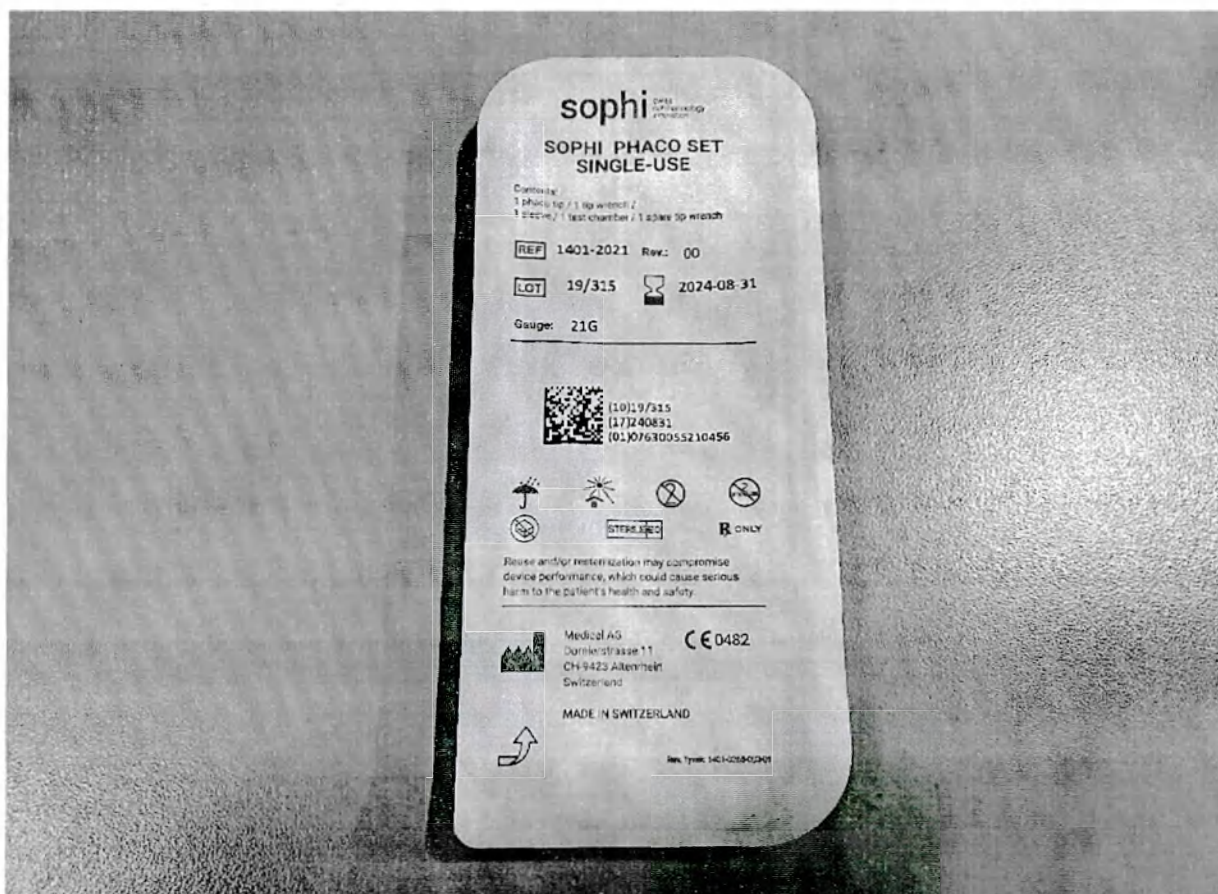


Рис 24 – Набор одноразовый для факэмульсификации 21G/30° на разрез 2.2–2.4 мм.
Маркировка

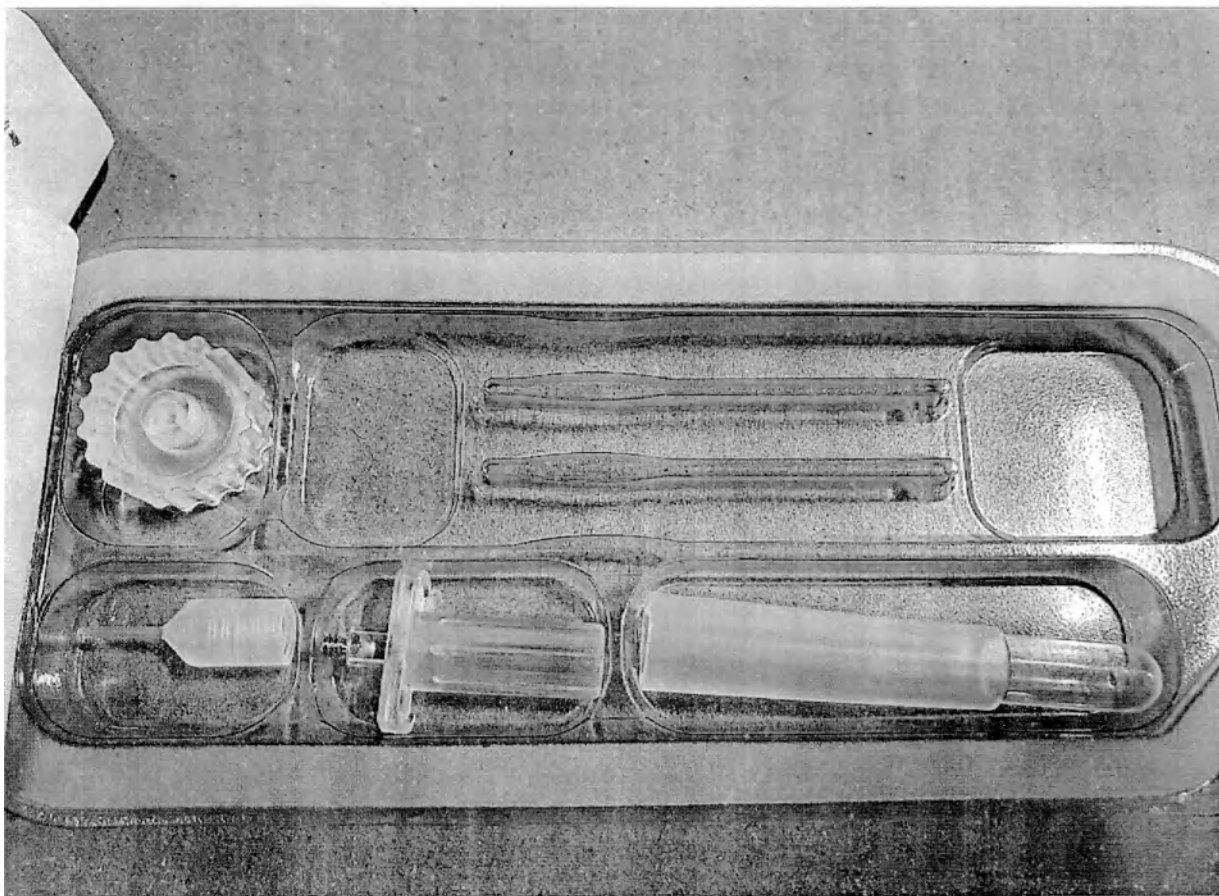


Рис 25 – Набор одноразовый для факэмульсификации 23G/30° на разрез 1.8–2.0 мм.
Внешний вид



Рис 26 – Набор одноразовый для факэмульсификации 23G/30° на разрез 1.8–2.0 мм.
Маркировка

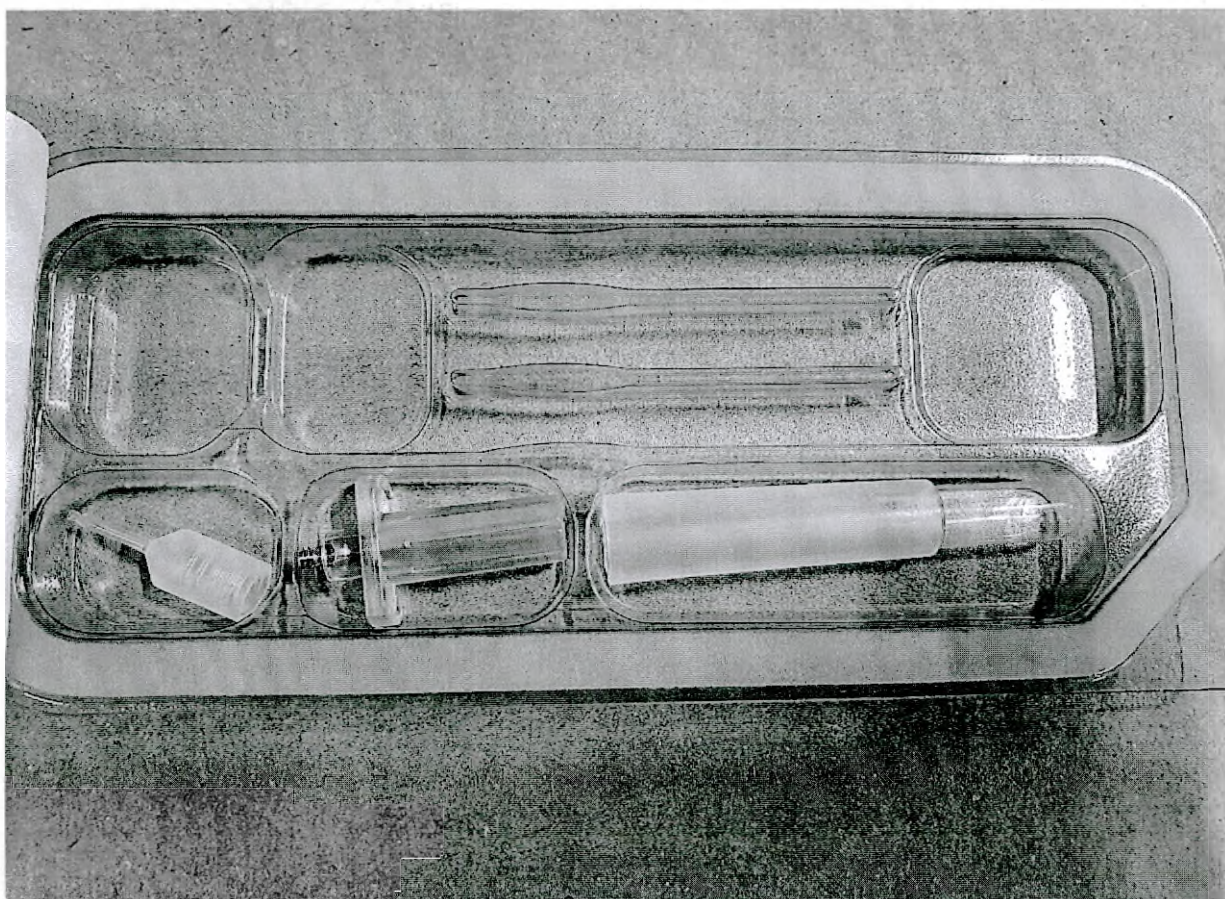


Рис 27 – Набор многоразовый для факоэмульсификации 20G/30° на разрез 2.5–2.75 мм.
Внешний вид



Рис 28 – Набор многоразовый для факоэмульсификации 20G/30° на разрез 2.5–2.75 мм.
Маркировка

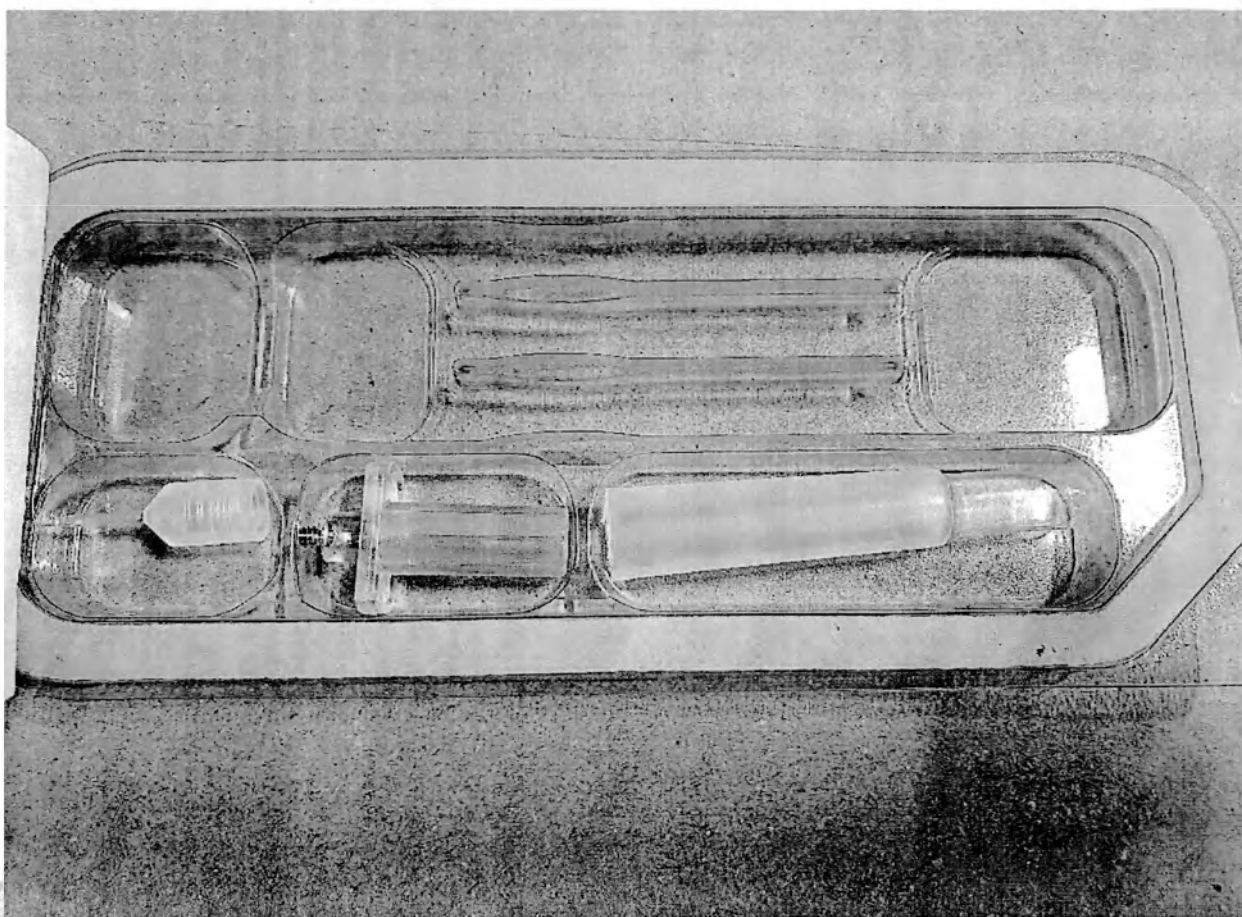


Рис 29 – Набор многоразовый для факэмульсификации 21G/30° на разрез 2.2–2.4 мм.
Внешний вид



Рис 30 – Набор многоразовый для факэмульсификации 21G/30° на разрез 2.2–2.4 мм.
Маркировка

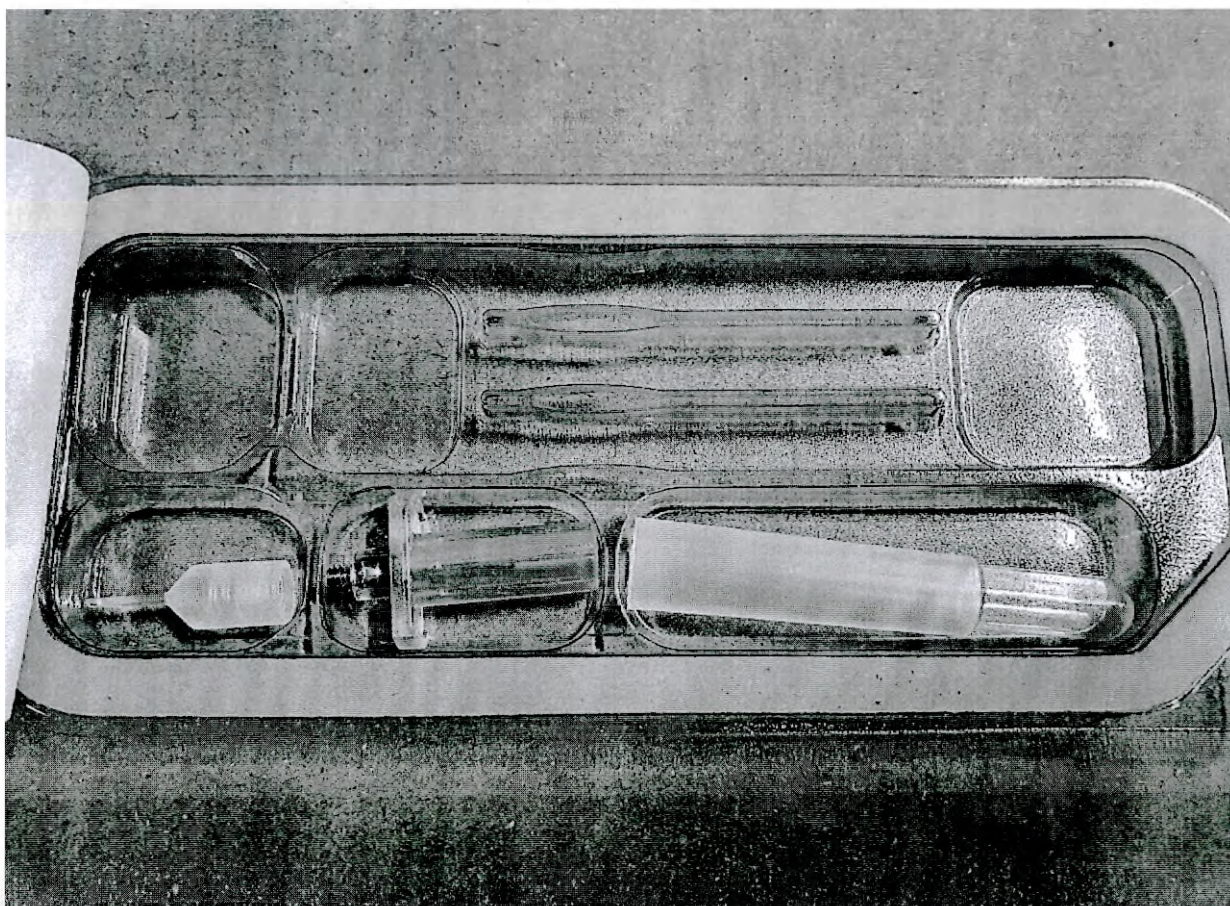


Рис 31 – Набор многоразовый для факэмульсификации 23G/30° на разрез 1.8–2.0 мм.
Внешний вид



Рис 32 – Набор многоразовый для факэмульсификации 23G/30° на разрез 1.8–2.0 мм.
Маркировка

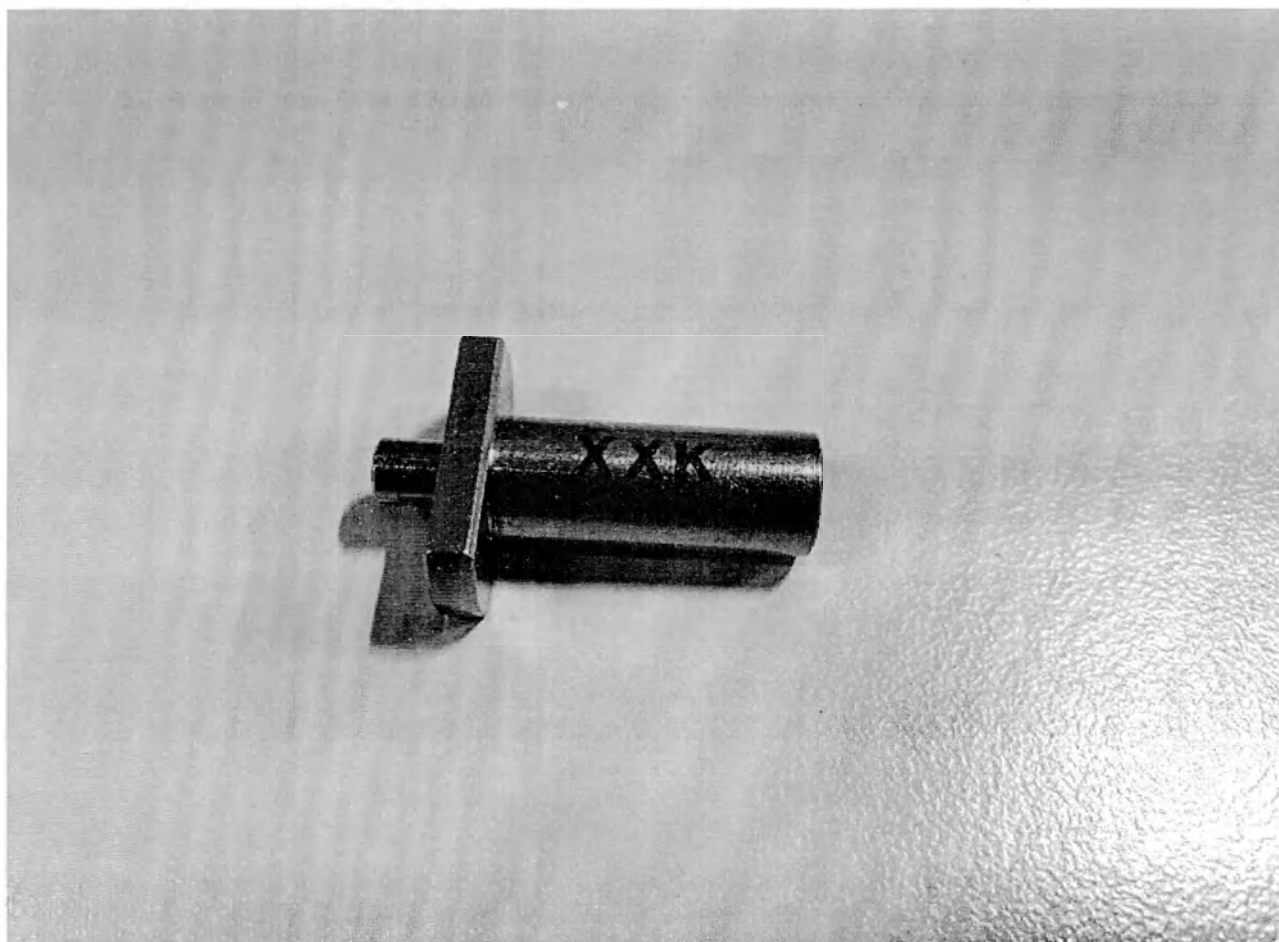


Рис 33 – Универсальный многоразовый ключ для факоигл. Внешний вид



Рис 34 – Универсальный многоразовый ключ для факоигл. Внешний вид

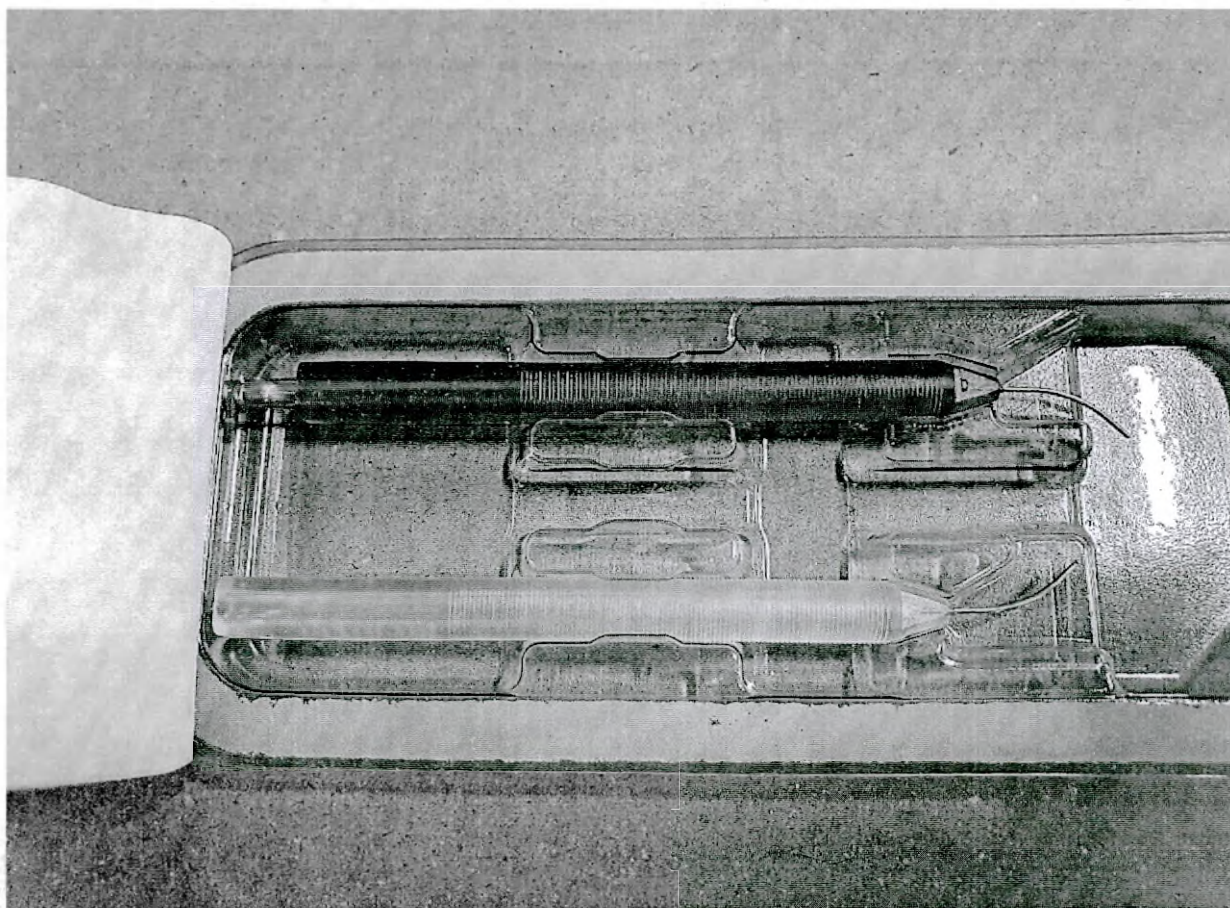


Рис 35 – Комплект рукояток для бимануальной ирригации и аспирации 21G. Внешний вид



Рис 36 – Комплект рукояток для бимануальной ирригации и аспирации 21G. Маркировка

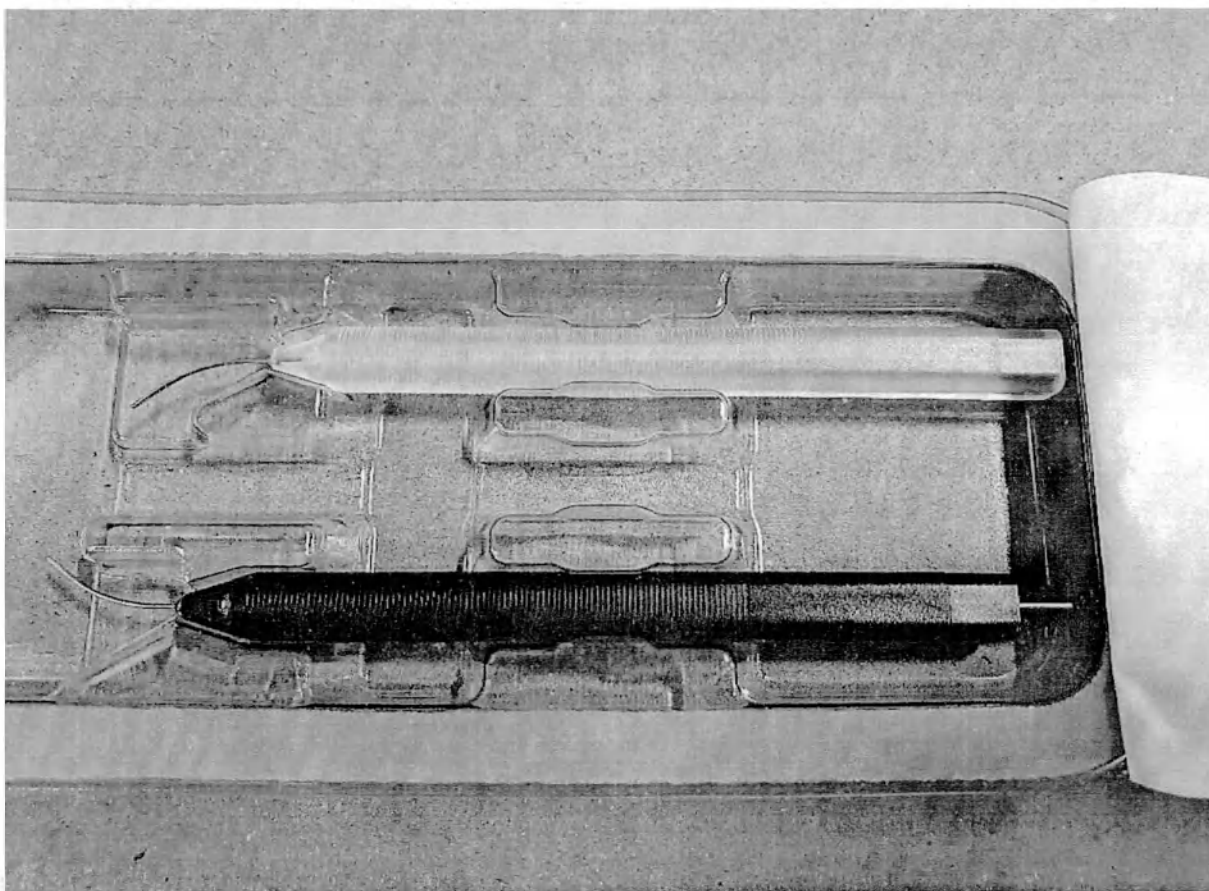


Рис 37 – Комплект рукояток для бимануальной ирригации и аспирации 23G. Внешний вид



Рис 38 – Комплект рукояток для бимануальной ирригации и аспирации 23G. Маркировка

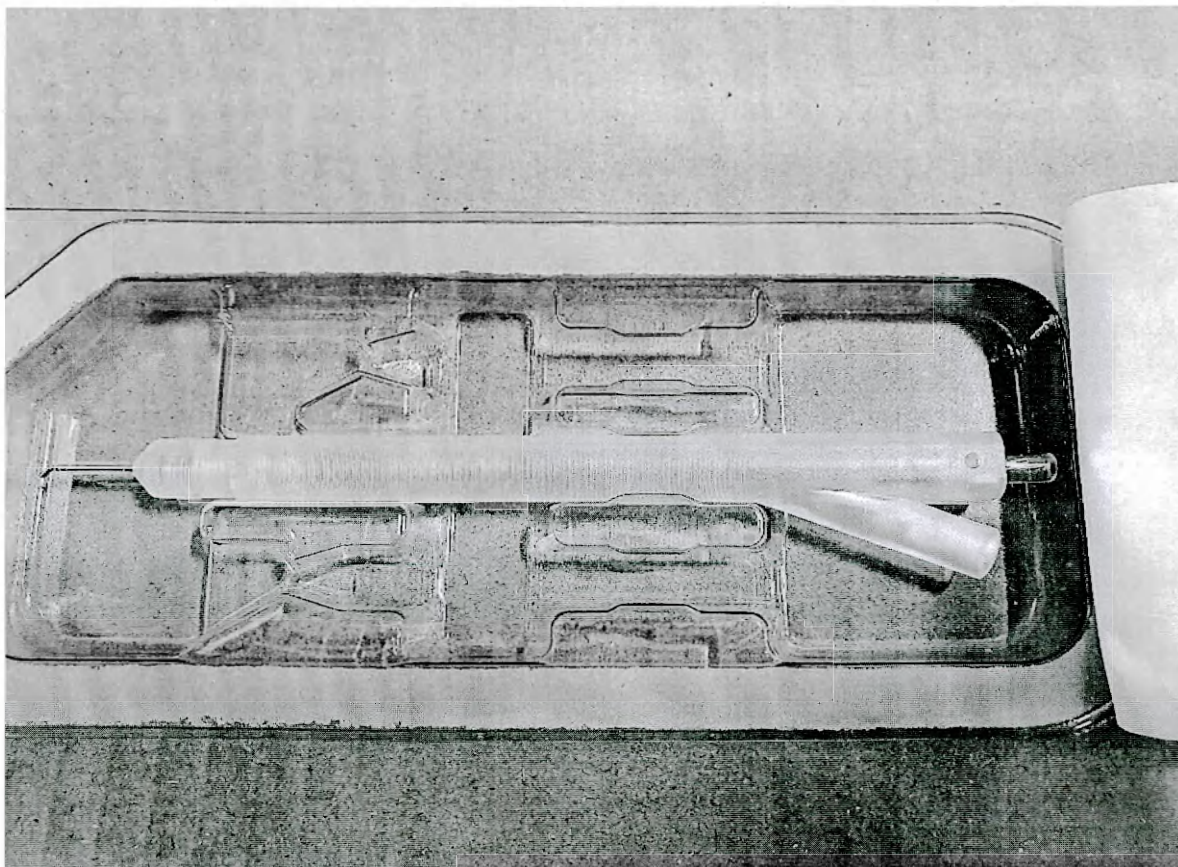


Рис 39 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 20G/45°. Внешний вид



Рис 40 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 20G/45°. Маркировка

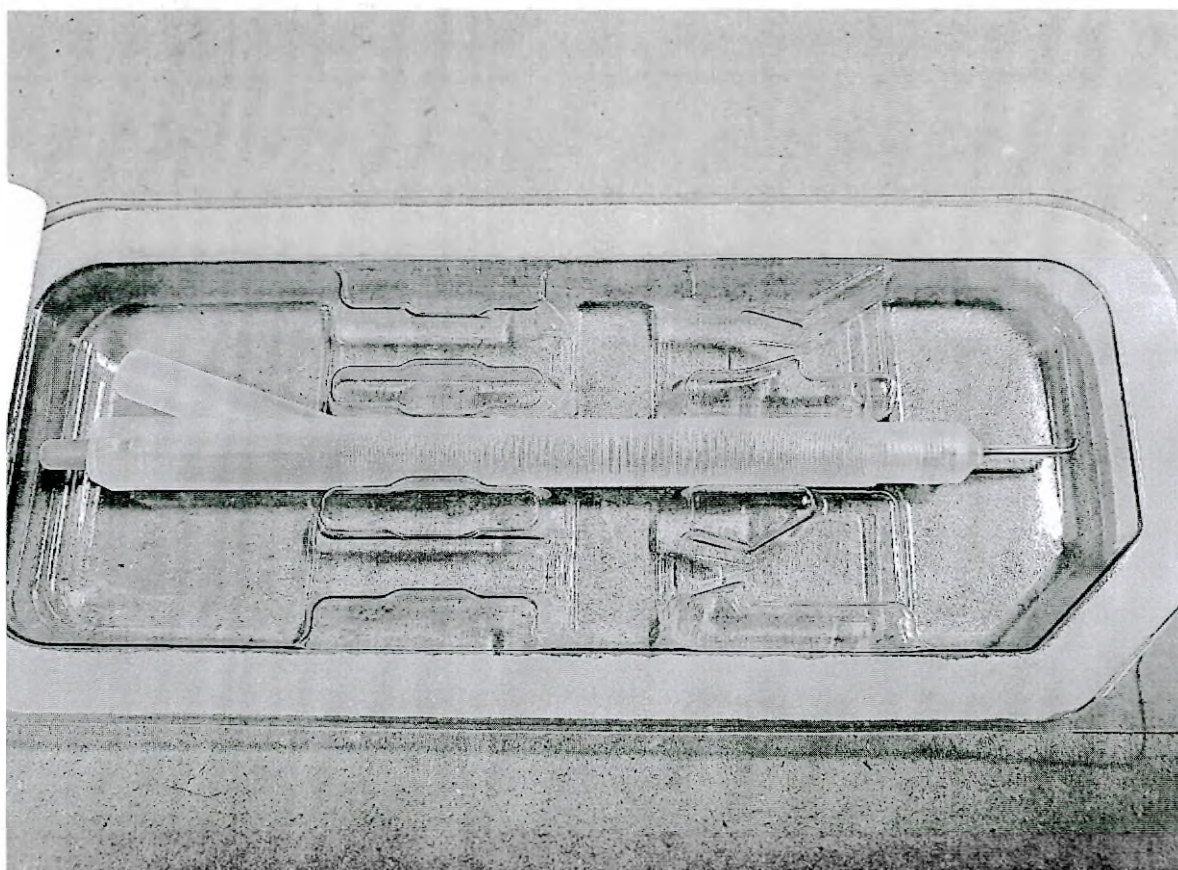


Рис 41 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 20G/65°. Внешний вид



Рис 42 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 20G/65°. Маркировка

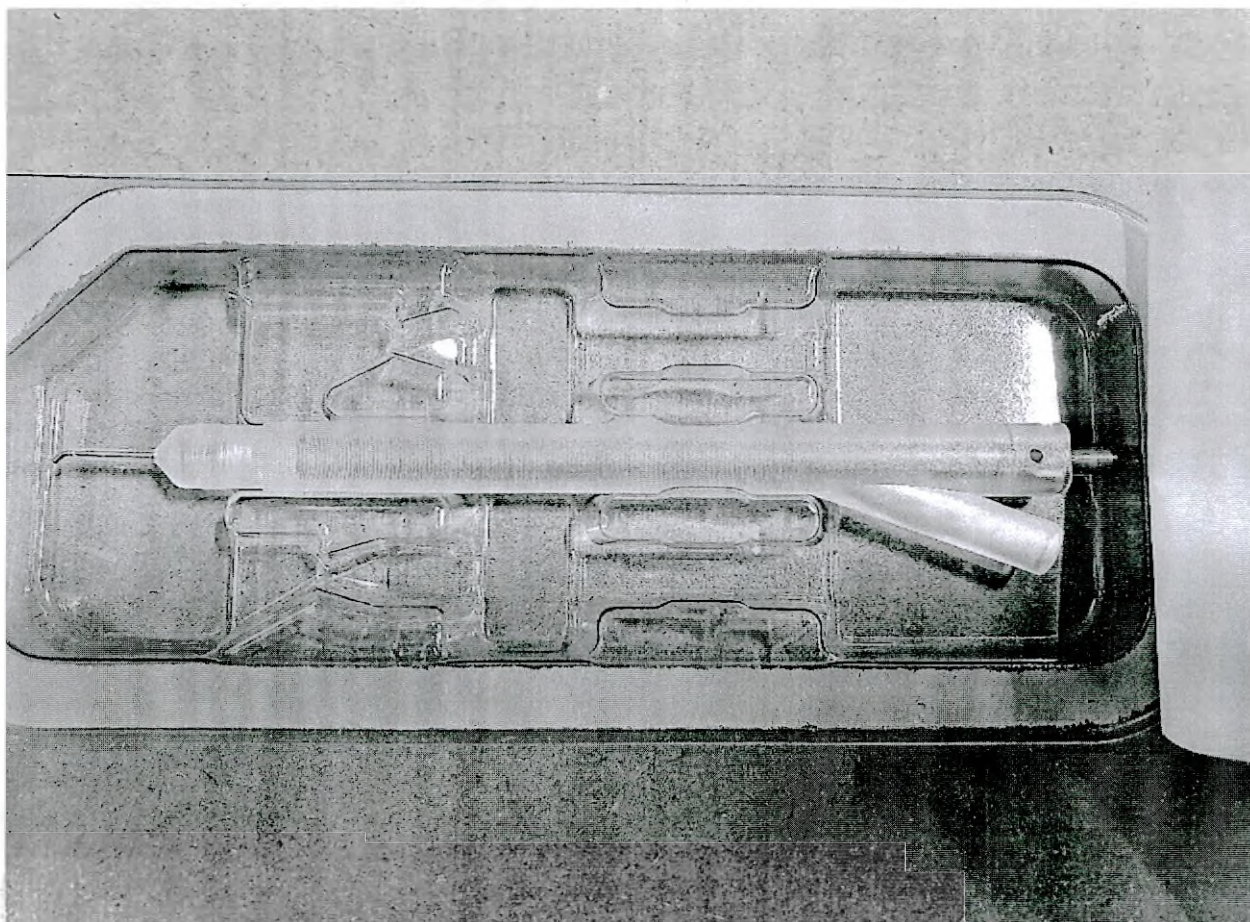


Рис 43 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 21G/45°. Внешний вид



Рис 44 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 21G/45°. Маркировка



Рис 45 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 23G/45°. Внешний вид



Рис 46 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 23G/45°. Маркировка

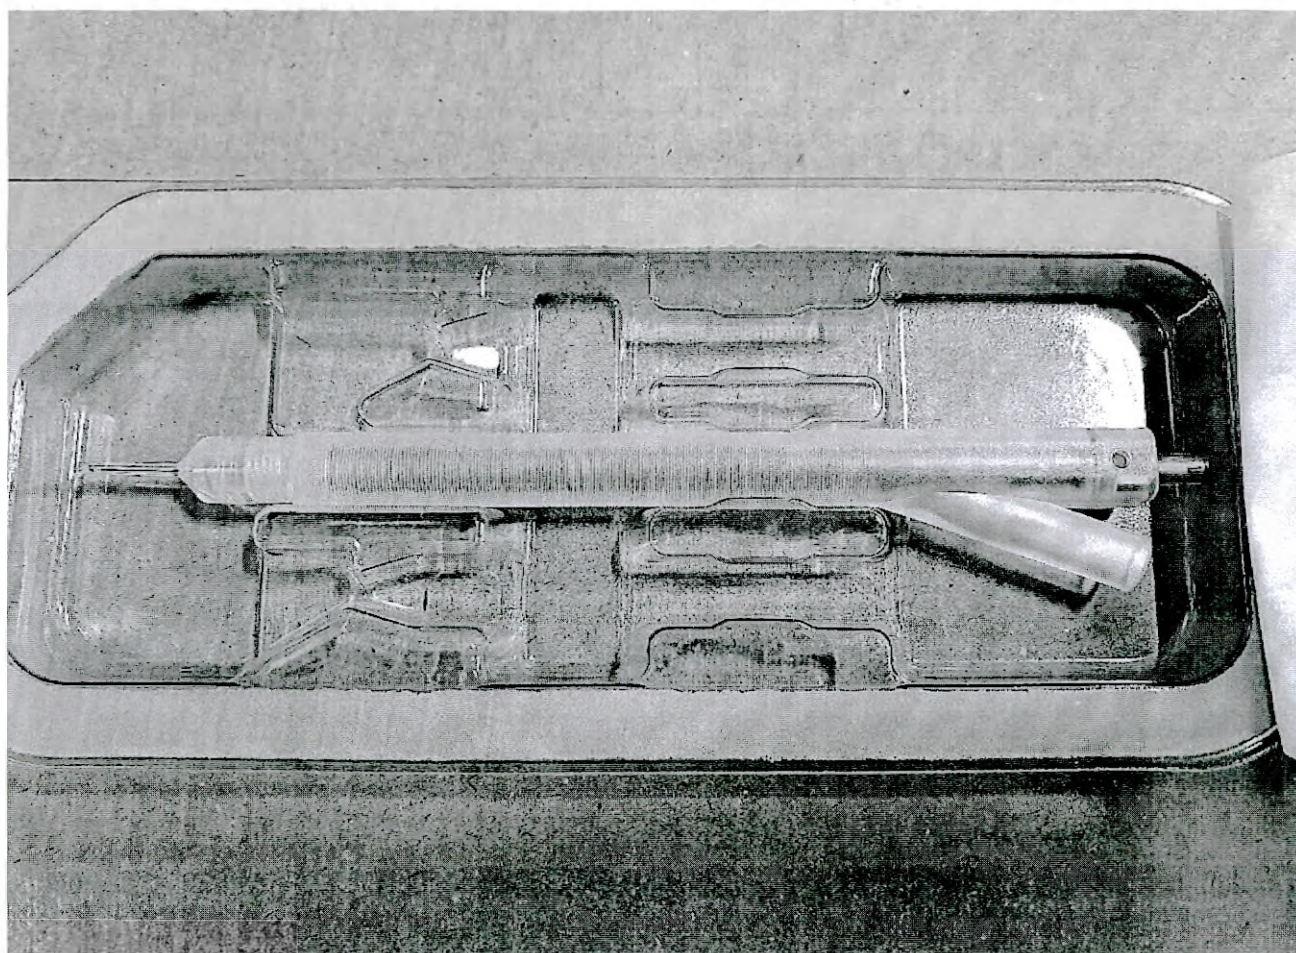


Рис 47 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 21G/45°. Внешний вид

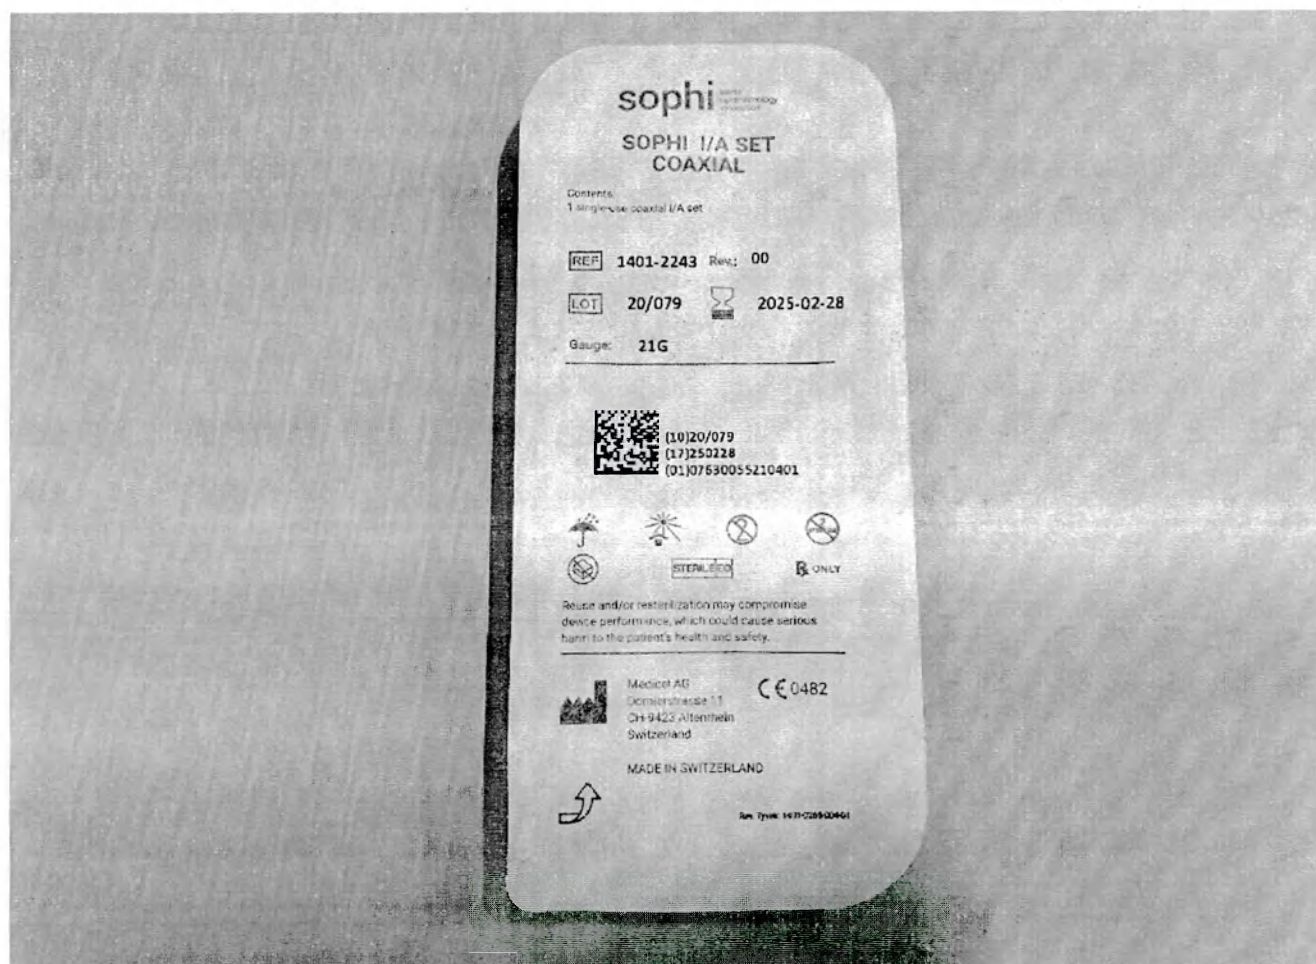


Рис 48 – Комплект рукояток для коаксиальной ирригации и аспирации 21G/45°. Маркировка

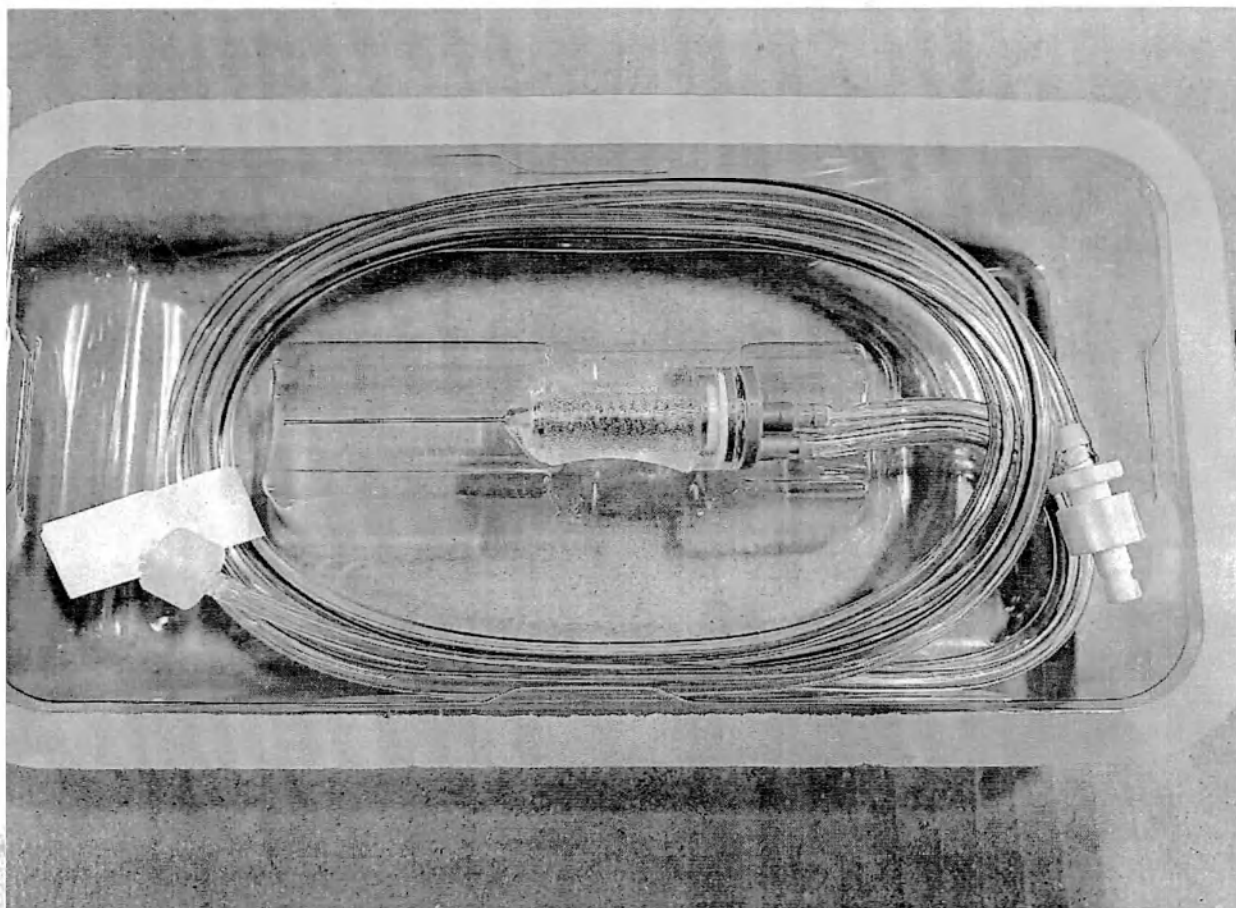


Рис 49 – Витректор для передней витректомии 23G/2000 резов/мин. Внешний вид

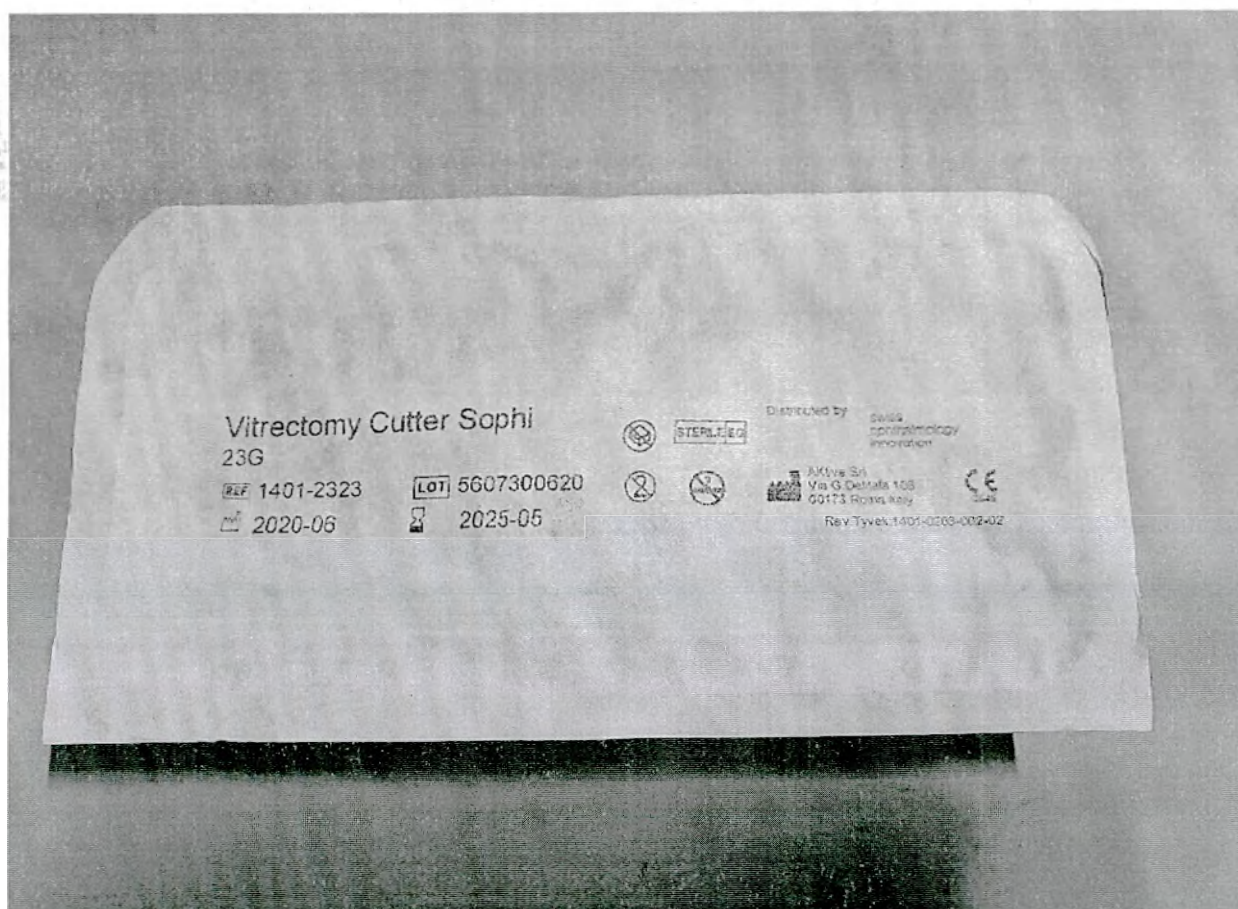


Рис 50 – Витректор для передней витректомии 23G/2000 резов/мин. Маркировка

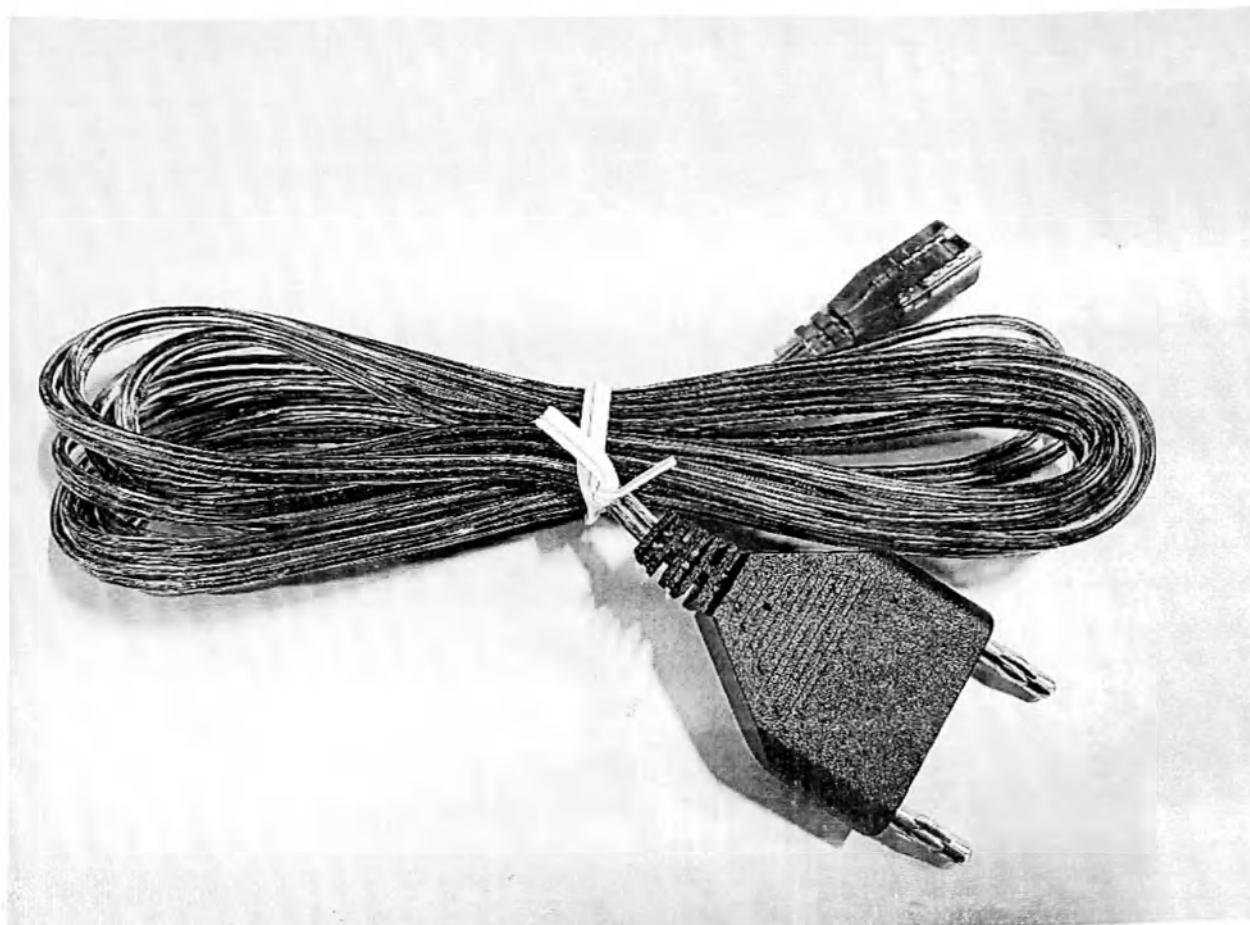


Рис 51 – Биполярный одноразовый диатермический кабель. Внешний вид



Рис 52 – Биполярный одноразовый диатермический кабель. Маркировка

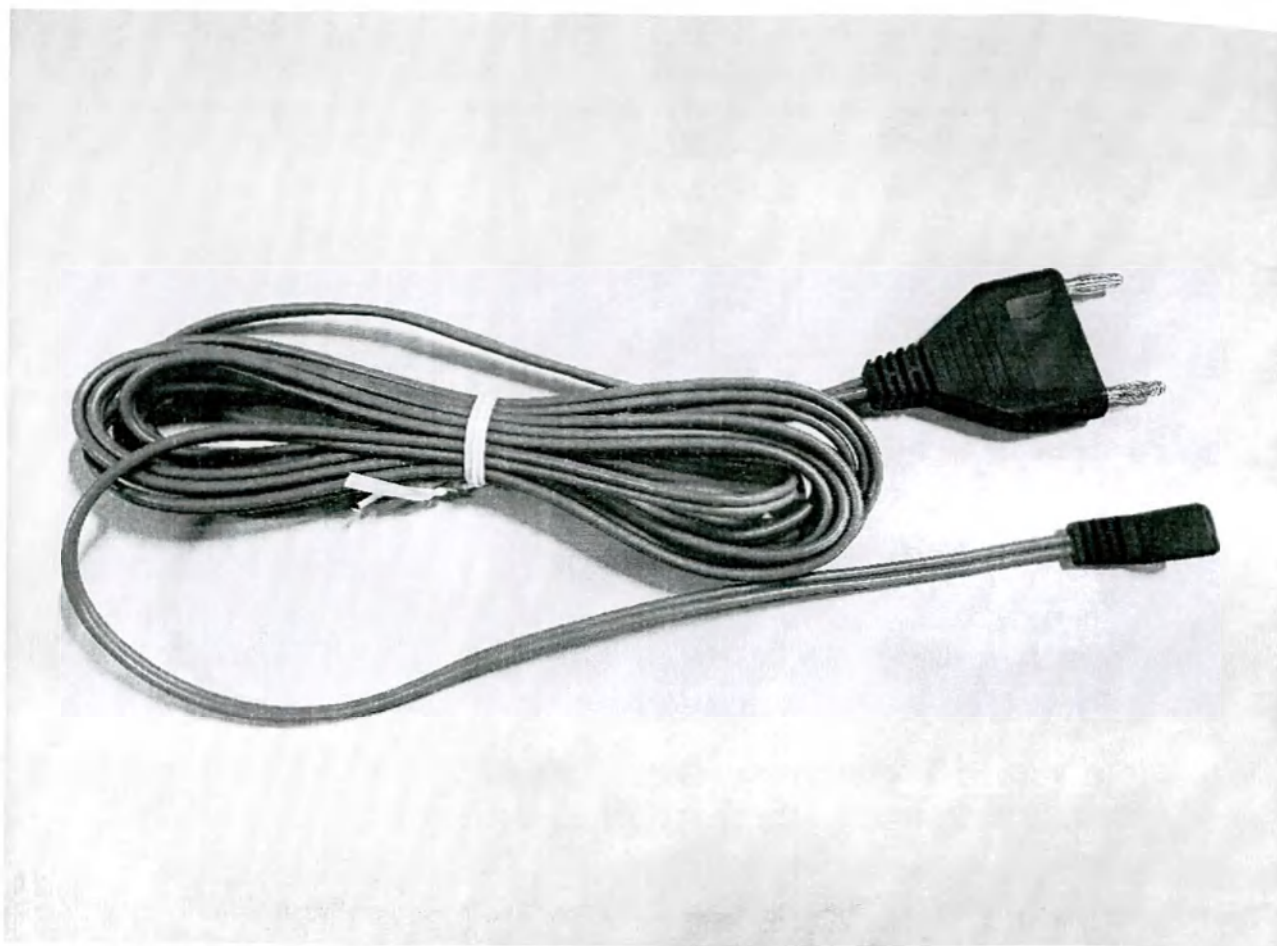


Рис 53 – Биполярный многожильный диатермический кабель. Внешний вид



Рис 54 – Биполярный одножильный диатермический кабель. Маркировка

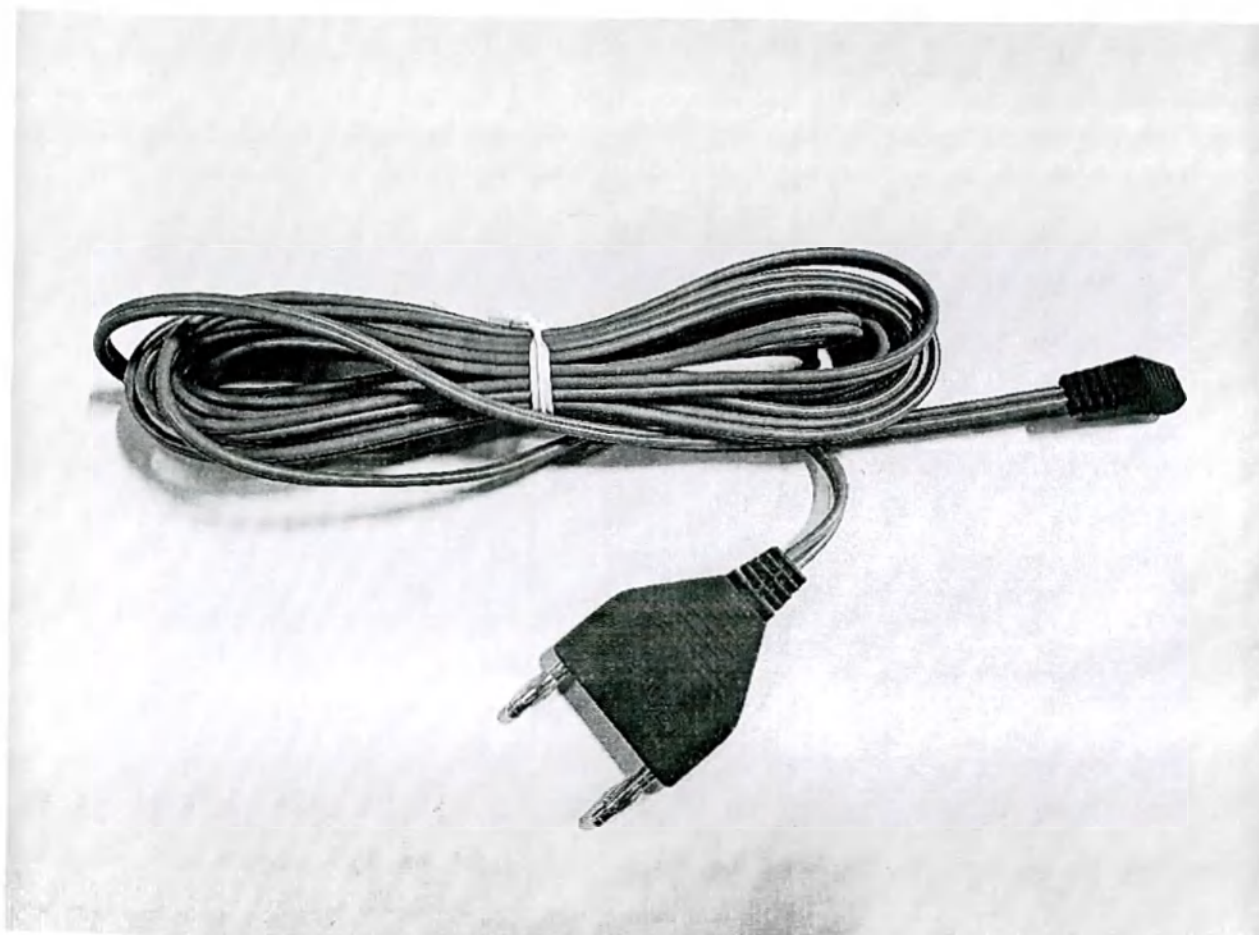


Рис 55 – Биполярный многожильный диатермический кабель. Внешний вид

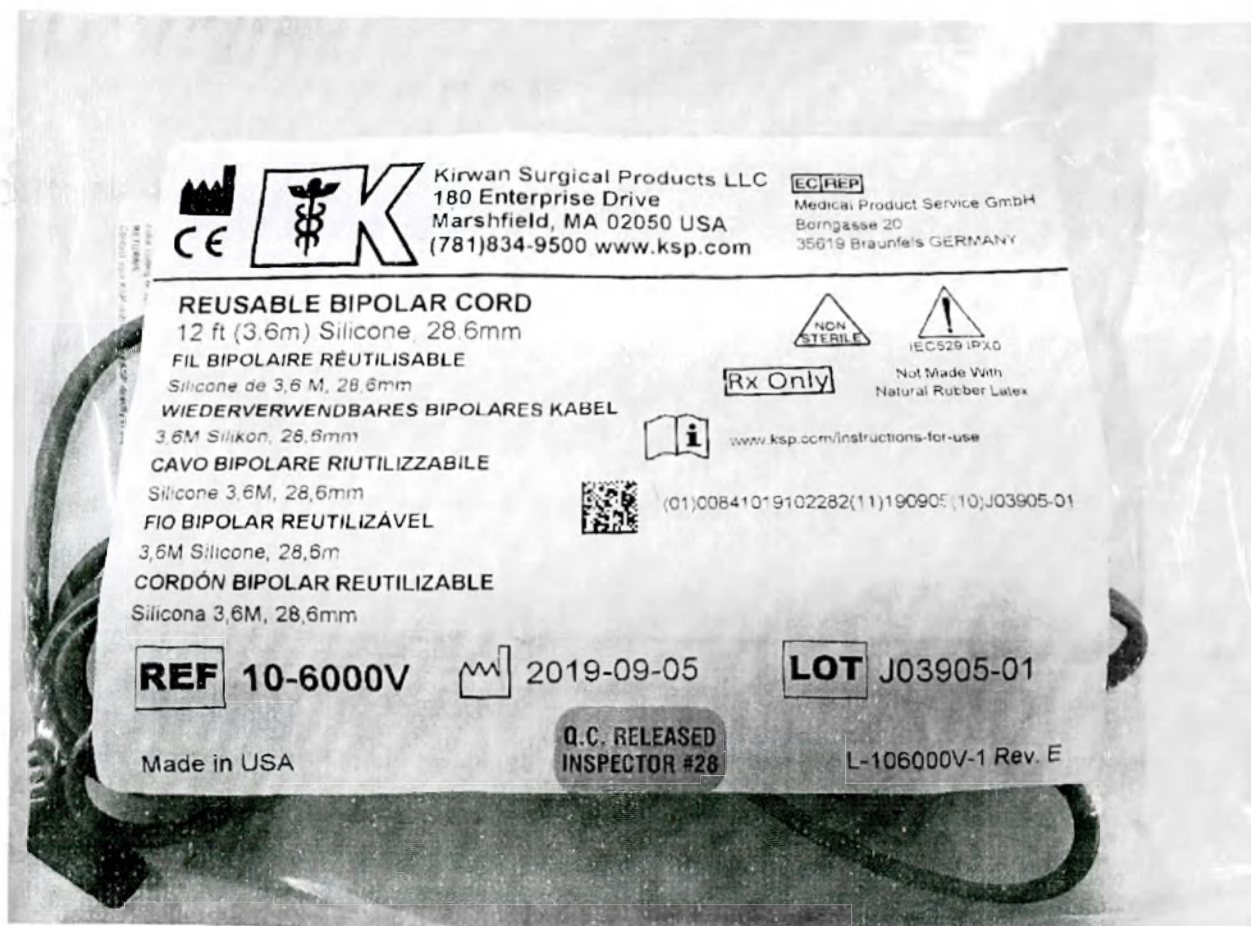


Рис 56 – Биполярный многожильный диатермический кабель. Маркировка

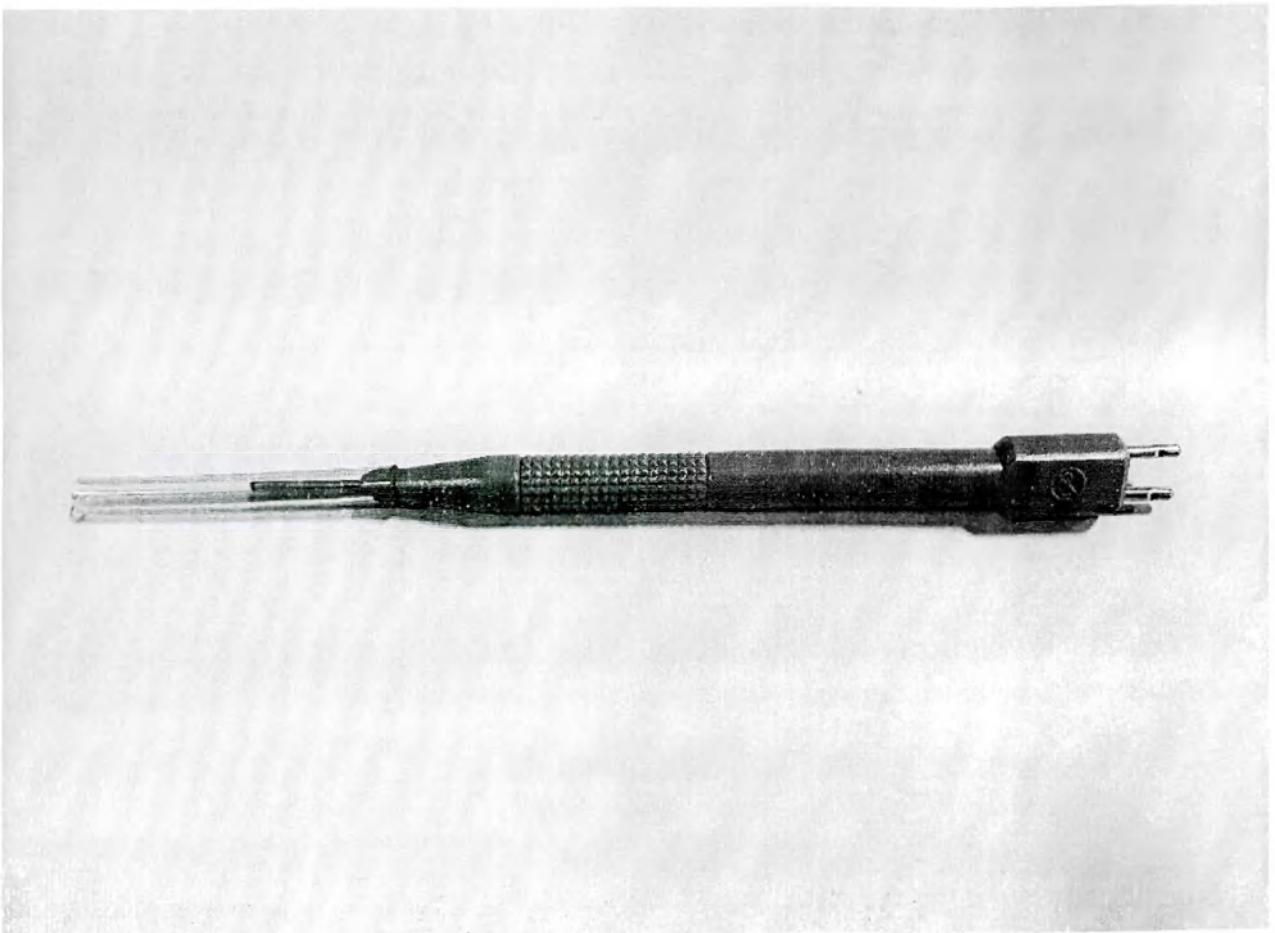


Рис 57 – Диатермокоагулятор одноразовый прямой, заостренный кончик. Внешний вид

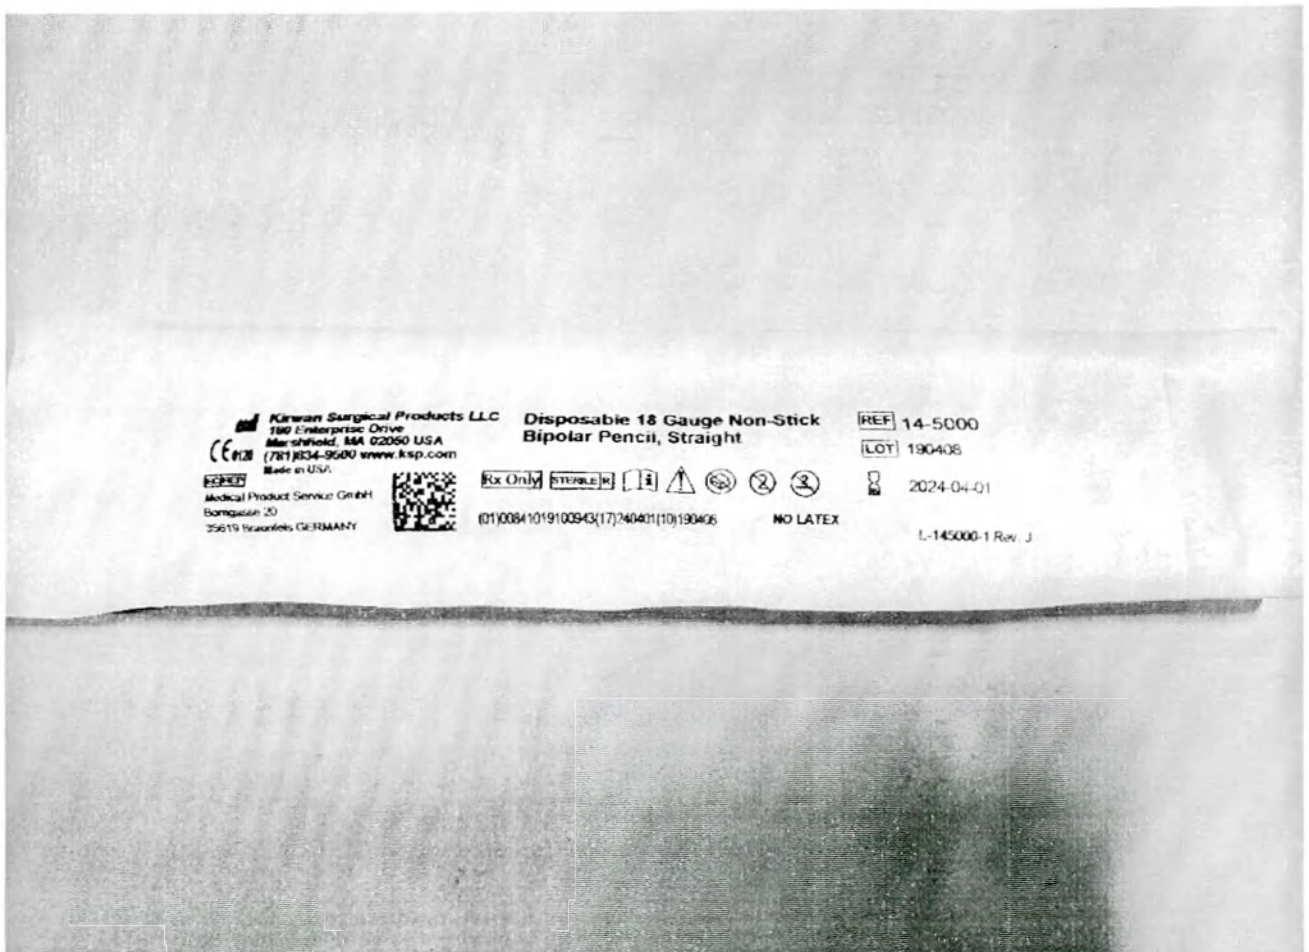


Рис 58 – Диатермокоагулятор одноразовый прямой, заостренный кончик. Маркировка

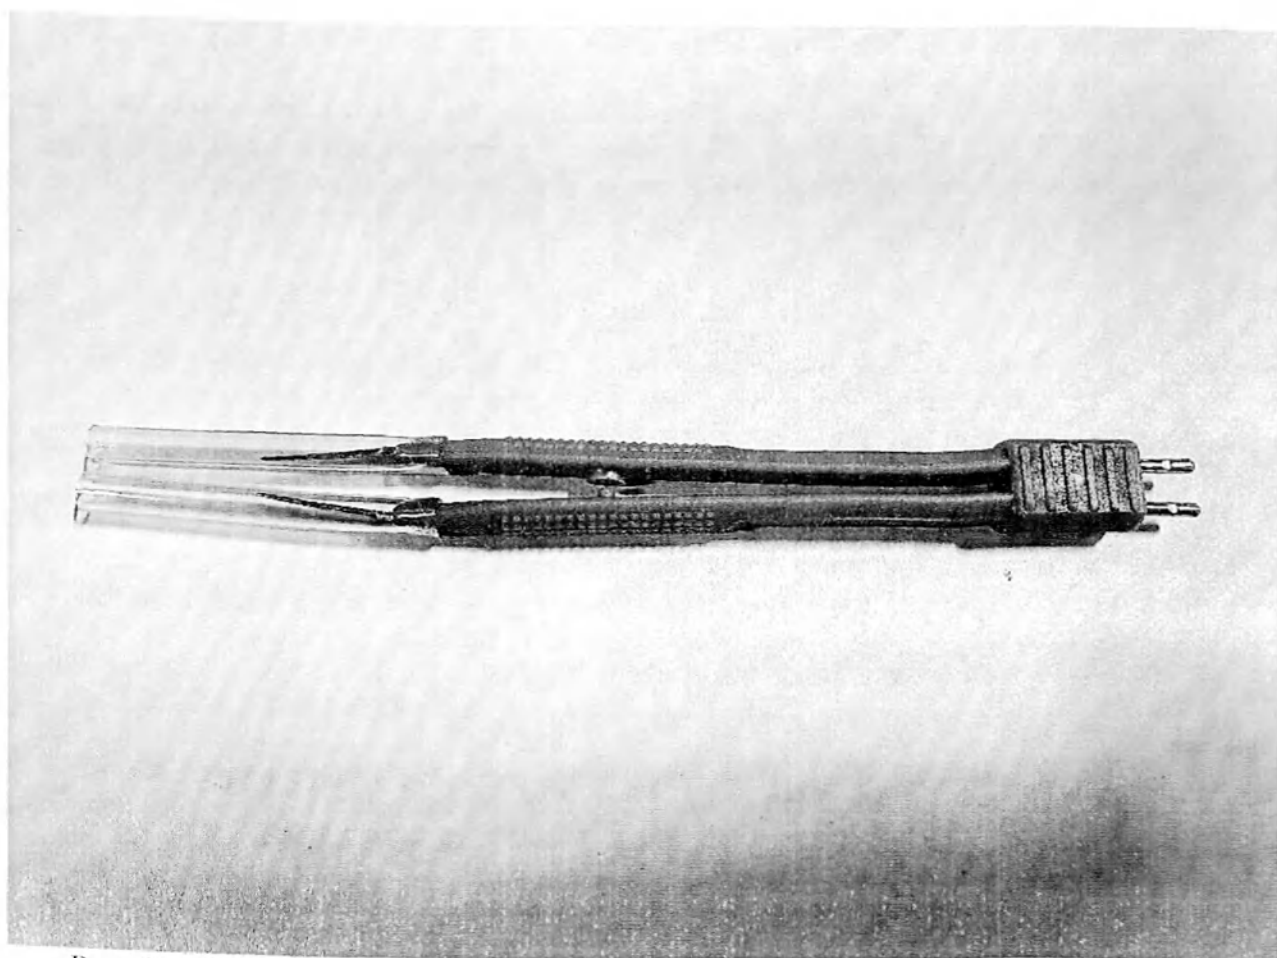


Рис 59 – Пинцет одноразовый для биполярной коагуляции, прямой. Внешний вид

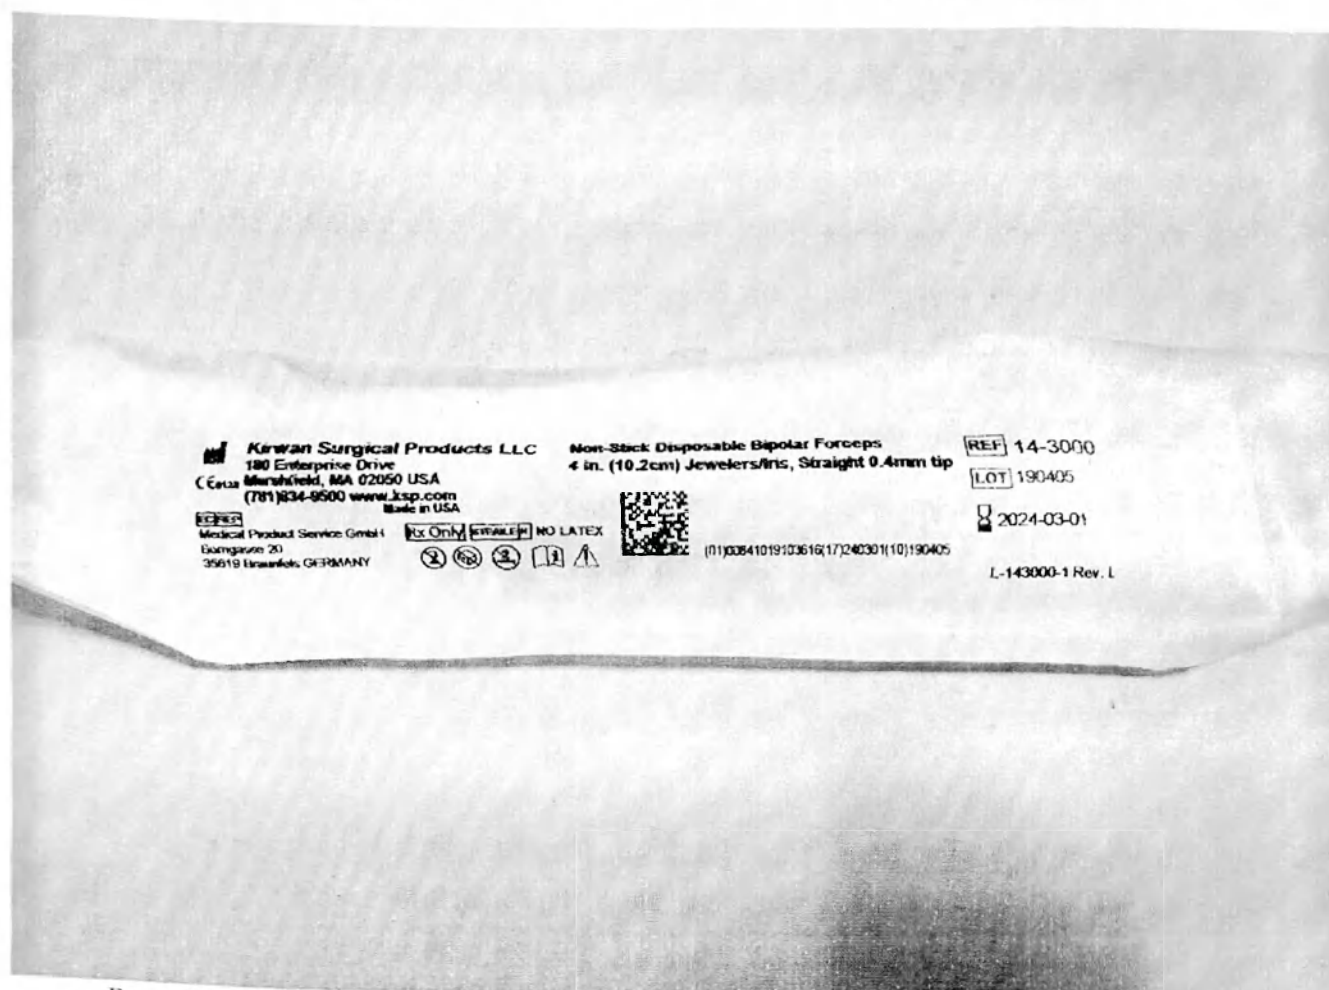


Рис 60 – Пинцет одноразовый для биполярной коагуляции, прямой. Маркировка

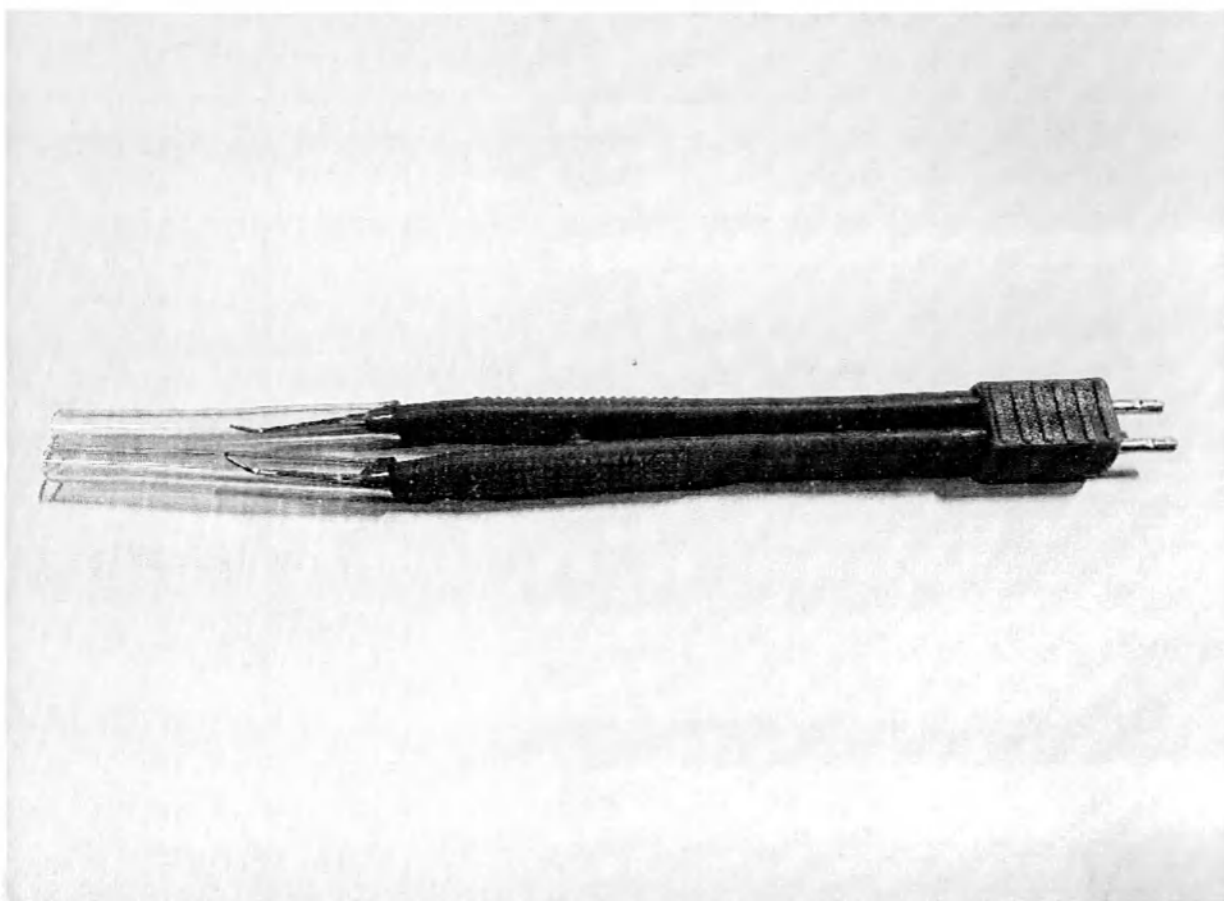


Рис 61 – Пинцет одноразовый для биполярной коагуляции, изогнутый. Внешний вид

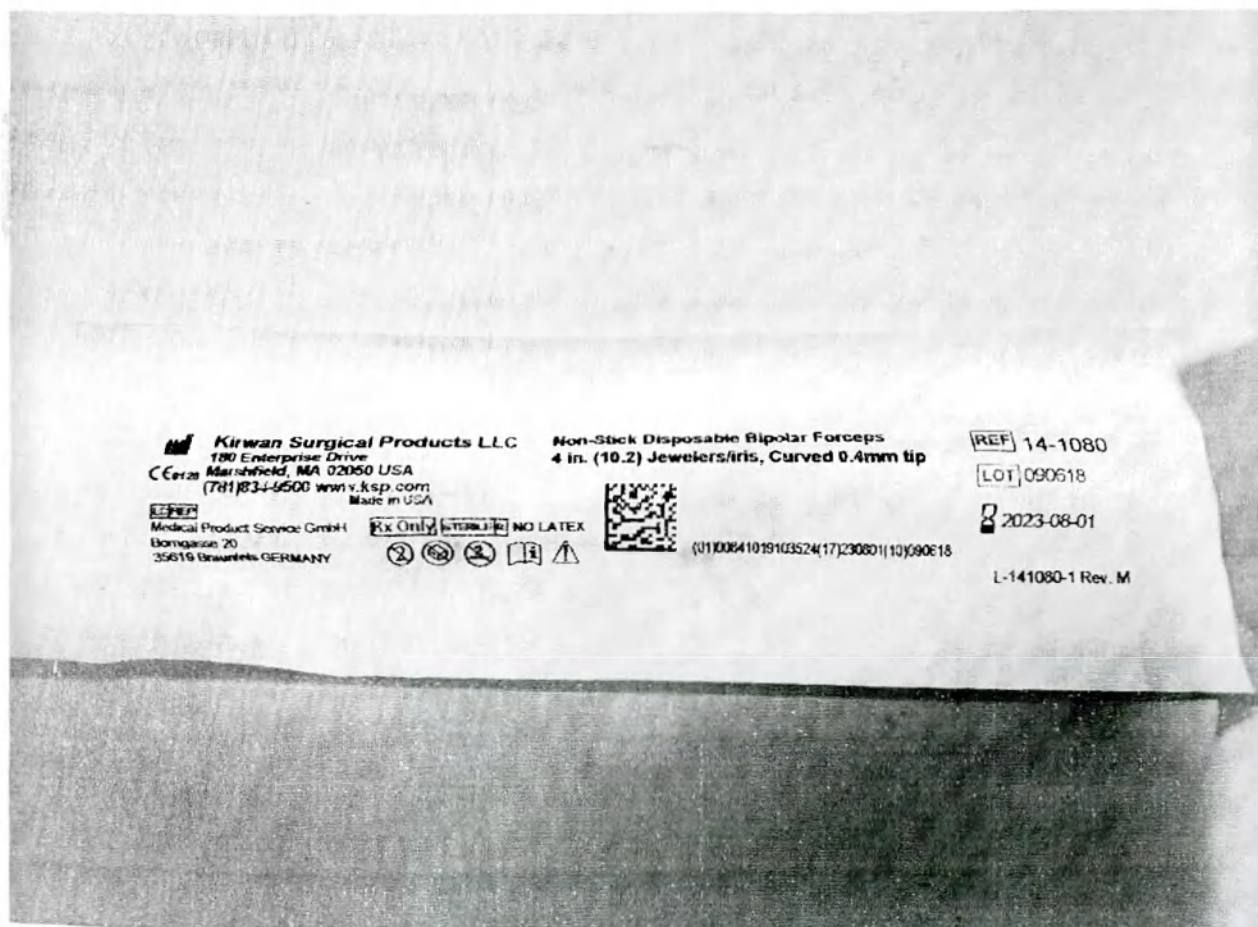


Рис 62 – Пинцет одноразовый для биполярной коагуляции, изогнутый. Маркировка

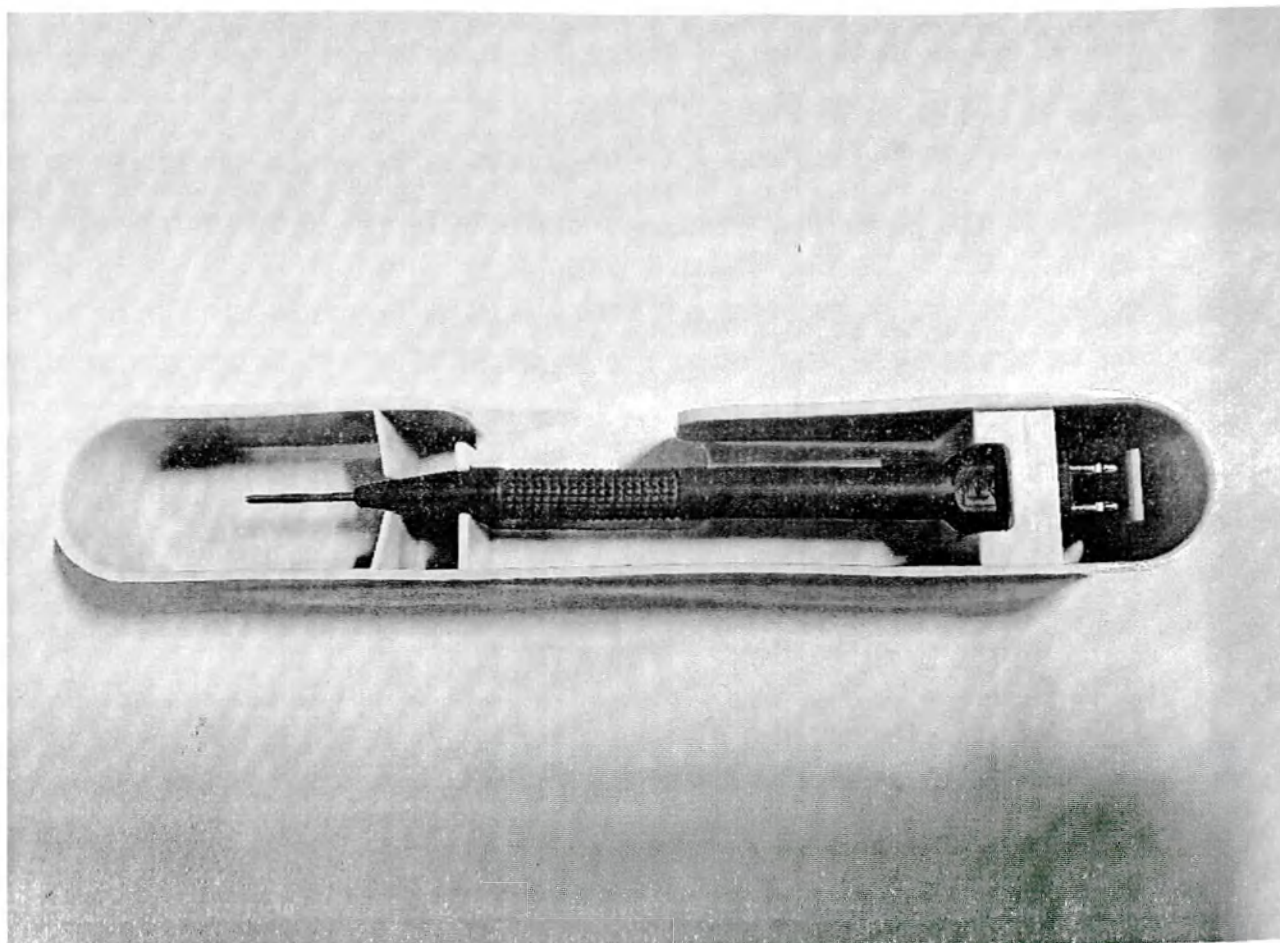


Рис 63 – Диатермокоагулятор многоразовый прямой, заостренный кончик. Внешний вид

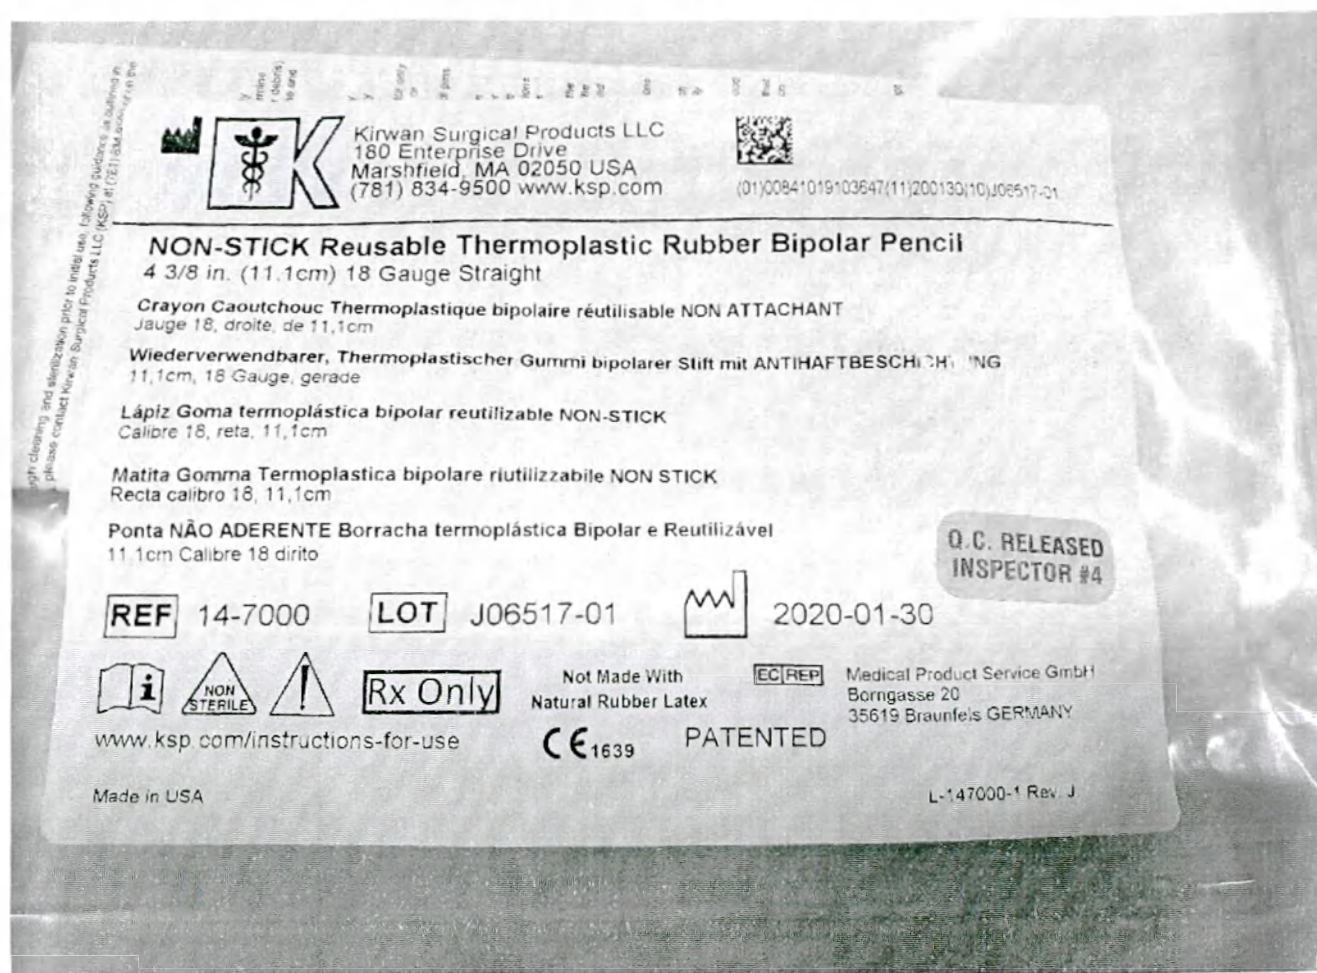


Рис 64 – Диатермокоагулятор многоразовый прямой, заостренный кончик. Маркировка

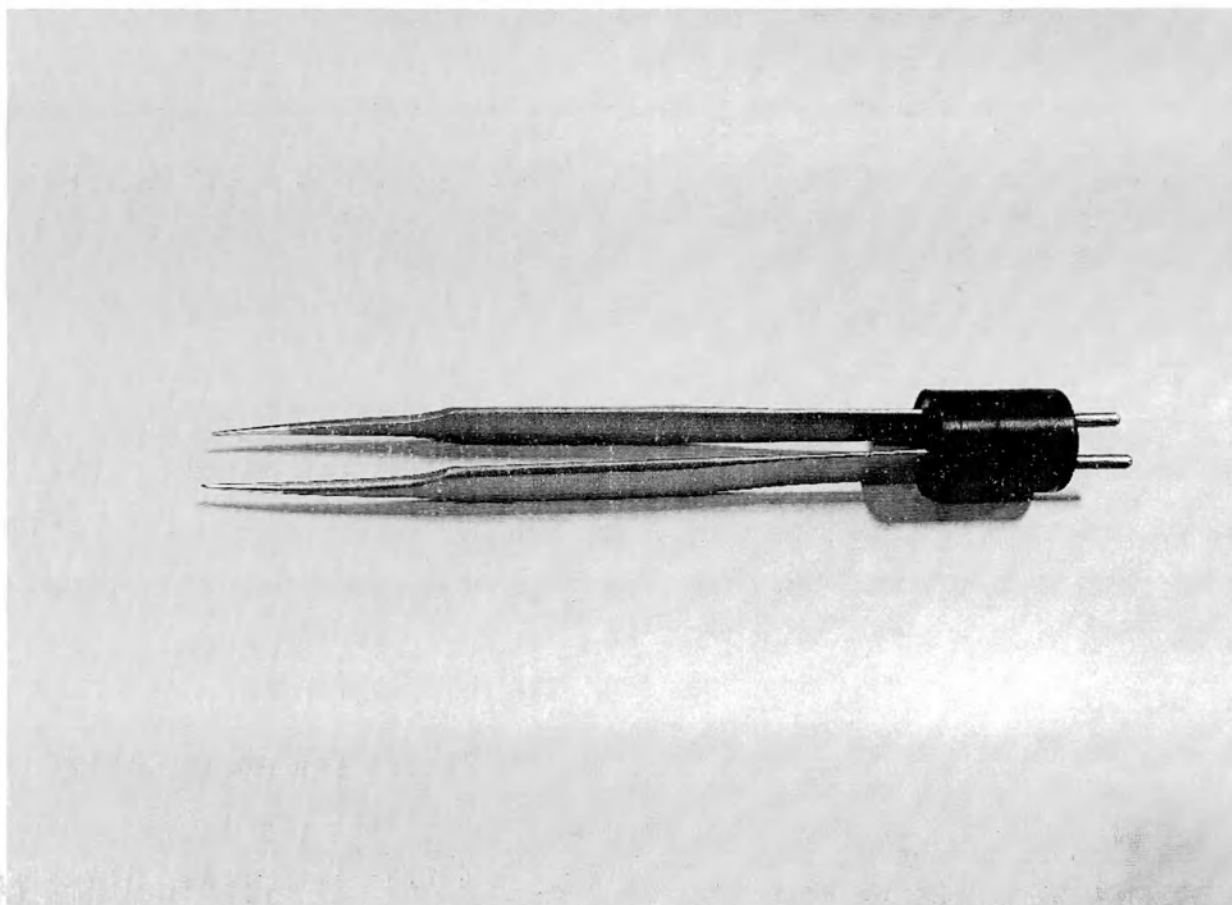


Рис 65 – Пинцет многоразовый для биполярной коагуляции, прямой. Внешний вид

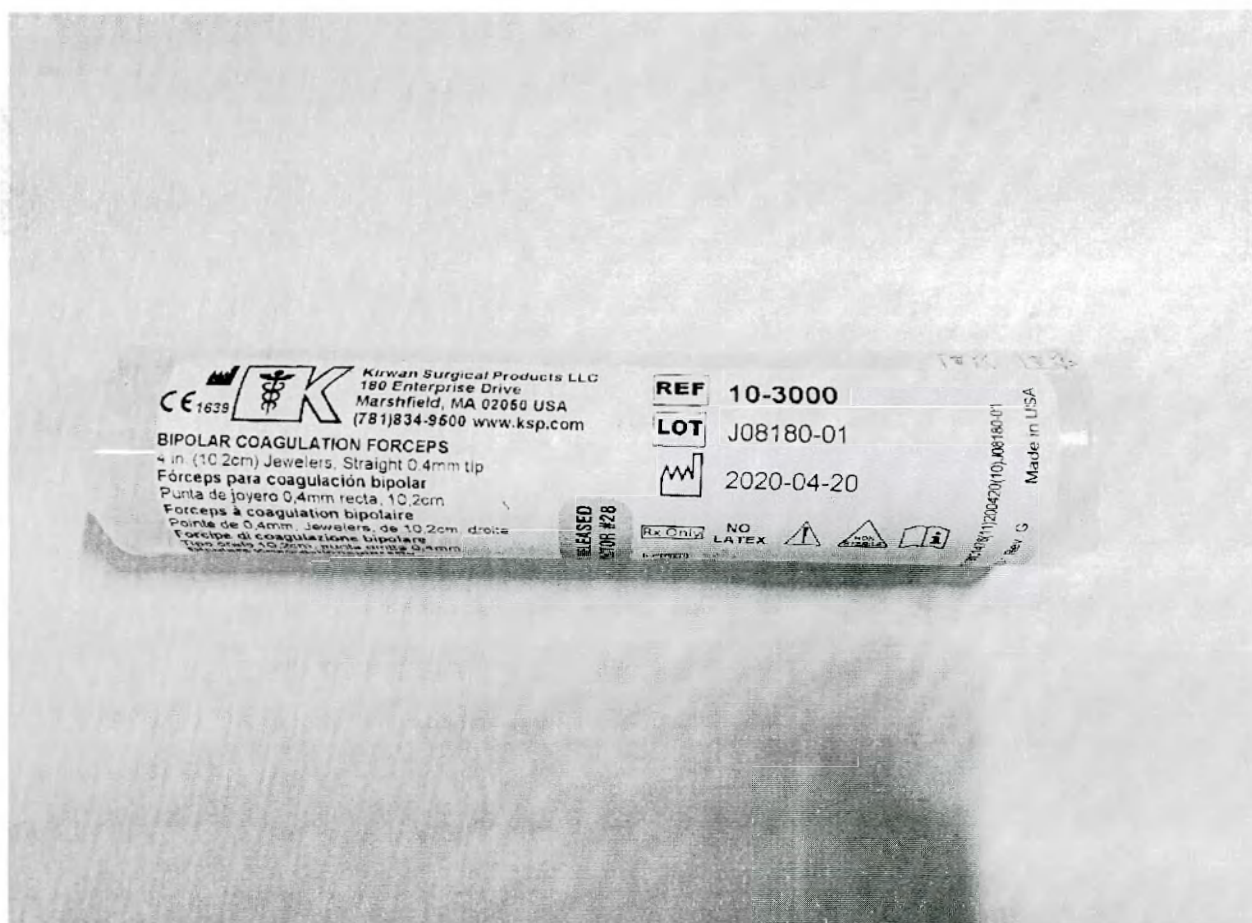


Рис 66 – Пинцет многоразовый для биполярной коагуляции, прямой. Маркировка.



Рис 67 – Пинцет многоразовый для биполярной коагуляции, прямой. Маркировка

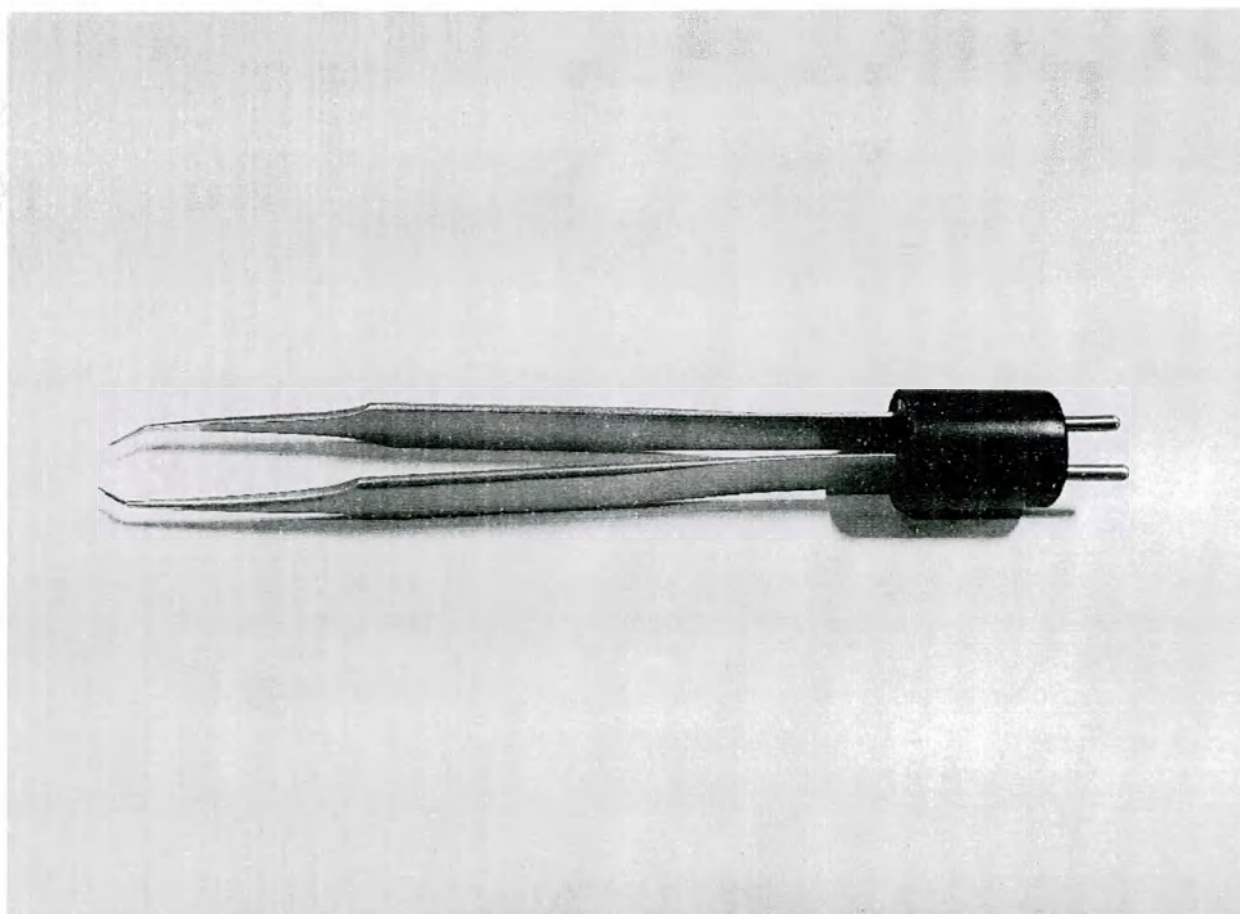


Рис 68 – Пинцет многоразовый для биполярной коагуляции, изогнутый

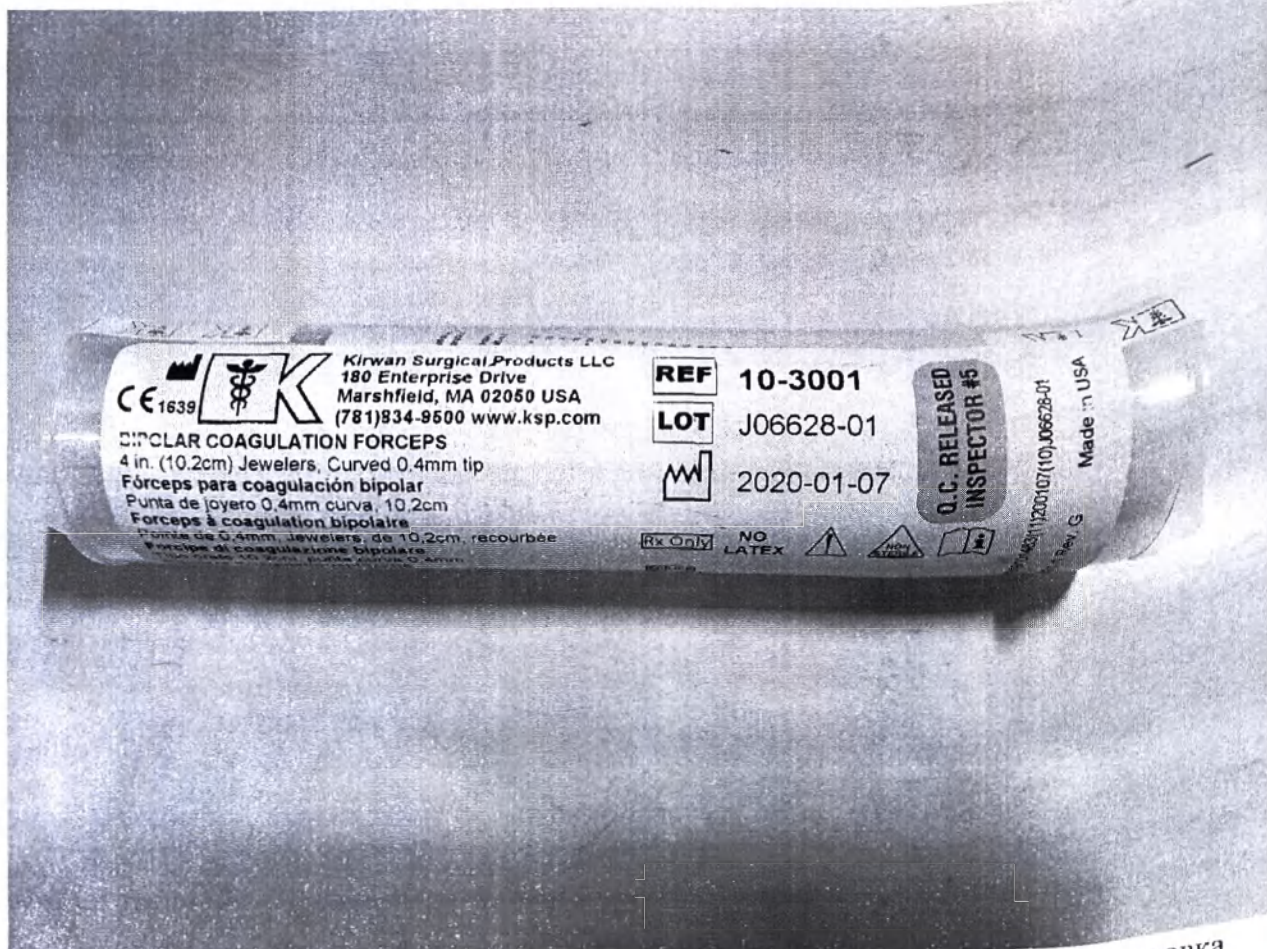


Рис 69 – Пинцет многоразовый для биполярной коагуляции, изогнутый. Маркировка

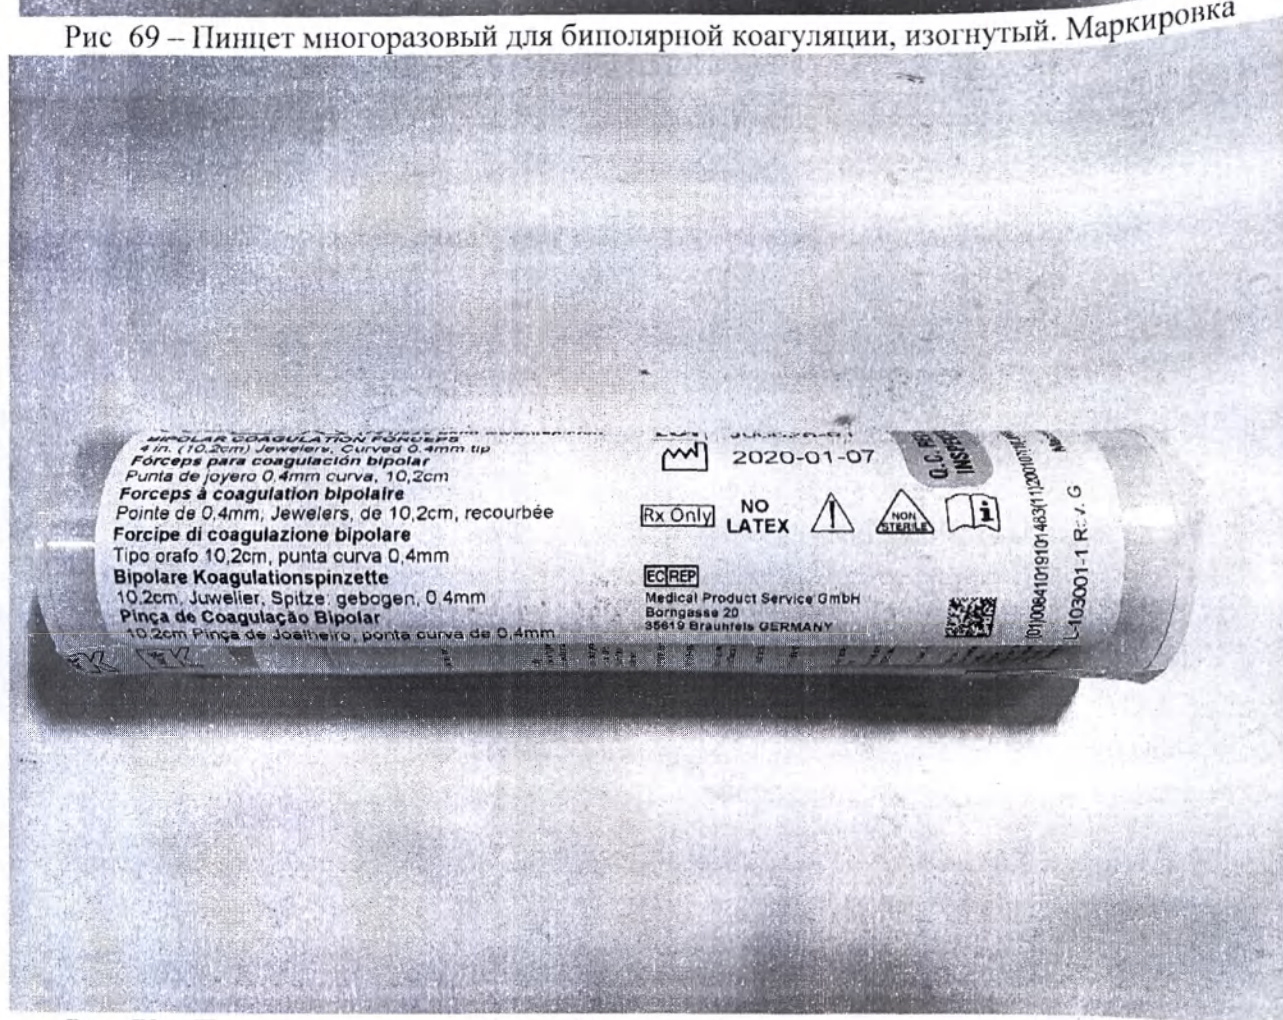


Рис 70 – Пинцет многоразовый для биполярной коагуляции, изогнутый. Маркировка

прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 38 (приделана восемь) листов

Должности Директор
ООО "ЦИЦИТА"

Подпись / Яковлев Д.А. /

