



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БИЭНСИ ГЛОБАЛ+»

Л.В. Елгайкина

«28» марта 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Имплантат интрадермальный TESORO с гиалуронатом натрия 20
мг/мл для контурной пластики»**

производства


Biostandard Co. Ltd. («Биостандарт Ко. Лтд.»), Республика Корея

Tesoro

DEEP


Cross-linked Hyaluronic Acid

1.0ml

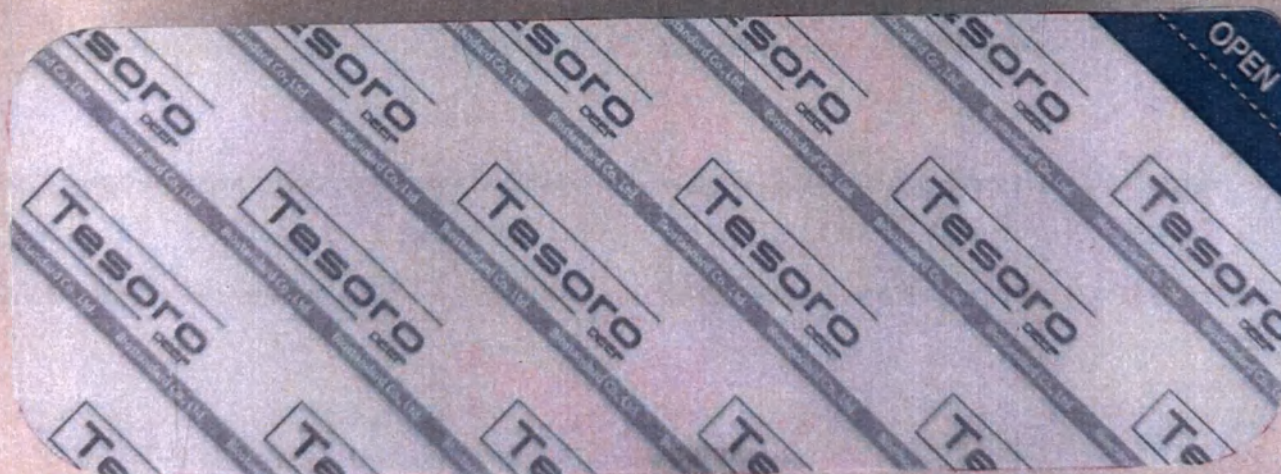

Институт интернационального ТЕСОДО ВЭР с гидролизом натрия 20 итти для концентрированных 1 итти. Медицинское издание предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве профессионального инструмента для увеличения объема мягких тканей, коррекции несовершенств кожи. 1 итти имеет размеры 1 см, 2 итти 276 x 13 мм, 2 итти имеют с информацией об имплантатах, инструкцию по применению. Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия хранения итти, инструкции по применению внутри упаковки. Срок годности: 24 месяца. Искренне приветствуем! Купить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Применять в соответствии с инструкцией. Компания: Bostand Co. Ltd. #407, #501, 20, Носорого 79000-01, Вейдунг-чун, Асан-си, Чонгдонгдо-до 31099, Республика Корея. Интернациональный представитель производителей медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «ВЭР» (VSDA), 127540, г. Москва, ул. Аудинская, д. 4, строение 2, помещение 1 (бокс 16, тел: +7 (916) 827-55-82, E-mail: info@vsevolod.com). Персональное удостоверение: №000 от 09.05.2009 г. Встречаемся: ВМС Global №2004, Сонгдо Технопарк II Центр 32, Сонгдохвак-кю, Йонсу-гу, Йонсеон, Республика Корея. <http://www.mtkcorp.co.kr>



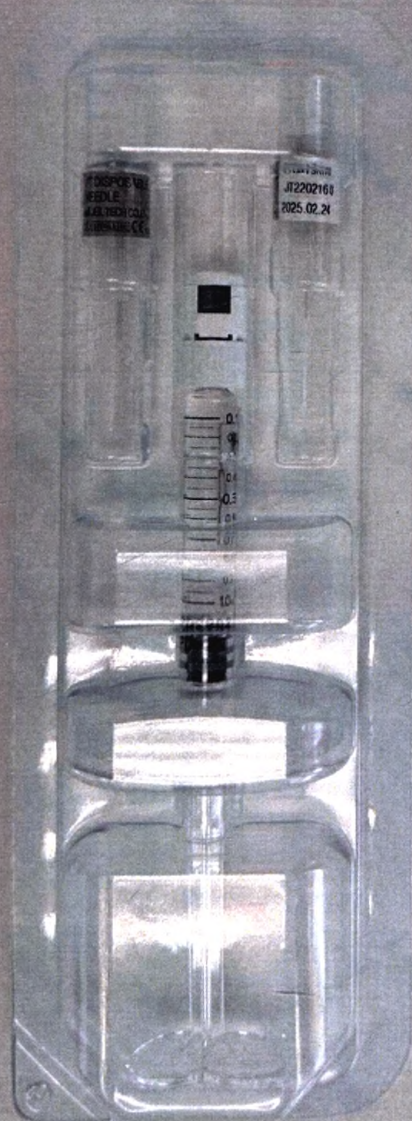

Medical Device

Tesoro
Cross-linked Hyaluronic acid

Instruction for Use


TESORO FINE (MPC-1E)
TESORO DEEP (MPD-2E)
TESORO SUB-Q (MPV-3E)

Tesoro

SUB-Q

Cross-linked Hyaluronic Acid

1.0ml

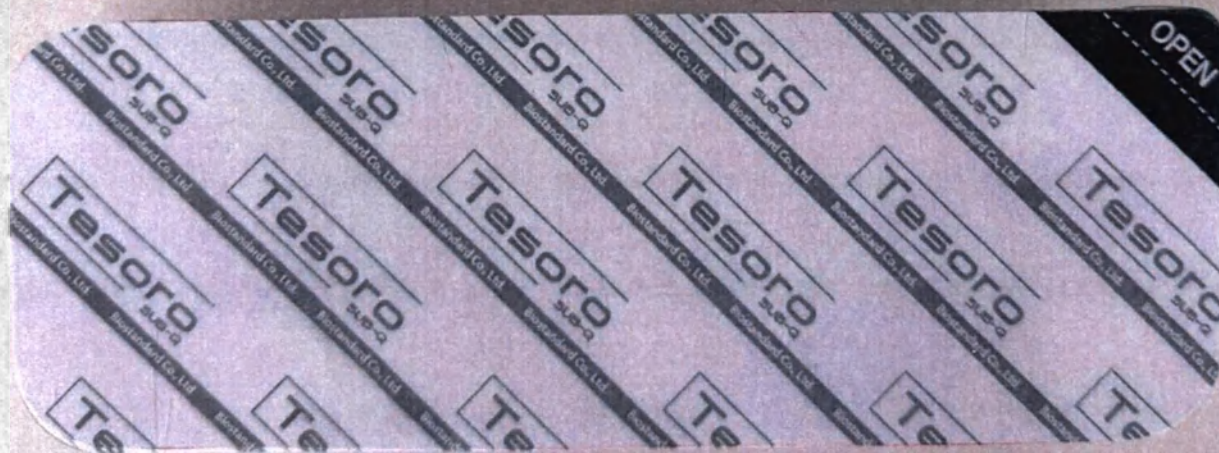

Маломощный инфракрасный ТЕСОКО SLD-4 с галогенным нагревом 20 Вт/лм для контрольной пластины, 1 лм. Медицинское изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заплата для увеличения объема липофилированных тканей, коррекции несовершенств кожи. Упаковка содержит 1 шприц, 1 мл, 1 иглу 25G x 13 мм, 1 иглу 27G x 13 мм, 2 накладки с инфракрасной обложкой, инструкцию по применению.

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерилизован. Не мыть.

Срок годности: 24 месяца.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80%, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.


Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Vivantest Co., Ltd. #407, #501, 20, Hoso-ro 79beon-gil, Baejeong-eup, Gyeongsang-do 31053, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью «БИНСИ ПИОСАН», 127540, г. Москва, ул. Аюуниском, д. 4, строение 2, помещение 160-16, тел.: +7 (916) 687-35-82, E-mail: binsoy@binsi.com.


Регистрационное удостоверение №000 от 02.03.2008 г.

Дистрибьютор: ВАС ПАВЭЛ М-2004, Сонгдо Технопарк IT Center 32, Сонгдогвиль-гу, Йонпун-гу, Инчон, Republic of Korea, <http://www.kimphangdo.com>

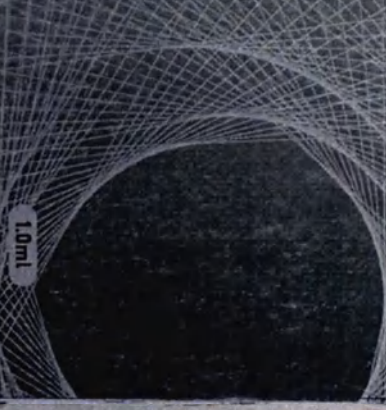

Made in Korea



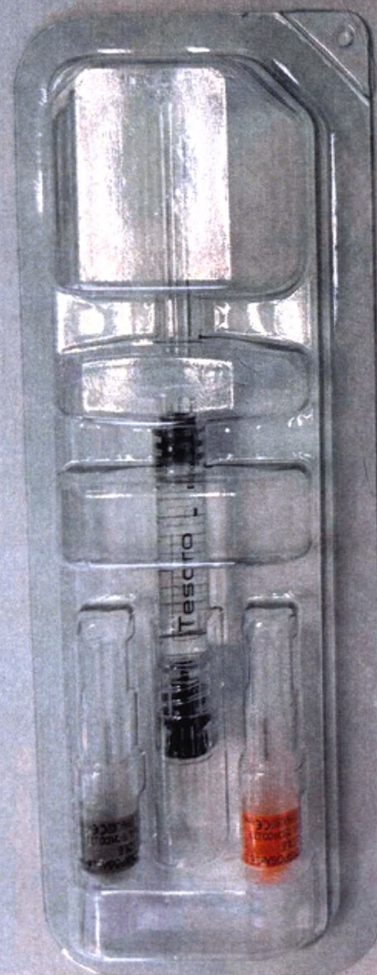

BIOSTANDARD
TESORO Sub-Q
Lot No : MPV2202
Exp Date : 2024.04.17


BIOSTANDARD
TESORO Sub-Q
Lot No : MPV2202
Exp Date : 2024.04.17


Medical Device

Tesoro
Cross-linked Hyaluronic acid

Instruction for Use
TESORO FINE (MPC-1E)
TESORO DEEP (MPD-2E)
TESORO SUB-Q (MPV-3E)

Method of administration

- 1 
Gently unscrew the protective cap of the syringe on the lock.
- 2 
Hold the narrow part of the needle cap, then screw it gently on the luerlock, until you feel slight resistance.
- 3 
Holding the widest part of the needle cap, press the cap by pushing inward, then screw it.
- 4 
Remove the protective cap of the needle by pulling it outward.

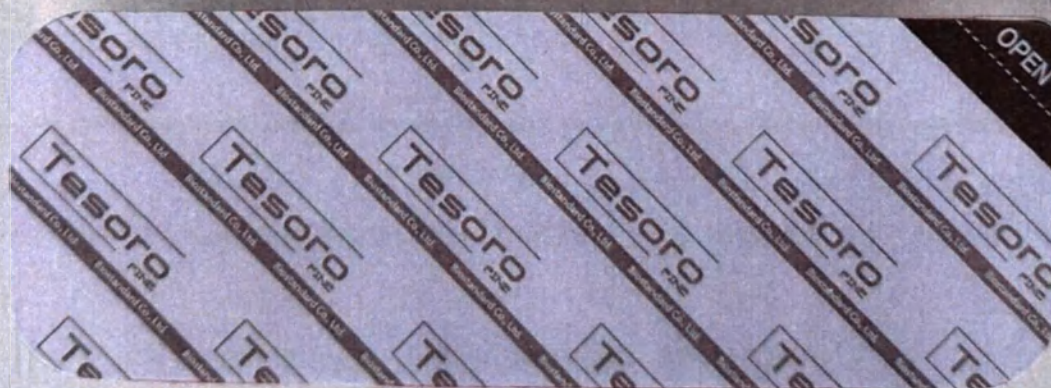

Имплантат интрадермальный TESORO FINE с гиалуронатом натрия 20 мг/мл для контурной пластики, 1 мл. Медицинское изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи. 1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, 1 иглу 27G x 13 мм, 1 иглу 30G x 13 мм, 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 24 месяца.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80%, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Biostandard Co. Ltd., #407, #501, 20, Hoseo-ro 79beon-gil, Baebang-eup, Asan-si, Chungcheongnam-do 31499, Republic of Korea.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью «БИЭНСИ ГЛОБАЛ», 127540, г. Москва, ул. Дубининская, д. 4, строение 2, помещение I блок 16, Тел.: +7 (916) 687-35-82, E-mail: filler.bncglobal@gmail.com.

Регистрационное удостоверение: №000 от 00.00.0000 г.

Дистрибьютор: BNC Global M-2804, Songdo Technopark IT Center 32, Songdogwahak-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea. <http://www.mybncglobal.com>

1x27G
1x30G



STERILE



Made in Korea

1.0ml



Medical Device

Tesoro
Cross-linked Hyaluronic acid

Instruction for Use


TESORO FINE (MPC-1E)

TESORO DEEP (MPD-2E)

TESORO SUB-Q (MPV-3E)

Method of administration

1



Gently unscrew the protective cap of the syringe on the lock.

2



Hold the narrow part of the needle cap, then screw it gently on the barrel, until you feel slight resistance.

3





Holding the widest part of the needle cap, press the cap by pushing inward, then screw it.


4



Remove the protective cap of the needle by pulling it outward.

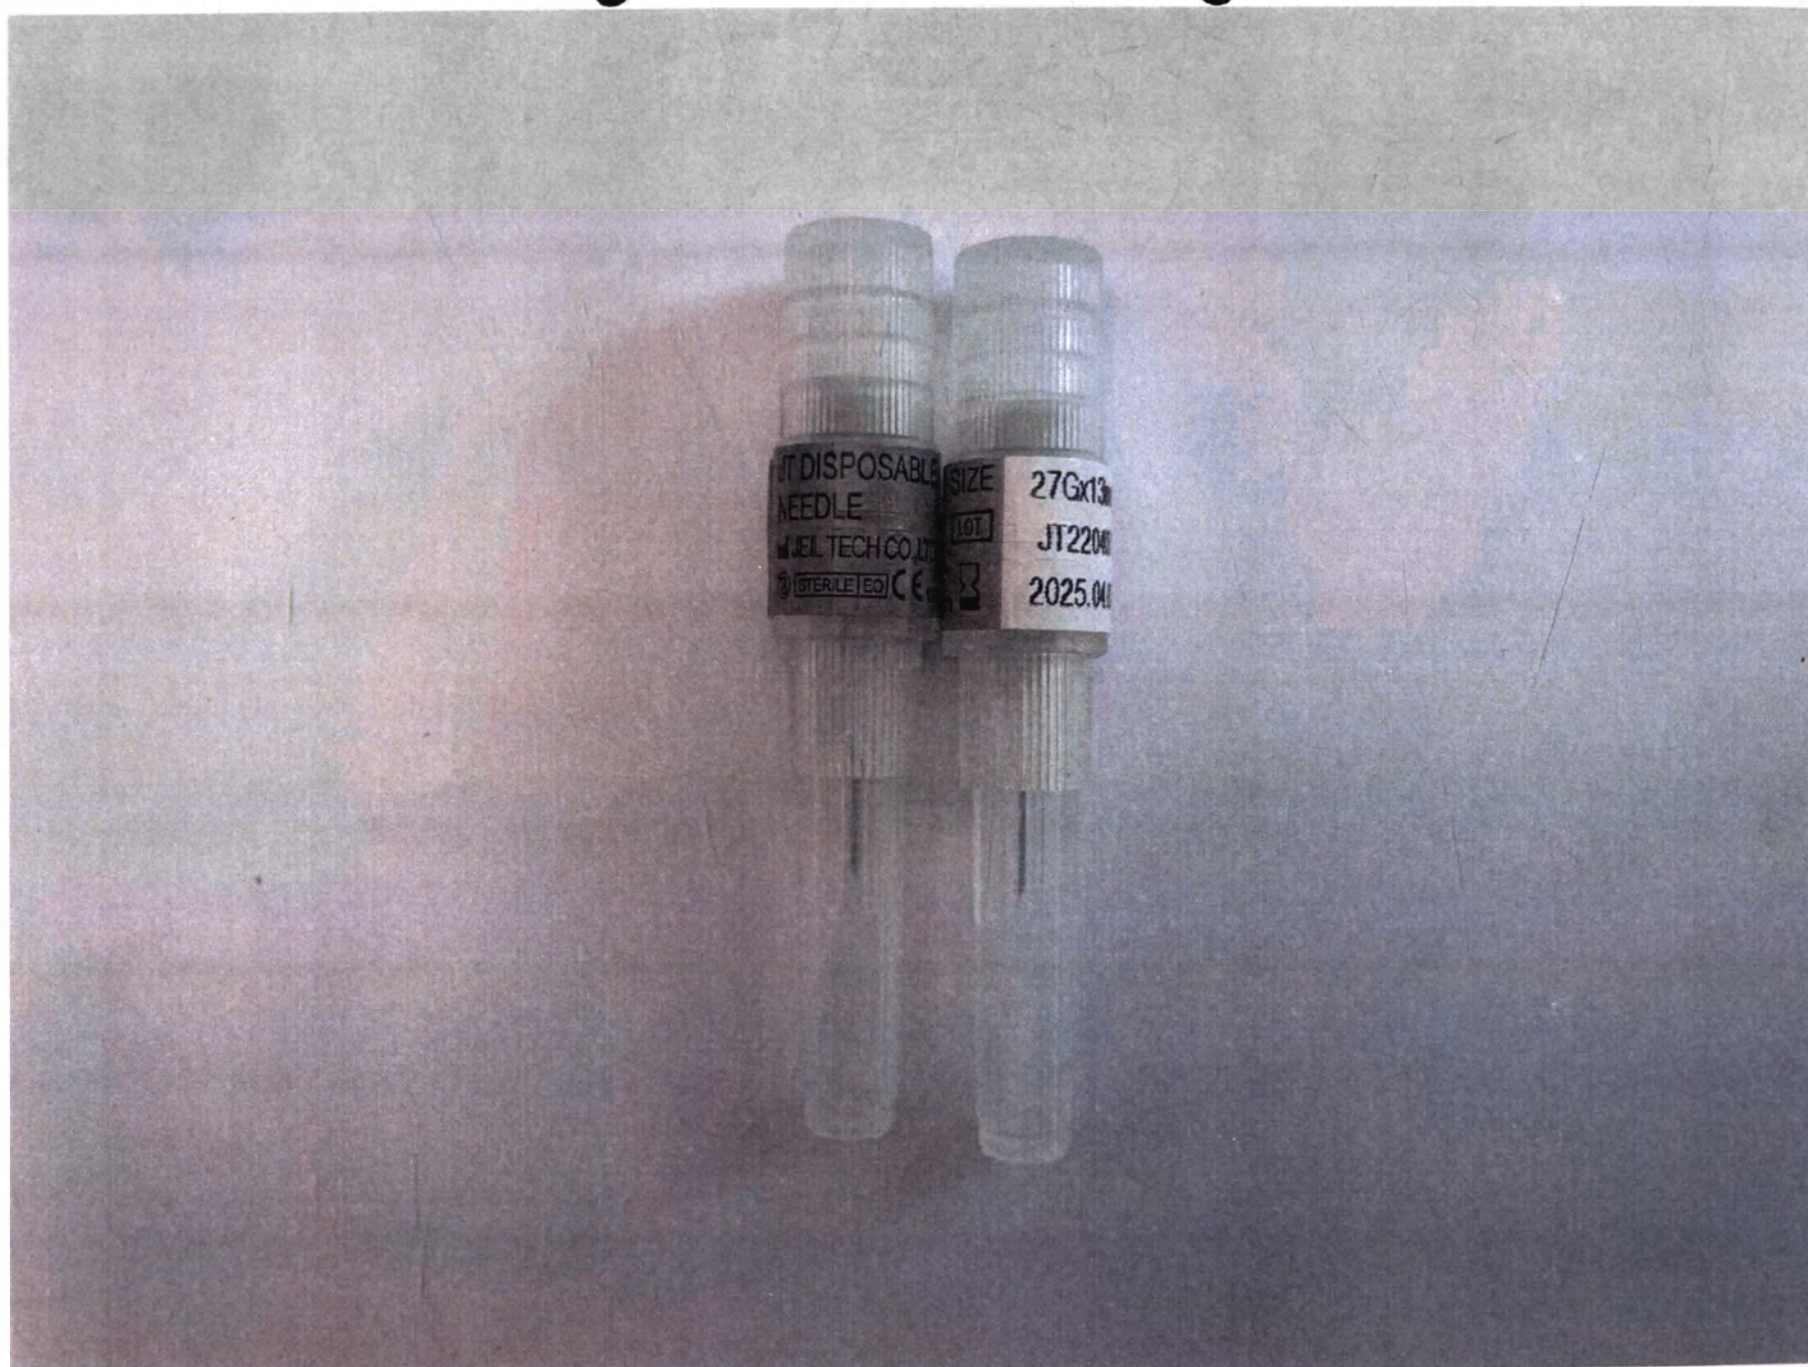

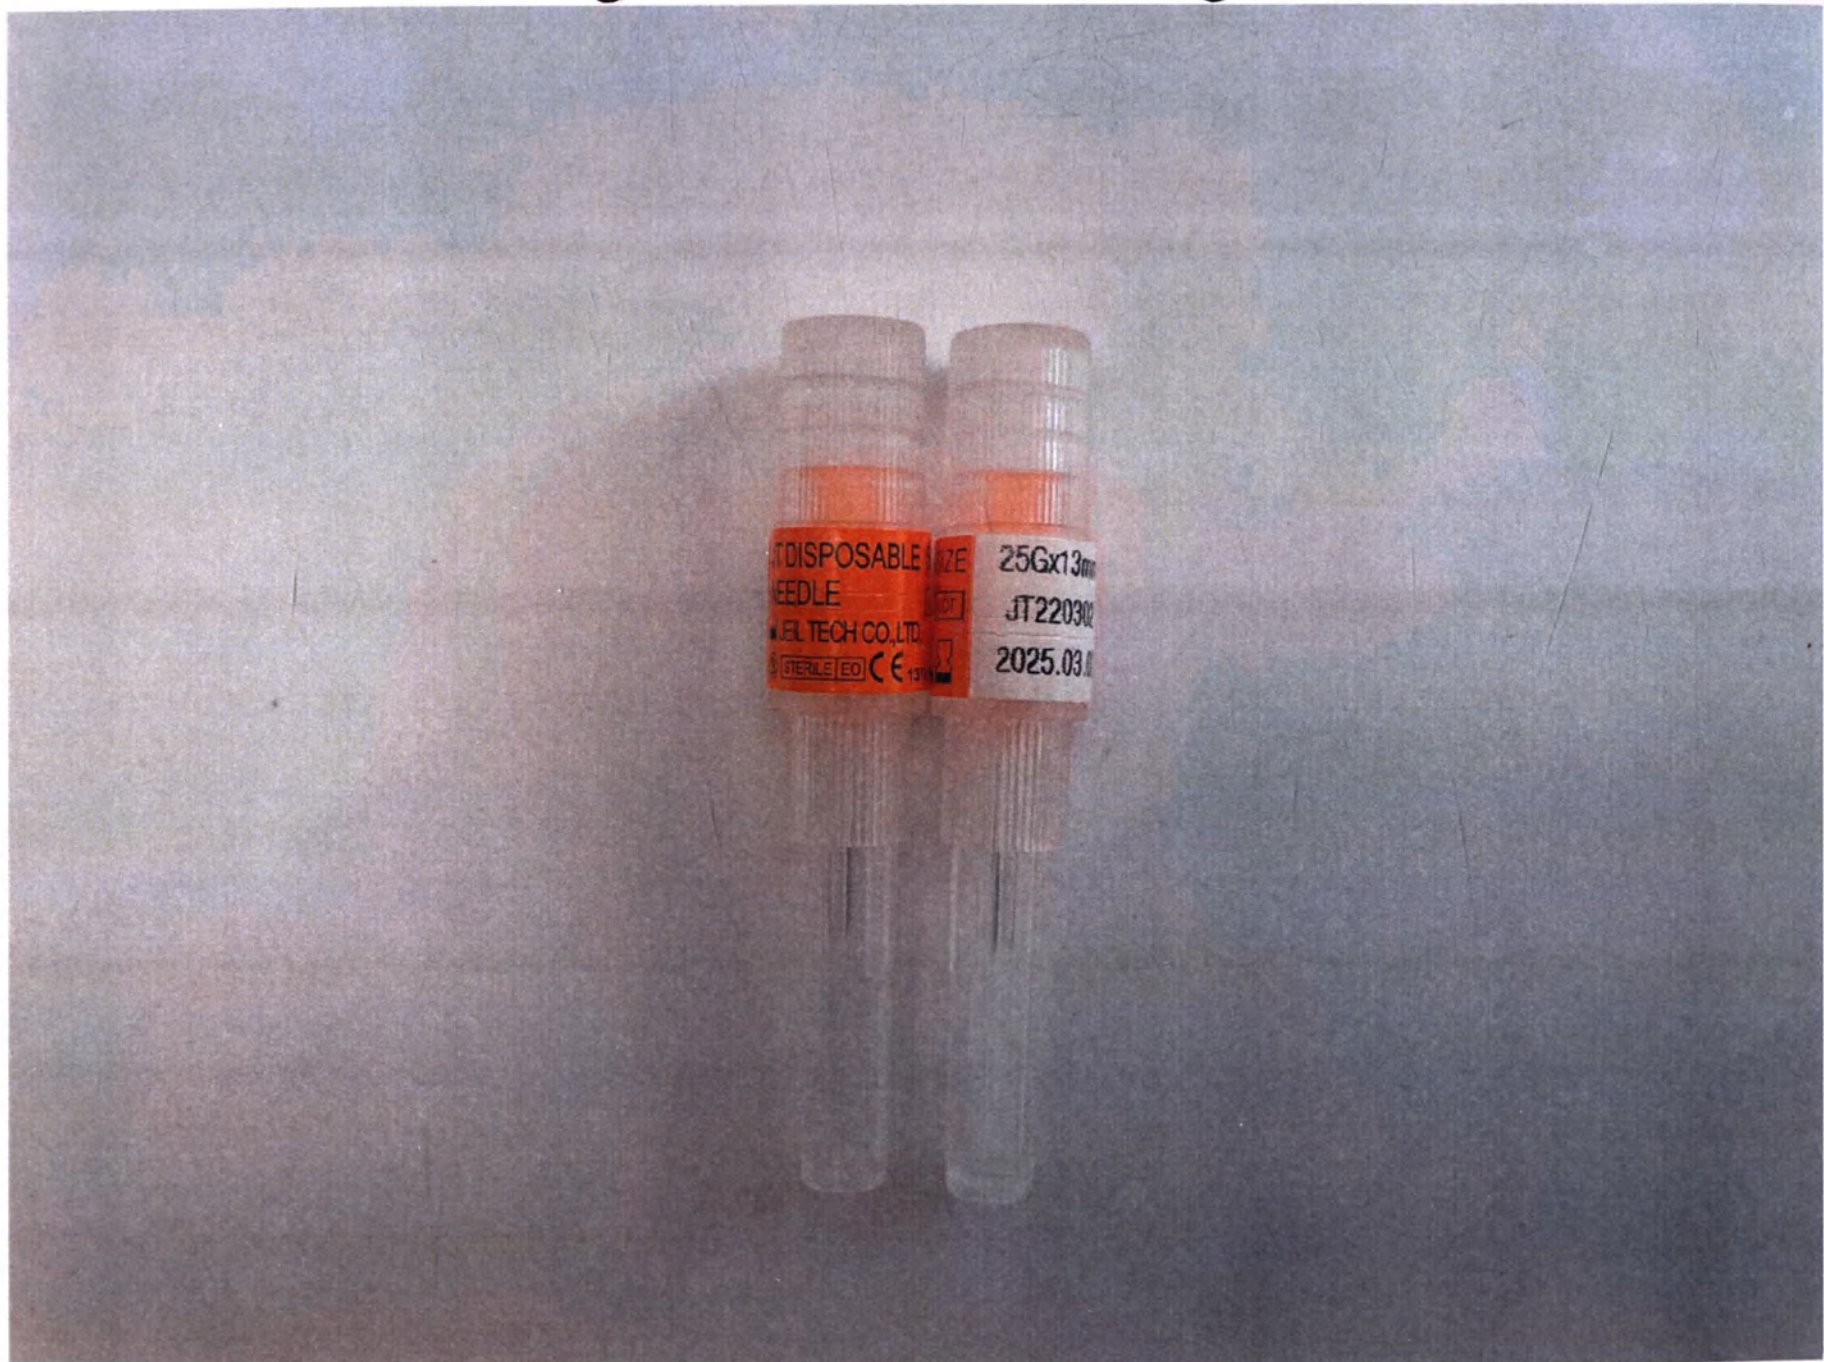

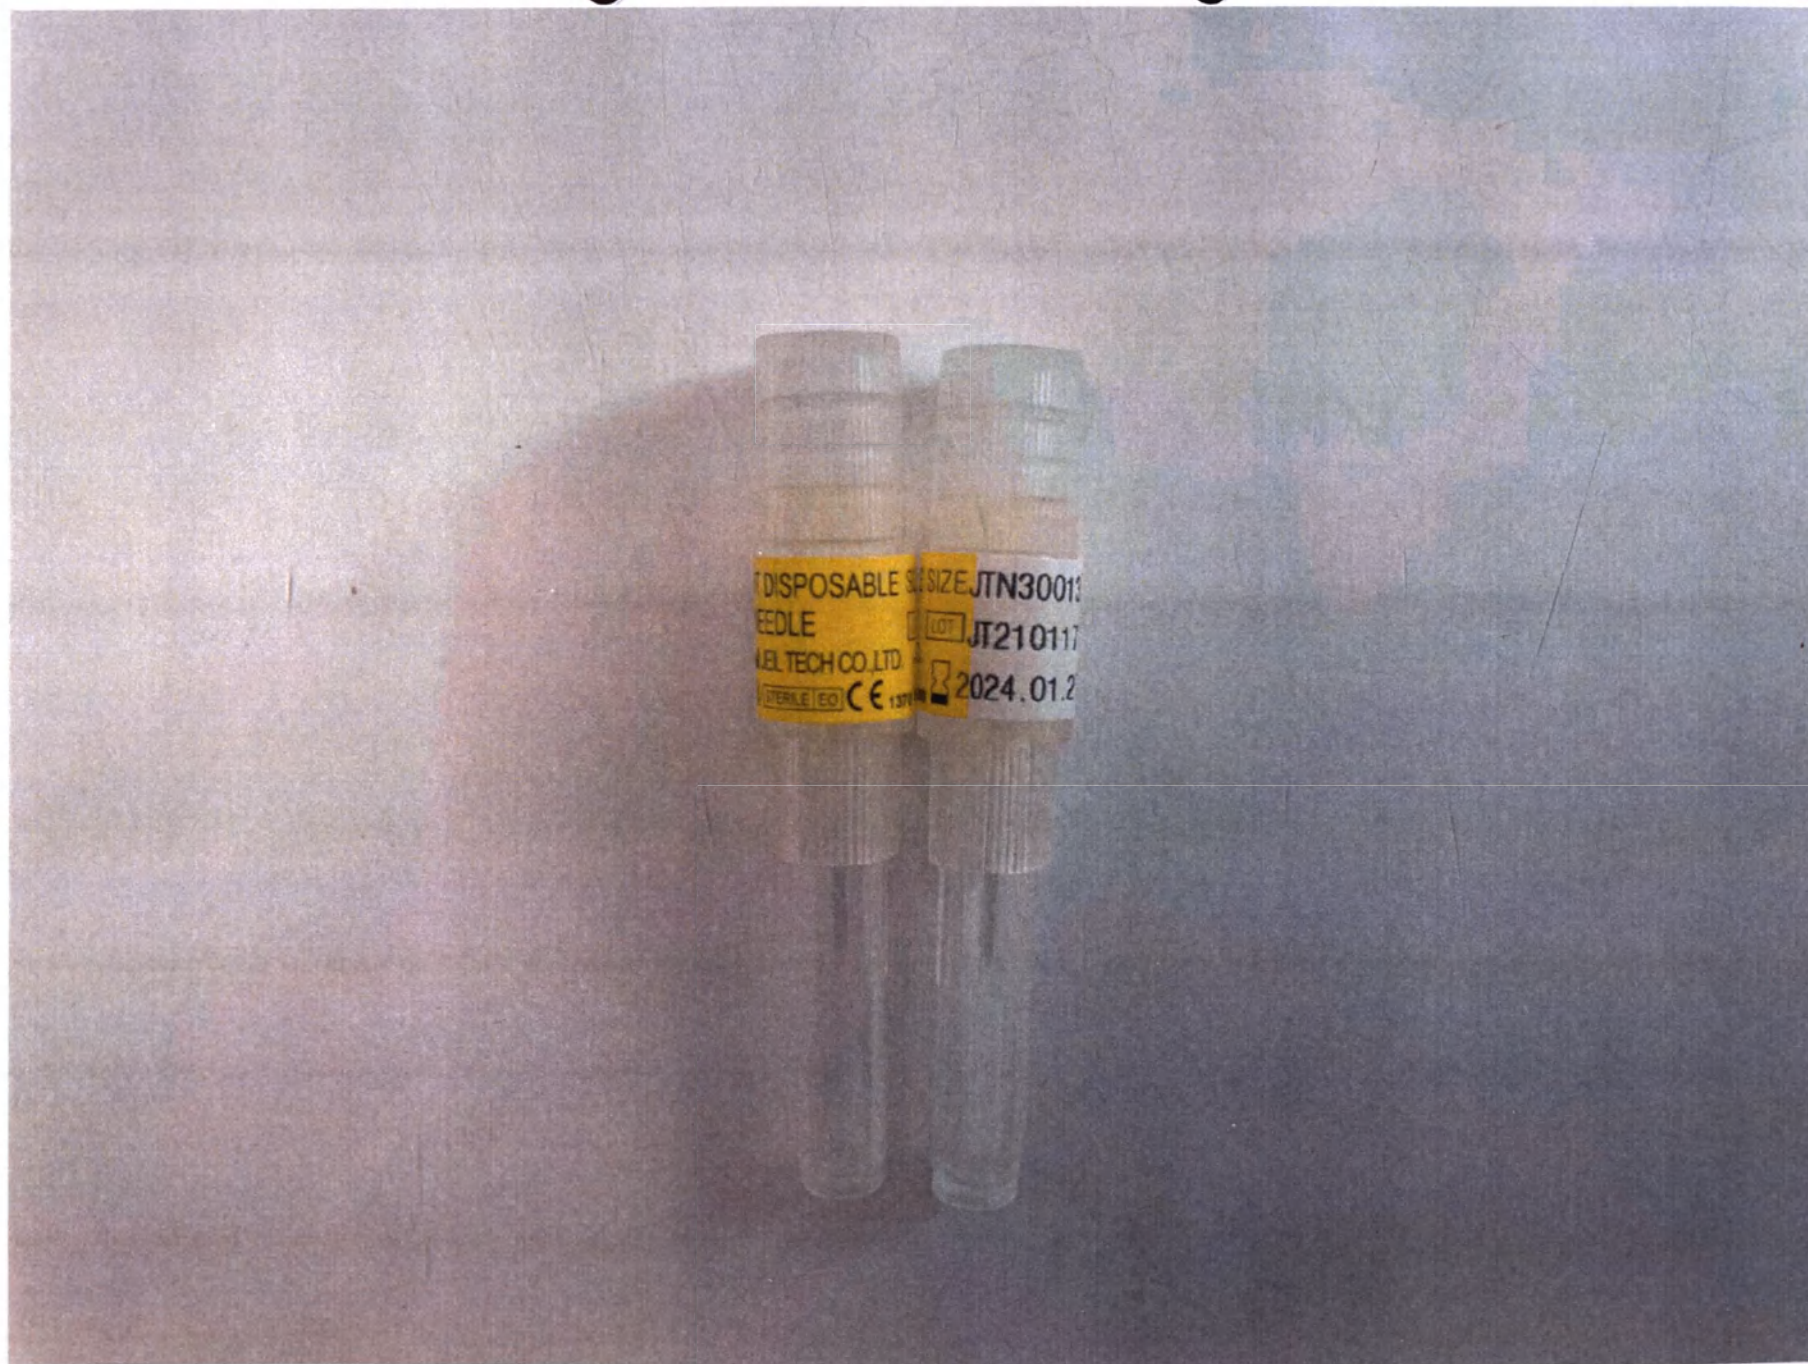

прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 13 лист
Генеральный директор
ООО «БИЗНЕС ГЛОБАЛ+»
Л.В. Елгайки



МП
«28» 03 2023 г.