

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«15» марта 2023 г.




**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия для диагностики in vitro**

**«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для
иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита
человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и
антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg),
антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к Treponema pallidum,
ТУ 21.20.23-061-26329720-2022**

Внешняя маркировка набора реагентов

Вариант исполнения 1

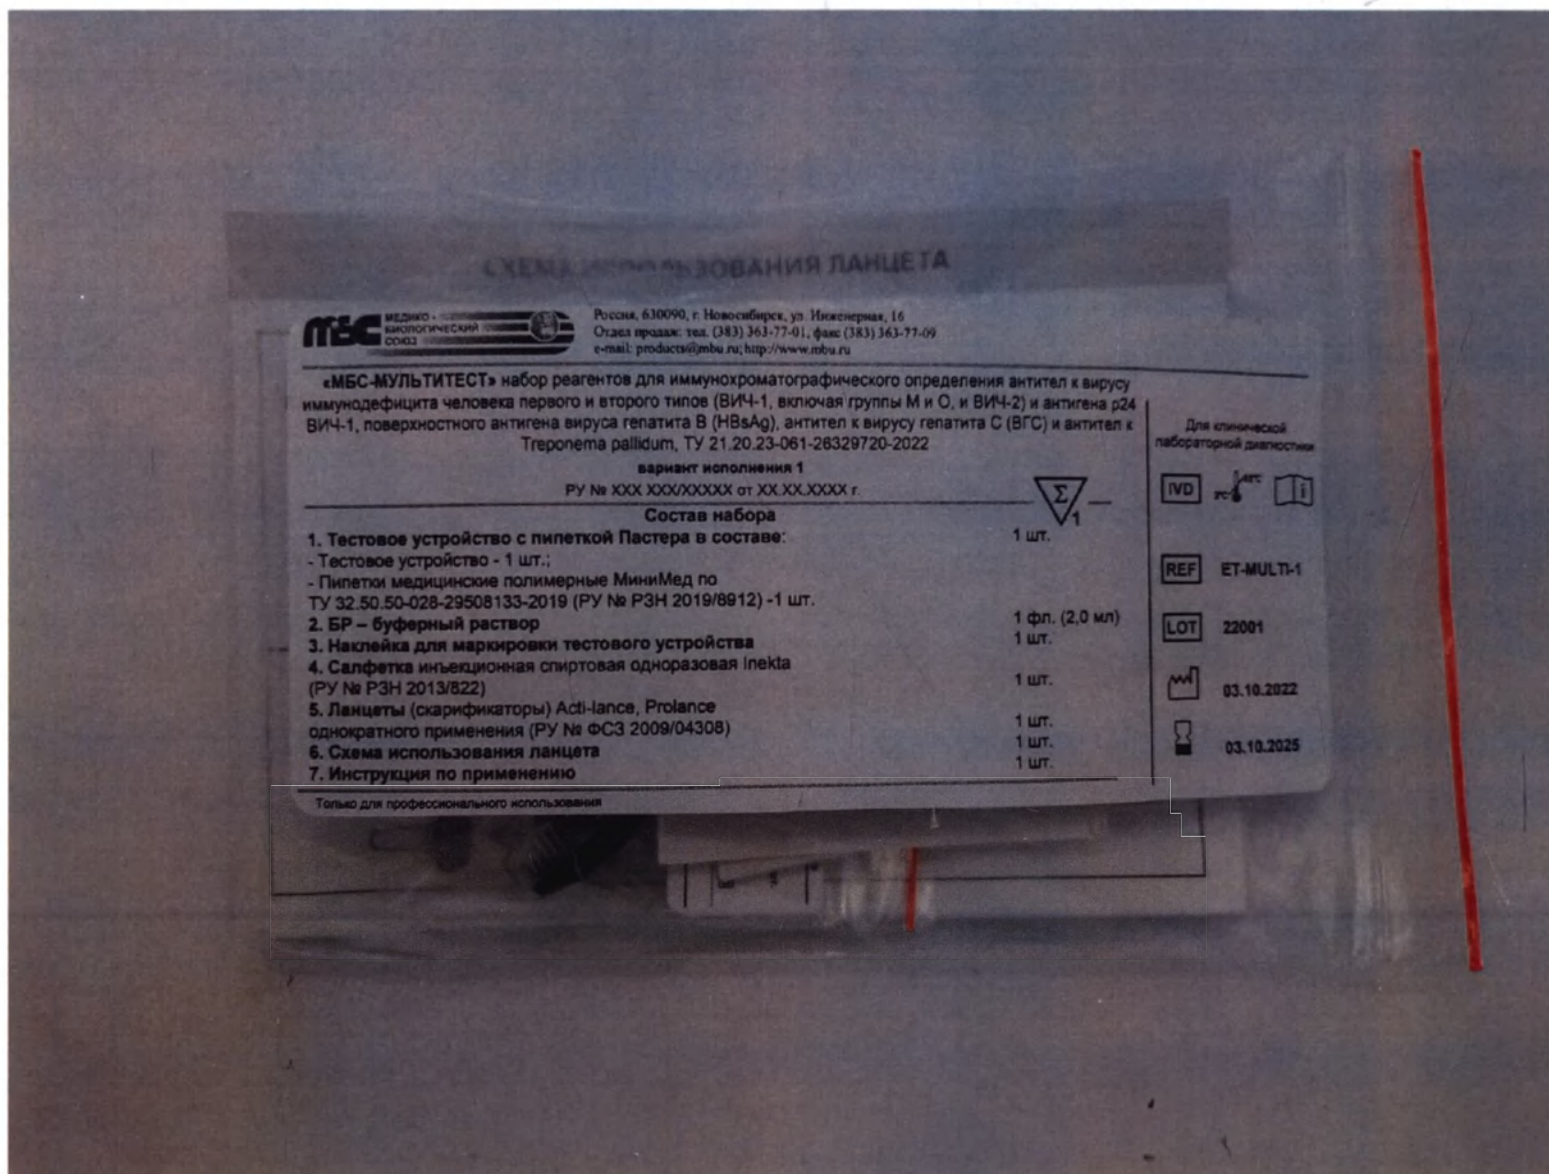

МБС ООО «Медико-биологический Союз»
 Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Электронная почта: info@cirmi.ru, www.goszdravnadzor.ru
 e-mail: info@cirmi.ru, www.goszdravnadzor.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к Треропетаму раллидум, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022

серийный номер: 22001

ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 от 03.04.2026

Состав набора

1. Тестовое устройство с пилеткой Пастера в составе	1 шт.
- Тестовое устройство - 1 шт.	
- Пилетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ТУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.	
2. БР - буферный раствор	1 шт. (2,0 мл)
3. Наклейка для маркировки тестового устройства	1 шт.
4. Салфетка интенсиональная спиртовая одноразовая Inetta (ТУ № РЗН 2013/822)	1 шт.
5. Пилетки (картриджи) Ас-1-анте, Роланте одноразового применения (ТУ № ФСЗ 2009/04308)	1 шт.
6. Схема использования ланцета	1 шт.
7. Инструкция по применению	1 шт.

Пилетка для профессионального использования

Для клинической лабораторной диагностики

IVD REF ET-MULTI-1 LOT 22001 03.10.2022 03.10.2025

Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
 65*56 мм

ООО «Медико-биологический Союз»
 Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАНЦЕТА

1. УДАЛИТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК
 ПОВЕРНУТИ
 ВЫТАЩИТИ

2. ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ К ПОДУШЕЧКЕ ПАЛЬЦА

3. НАЖМИТЕ КНОПКУ

ВНИМАНИЕ!

ООО «Медико-биологический Союз»
 БР - буферный раствор
 LOT 22001
 03.04.2026

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пилеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.
- Пилетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ТУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

LOT 22001 03.04.2026

IVD 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 Модель: Пилетка для ланцета (Пастера): 0,25 мл

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»


630090, 2. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353

ООО «Медико-биологический Союз»

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению медицинского изделия для диагностики in vitro

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
 набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к Треропетаму раллидум, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

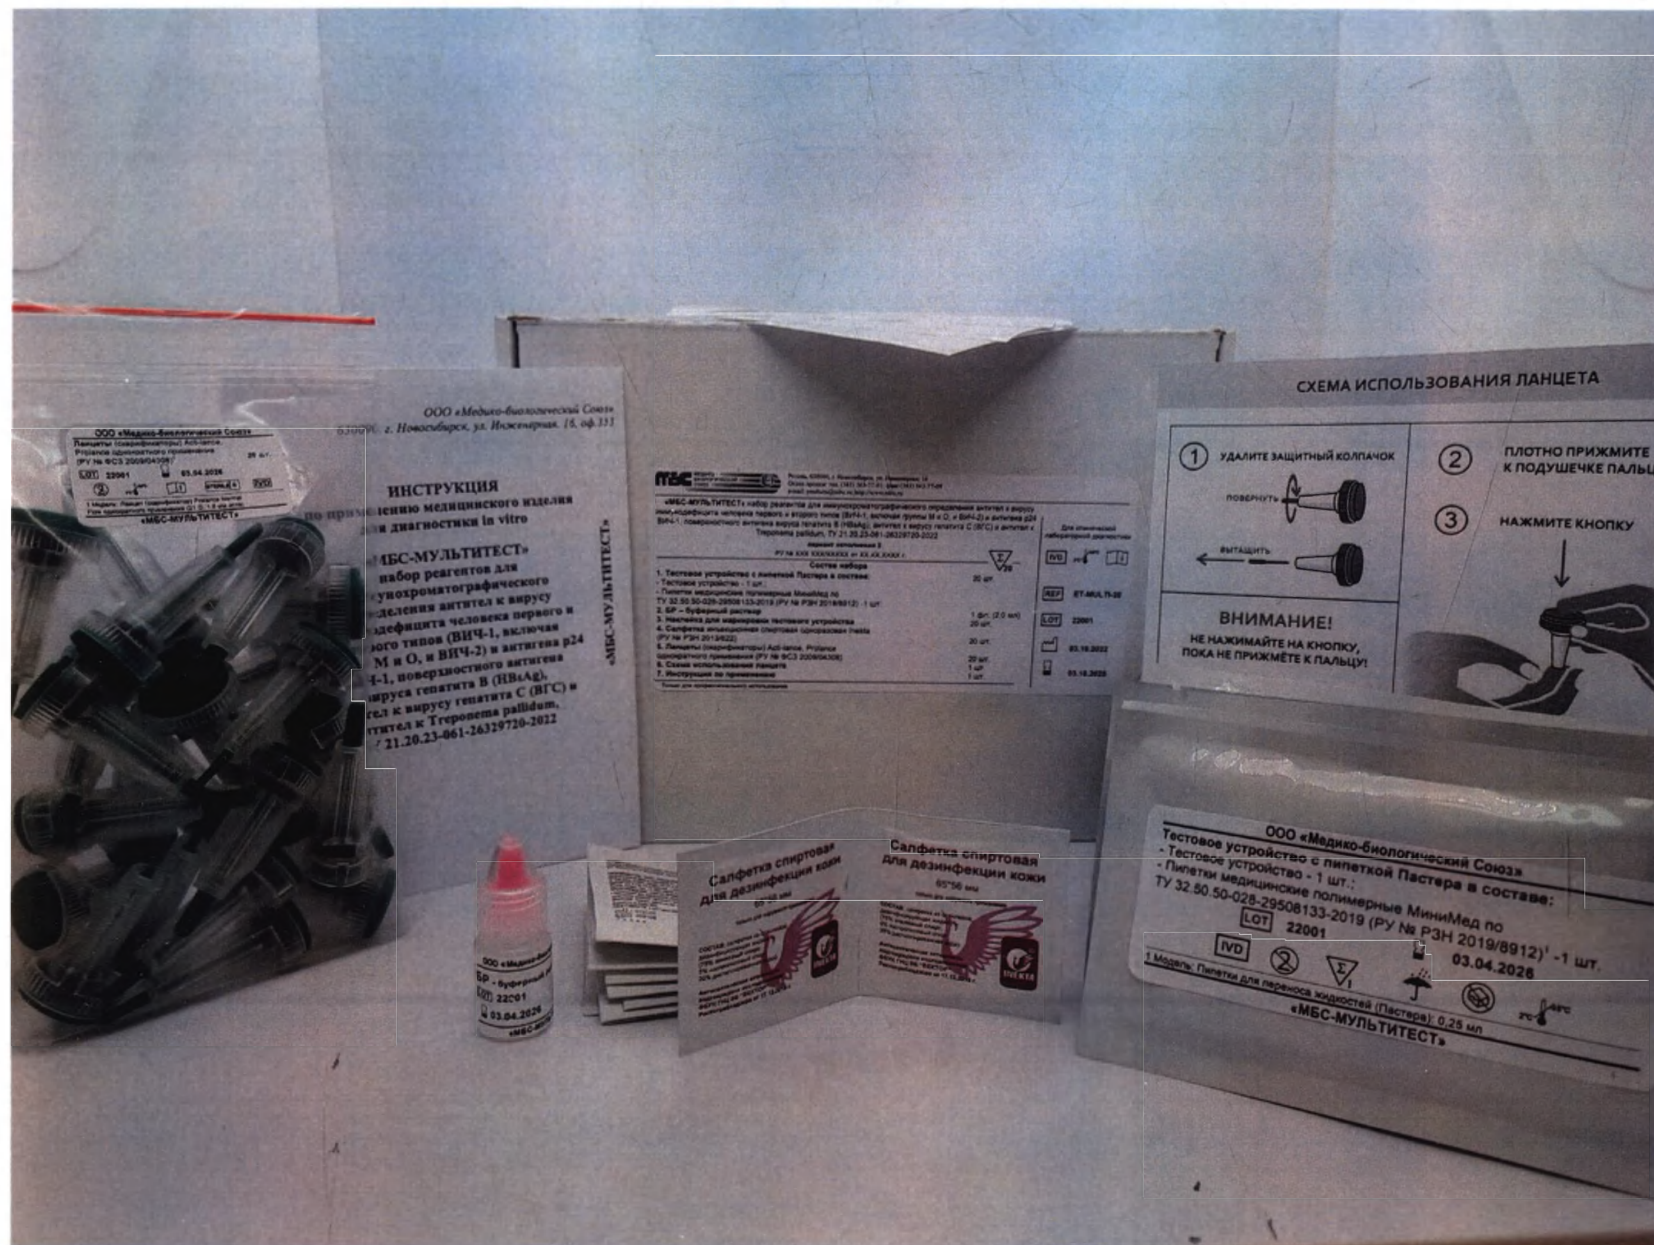

ООО «Медико-биологический Союз»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф.353

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия для диагностики in vitro


«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для
иммунохроматографического
определения антител к вирусу
иммунодефицита человека первого и
второго типов (ВИЧ-1, включая
группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24
ВИЧ-1, поверхностного антигена
вируса гепатита В (HBeAg)

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»
Регистрационный номер:
РП № ФСЗ 205040209
03.04.2026
LOT 22001
ИВД
Тестовое устройство с пипеткой Пастера
МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РП № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАНЦЕТА


① УДАЛИТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



ПОВЕРНУТЬ
ВЫТАЩИТЬ


② ПЛОТНО ПРИЖМИТЕ
К ПОДУШЕЧКЕ ПАЛЬЦА

③ НАЖМИТЕ КНОПКУ

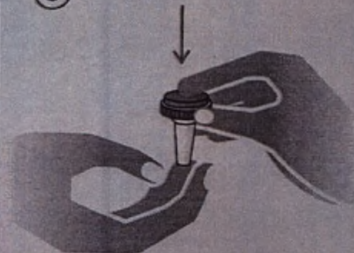

ВНИМАНИЕ!

НЕ НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКУ,
ПОКА НЕ ПРИЖМЕТЕ К ПАЛЬЦУ!



Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи
67x56 мм

Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи
67x56 мм

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РП № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.


LOT 22001

03.04.2026



1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к *Treponema pallidum*, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022

вариант исполнения 2

ПУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

20 шт.

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор

1 фл. (2,0 мл)

3. Наклейка для маркировки тестового устройства

20 шт.

4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (ПУ № РЗН 2013/822)

20 шт.

5. Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (ПУ № ФСЗ 2009/04308)

20 шт.

6. Схема использования ланцета

1 шт.

7. Инструкция по применению

1 шт.

Только для профессионального использования



Для клинической
лабораторной диагностики



ET-MULTI-20




22001



03.10.2022



03.10.2025

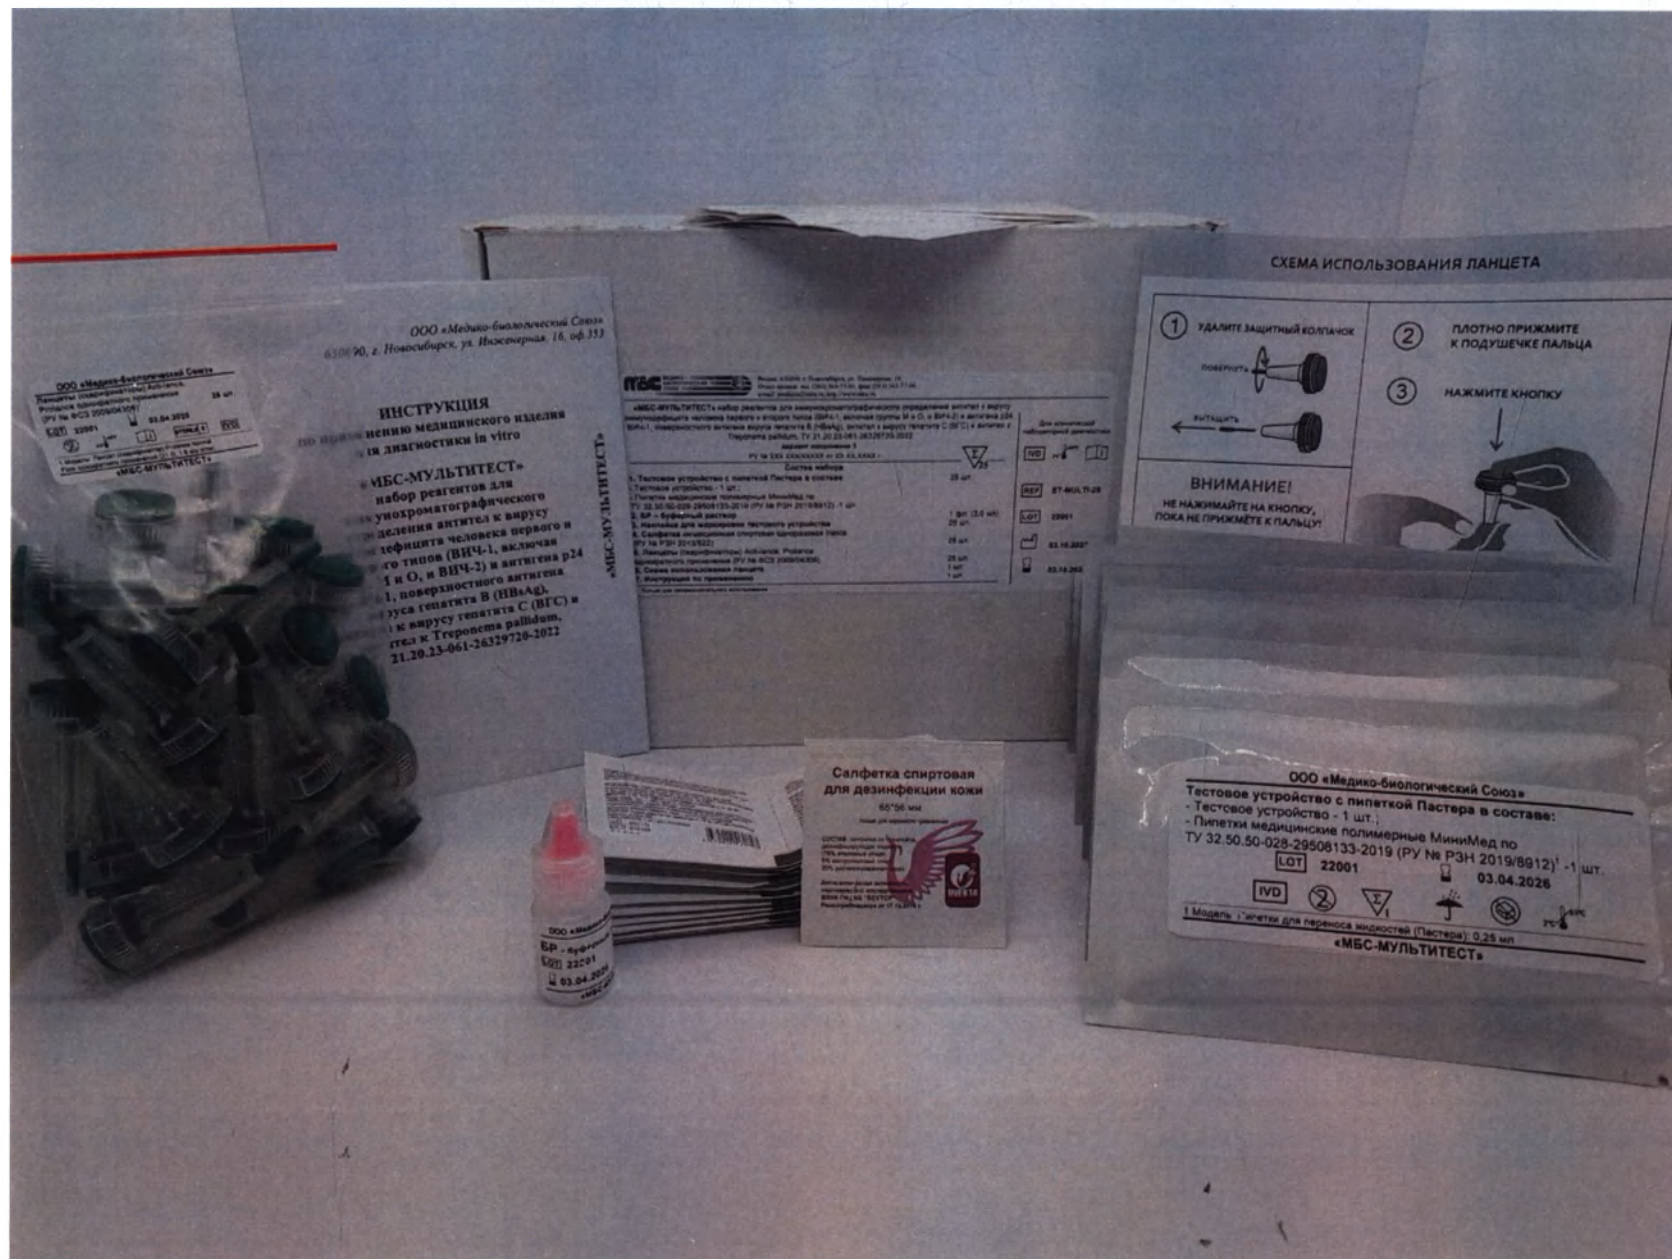

ООО «Медико-биологический Союз»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф.353



ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия для диагностики in vitro

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для
иммунохроматографического
определения антител к вирусу
иммунодефицита человека первого и
второго типа (ВИЧ-1, включая
2) и антигена р24
ого антигена
3 (HBsAg),
антитела к Герpes-вирусу типа С (VTC) и
а pallidum,
17-21-23-061-243 9720-2022

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»
Регистратура (сертификат) АИЗ-Мед
Идентификационный номер изделия
(ПУ № ВСС 2008/04/201)
LOT 22001 03.04.2026
Модель: Пипетка (сертификат) РМБС-М
Регистратура (сертификат) РМБС-М
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАНЦЕТА

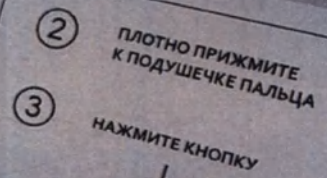

ВНИМАНИЕ!
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКУ,
ПОКА НЕ ПРИЖМЁТЕ К ПАЛЬЦУ!

Салфетка спиртовая
для дезинфекции кожи
65*66 мм

СОСТАВ: салфетки из нетканого
материала, пропитанные 70% спиртом
(70% этиловый спирт,
2% хлоргексидин, 2% антисептический раствор,
20% дезинфицирующего средства)
Антисептическая салфетка
назначается для дезинфекции
кожных поверхностей перед
использованием медицинского изделия
Регистратура от 17.12.2019 г.

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.


LOT 22001

03.04.2026



¹ Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к *Treponema pallidum*, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022

вариант исполнения 3

ПУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
 - Тестовое устройство - 1 шт.;
 - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.
2. БР – буферный раствор
3. Наклейка для маркировки тестового устройства
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (ПУ № РЗН 2013/822)
5. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (ПУ № ФСЗ 2009/04308)
6. Схема использования ланцета
7. Инструкция по применению

25 шт.

1 фл. (2,0 мл)


25 шт.

25 шт.


25 шт.

1 шт.

1 шт.



Для клинической
лабораторной диагностики



REF ET-MULTI-25

LOT 22001


03.10.2022

03.10.2025

Только для профессионального использования

Вариант исполнения 4



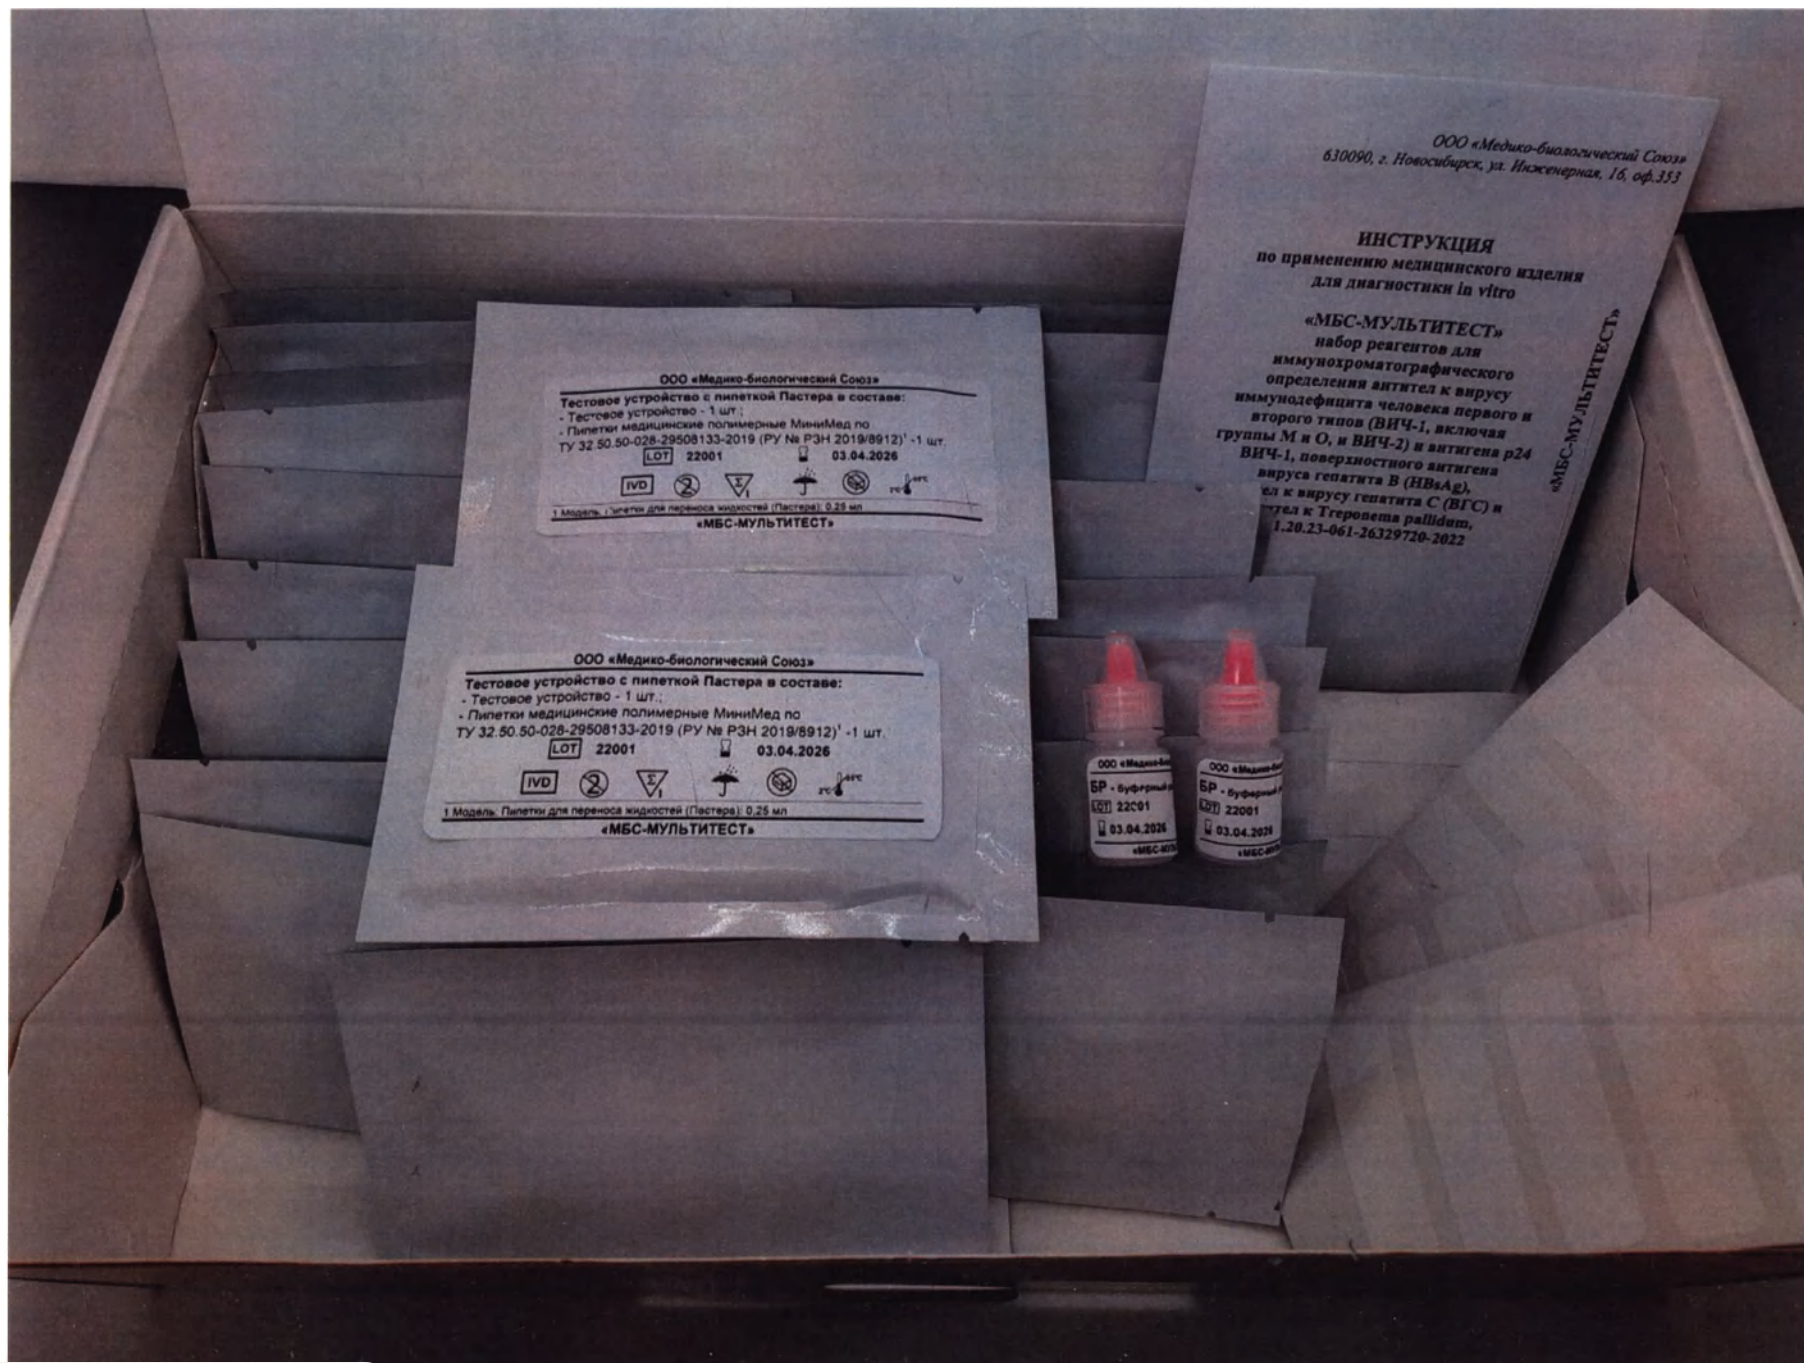


ООО «Медико-биологический Союз»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353

ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия для диагностики in vitro

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для
иммунохроматографического
определения антител к вирусу
иммунодефицита человека первого и
второго типов (ВИЧ-1, включая
группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24
ВИЧ-1, поверхностного антигена
вируса гепатита В (HBsAg),
антител к вирусу гепатита С (HCV) и
антител к Тромбоцитам (HbAg),
1.20.23-061-26329720-2022

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.
LOT 22001 03.04.2026




1 Модель. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.
LOT 22001 03.04.2026



1 Модель. Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»





Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (HCV) и антител к *Typhlophaga pallidum*, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022
вариант исполнения 4
РУ № XXX XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе: - Тестовое устройство - 1 шт.; - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.	40 шт.
2. БР – буферный раствор	2 фл. (по 2,0 мл)
3. Наклейка для маркировки тестового устройства	40 шт.
4. Инструкция по применению	1 шт.


Только для профессионального использования


REF ET-MULTI-40
LOT 22001
03.10.2022
03.10.2025

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Вариант исполнения 5

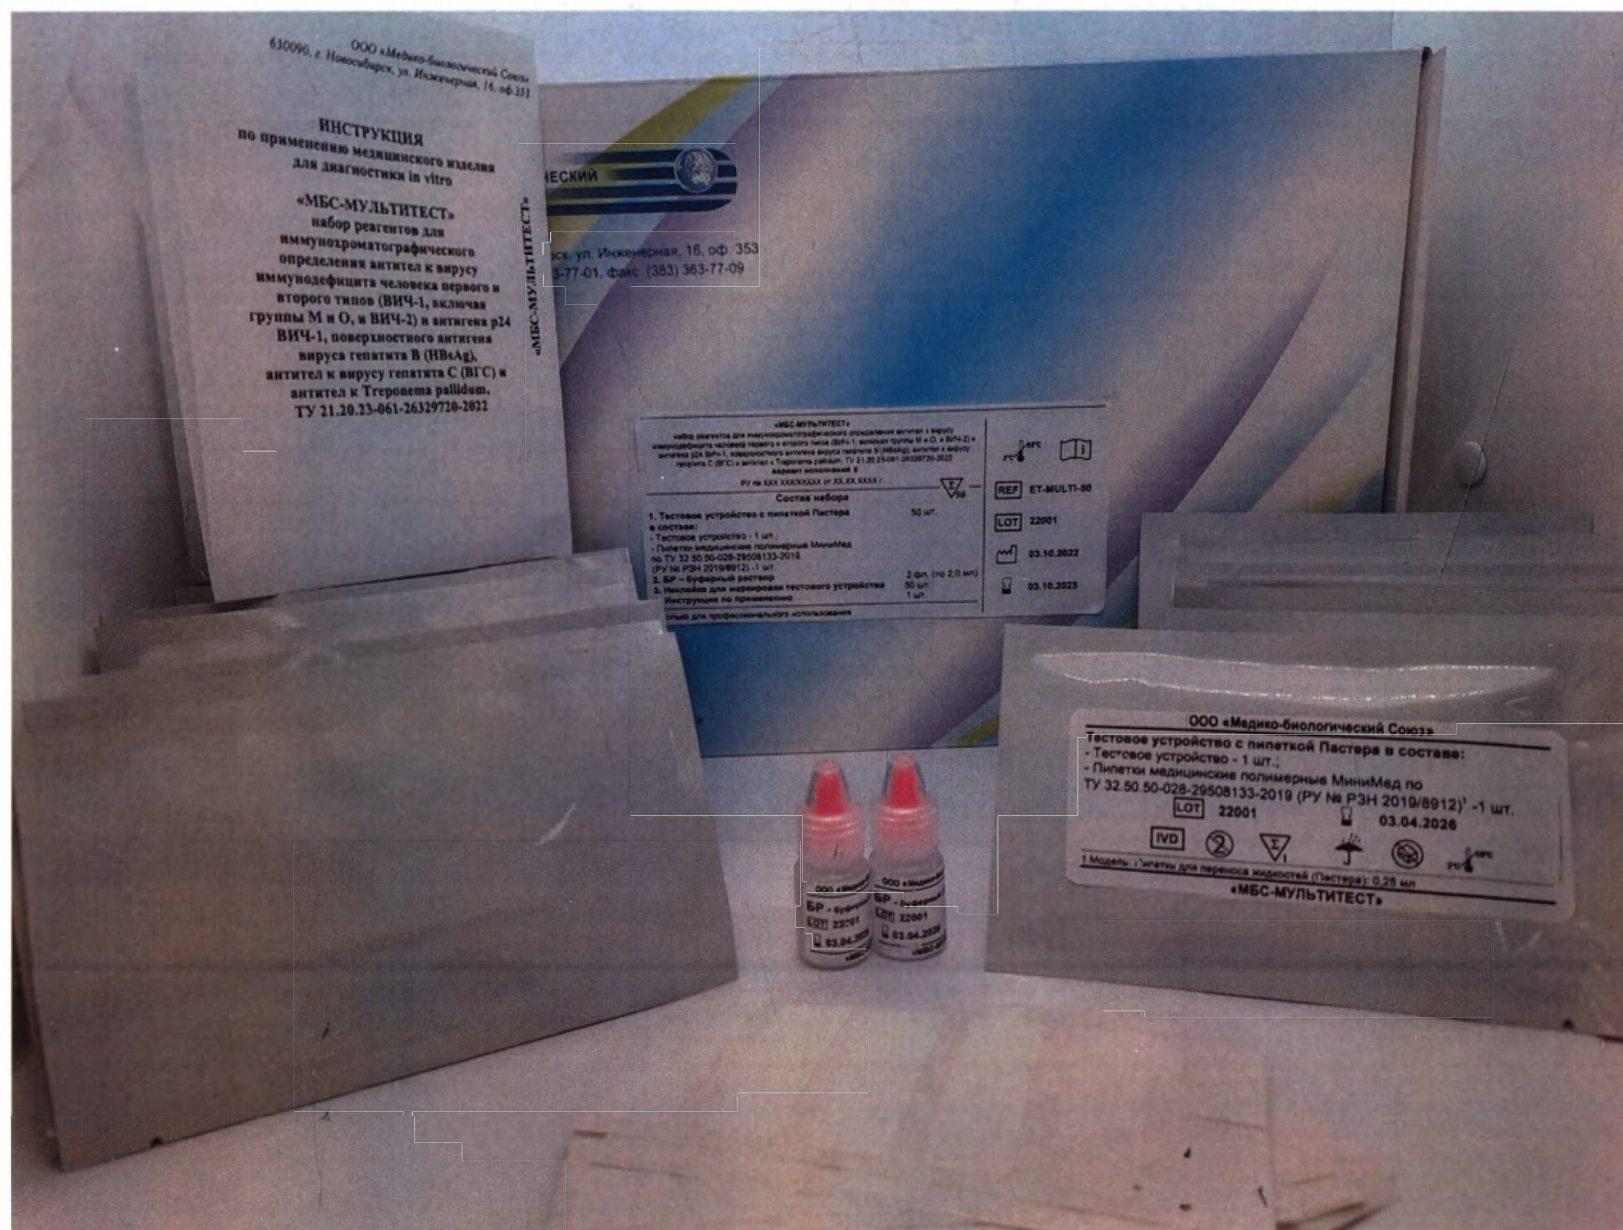

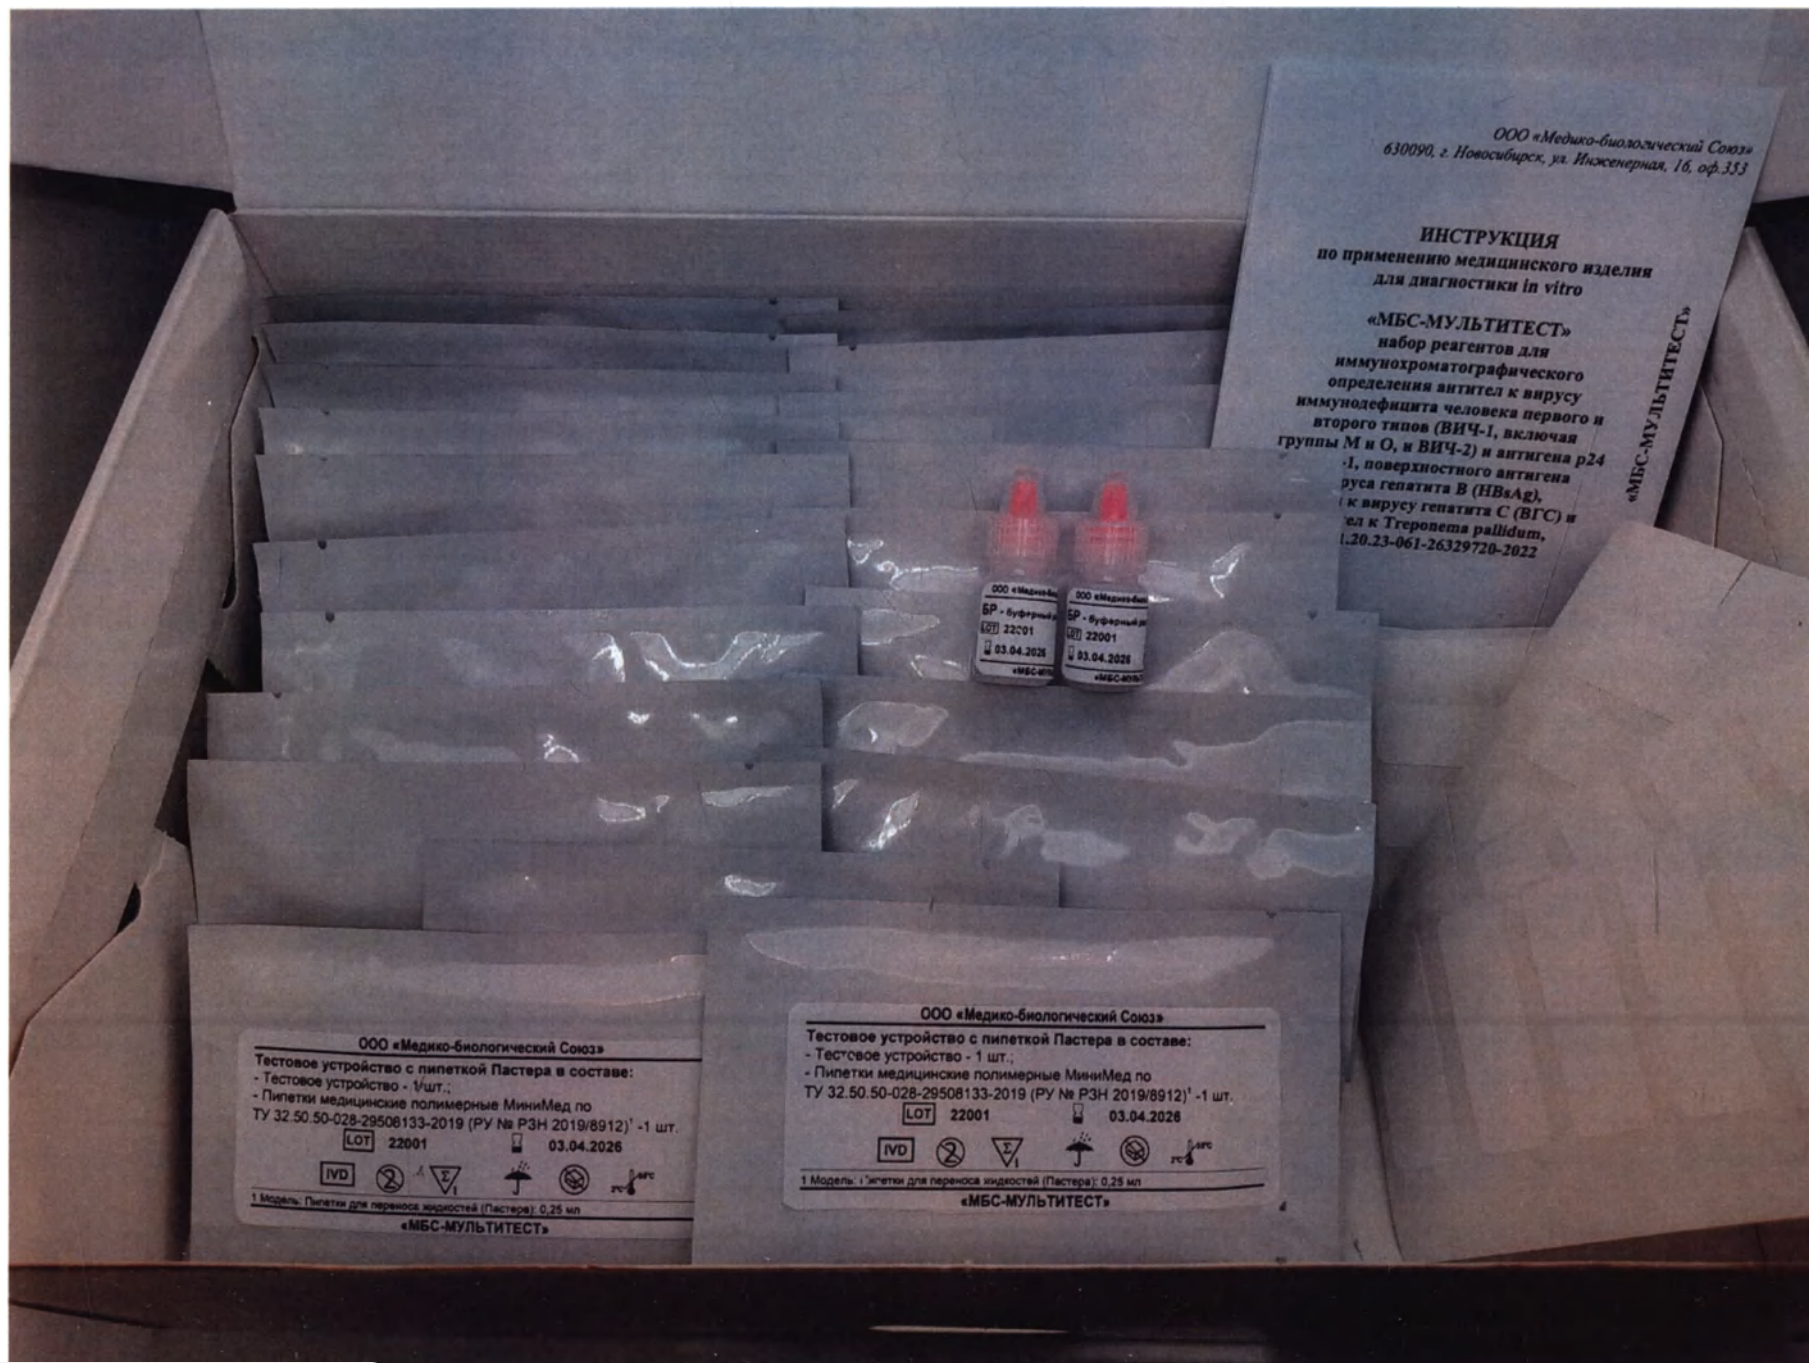

ООО «Медико-биологический Союз»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353


ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия для диагностики in vitro

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для
иммунохроматографического
определения антител к вирусу
иммунодефицита человека первого и
второго типов (ВИЧ-1, включая
группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24
-1, поверхностного антигена
руса гепатита В (HBsAg),
к вирусу гепатита С (ВГС) и
к *Treponema pallidum*,
1.20.23-061-26329720-2022

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.,
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.
LOT 22001 03.04.2026
IVD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»
Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.,
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹ - 1 шт.
LOT 22001 03.04.2026
IVD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу
иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и
антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу
гепатита С (HCV) и антител к T-гепатита pallidum, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022
вариант исполнения 5
РУ № XXX XXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе:
- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019
(РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | 50 шт. |
| 2. БР – буферный раствор | 2 фл. (по 2,0 мл) |
| 3. Наклейка для маркировки тестового устройства | 50 шт. |
| 4. Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для профессионального использования



REF ET-MULTI-50


LOT 22001

03.10.2022

03.10.2025

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

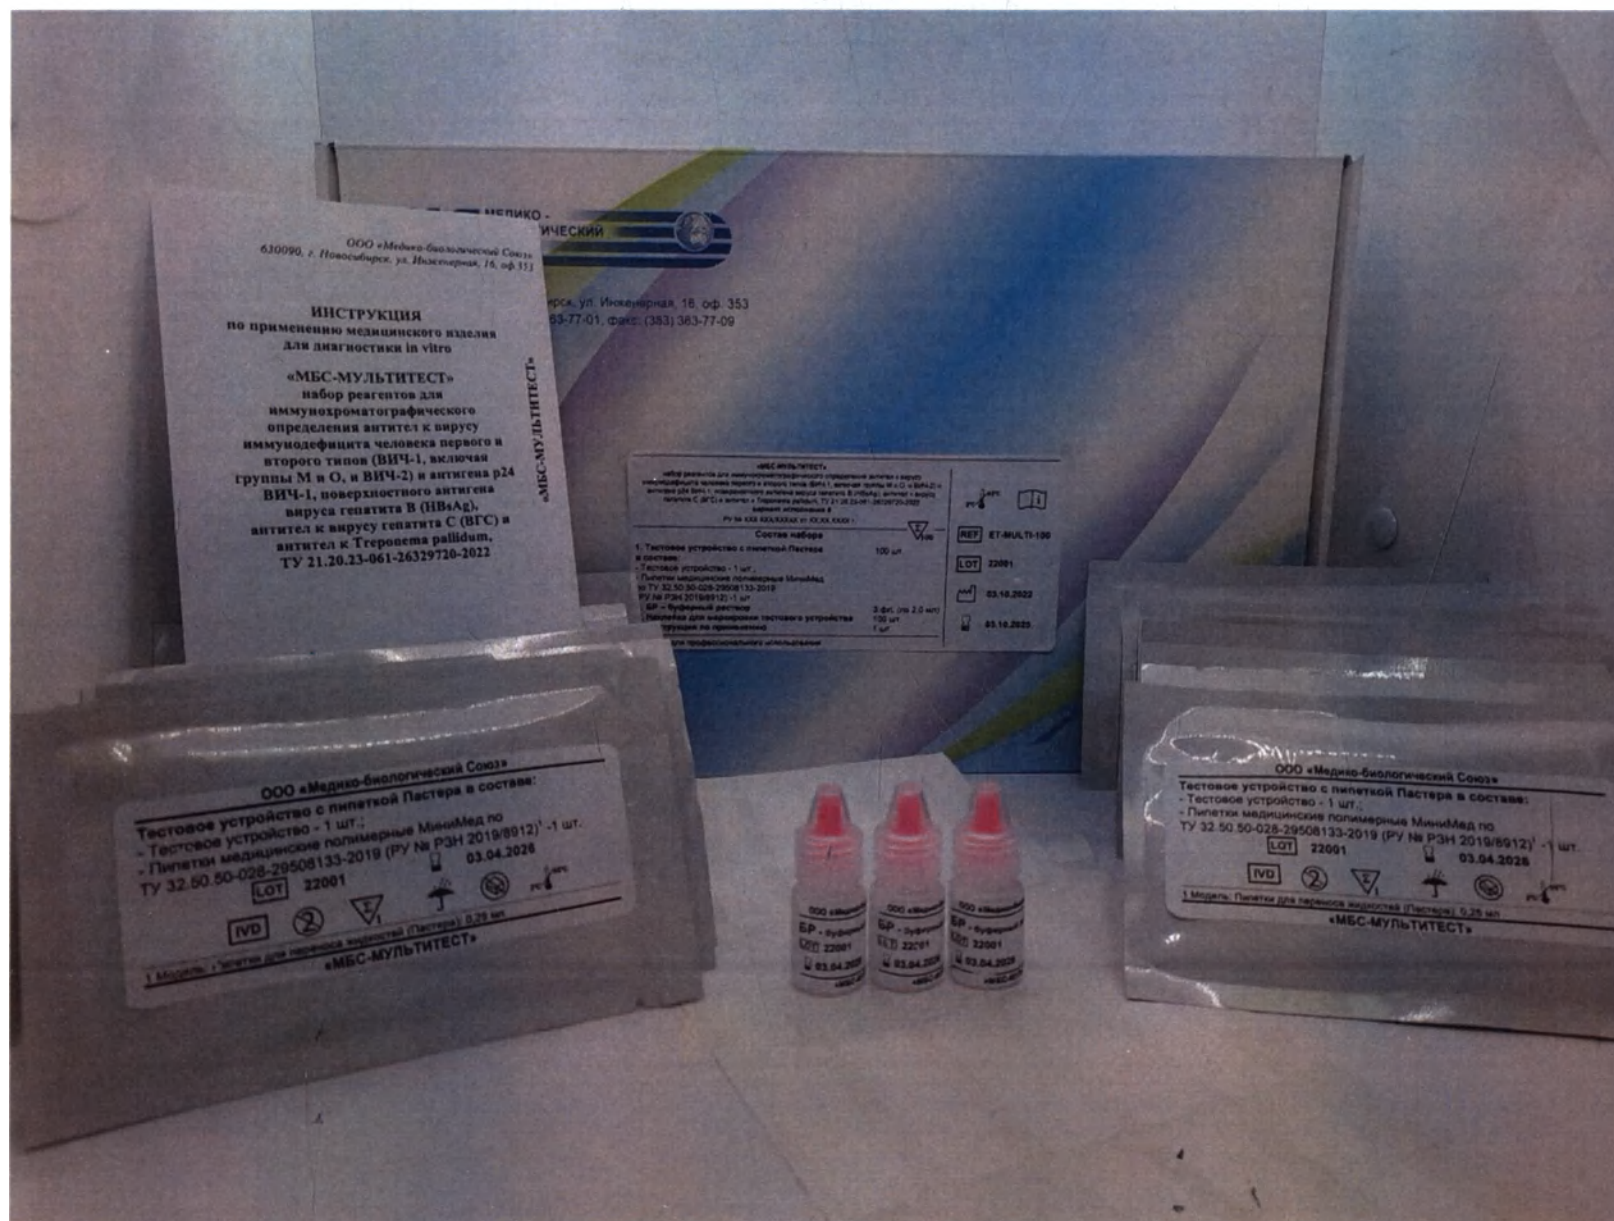

ООО «Медико-биологический Союз»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
для диагностики in vitro

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для
иммунохроматографического
определения антител к вирусу
иммунодефицита человека первого и
второго типов (ВИЧ-1, включая
группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24
ВИЧ-1, поверхностного антигена
вируса гепатита В (HBsAg),
антител к вирусу гепатита С (ВГС) и
антител к *Treponema pallidum*,
ТУ 21.20.23-061-26329720-2022

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

LOT 22001

03.04.2026



1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

LOT 22001


03.04.2026



1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»





МЕДИКО -
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
СОЮЗ

Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16, оф. 353
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»
набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (HCV) и антител к *Typhoea pallidum*. ТУ 21.20.23-061-26329720-2022
вариант исполнения 6
РУ № XXX XXXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с липеткой Пастера в составе: - Тестовое устройство - 1 шт.; - Липетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.	100 шт.
2. БР – буферный раствор	3 фл. (по 2,0 мл)
3. Наклейка для маркировки тестового устройства	100 шт.
4. Инструкция по применению	1 шт.

Только для профессионального использования

REF ET-MULTI-100
LOT 22001
03.10.2022
03.10.2025


IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Внутренняя маркировка набора реагентов


Упаковка компонента набора реагента «Тестовое устройство»

Вариант исполнения 1-6

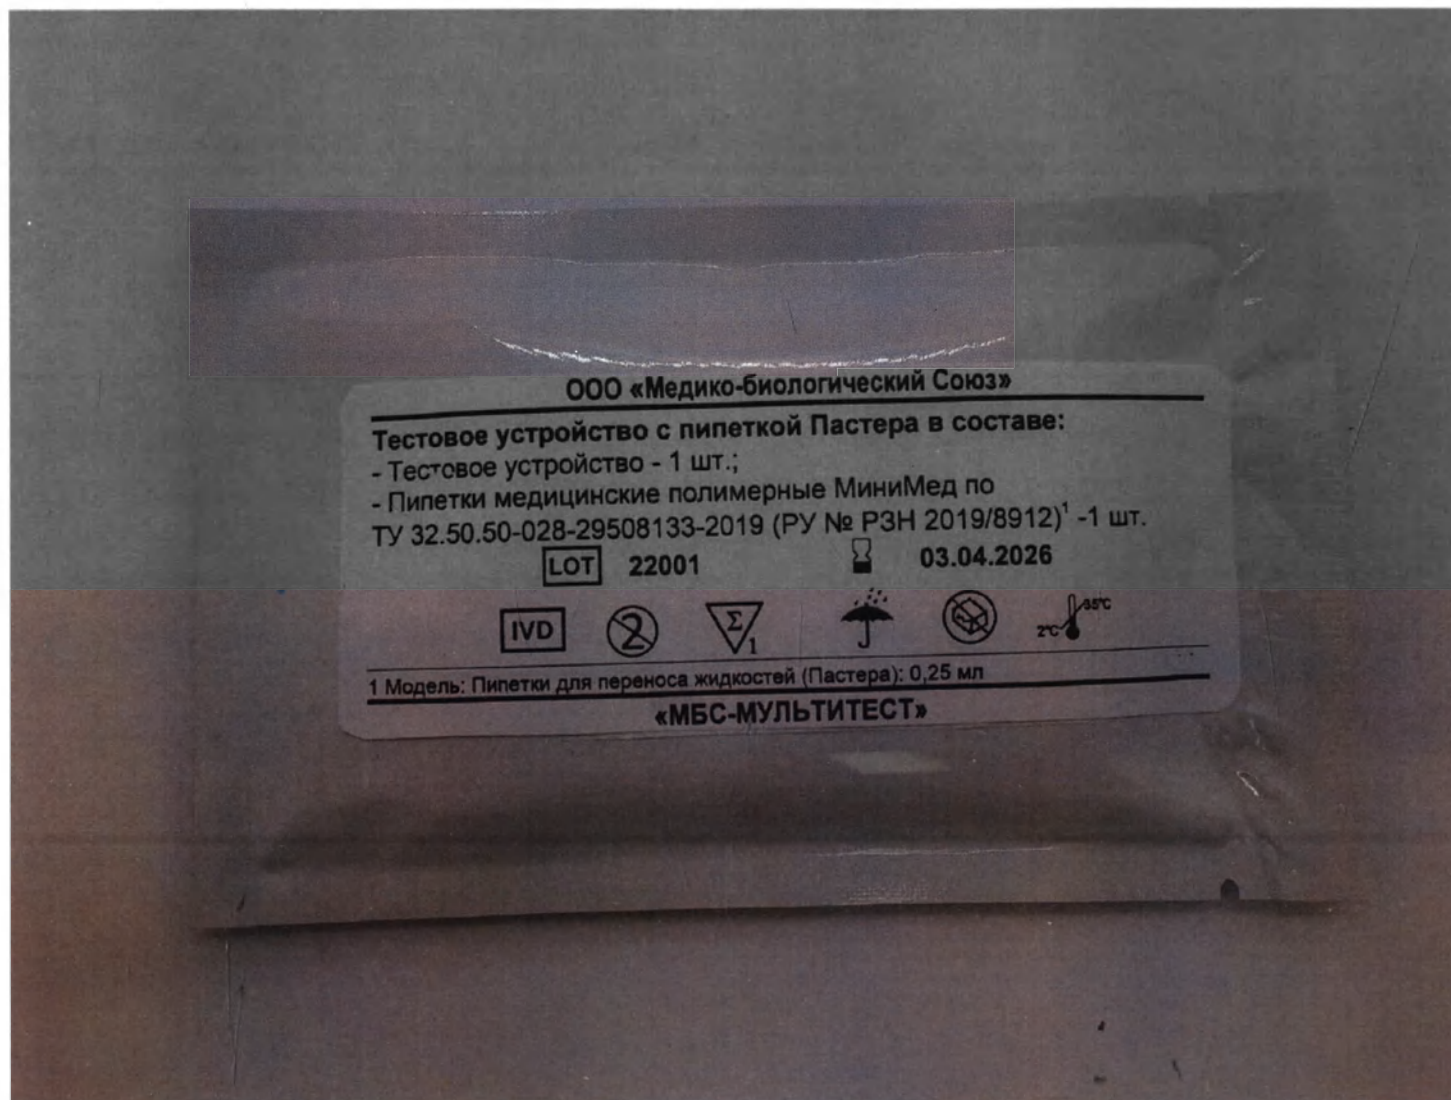


«БР» - буферный раствор


Вариант исполнения 1-6

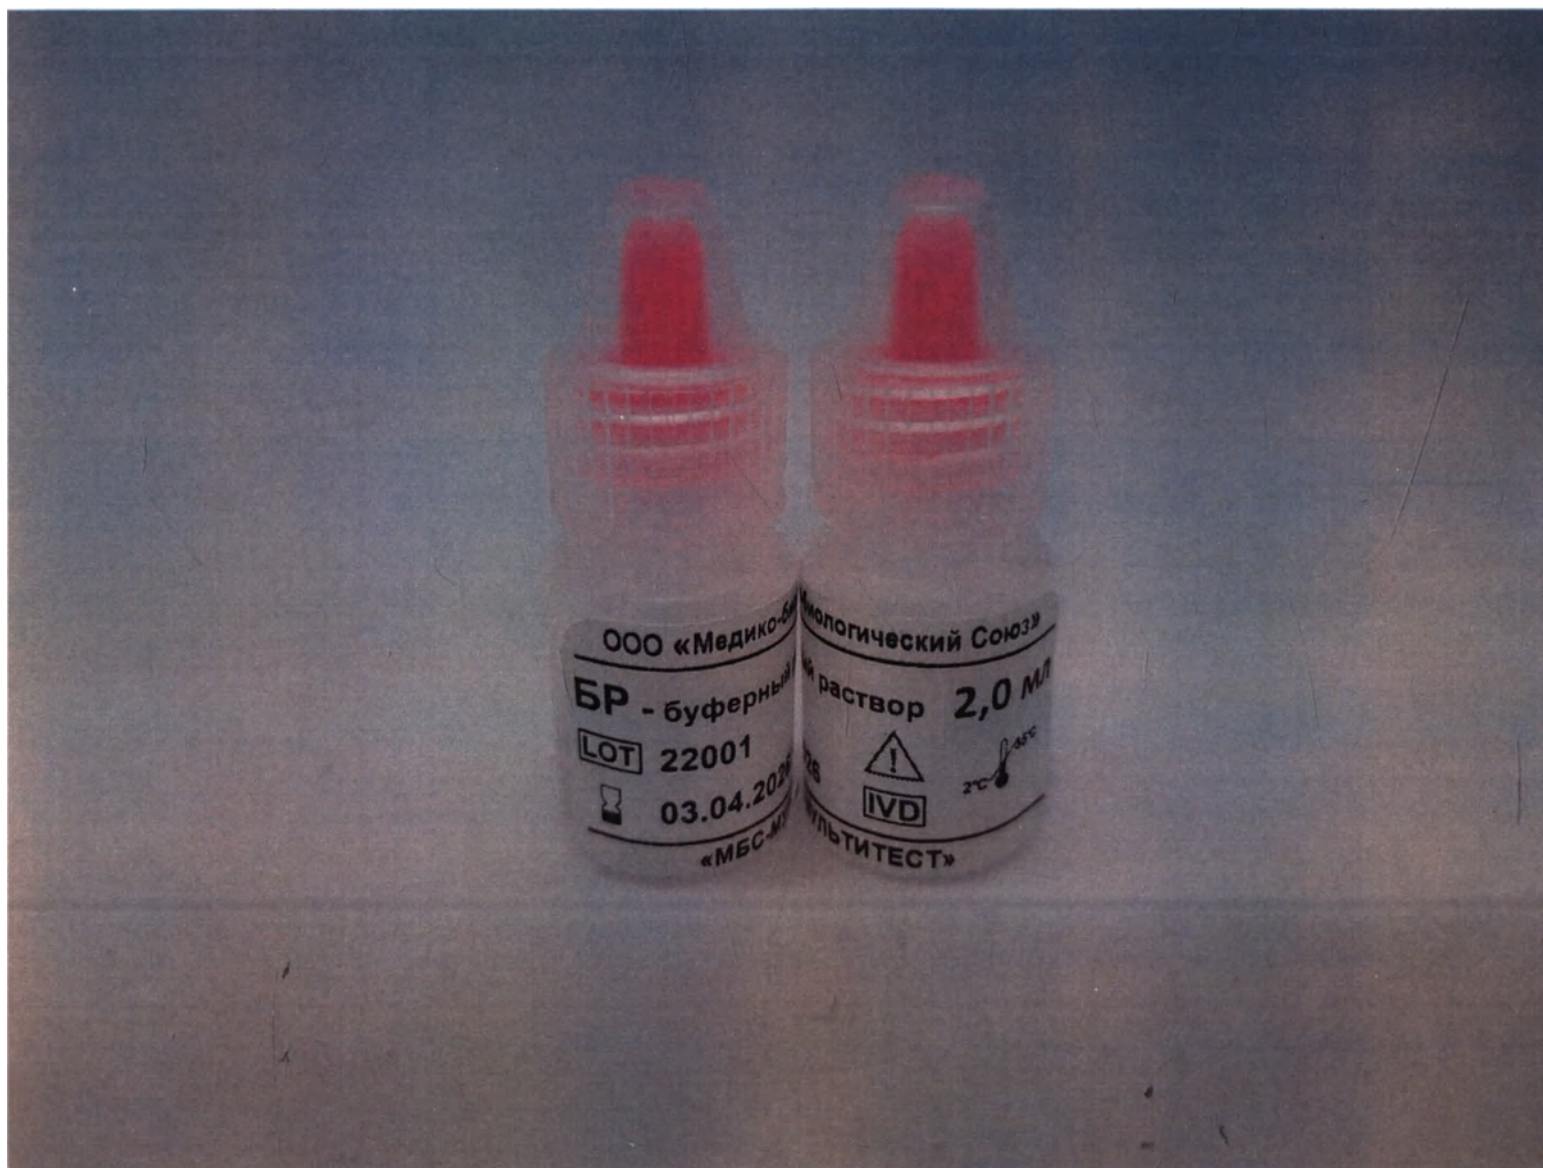


Скарификатор

Вариант исполнения 1

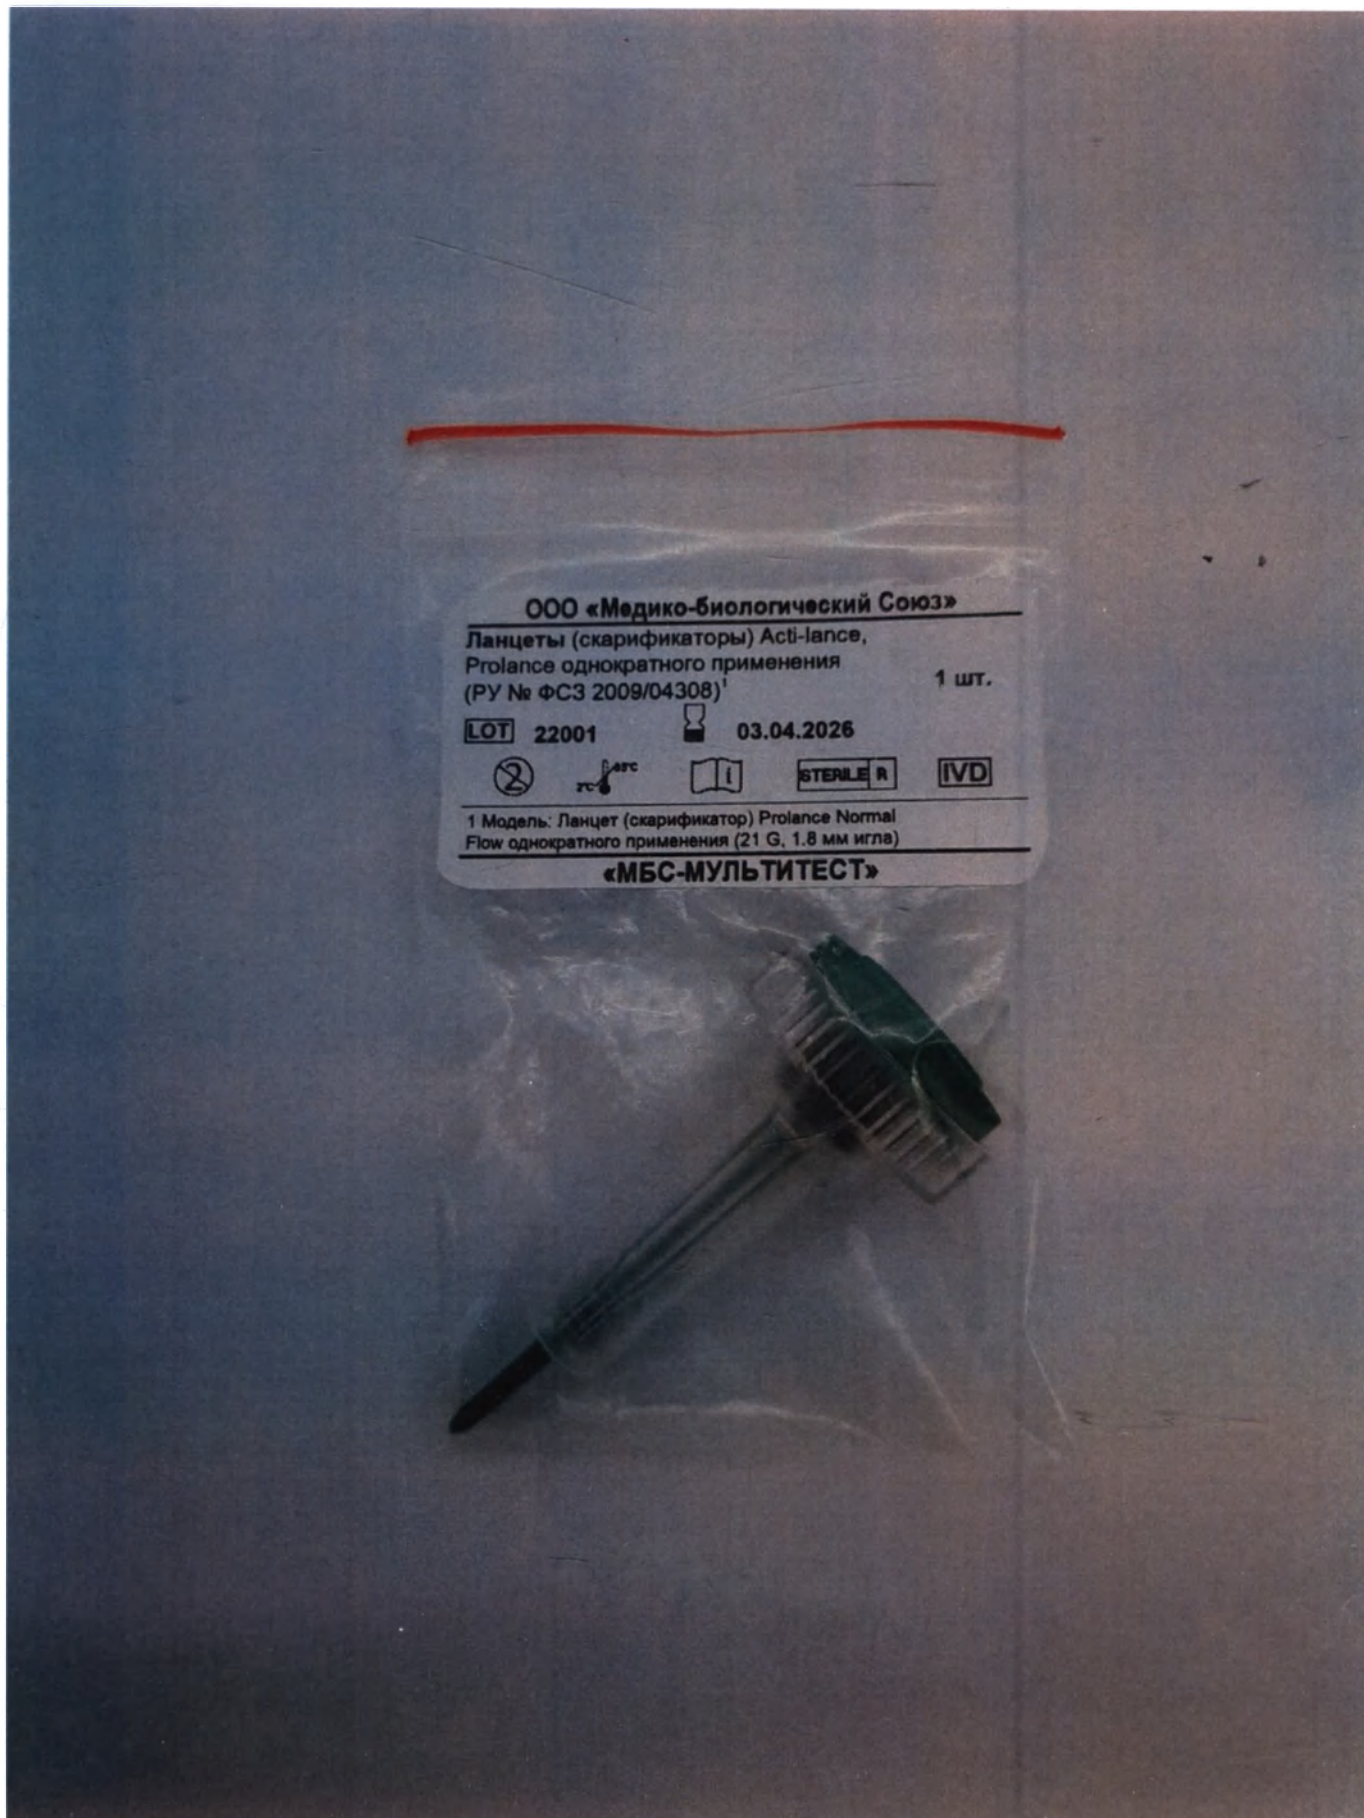

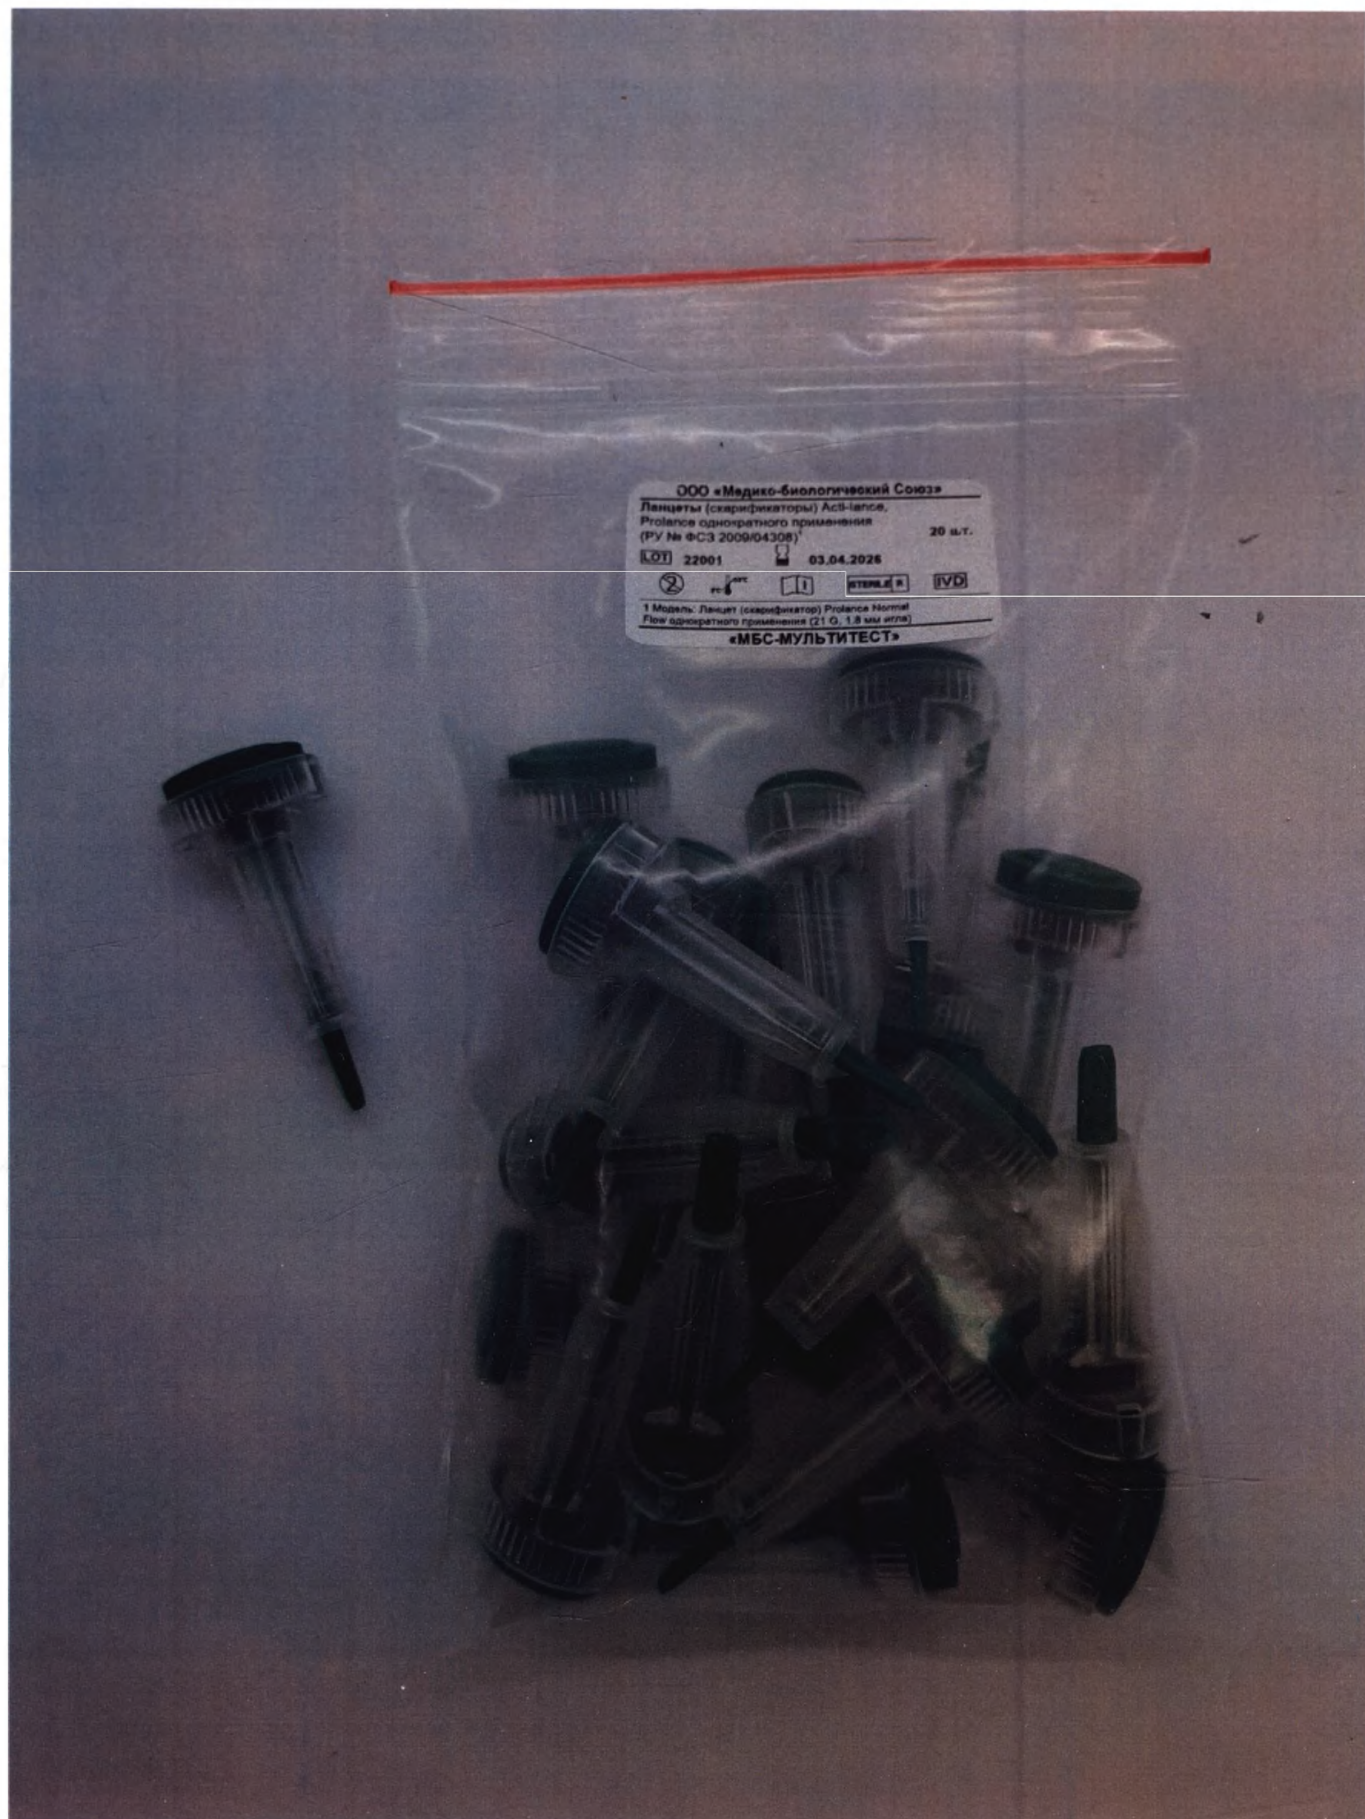

Вариант исполнения 3

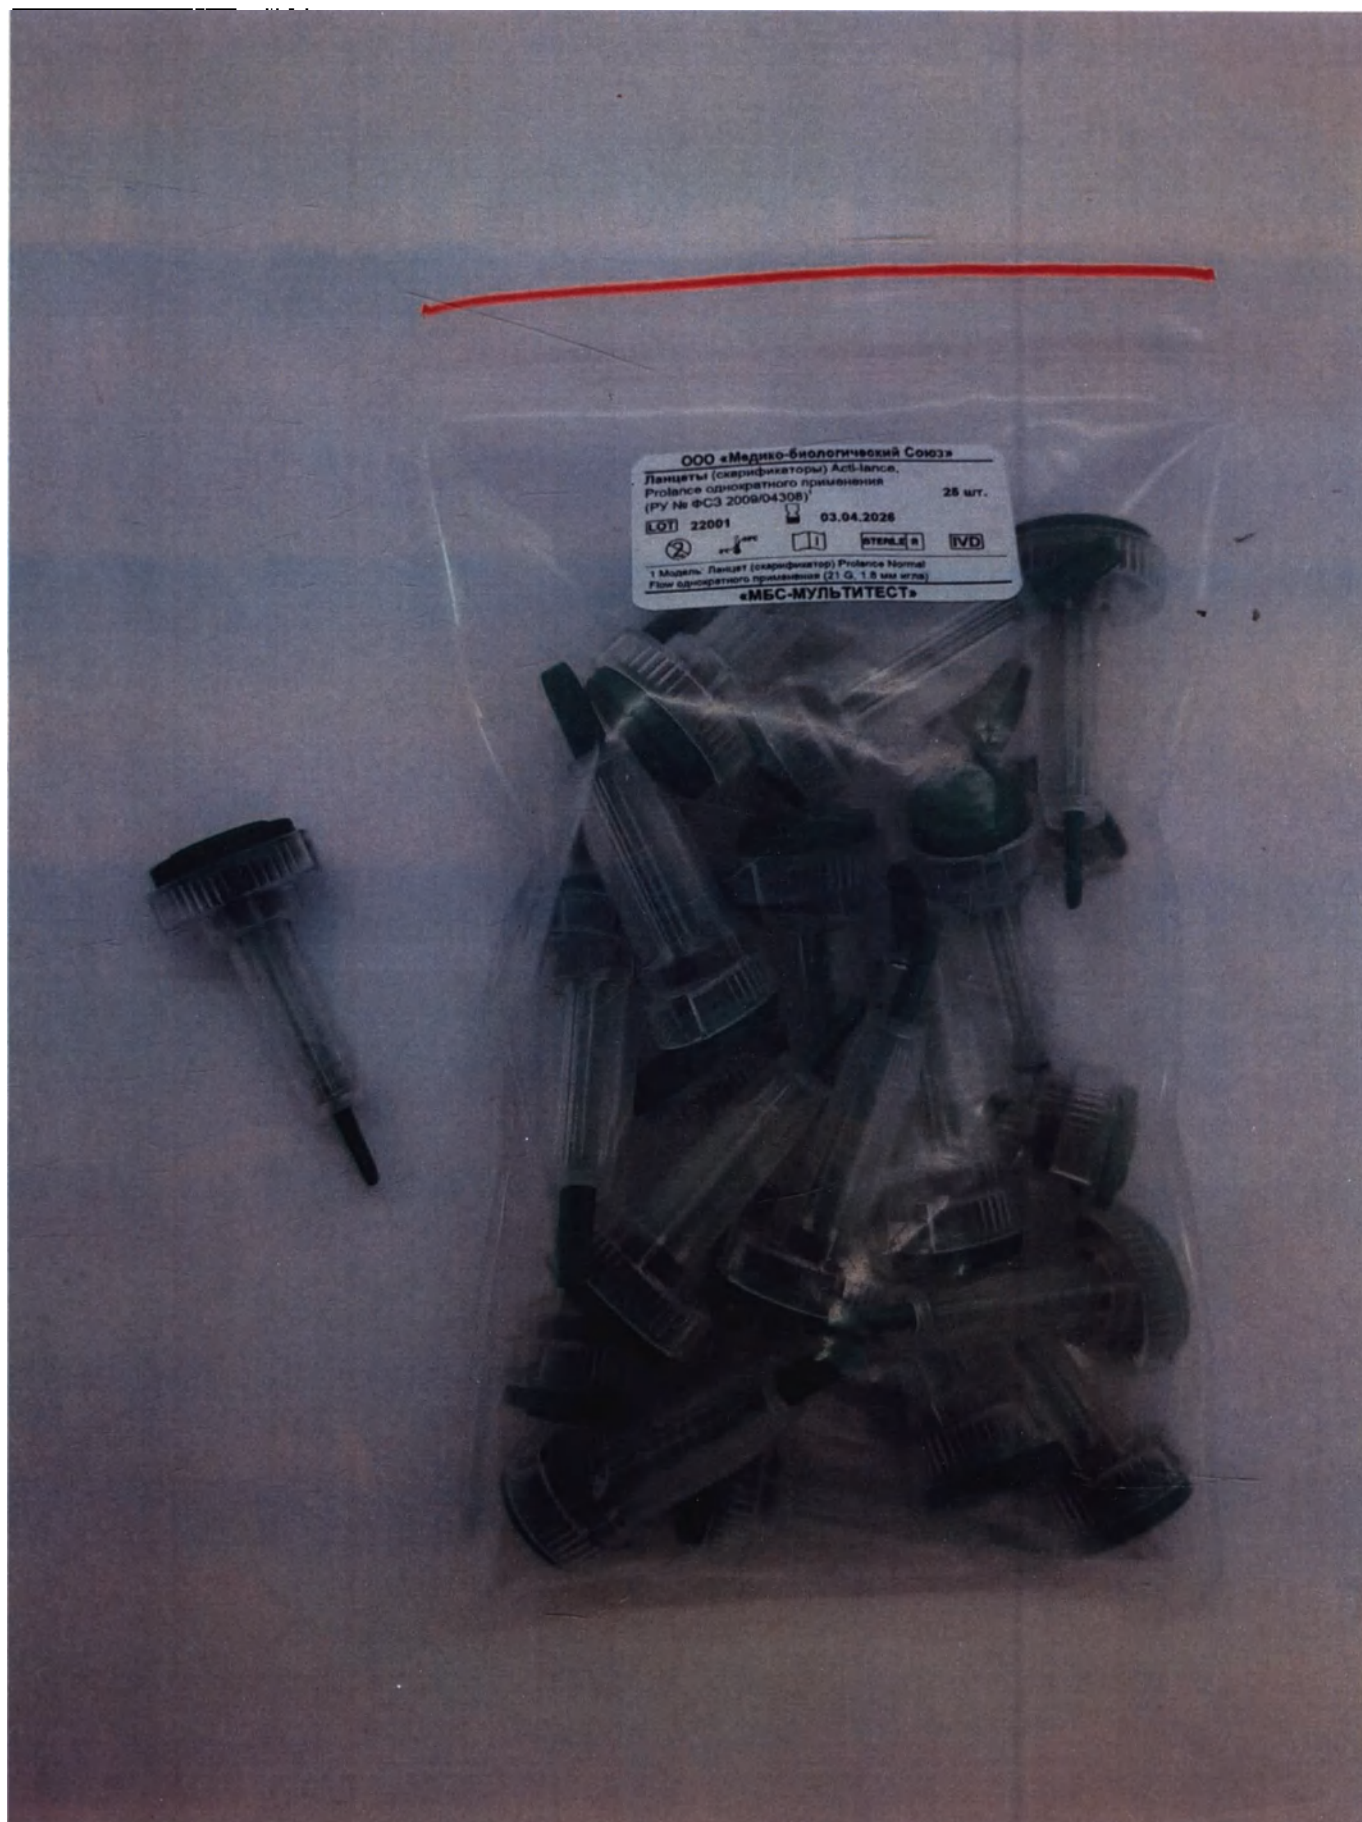

Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (ПУ № РЗН 2013/822) (упаковка от производителя МИ)

Вариант исполнения 1-3



Лицевая сторона салфетки инъекционной спиртовой одноразовой Inekta (ПУ № РЗН 2013/822)



Обратная сторона салфетки инъекционной спиртовой одноразовой Inekta (ПУ № РЗН 2013/822)

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на (24) листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Медико-биологический Союз»

М.В. Лосев

«03» марта 2023 г.




Образцы маркировки медицинского изделия


**«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для
иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита
человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2)
и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg),
антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к *Treponema pallidum*,
ТУ 21.20.23-061-26329720-2022**

Внешняя маркировка


Вариант исполнения 1


		Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к <i>Treponema pallidum</i> , ТУ 21.20.23-061-26329720-2022			
вариант исполнения 1 РУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.			
Состав набора			
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	1 шт.		
- Тестовое устройство - 1 шт.;			
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.			
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)		
3. Наклейка для маркировки тестового устройства	1 шт.		
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	1 шт.		
5. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	1 шт.		
6. Схема использования ланцета	1 шт.		
7. Инструкция по применению	1 шт.		
Только для профессионального использования		Для клинической лабораторной диагностики     ET-MULTI-1  XXXXX  XX.XX.XXXX  XX.XX.XXXX	

Вариант исполнения 2

		Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к <i>Treponema pallidum</i> , ТУ 21.20.23-061-26329720-2022			
вариант исполнения 2 РУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.			
Состав набора			
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	20 шт.		
- Тестовое устройство - 1 шт.;			
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.			
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)		
3. Наклейка для маркировки тестового устройства	20 шт.		
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	20 шт.		
5. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	20 шт.		
6. Схема использования ланцета	1 шт.		
7. Инструкция по применению	1 шт.		
Только для профессионального использования		Для клинической лабораторной диагностики     ET-MULTI-20  XXXXX  XX.XX.XXXX  XX.XX.XXXX	

Вариант исполнения 3

		Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16 Отдел продаж: тел. (383) 363-77-01, факс (383) 363-77-09 e-mail: products@mbu.ru; http://www.mbu.ru	
«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к <i>Treponema pallidum</i> , ТУ 21.20.23-061-26329720-2022			
вариант исполнения 3 РУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.			
Состав набора			
1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера в составе:	25 шт.		
- Тестовое устройство - 1 шт.;			
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.			
2. БР – буферный раствор	1 фл. (2,0 мл)		
3. Наклейка для маркировки тестового устройства	25 шт.		
4. Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta (РУ № РЗН 2013/822)	25 шт.		
5. Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения (РУ № ФСЗ 2009/04308)	25 шт.		
6. Схема использования ланцета	1 шт.		
7. Инструкция по применению	1 шт.		
Только для профессионального использования		Для клинической лабораторной диагностики     ET-MULTI-25  XXXXX  XX.XX.XXXX  XX.XX.XXXX	



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»


набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к *Treponema pallidum*, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022
вариант исполнения 4

ПУ № XXX XXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера | 40 шт. |
| в составе: | |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед | |
| по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 | |
| (ПУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт. | |
| 2. БР – буферный раствор | 2 фл. (по 2,0 мл) |
| 3. Наклейка для маркировки тестового устройства | 40 шт. |
| 4. Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для профессионального использования



REF ET-MULTI-40


LOT XXXXX

XX.XX.XXXX

XX.XX.XXXX

IVD

Для клинической лабораторной диагностики



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к *Treponema pallidum*, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022

вариант исполнения 5

РУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера

50 шт.

в составе:

- Тестовое устройство - 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (РУ № РЗН 2019/8912) - 1 шт.

2. БР – буферный раствор

2 фл. (по 2,0 мл)

3. Наклейка для маркировки тестового устройства

50 шт.

4. Инструкция по применению

1 шт.

Только для профессионального использования



REF ET-MULTI-50

LOT XXXXX




XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

IVD

Для клинической лабораторной диагностики



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
 Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
 e-mail: products@mbu.ru
 http://www.mbu.ru

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к *Treponema pallidum*, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022
вариант исполнения 6

ПУ № XXX XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Состав набора

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Тестовое устройство с пипеткой Пастера | 100 шт. |
| в составе: | |
| - Тестовое устройство - 1 шт.; | |
| - Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912) -1 шт. | |
| 2. БР – буферный раствор | 3 фл. (по 2,0 мл) |
| 3. Наклейка для маркировки тестового устройства | 100 шт. |
| 4. Инструкция по применению | 1 шт. |

Только для профессионального использования



REF ET-MULTI-100

LOT XXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

IVD

Для клинической лабораторной диагностики

Внутренняя маркировка

Варианты исполнения 1-6

ООО «Медико-биологический Союз»

Тестовое устройство с пипеткой Пастера
в составе:

- Тестовое устройство- 1 шт.;
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 (ПУ № РЗН 2019/8912)¹-1 шт

 XXXXX   

 XX.XX.XXXX   2°C  35°C

1 Модель: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»

БР - буферный раствор 2,0 мл

 XXXXX   35°C


 XX.XX.XXXX 

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

ООО «Медико-биологический Союз»

Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения
(ПУ № ФСЗ 2009/04308)¹ X шт.


 XXXXX  XX.XX.XXXX

  35°C   


1 Модель: Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 G, 1.8 мм игла)

«МБС-МУЛЬТИТЕСТ»

Маркировка транспортной тары



Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
Отдел продаж: тел.: (383) 363-77-01, факс: (383) 363-77-09
e-mail: products@mbu.ru
http://www.mbu.ru



«МБС-МУЛЬТИТЕСТ» набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1, включая группы М и О, и ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), антител к вирусу гепатита С (ВГС) и антител к Treponema pallidum, ТУ 21.20.23-061-26329720-2022



Кат. №	ET-MULTI-XXX
Серия	XXXXX
Дата изготовления	XX.XX.XXXX
Срок годности	XX.XX.XXXX
Число потребительских упаковок в транспортной таре	XX шт.
Масса нетто транспортной тары	X,XX кг
Масса брутто транспортной тары	X,XX кг
Масса нетто потребительской упаковки	X,XX кг

Срочный груз

Не бросать

Не замораживать!

Прошито пронумеровано скреплено
печатью на () листах
Директор ООО «Медико-биологический
Союз» М.В.Лосев

