

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПФ "ПОТОК ИНТЕР"


Ощепков Олег Владимирович

 (подпись)
М.П. «21» 06 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА УОВ «ПОТОК 150-М-01» канальная по ТУ 32.50.50-003-40178340-2021 в вариантах исполнения




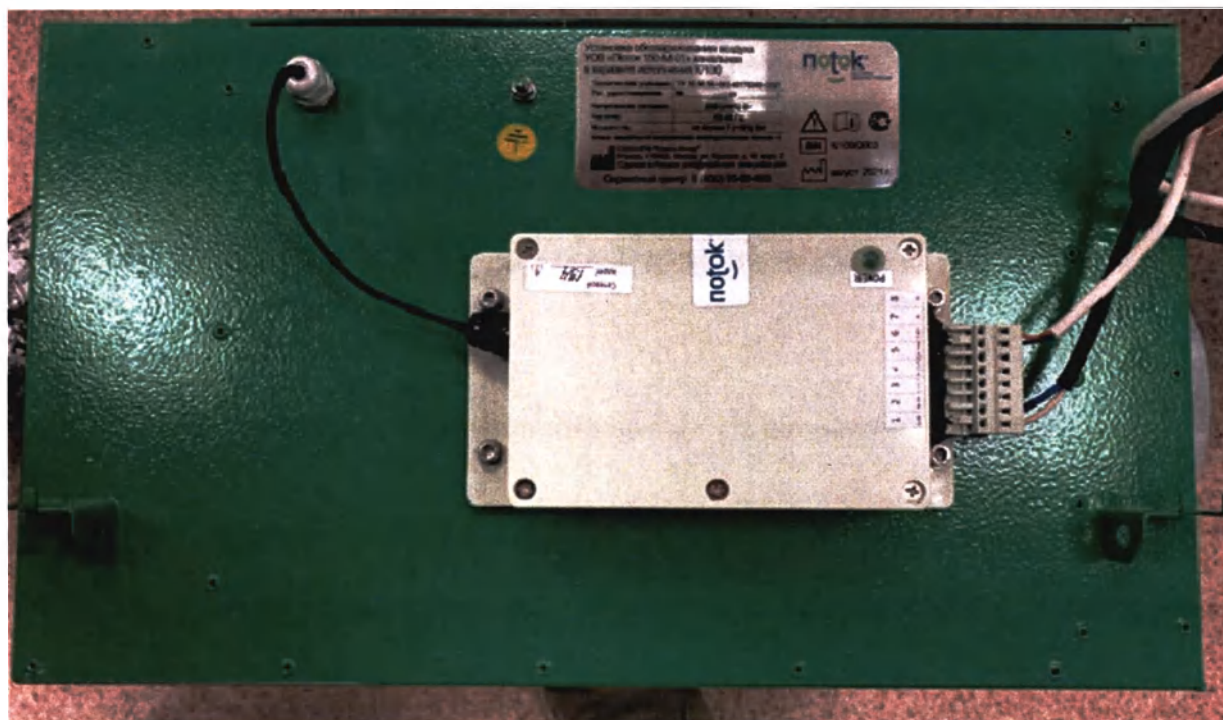

Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» канальная
(Различие вариантов исполнения только в габаритах)



Пульт дистанционного управления и контроля

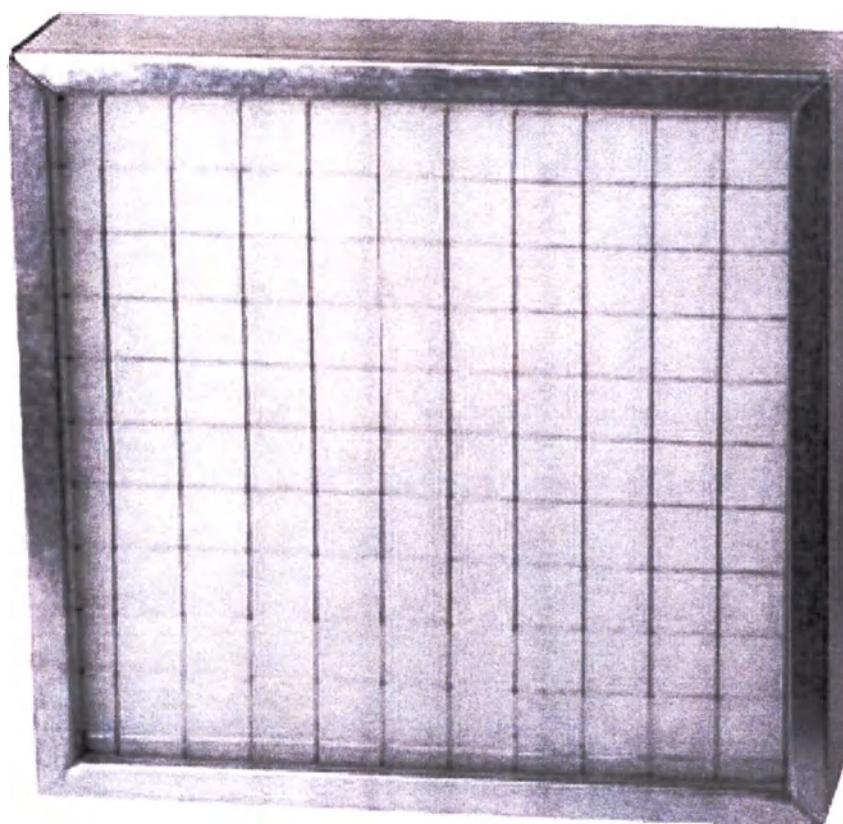

Фильтр очистки воздуха общего назначения



Фильтр высокоэффективной очистки воздуха





Транспортная упаковка

Макеты этикеток общего вида медицинского изделия

Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» канальная в варианте исполнения К/_____		
Технические условия: ТУ 32.50.50-003-40178340-2021		
Рег. удостоверение	№ _____ от _____ г.	  
Напряжение питания:	230 (±10%) В~	
Частота:	50-60 Гц	
Мощность:	_____ (+10%) Вт	
Класс защиты от поражения электрическим током - I		 К/_____ / _____  _____ 202_ г.
 ООО НПФ "Поток Интер" Россия, 115162, Москва, ул. Хавская, д. 18, корп. 2 Сделано в России post@potok.com www.potok.com		
Сервисный центр 8 (800) 55-00-495		

Внешний вид наклейки-шильдика



Установка обеззараживания воздуха УОВ
«Поток 150-М-01» канальная
в варианте исполнения К/_____

Технические условия: ТУ 32.50.50-003-40178340-2021

Рег. удостоверение № _____ от _____ г.

Напряжение питания: 230 ($\pm 10\%$) В~

Частота: 50-60 Гц

Мощность: _____ (+10%) Вт

Класс защиты от поражения электрическим током - I



ООО НПФ "Поток Интер"
Россия, 115162, Москва, ул. Хавская, д. 18, корп. 2
Сделано в России post@potok.com www.potok.com

Сервисный центр 8 (800) 55-00-495

notok®
СИСТЕМЫ
БИОИННАКТИВАЦИИ



SN

К/_____/____



_____202_ г.

Этикетка транспортной упаковки



Пульт дистанционного управления
и контроля ПДУК

Телефоны сервисного центра:

+7 (495) 025-20-20

8 (800) 55-00-495

www.potok.com

СЕТЬ

Пульт дистанционного управления
и контроля ПДУК

Напряжение питания:	230 ($\pm 10\%$) В~
Частота:	50-60 Гц
Мощность:	3 ($+10\%$) Вт

Класс защиты от поражения электрическим током - II



ООО НПФ "Поток Интер"

Россия, 115162, Москва, ул. Хавская, д. 18, корп. 2

Сделано в России post@potok.com www.potok.com



_____ 202_ г.

SN

Этикетка Пульта дистанционного управления и контроля

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

9/Дебят листа(ов)

Генеральный директор

ООО ЦПФ "ПОТОК ИНТЕР"

Ошепков О. В.

