

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

медицинского изделия

**Аспиратор лабораторный «АЛ-1000»
по ТУ 32.50.50-002-27278232-2022**

helicon

Аспиратор лабораторный "АЛ-1000"

ТУ 32.50.50-002-27278232-2022

Состав:

1. Блок аспиратора – 1 шт.
2. Сосуд-ловушка с крышкой – 1 шт.
3. Аспирационная магистраль – 1 шт.
4. Фильтр воздушный – 1 шт.
5. Блок питания внешний – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

 ООО "НПФ Хеликон", 121351, г. Москва, Вн. тер. г. муницип.
округ Кунцево, ул. Коцюбинского, дом 4, пом. 390

 03.2022

Артикул: АЛ-1000

Сер. номер: 200012210001

РУ номер: _____

Сделано в России



Масса нетто: 2750 г.

Масса брутто: 3500 г.

Верхнее наполнение ложемент:



Нижнее наполнение ложемент:




Комплектация aspiratora:



Блок аспиратора и панель управления:



Правая сторона блока aspirатора:

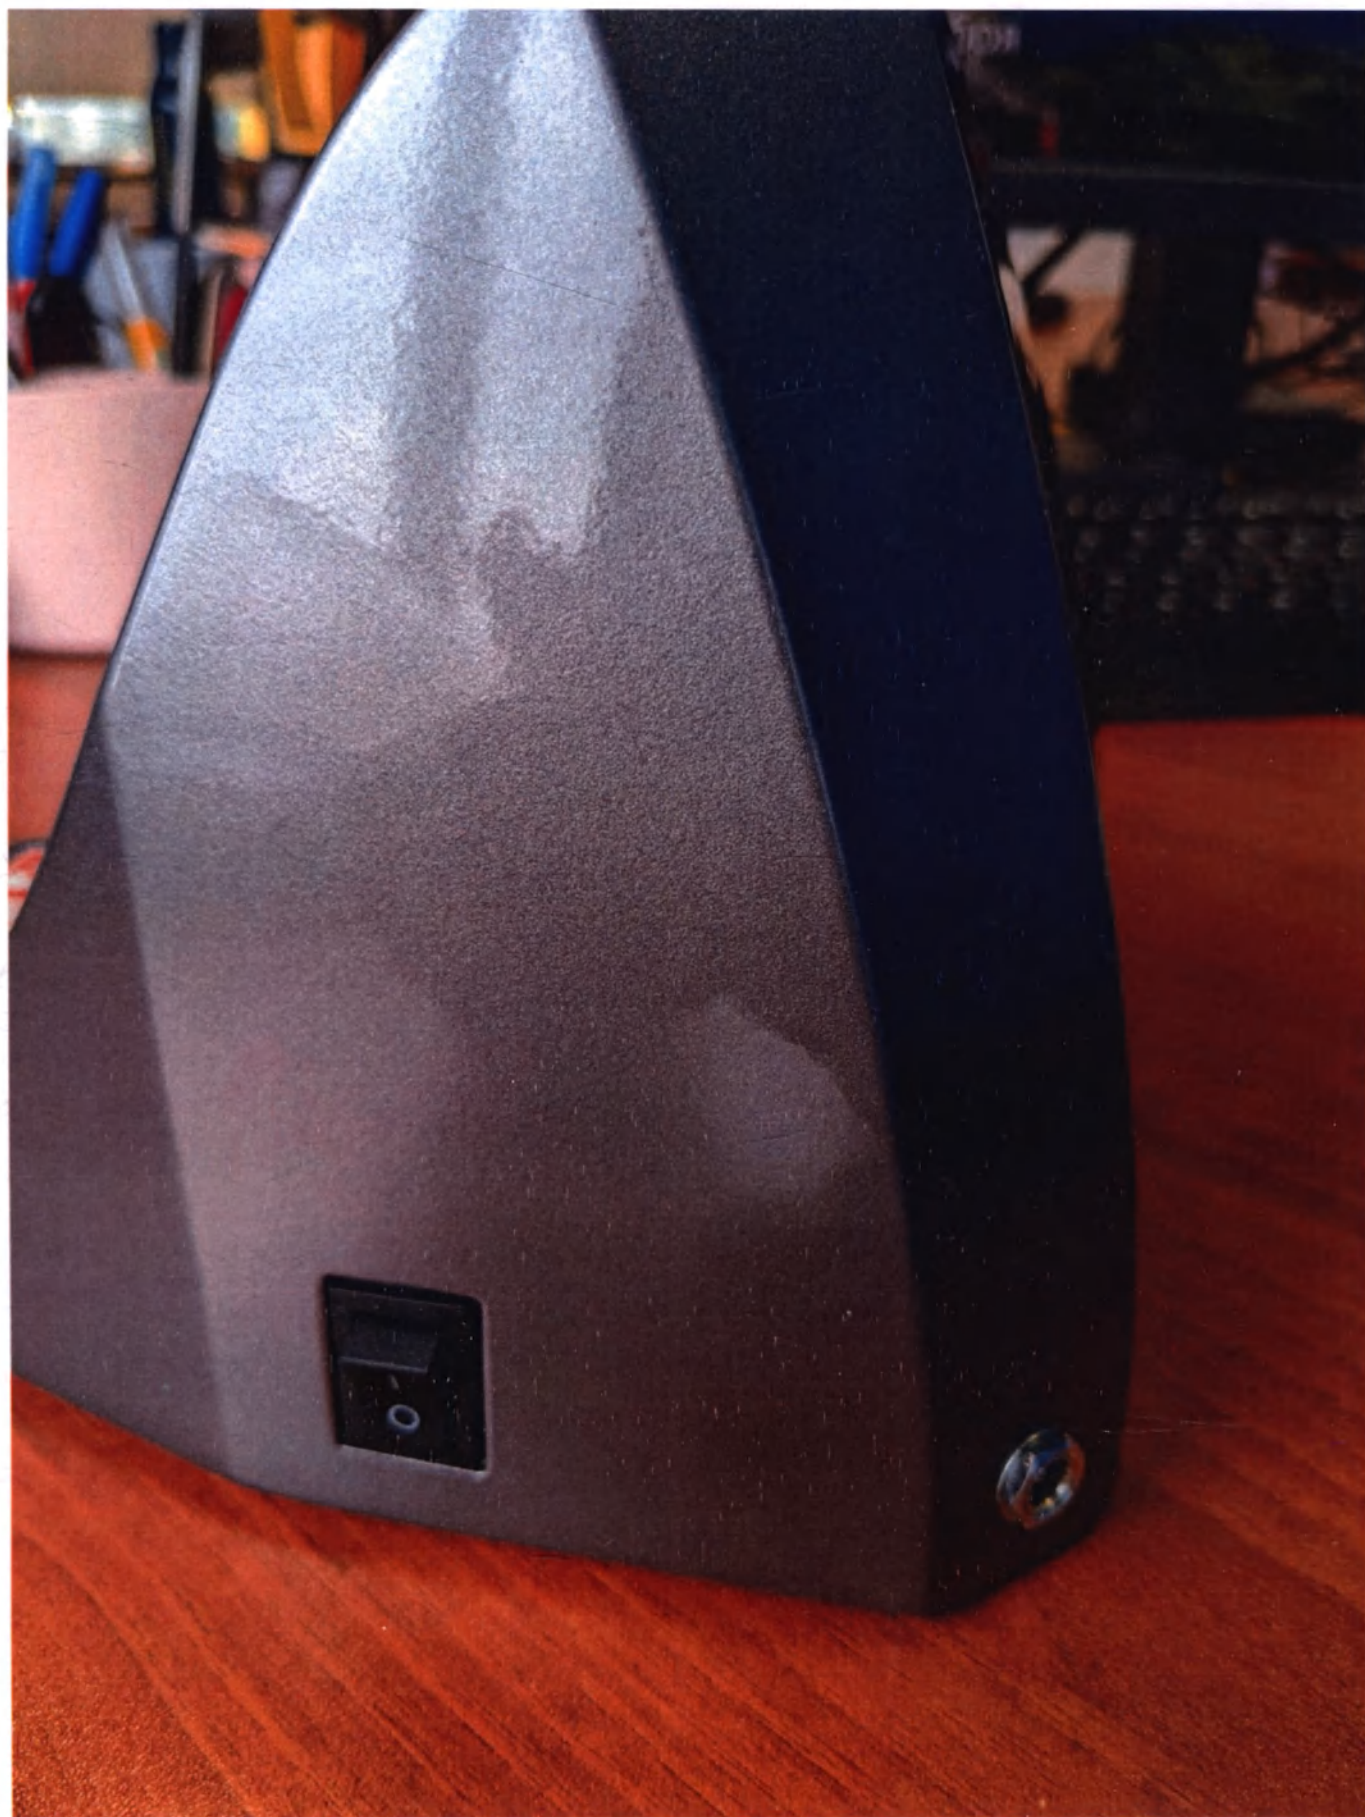

Задняя сторона блока aspirатора:



Основание блока aspirатора с маркировкой:



helicon

Аспиратор лабораторный "АЛ-1000"

ТУ 32.50.50-002-27278232-2022



ООО "НПФ Хеликон", 121351, г. Москва, Вн. тер.
г. муницип. округ Кунцево, ул. Коцюбинского,
дом 4, пом. 390



03.2022

Артикул: АЛ-1000

Сер. номер: 200012210001

Блок питания: 12В, 1А

Максимальная потребляемая мощность: 36 Вт.

Масса: 2755 г.

РУ номер:

Сделано в России



IVD




IPX0

Сосуд-ловушка:



Крышка с установленной аспирационной магистралью:

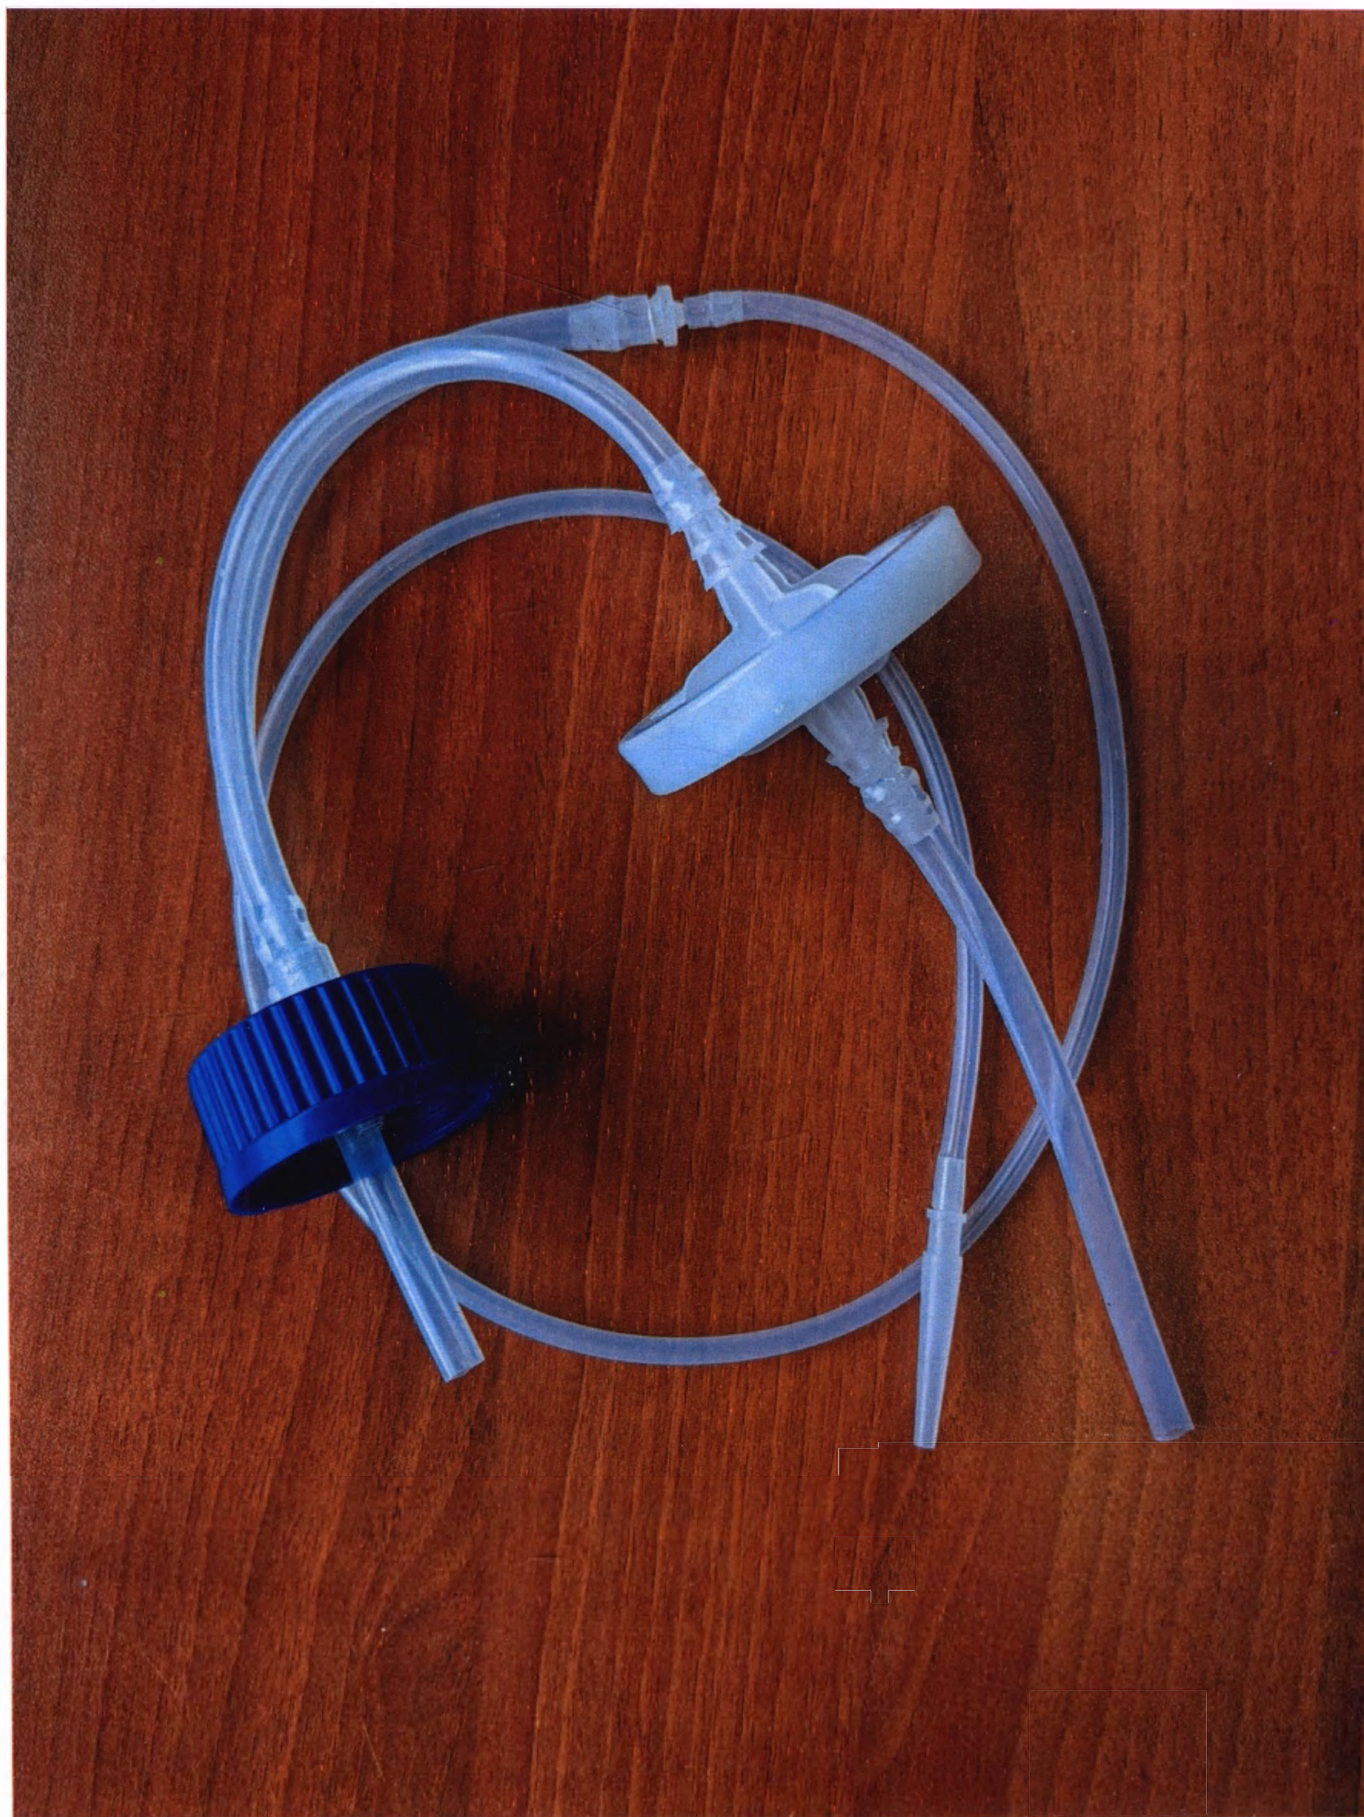


Фильтр аспирационной магистрали:



Блок питания аспиратора:



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов
Генеральный директор
ООО «НПФ Хеликон»

 С.А. Горинов

