

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "Айболит-2000"

Ильин В.А.

«10» мая 2023 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия
«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой
с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022**

2023



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.


Общий вид




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Общий вид с принадлежностями




**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Камера шкафа в сборе**

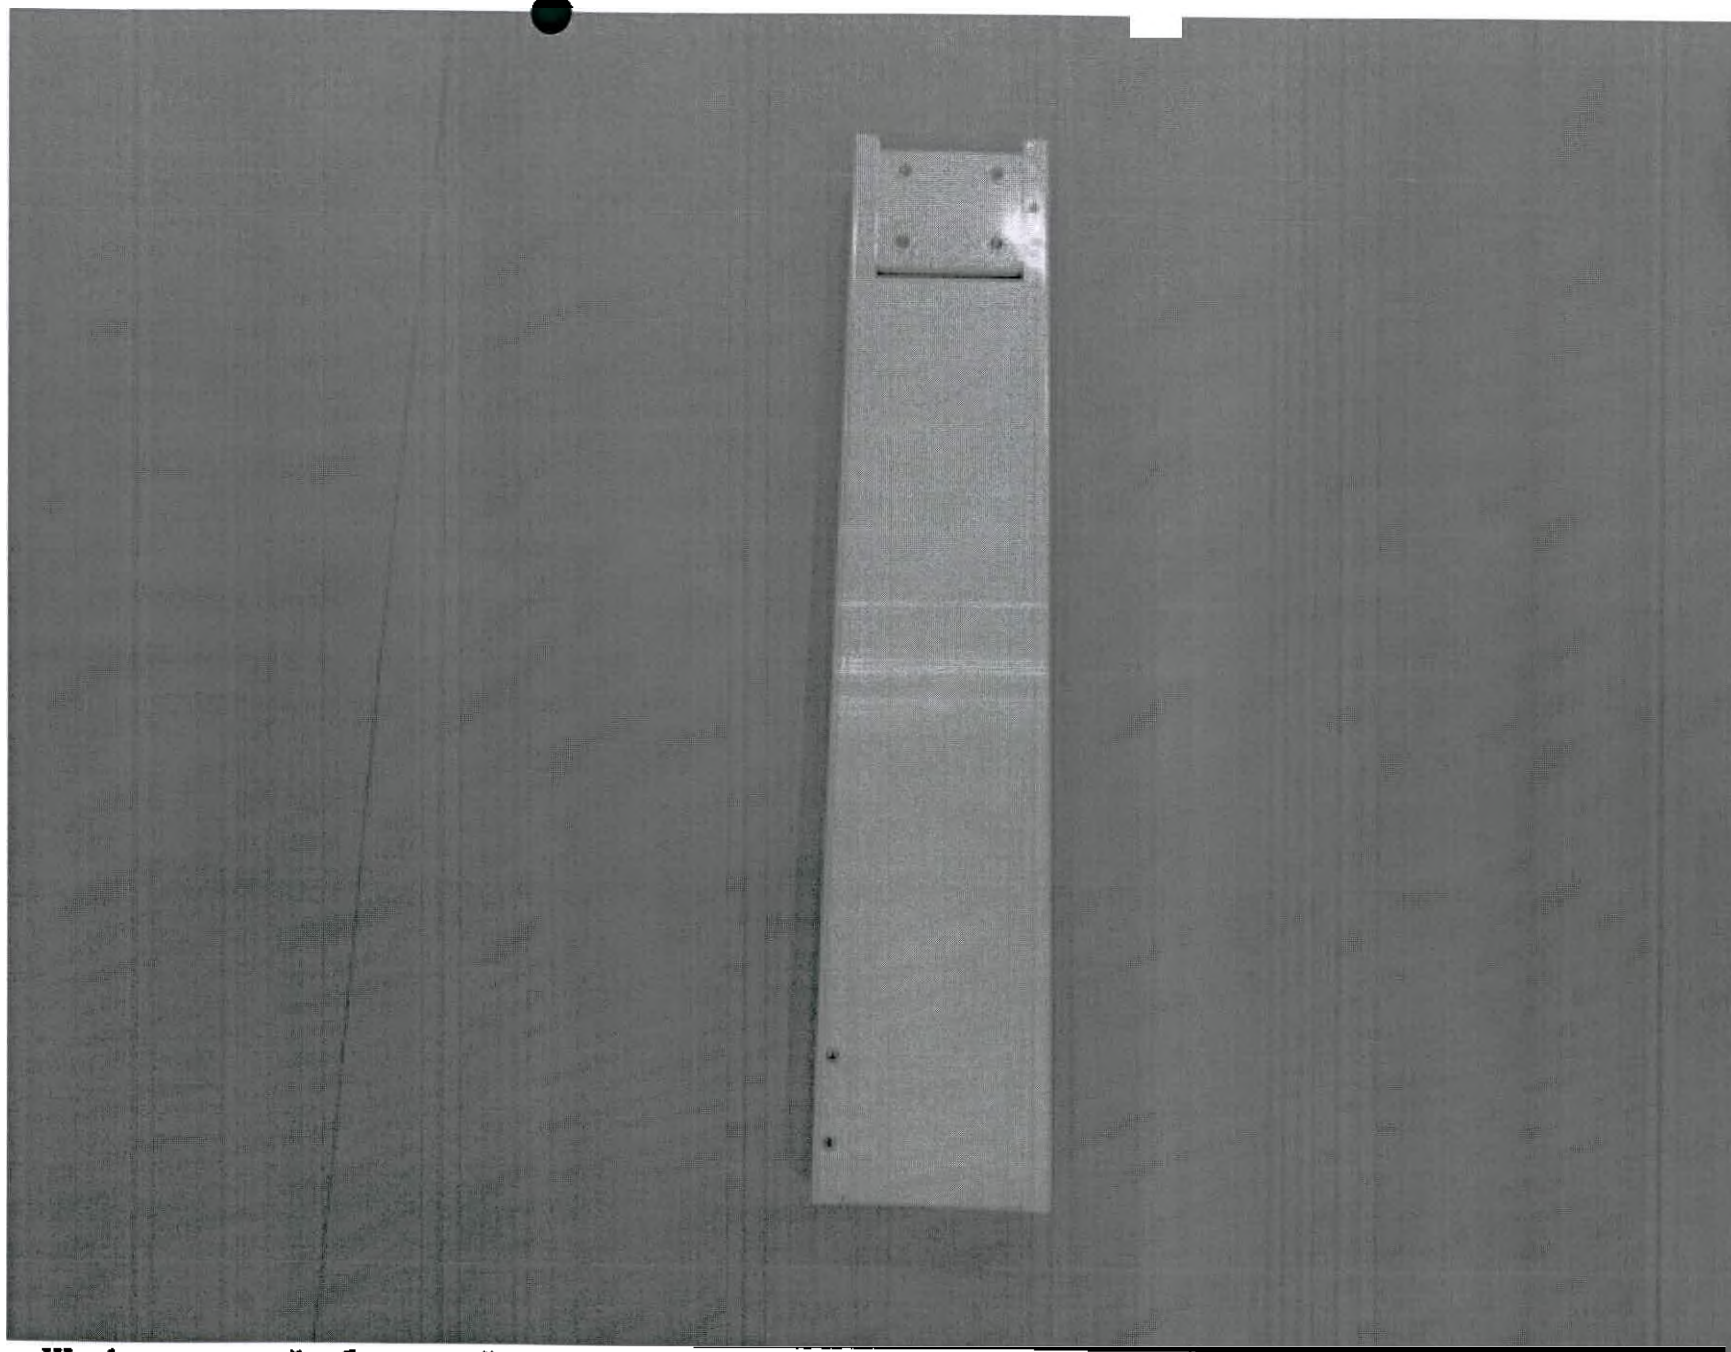


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя правая**

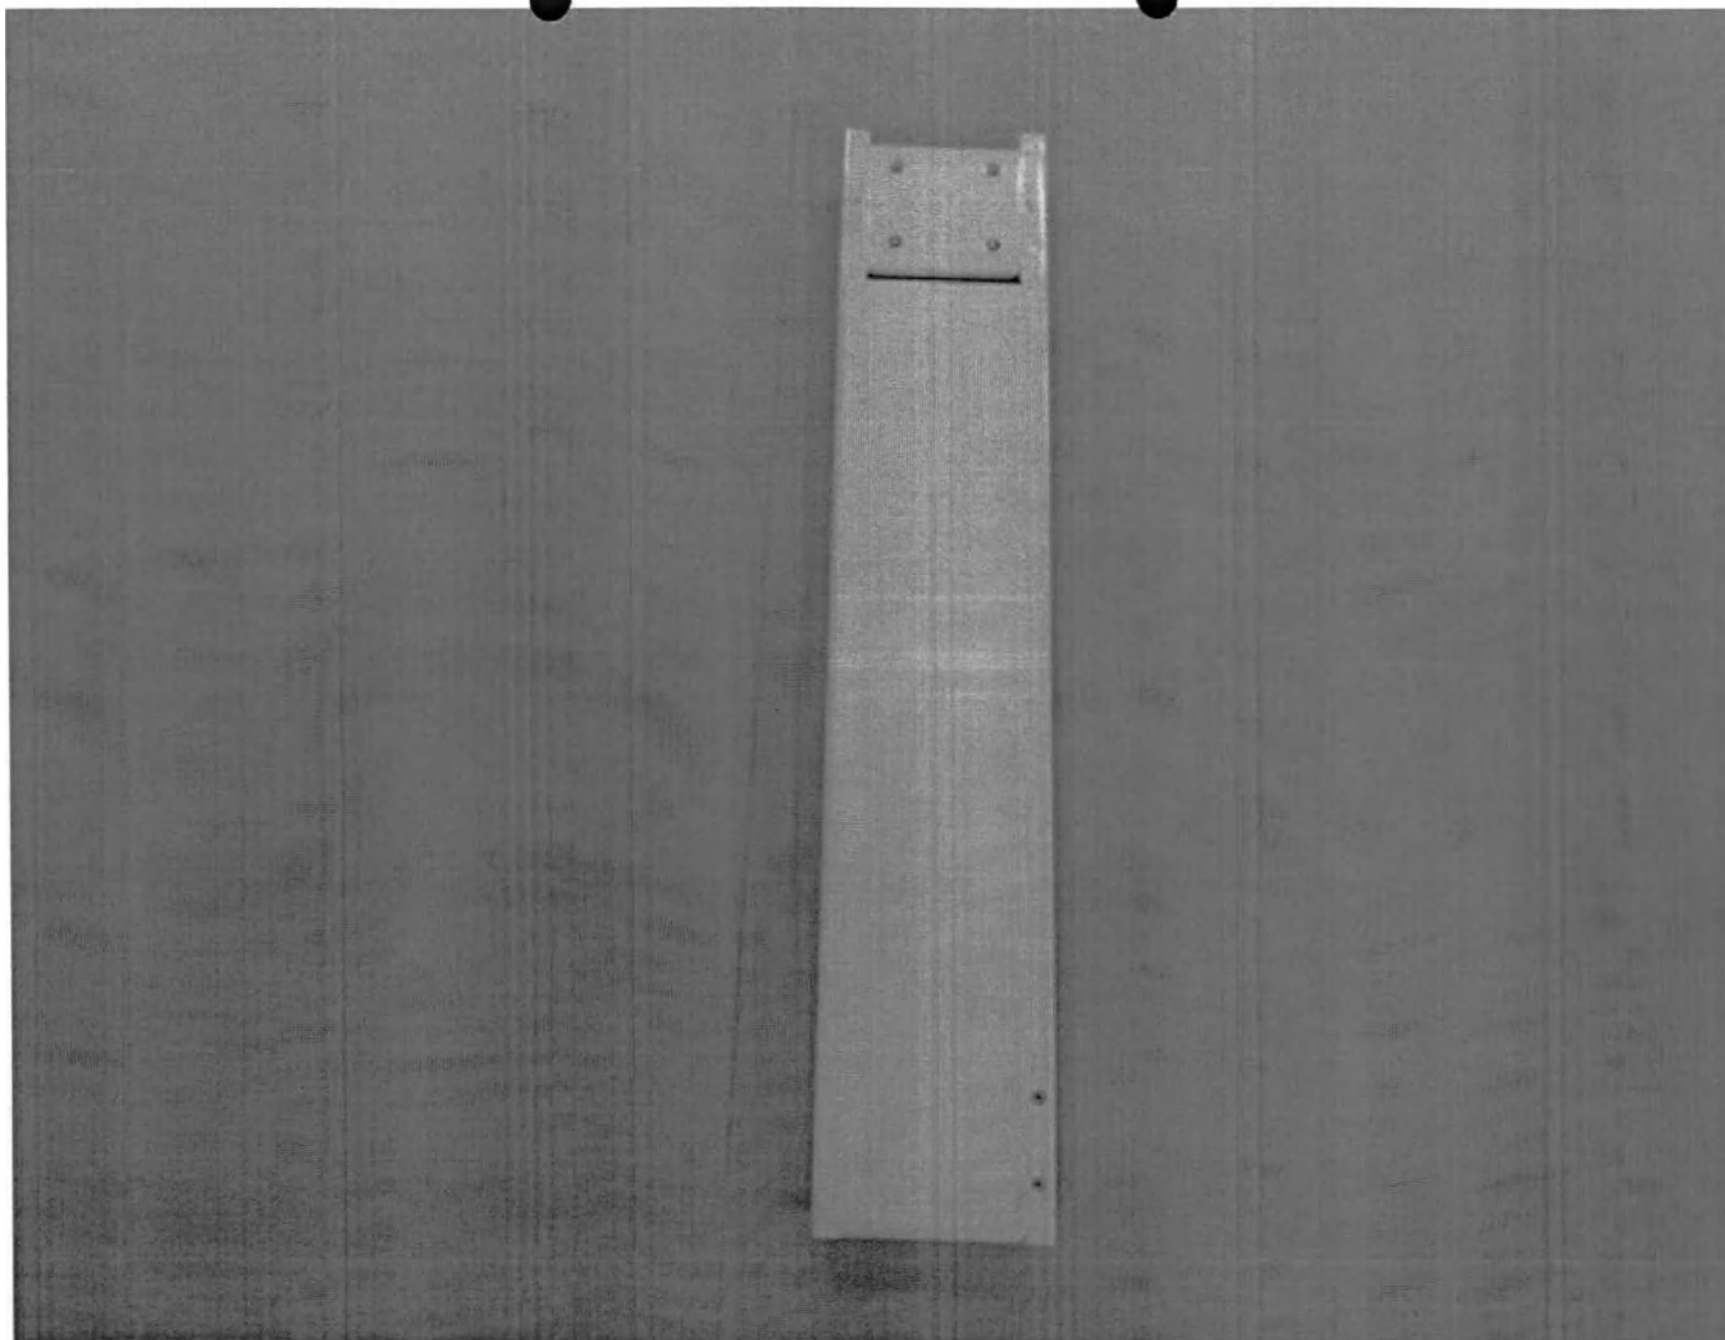


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя левая

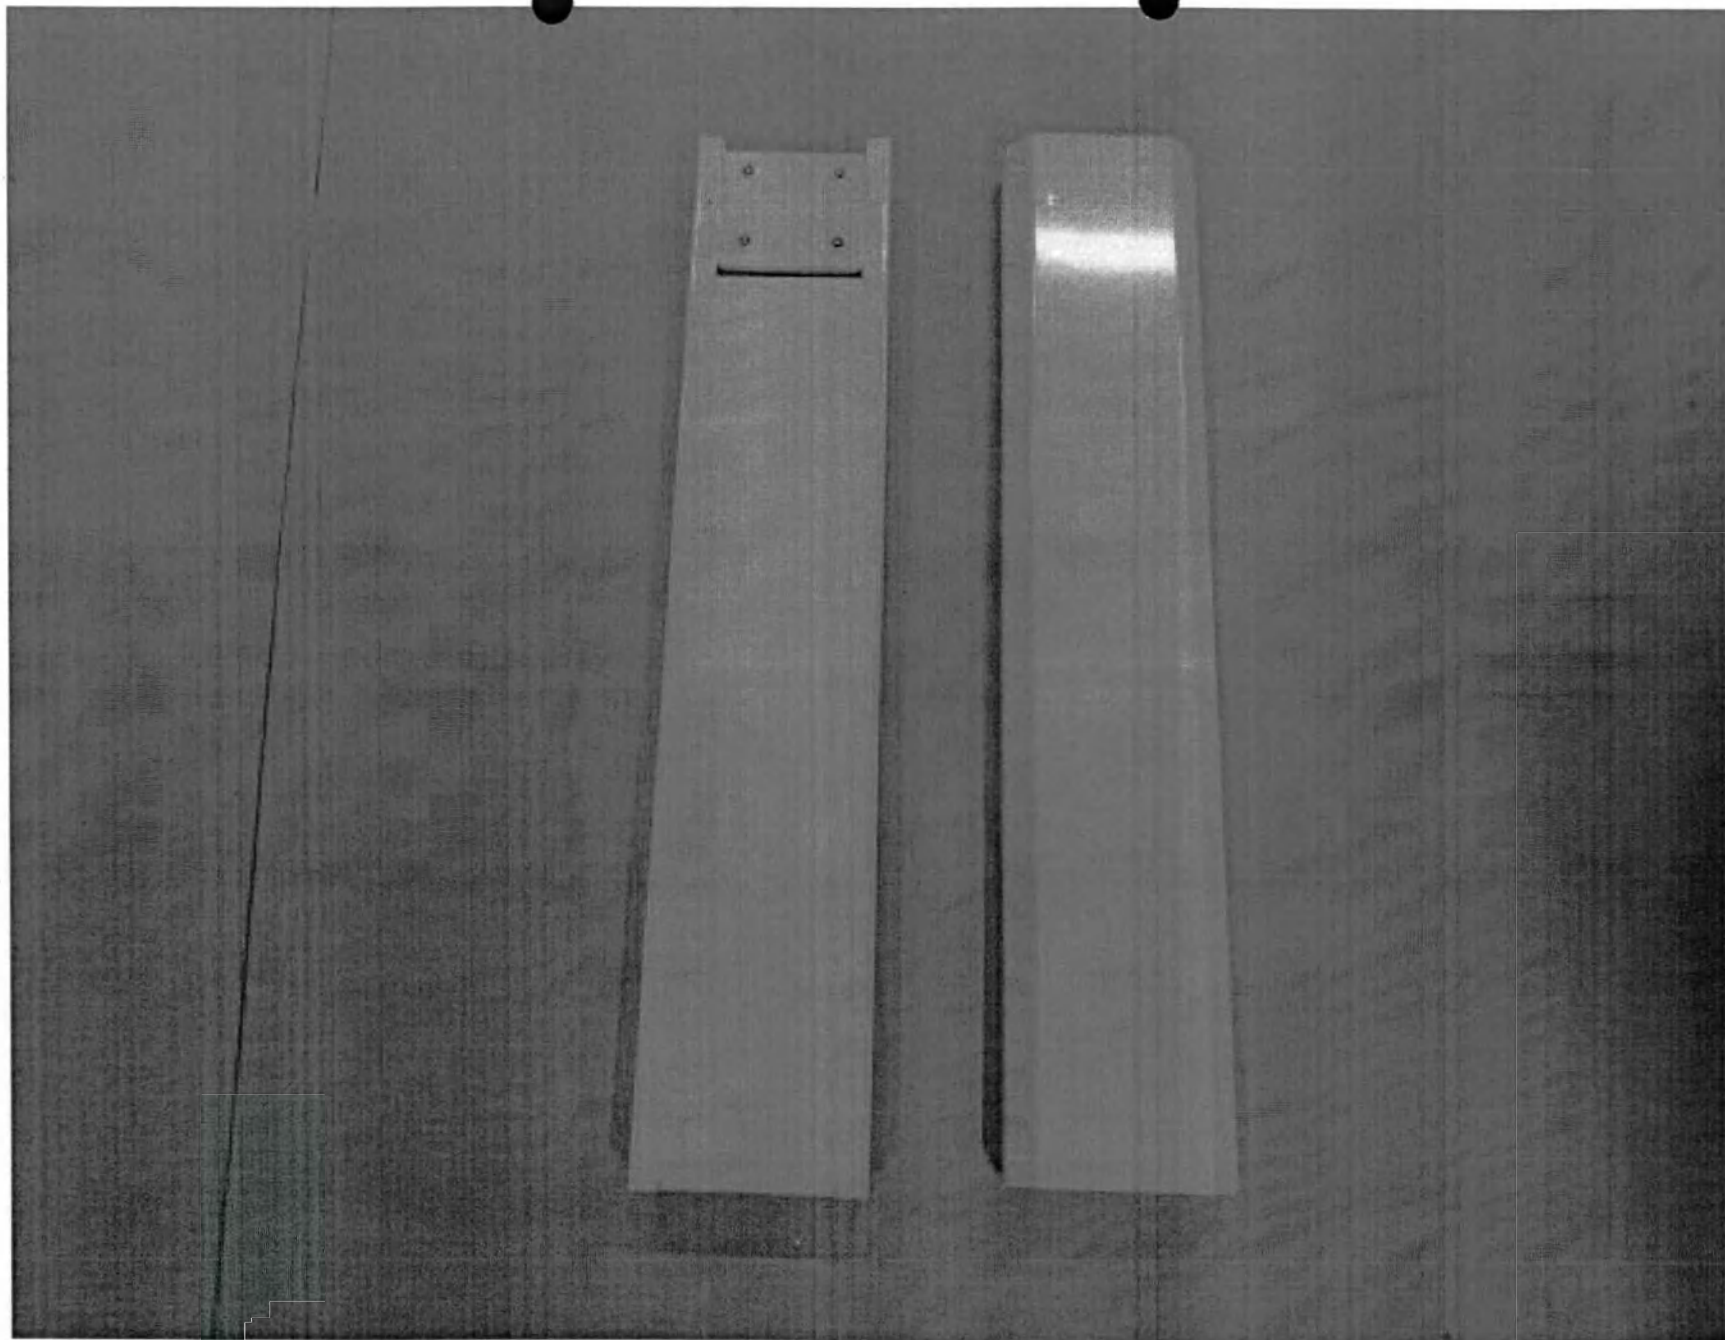


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка передняя

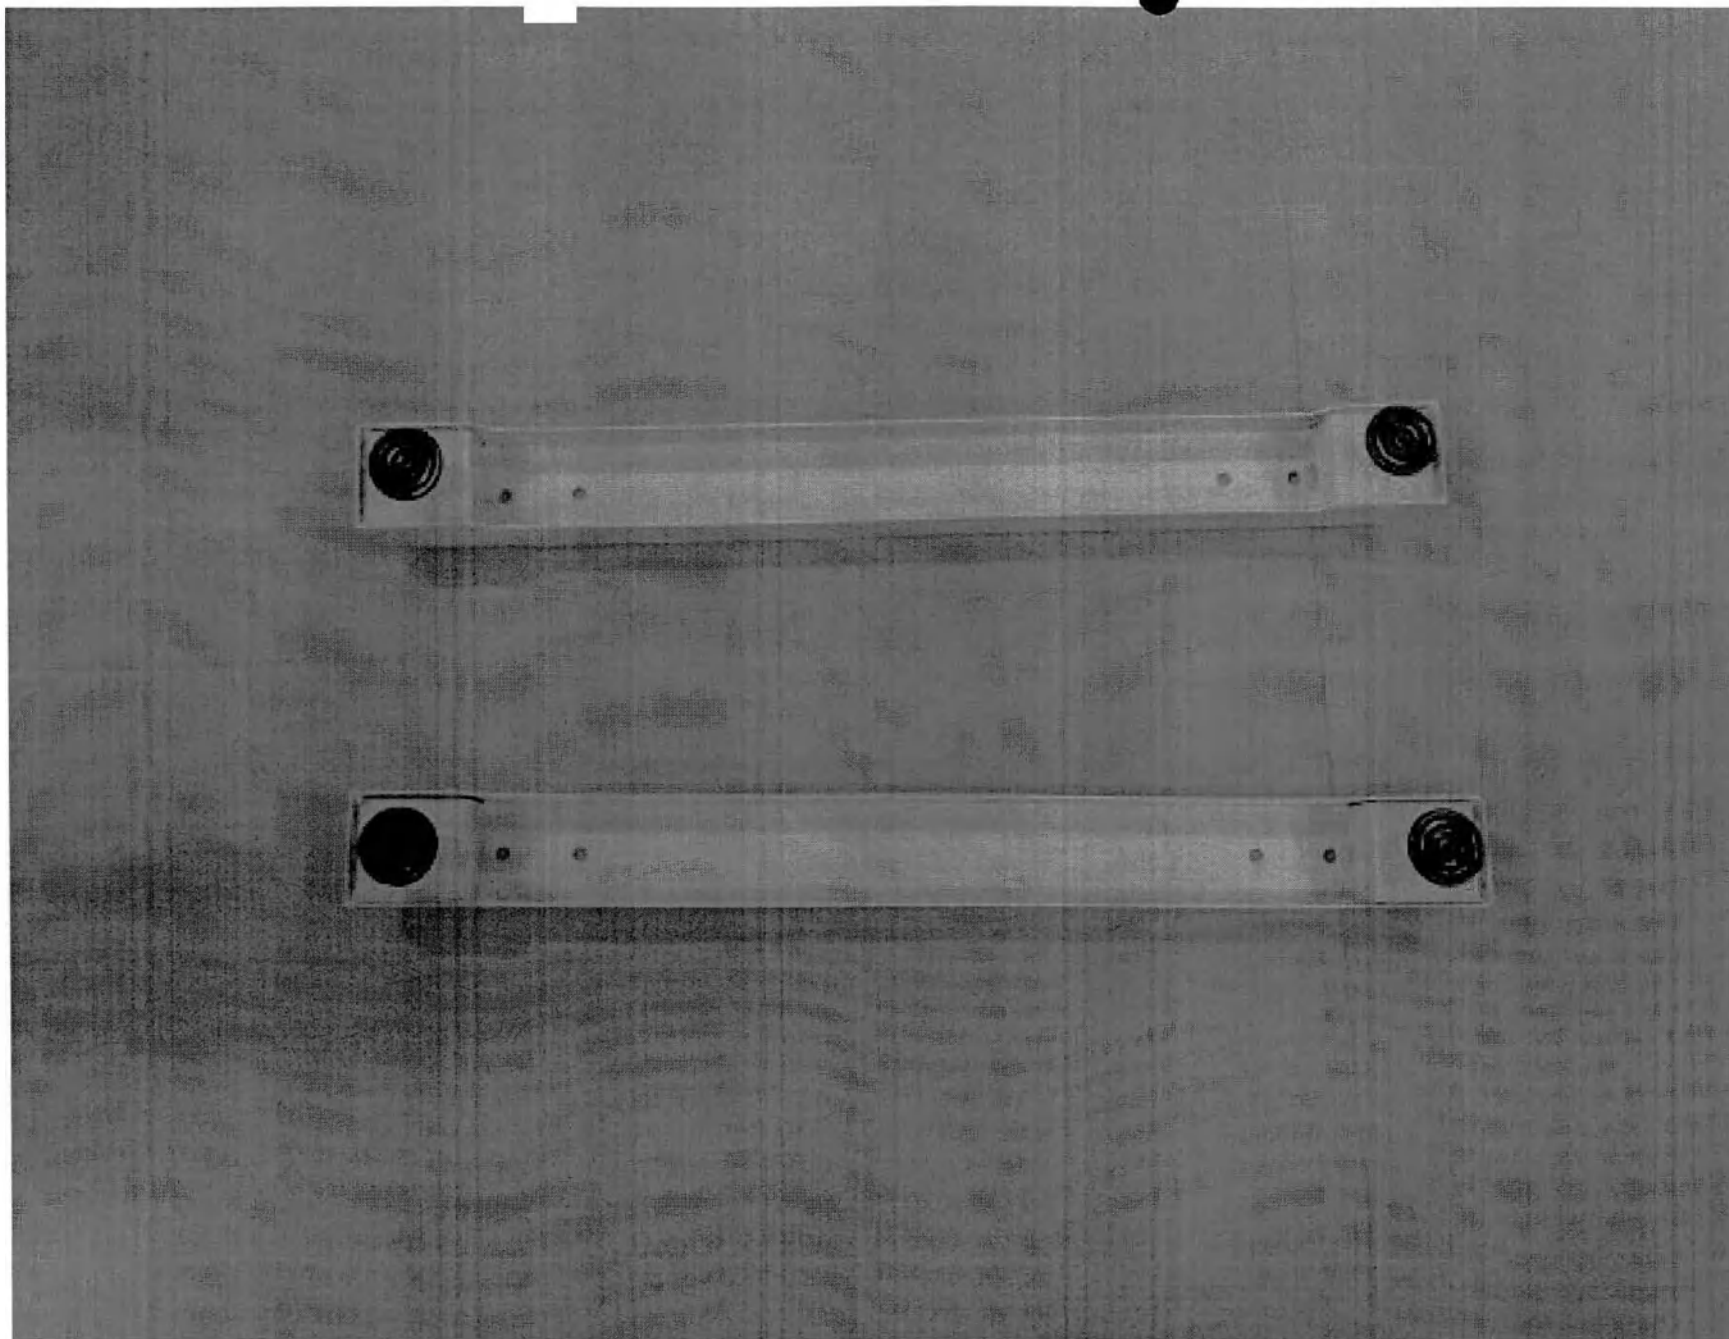


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Лыжа

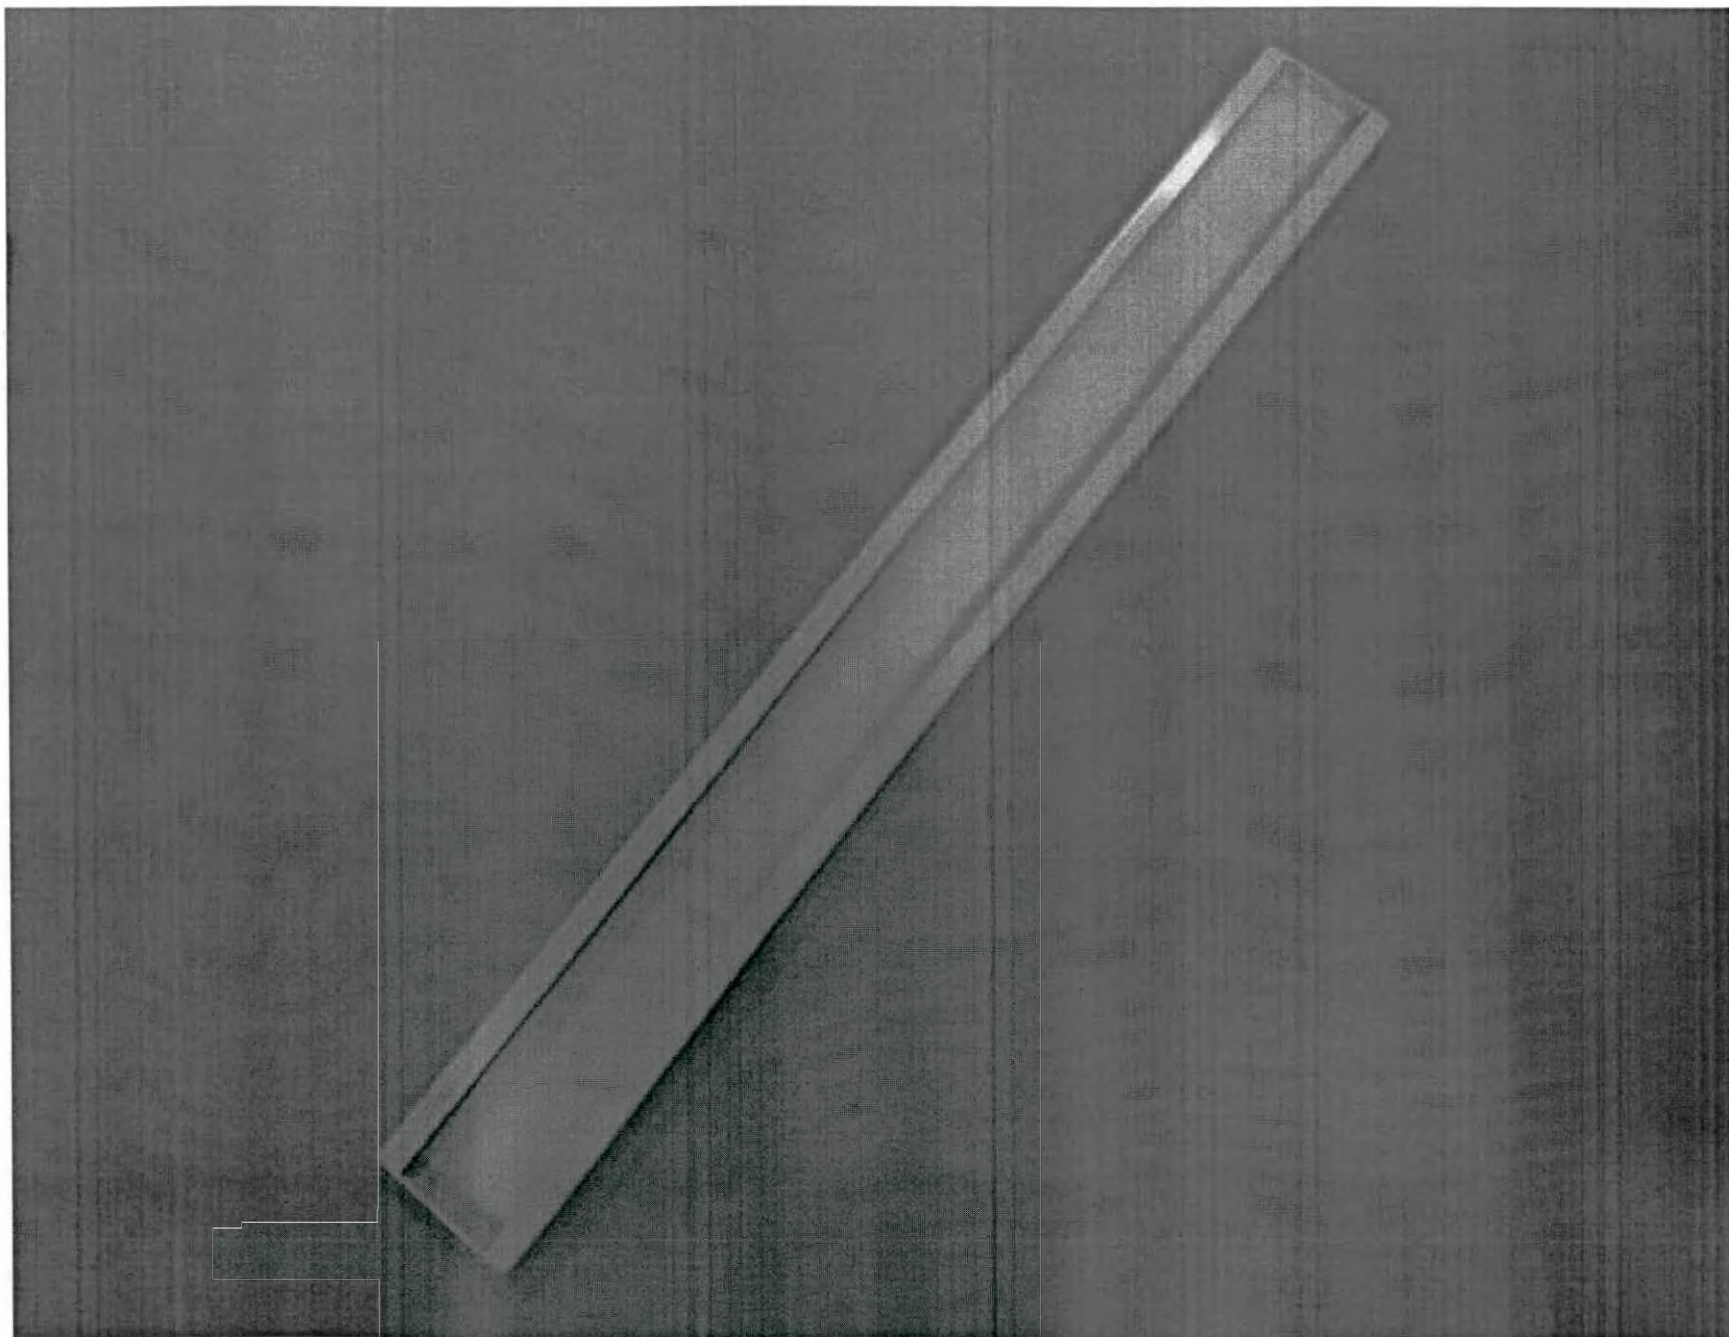


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стяжка нижняя

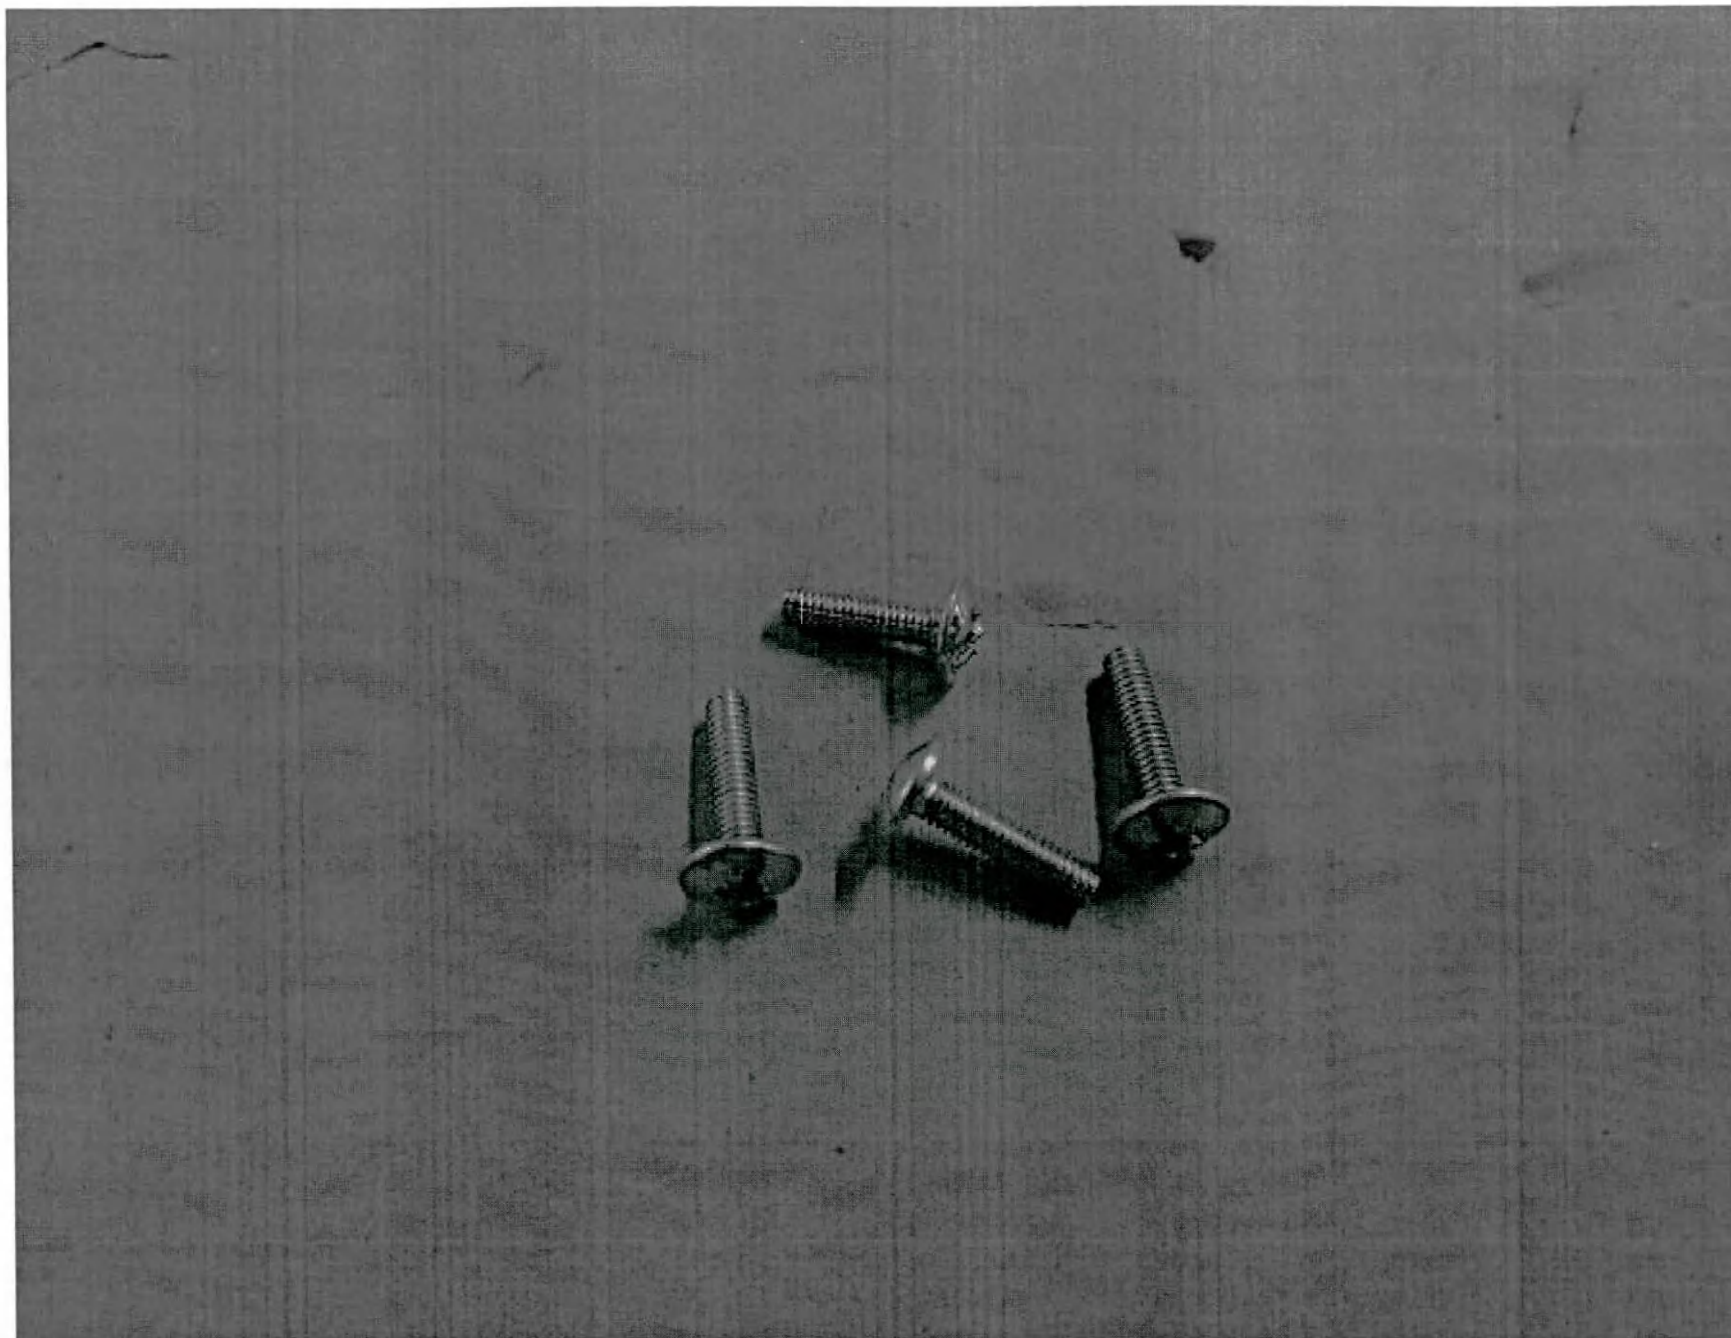


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Винт 4x16 комби

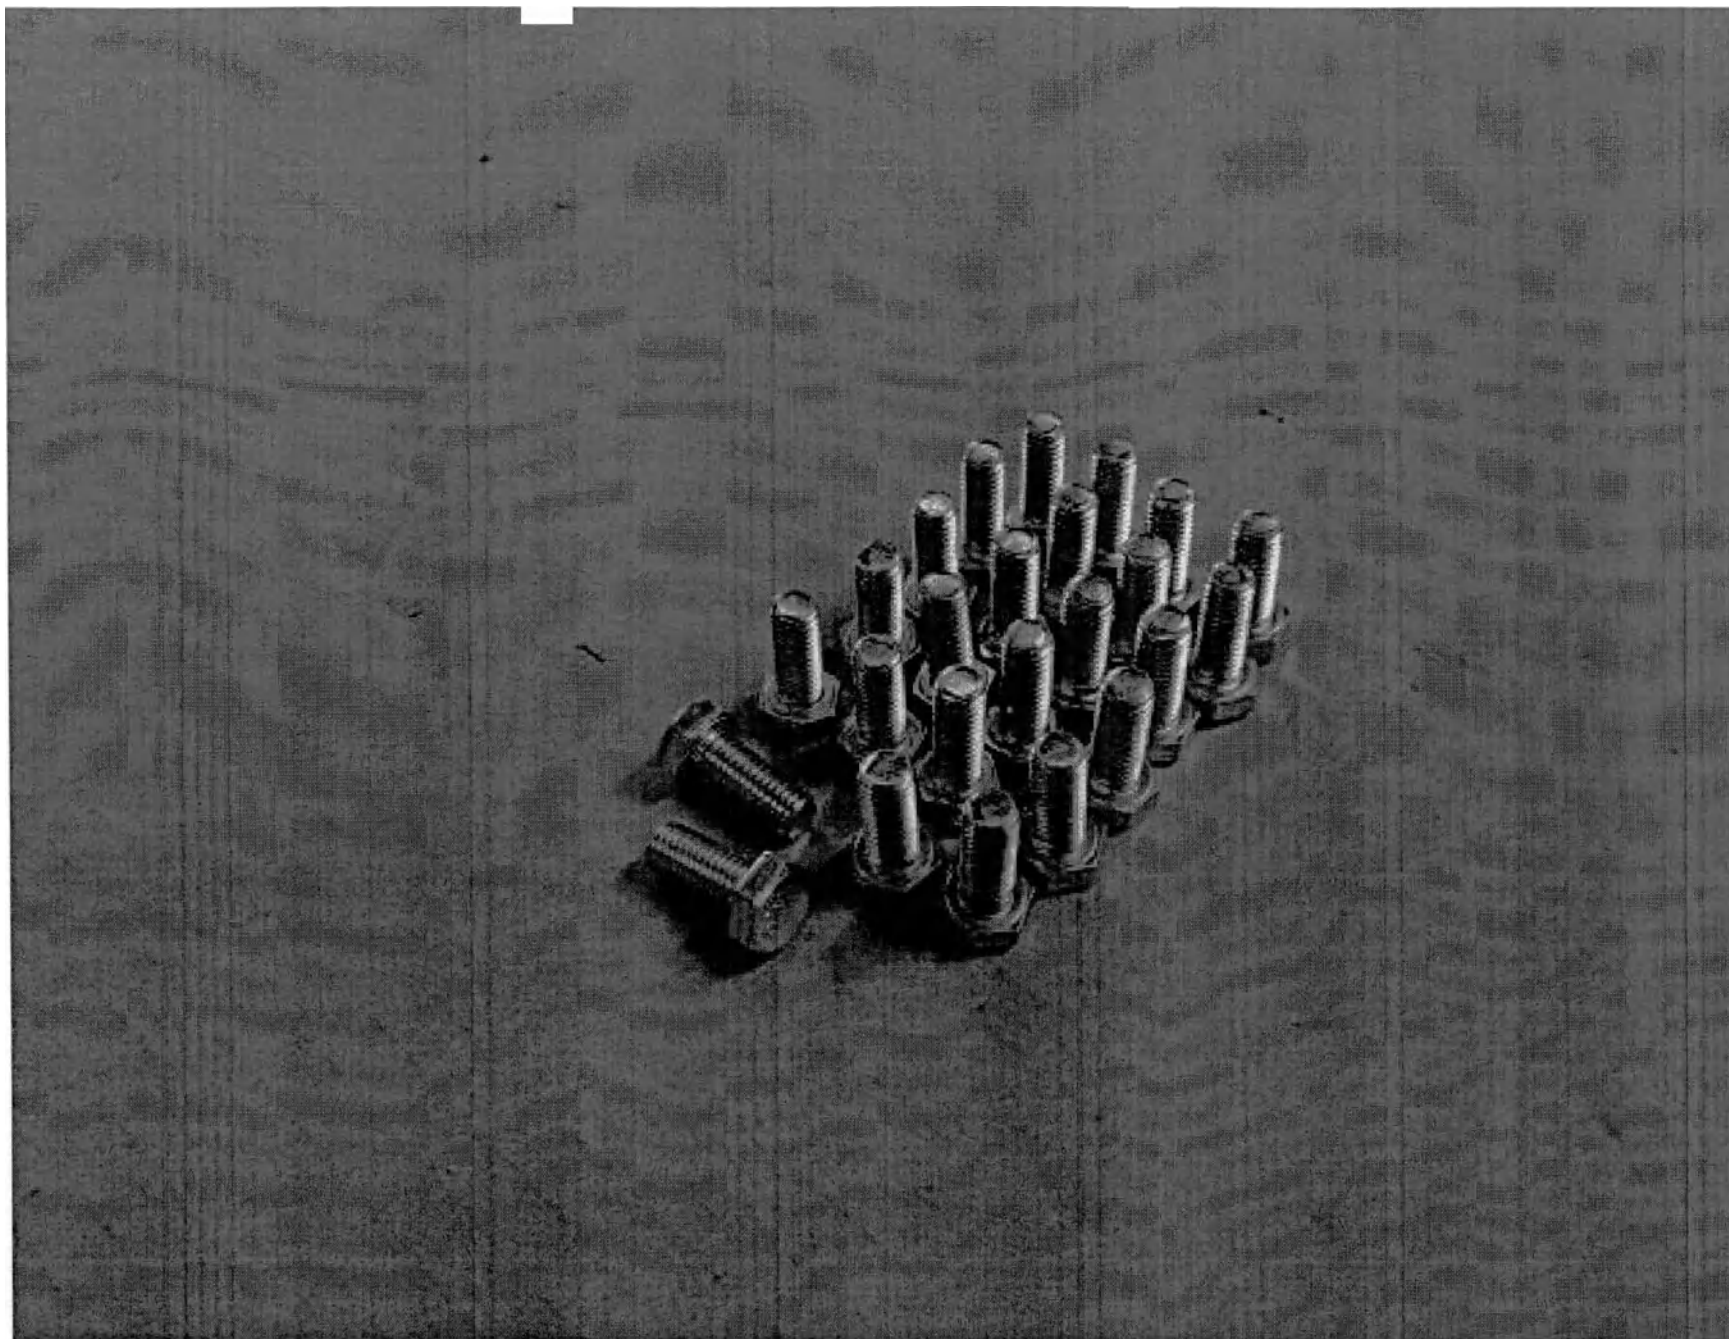


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Болт 8х20**

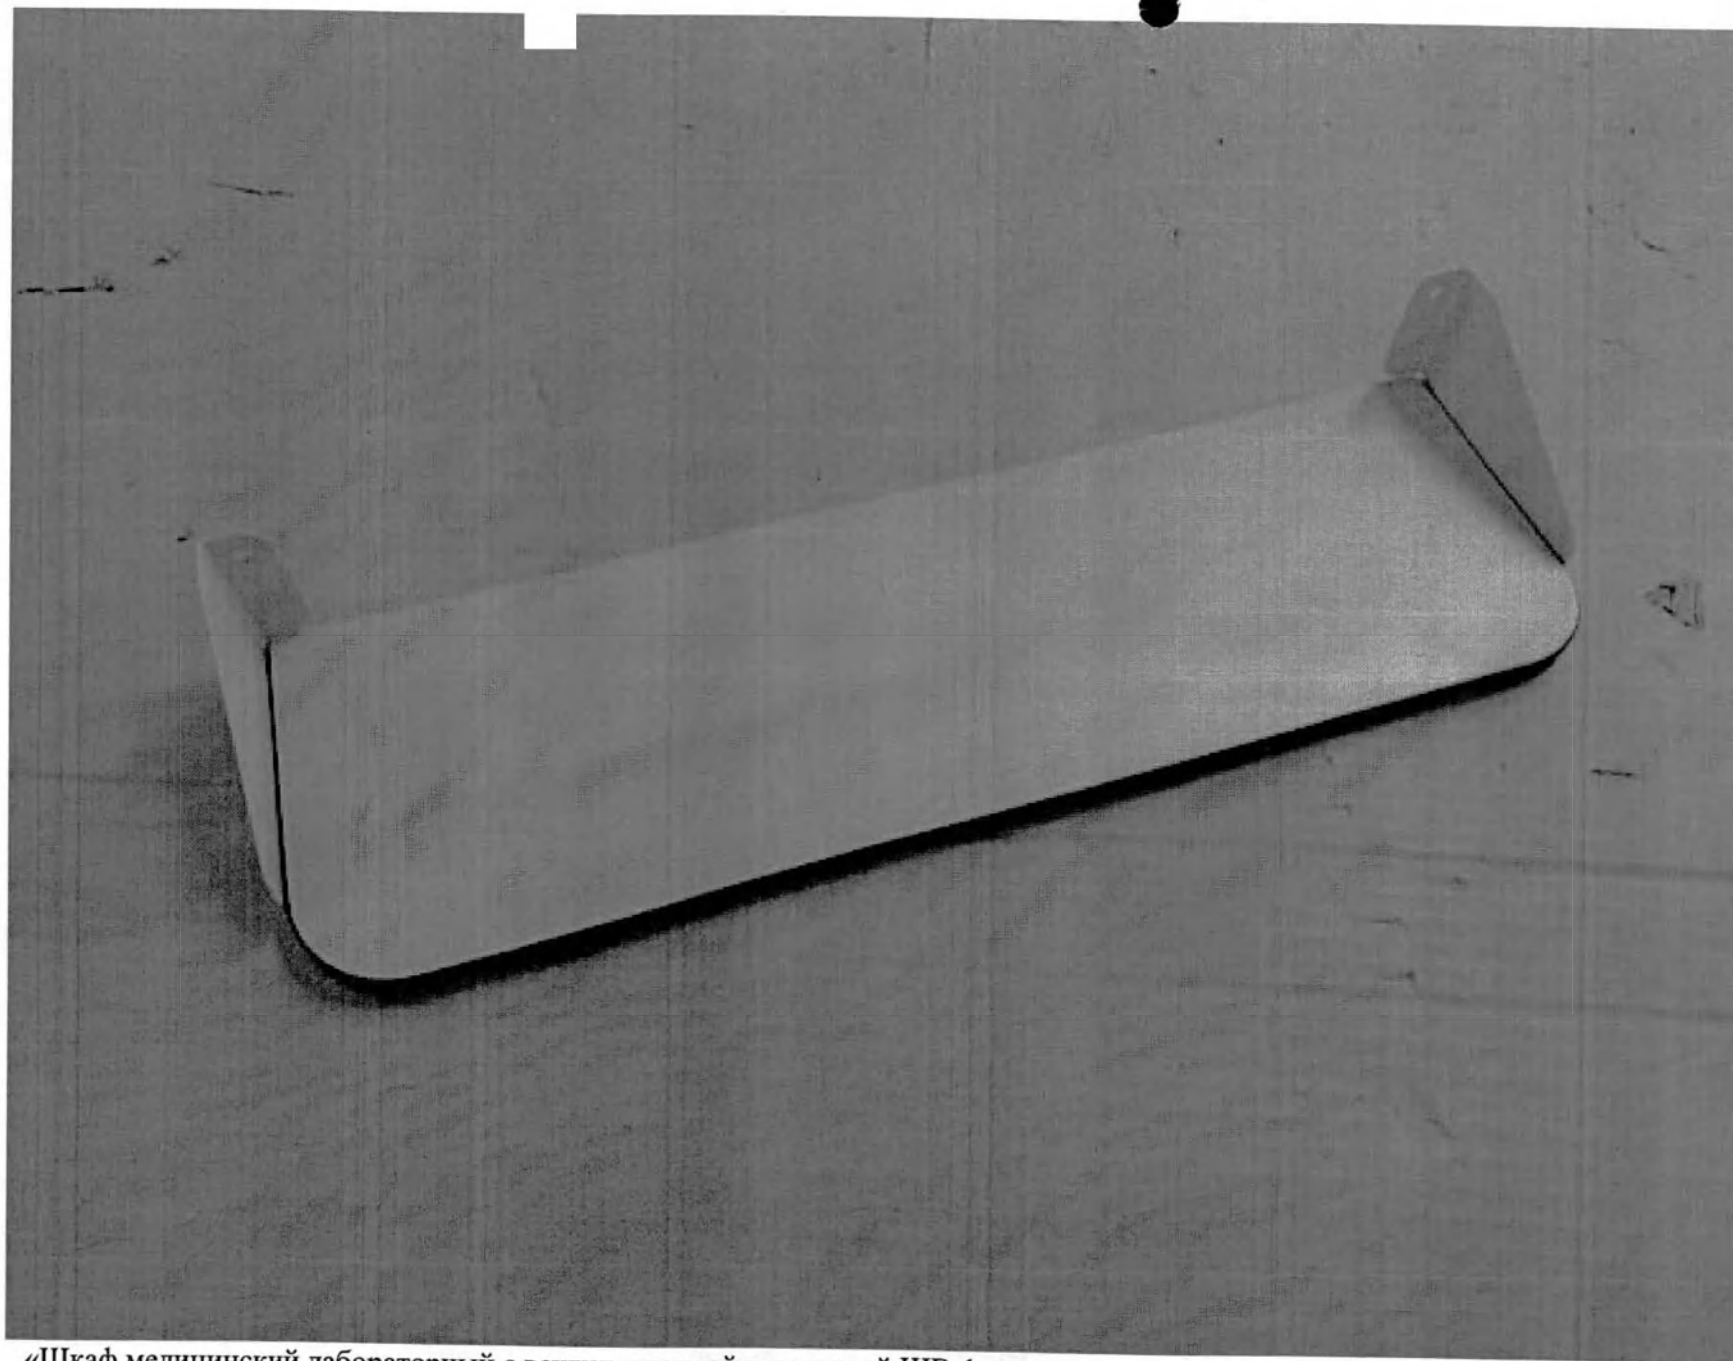

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Принадлежность: Полка боковая

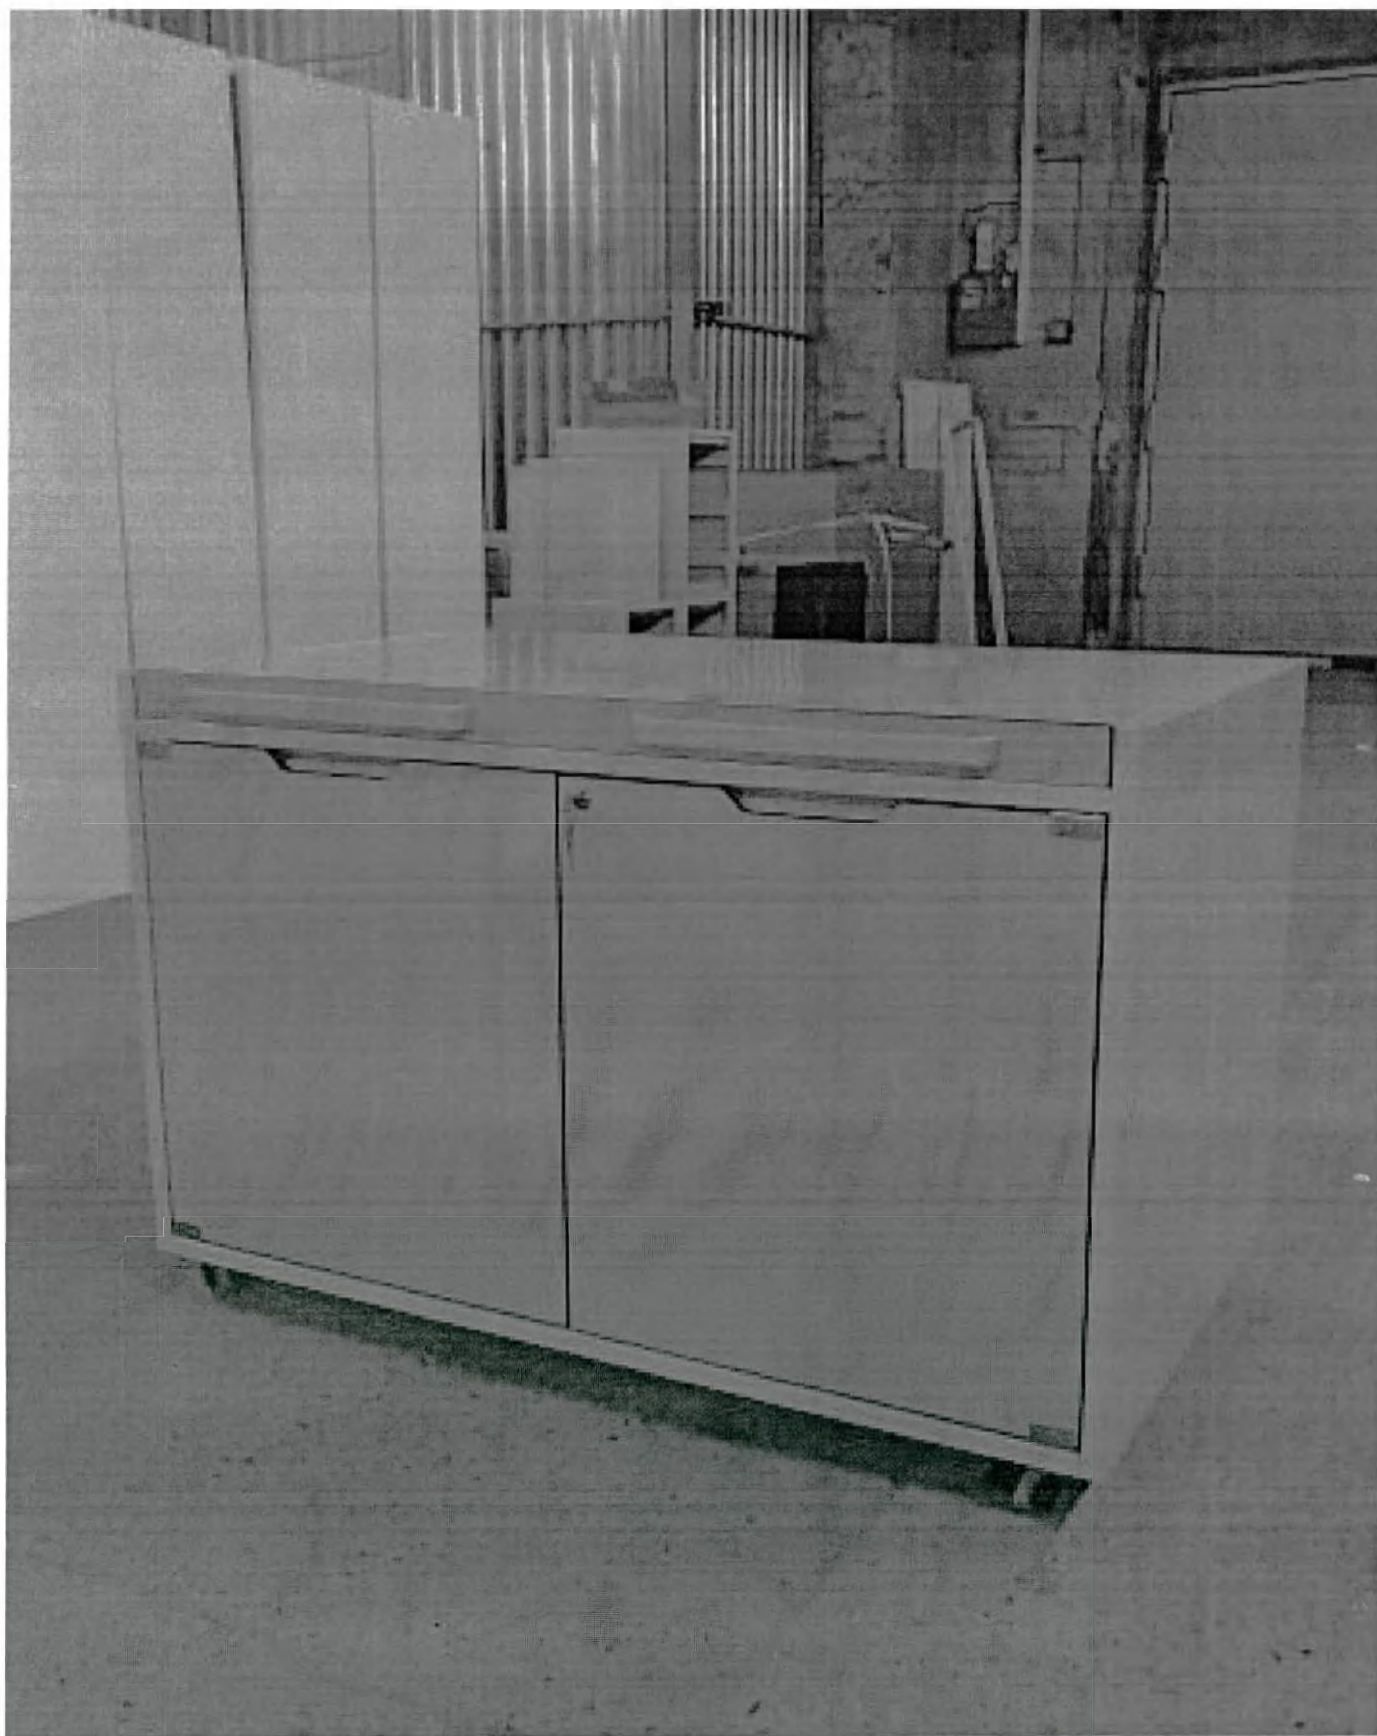

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022. Принадлежность: Модуль подкатной ШВМ-1

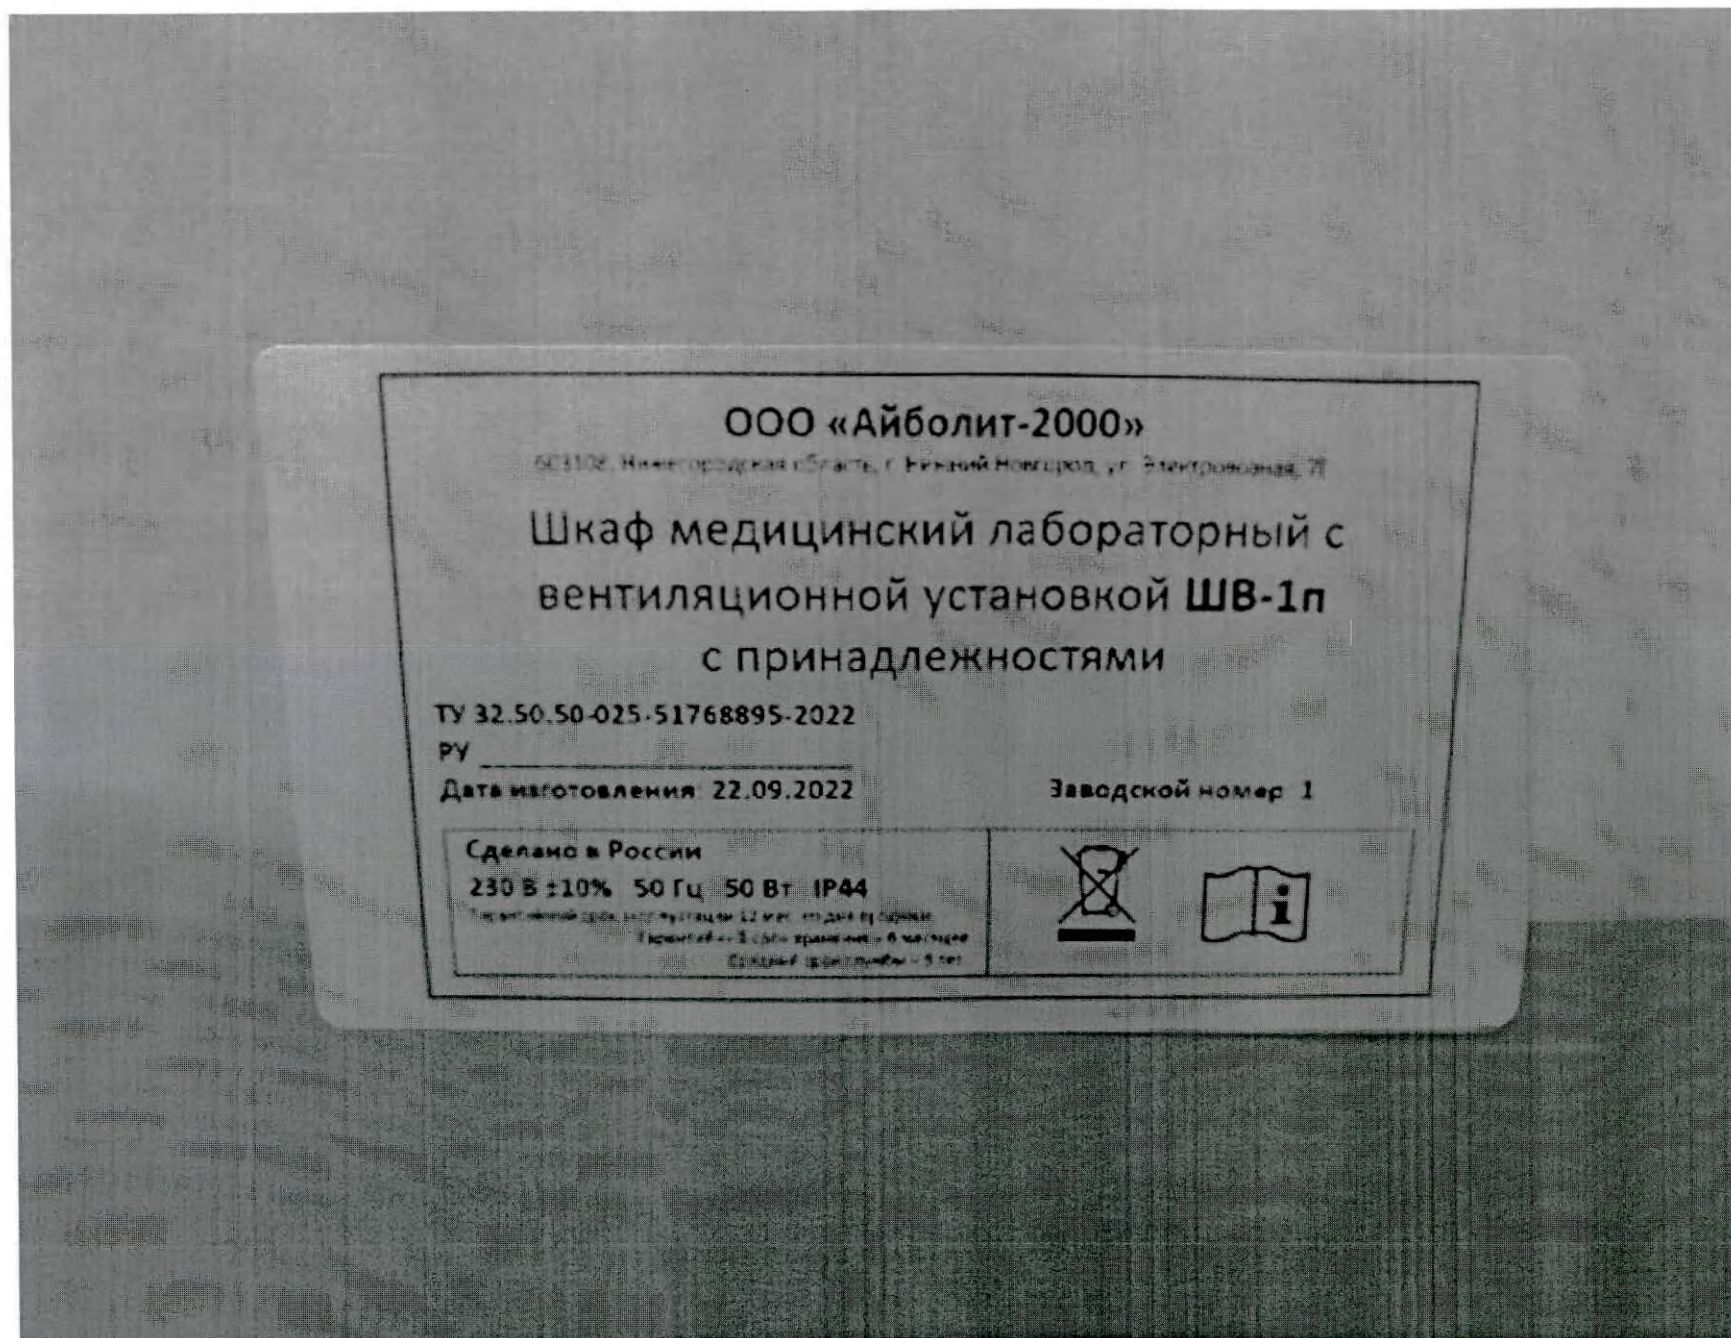

ООО «Айболит-2000»

603102, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7

Шкаф медицинский лабораторный с
вентиляционной установкой ШВ-1п
с принадлежностями

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

РУ

Дата изготовления: 22.09.2022

Заводской номер: 1

Сделано в России

230 В $\pm 10\%$ 50 Гц 50 Вт IP44

Параметры шкафа: высота 12 м, ширина 0,6 м, глубина 0,6 м
Гарантия: 3 года (при условии соблюдения правил эксплуатации)
Срок службы: 5 лет




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.


Маркировка изделия



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка изделия. Символ «Опасность повреждения рук».

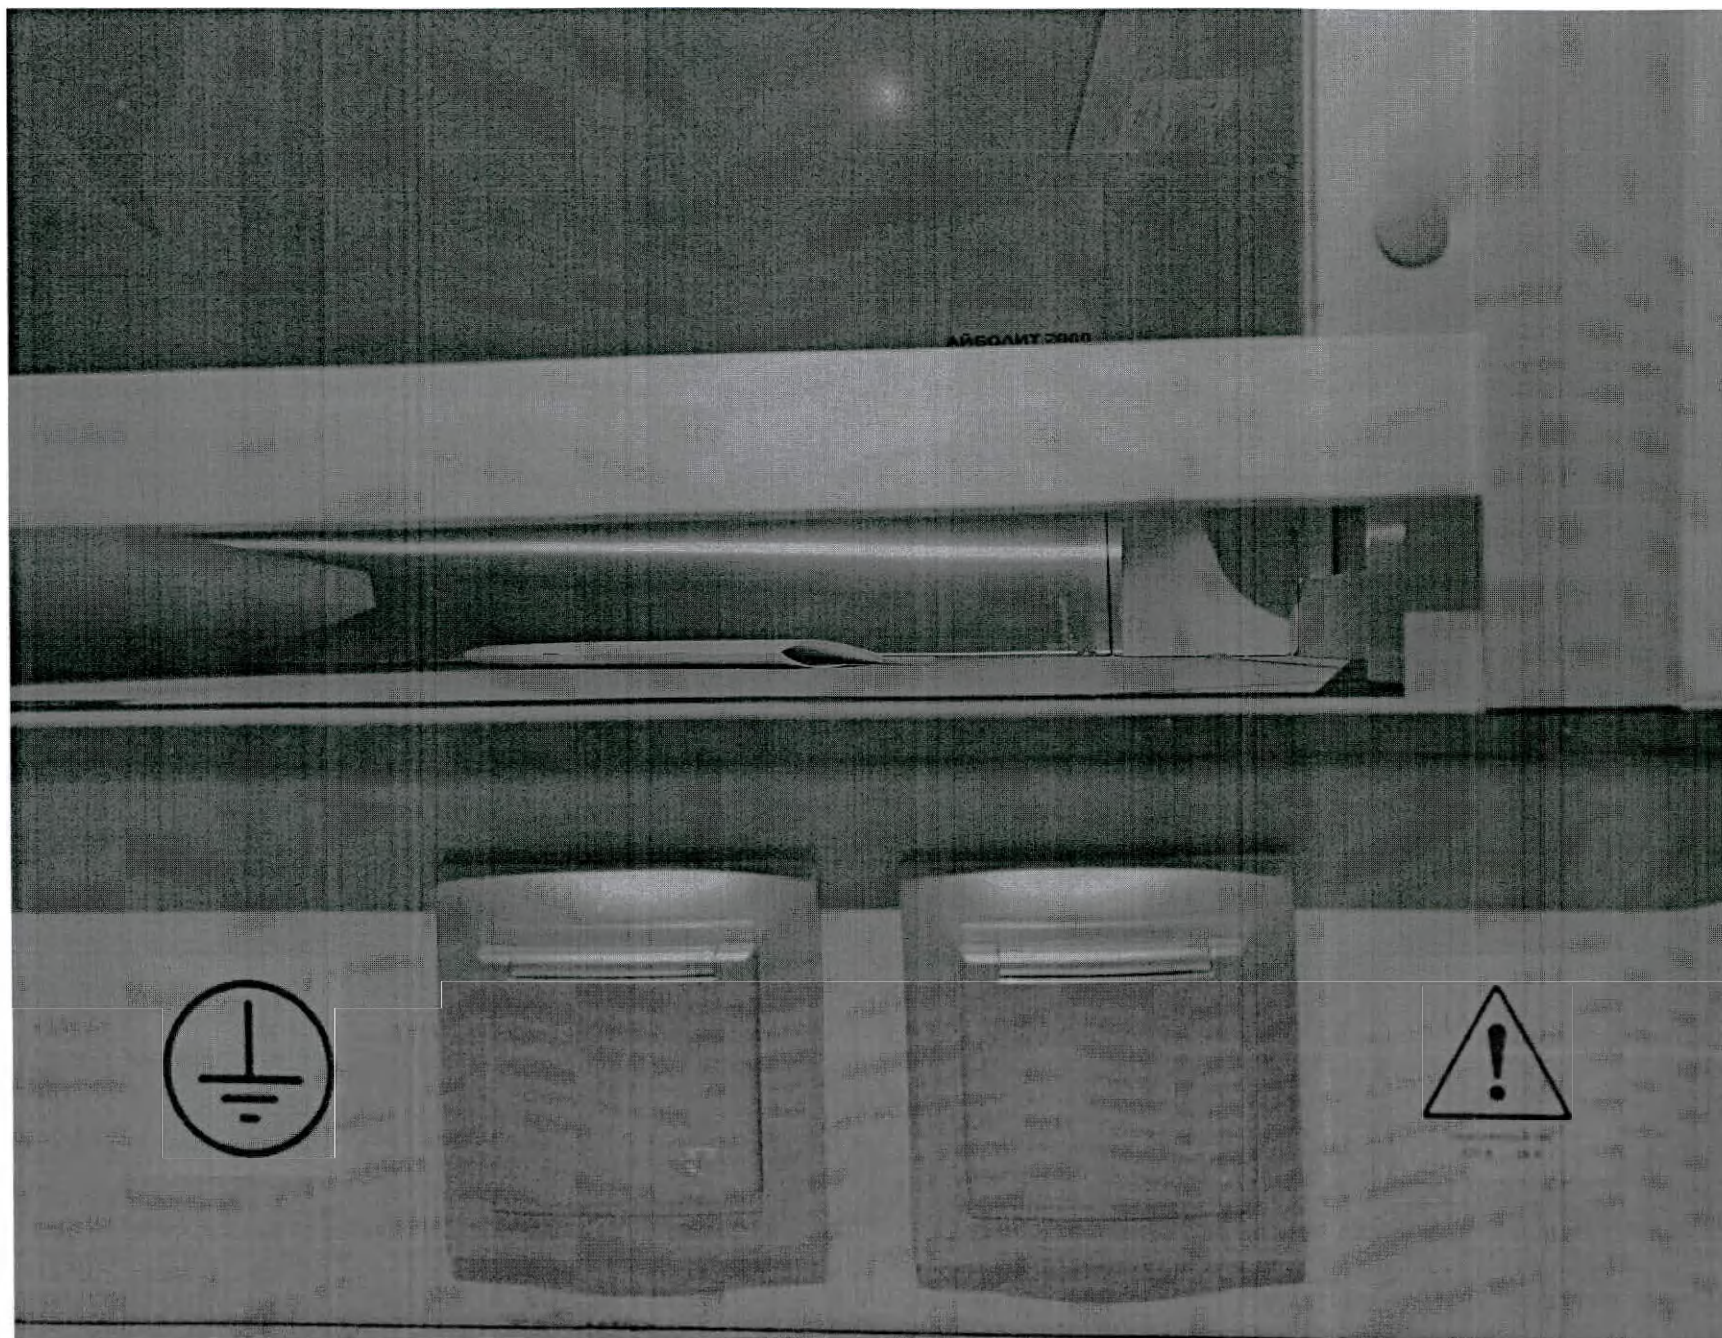

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка розеток

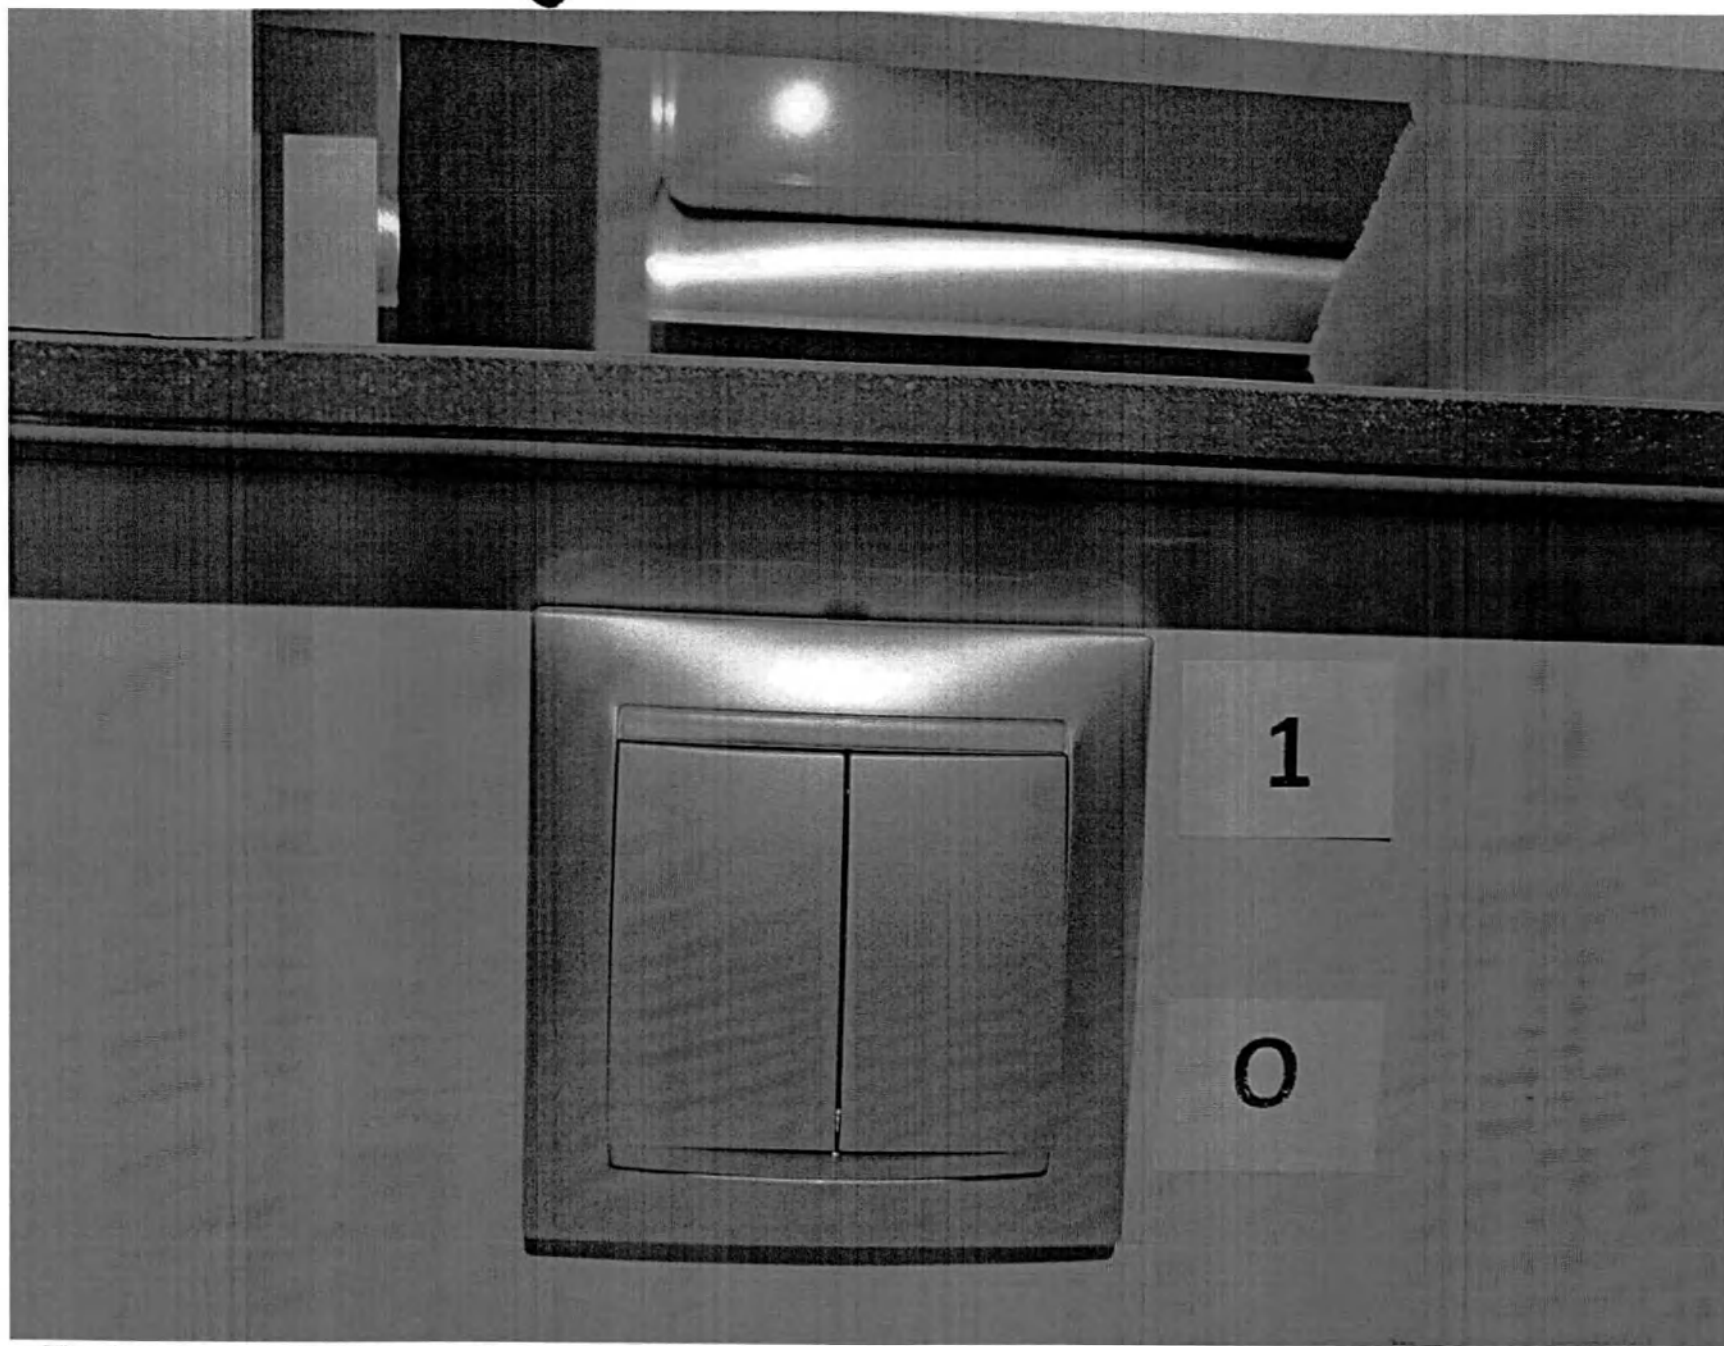

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка выключателя

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровская, 7Г

Полка боковая

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

РУ _____

Дата изготовления: 22.09.2022 _____ Заводской номер: 1 _____

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

Средний срок службы – 6 лет.



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка принадлежности: Полка боковая



**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка принадлежности: Модуль подкатной ШВМ-1**

ООО «Айболит-2000»

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями



Пакет 1 из 1

Шкаф

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

Регистрационное удостоверение _____



ЦВЕТ КОРПУСА

ЦВЕТ ПЛАСТИКА

СЕРЫЙ

ФИСТАШКОВЫЙ

Заводской номер

№ 1

Дата изготовления

22.09.2022

Комплект поставки:

Камера шкафа в сборе – 1 шт.
Стойка задняя правая – 1 шт.
Стойка задняя левая – 1 шт.
Стойка передняя – 2 шт.
Лыжа – 2 шт.
Стяжка нижняя – 1 шт.
Винт 4х16 комби – 4 шт.
Болты 8х20 – 24 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.
Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.
Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.7Г

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №1 Шкаф

ООО «Айболит-2000»

**Шкаф медицинский лабораторный
с вентиляционной установкой с принадлежностями**



**Пакет 1 из 1
Модуль подкатной
ШВМ-1**



ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА
ЦВЕТ ПЛАСТИКА

Комплект поставки:
Модуль подкатной ШВМ-1 – 1 шт.


СЕРЫЙ
фисташковый

Заводской номер _____

Дата изготовления 22.09.2022

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.
Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.
Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.71

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка потребительской (транспортной) упаковки принадлежности: Модуль подкатной ШВМ-1

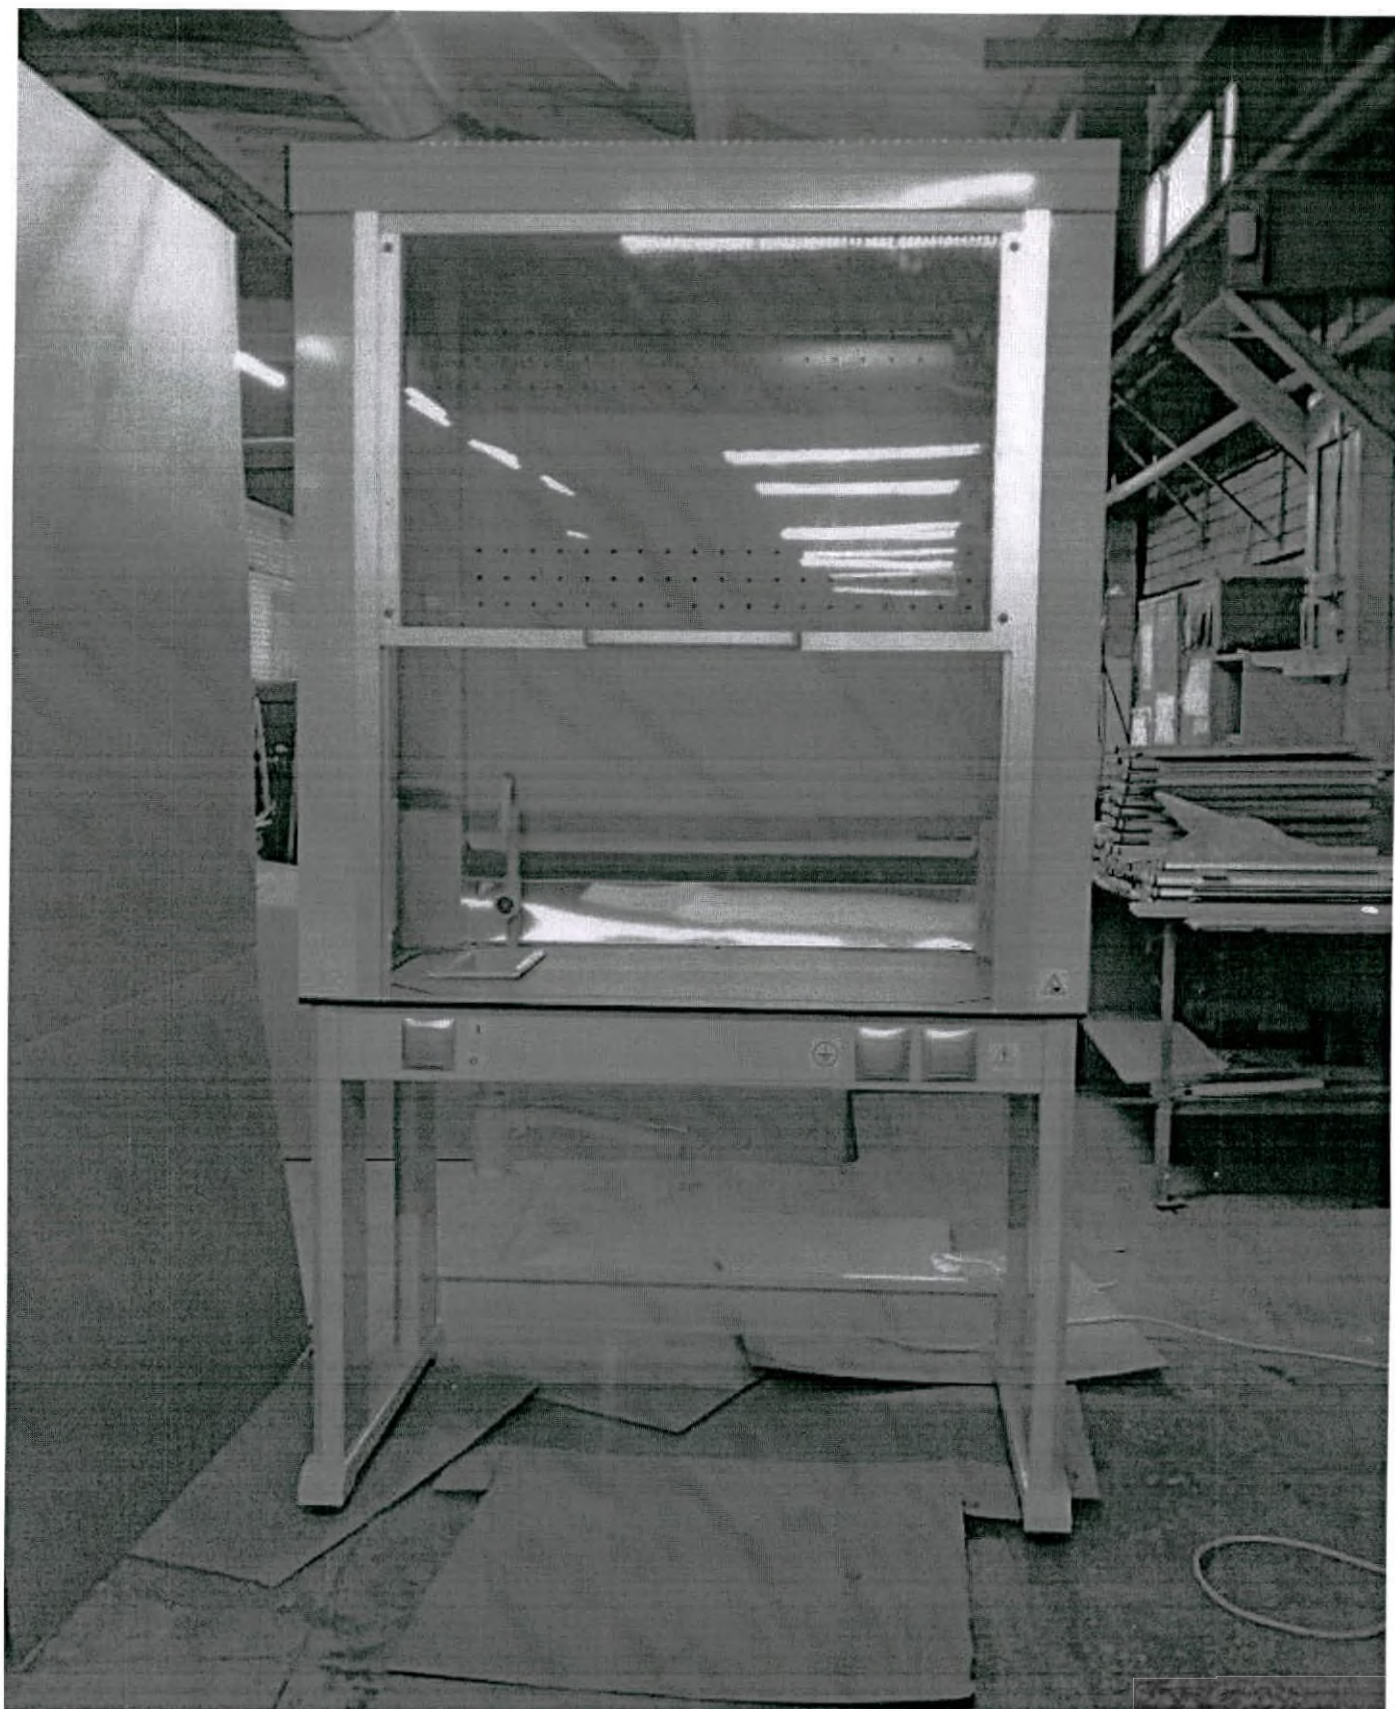


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Общий вид




**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Общий вид с принадлежностями**




**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ПВ-2п с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Камера шкафа в сборе**

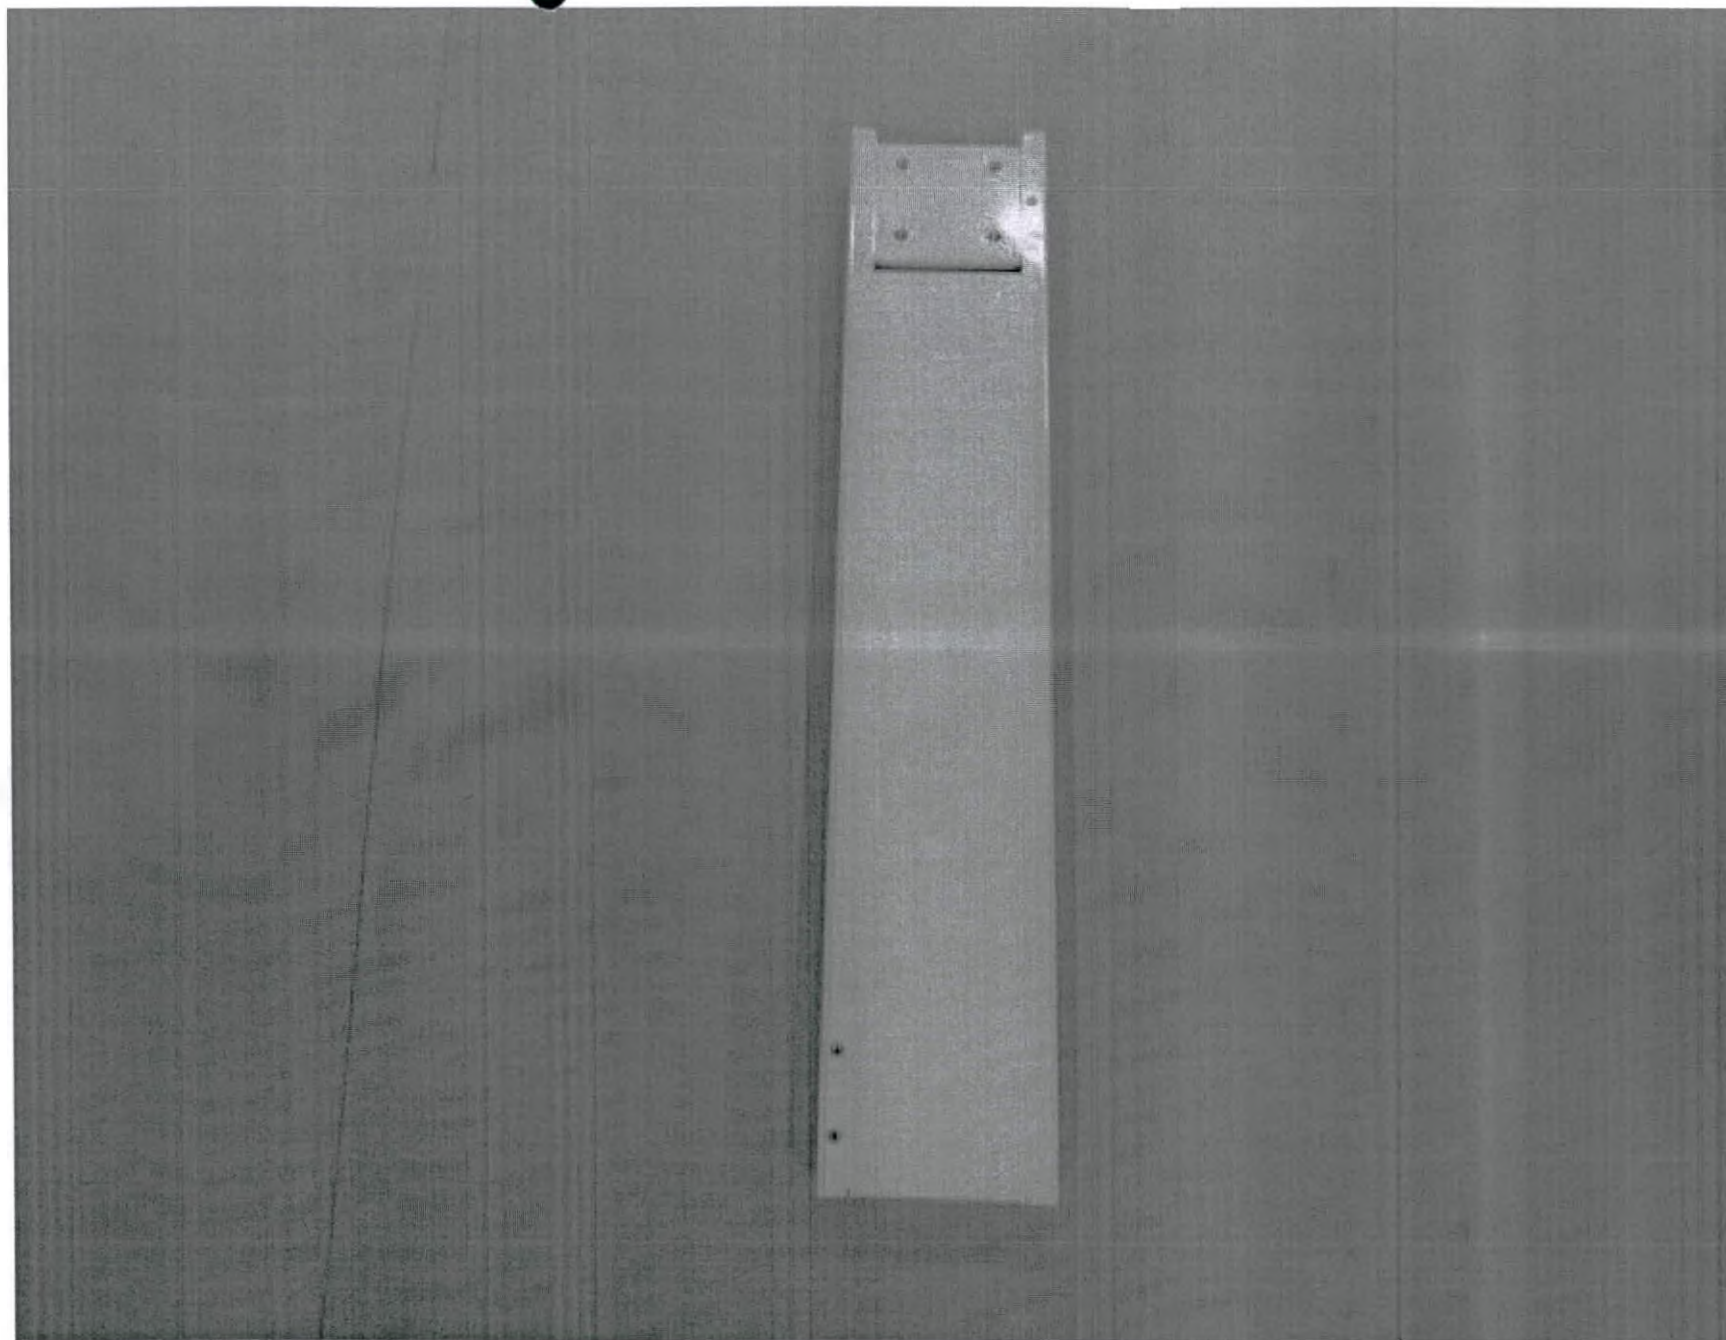


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя правая

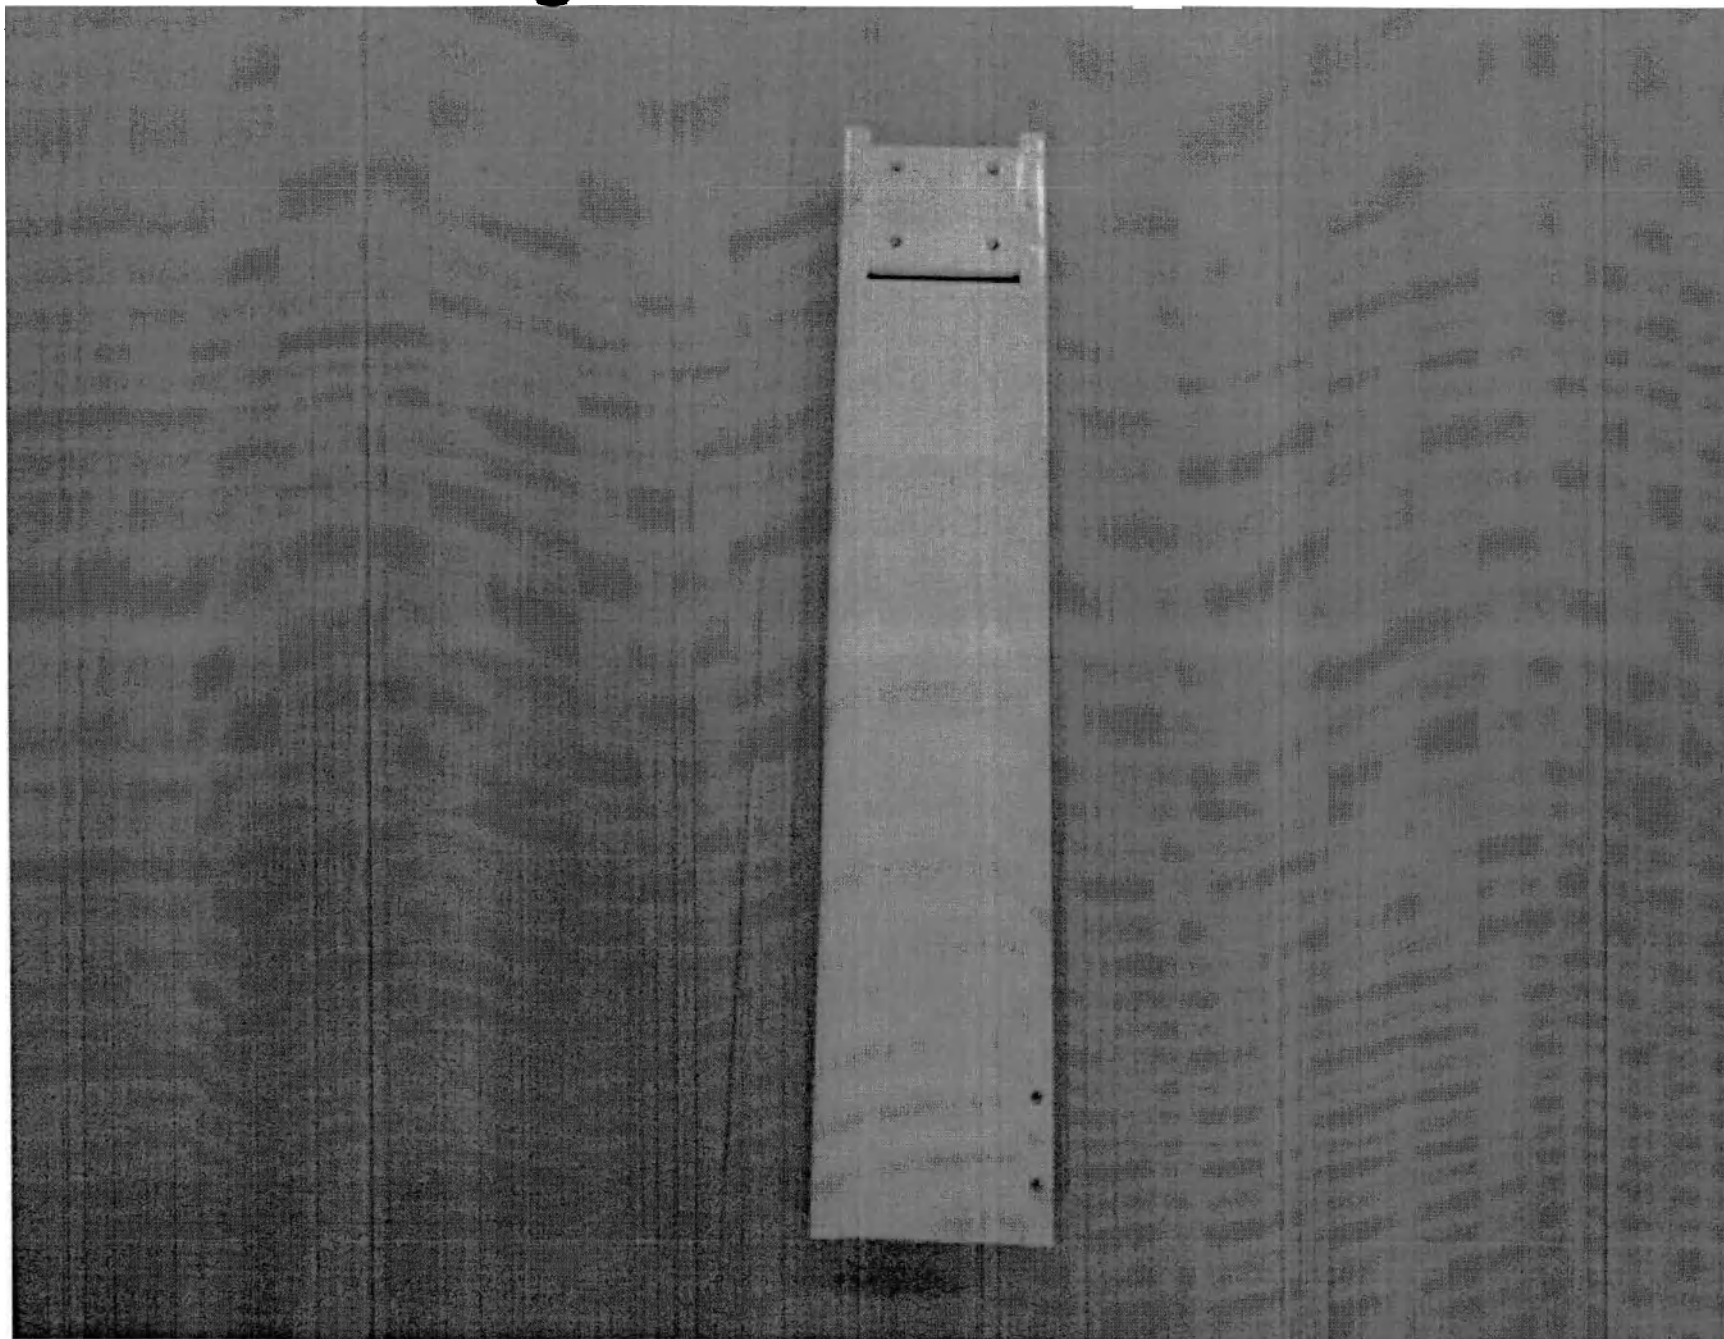


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ПВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя левая**

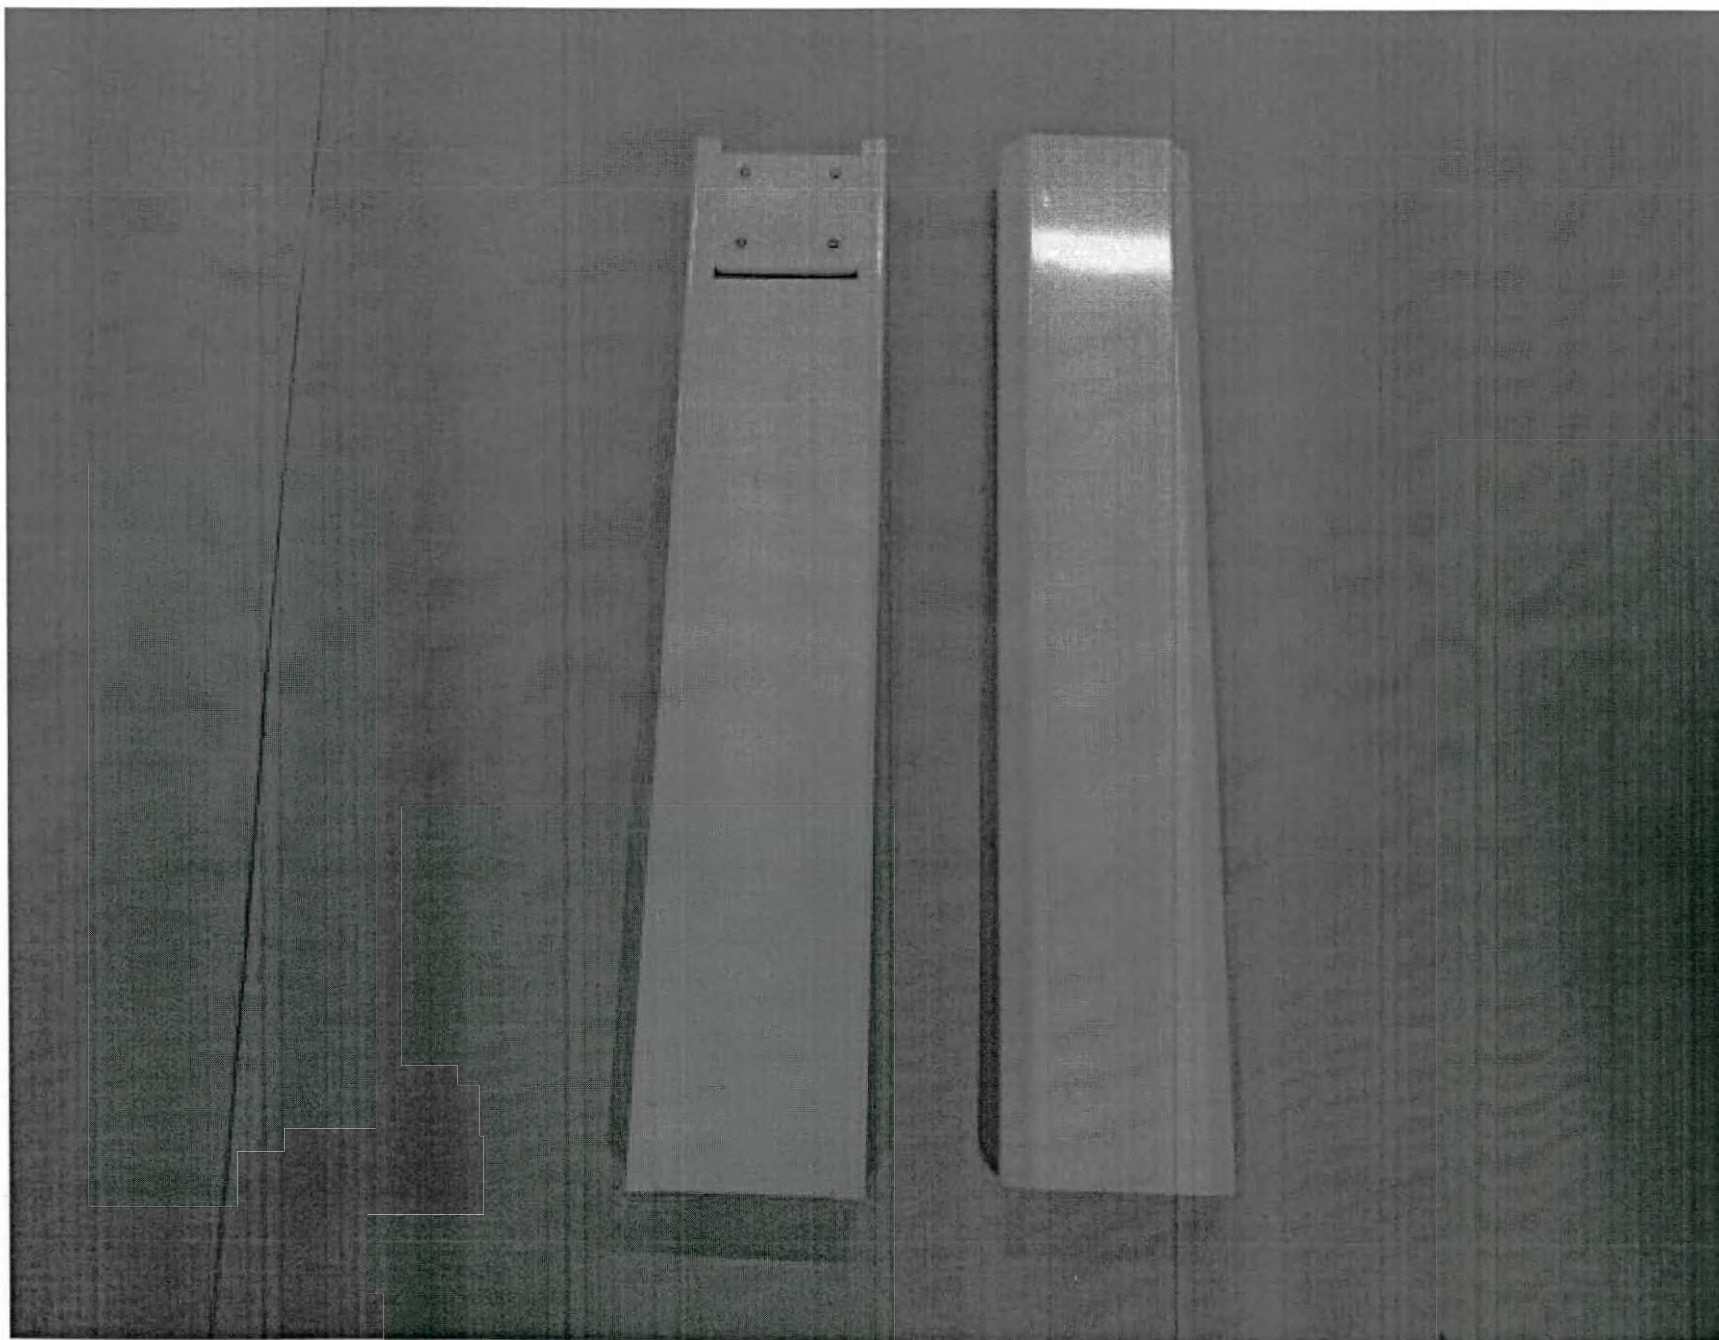


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка передняя

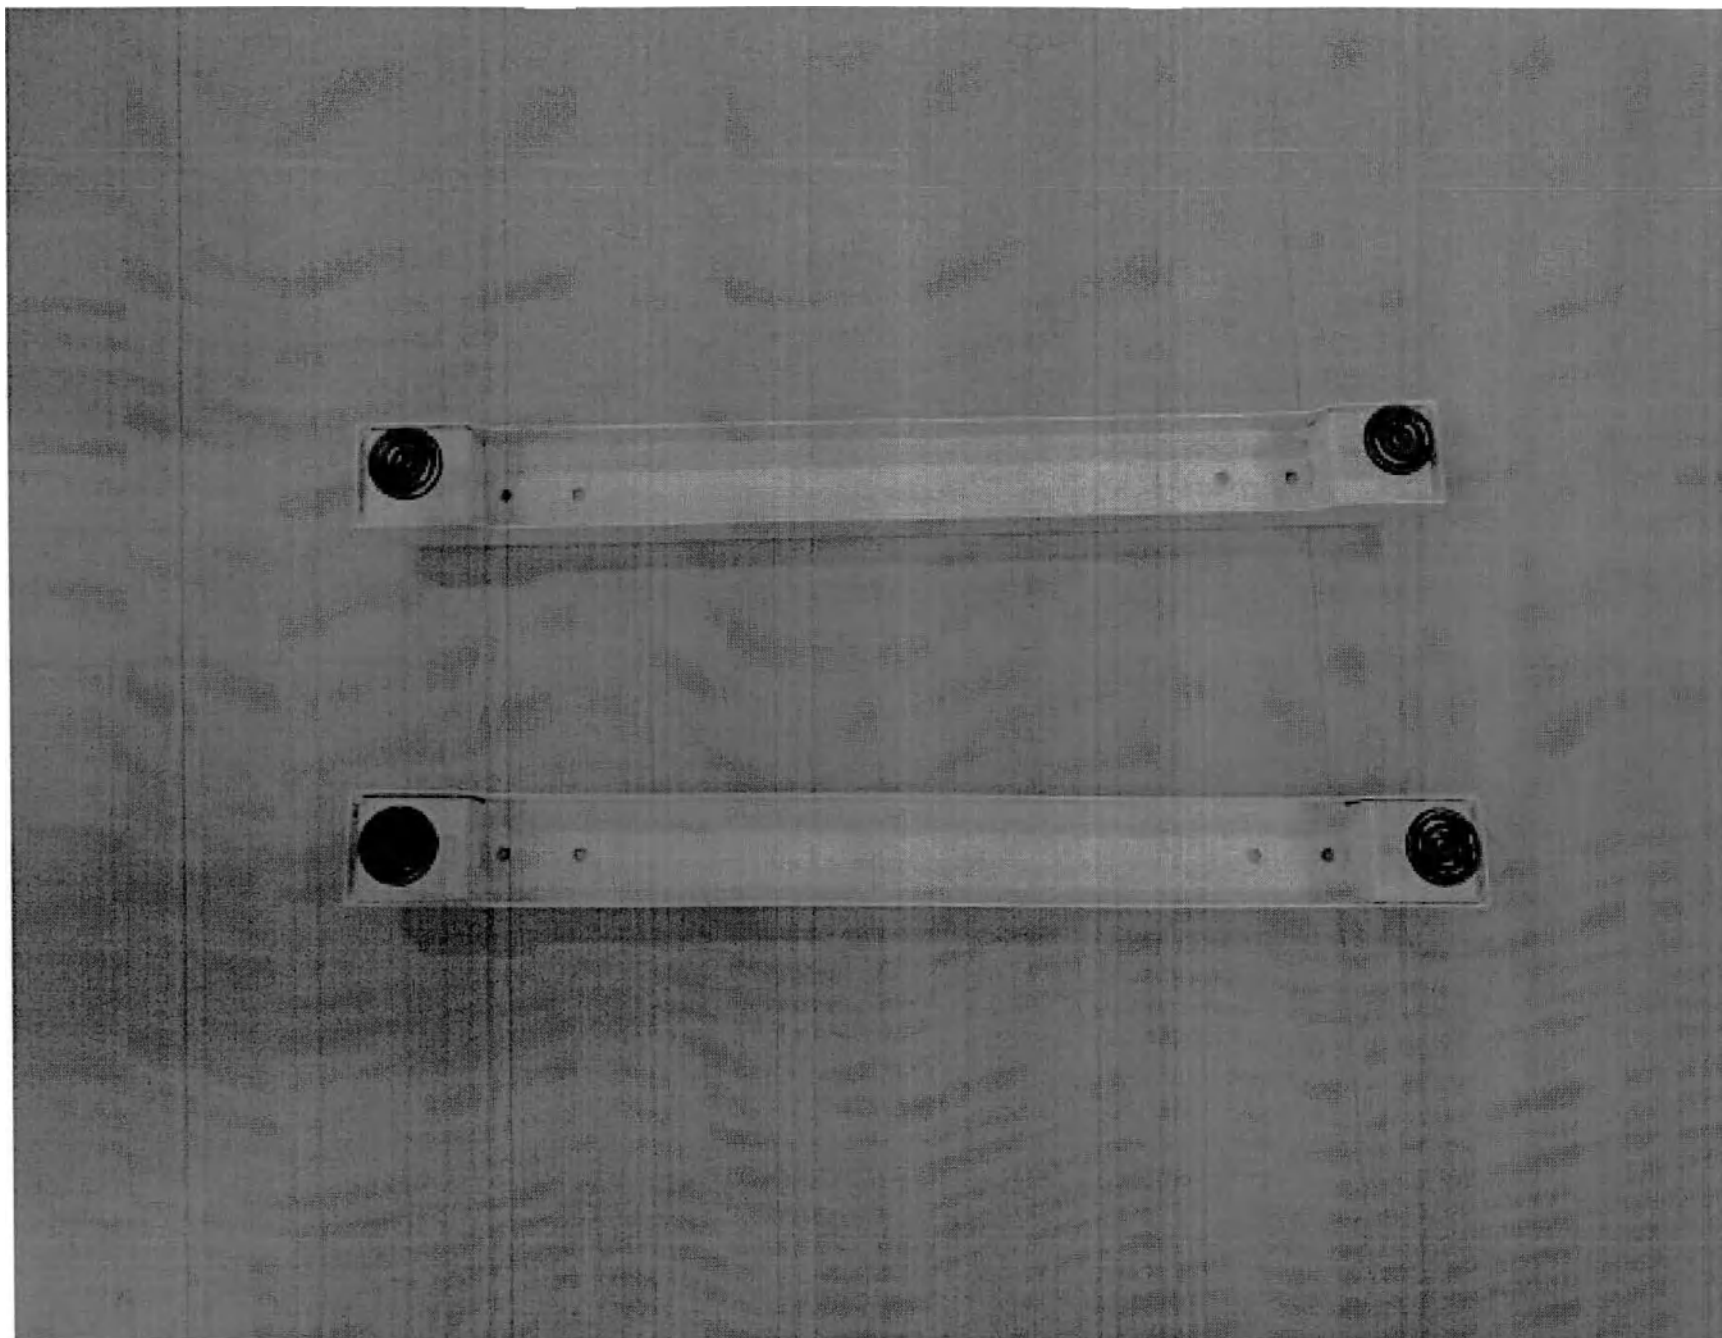


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Лыжа**

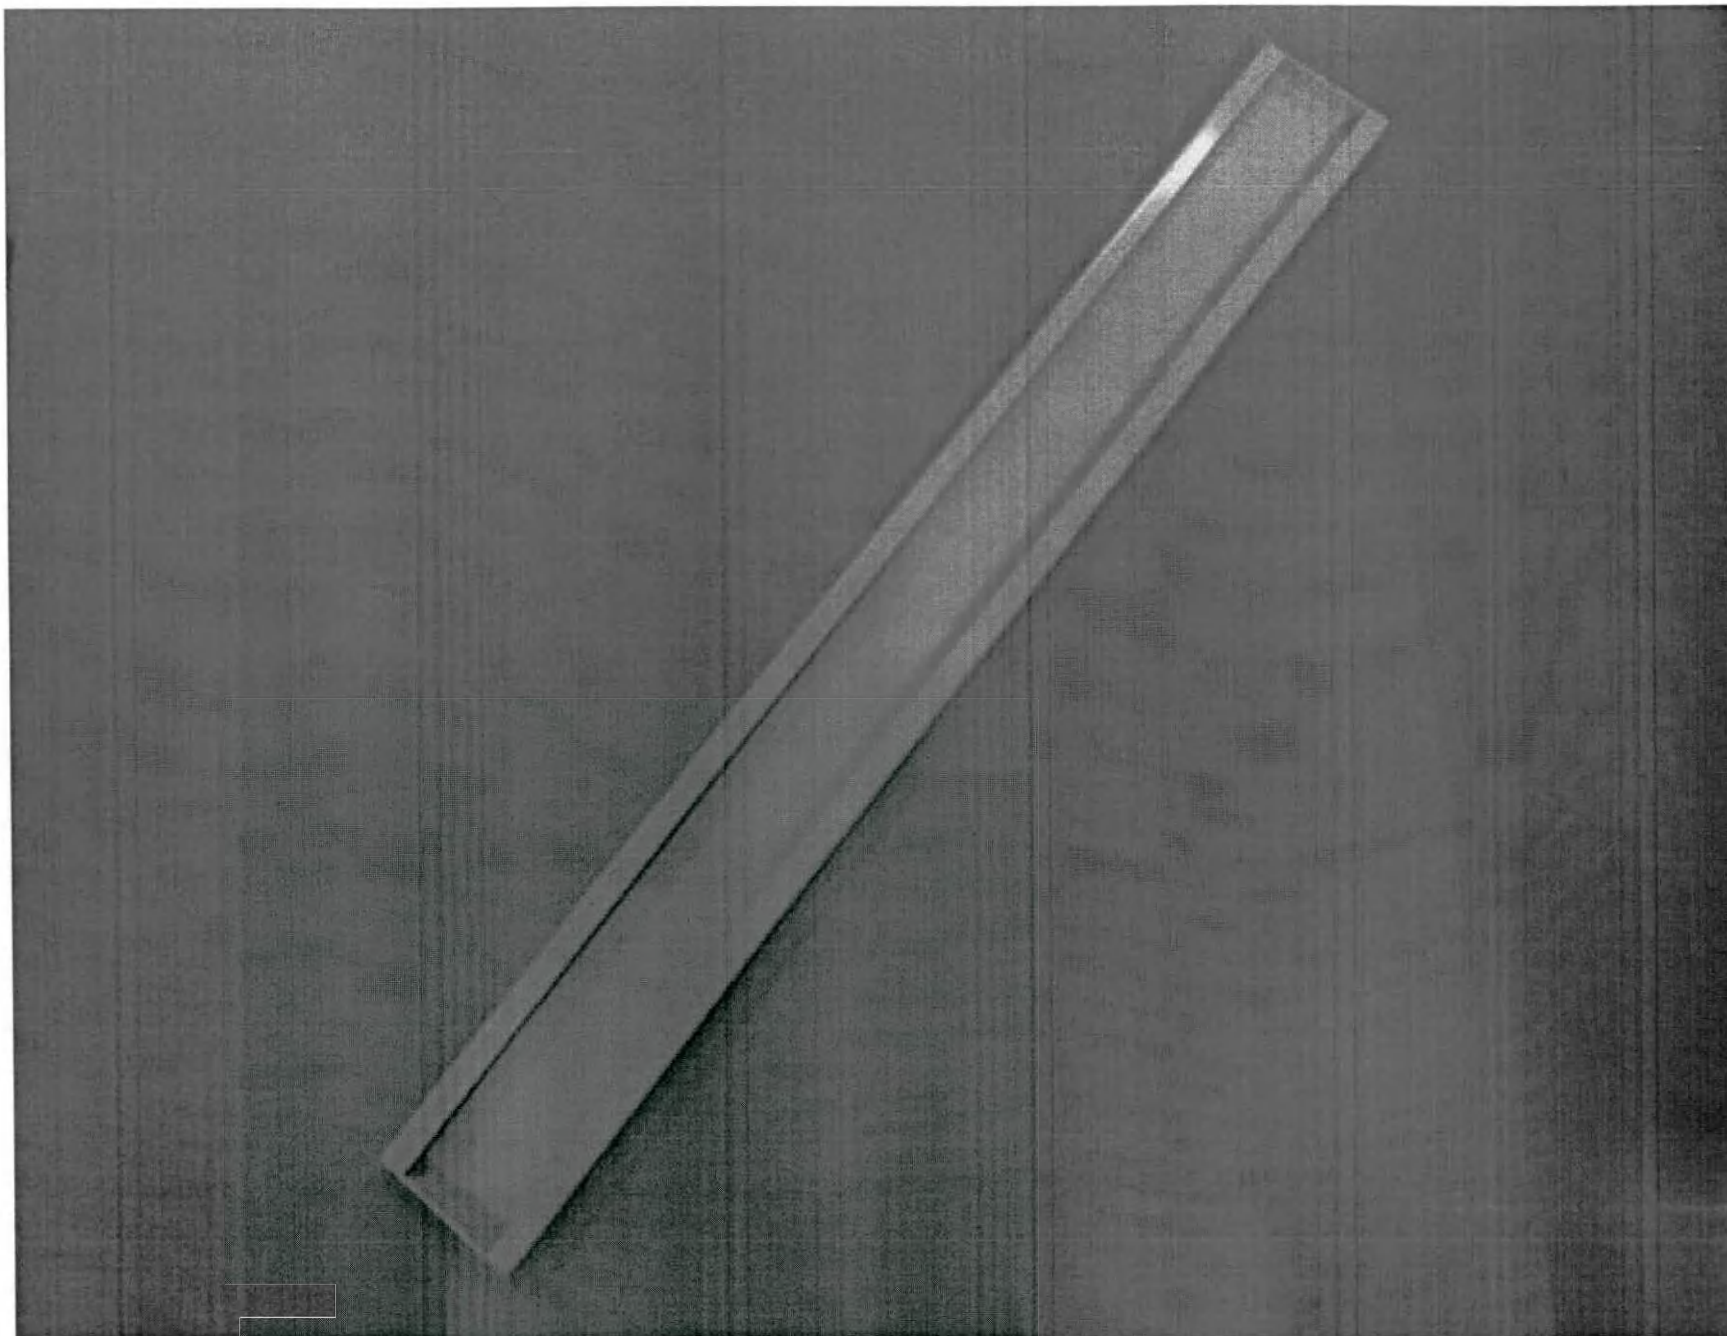


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стяжка нижняя

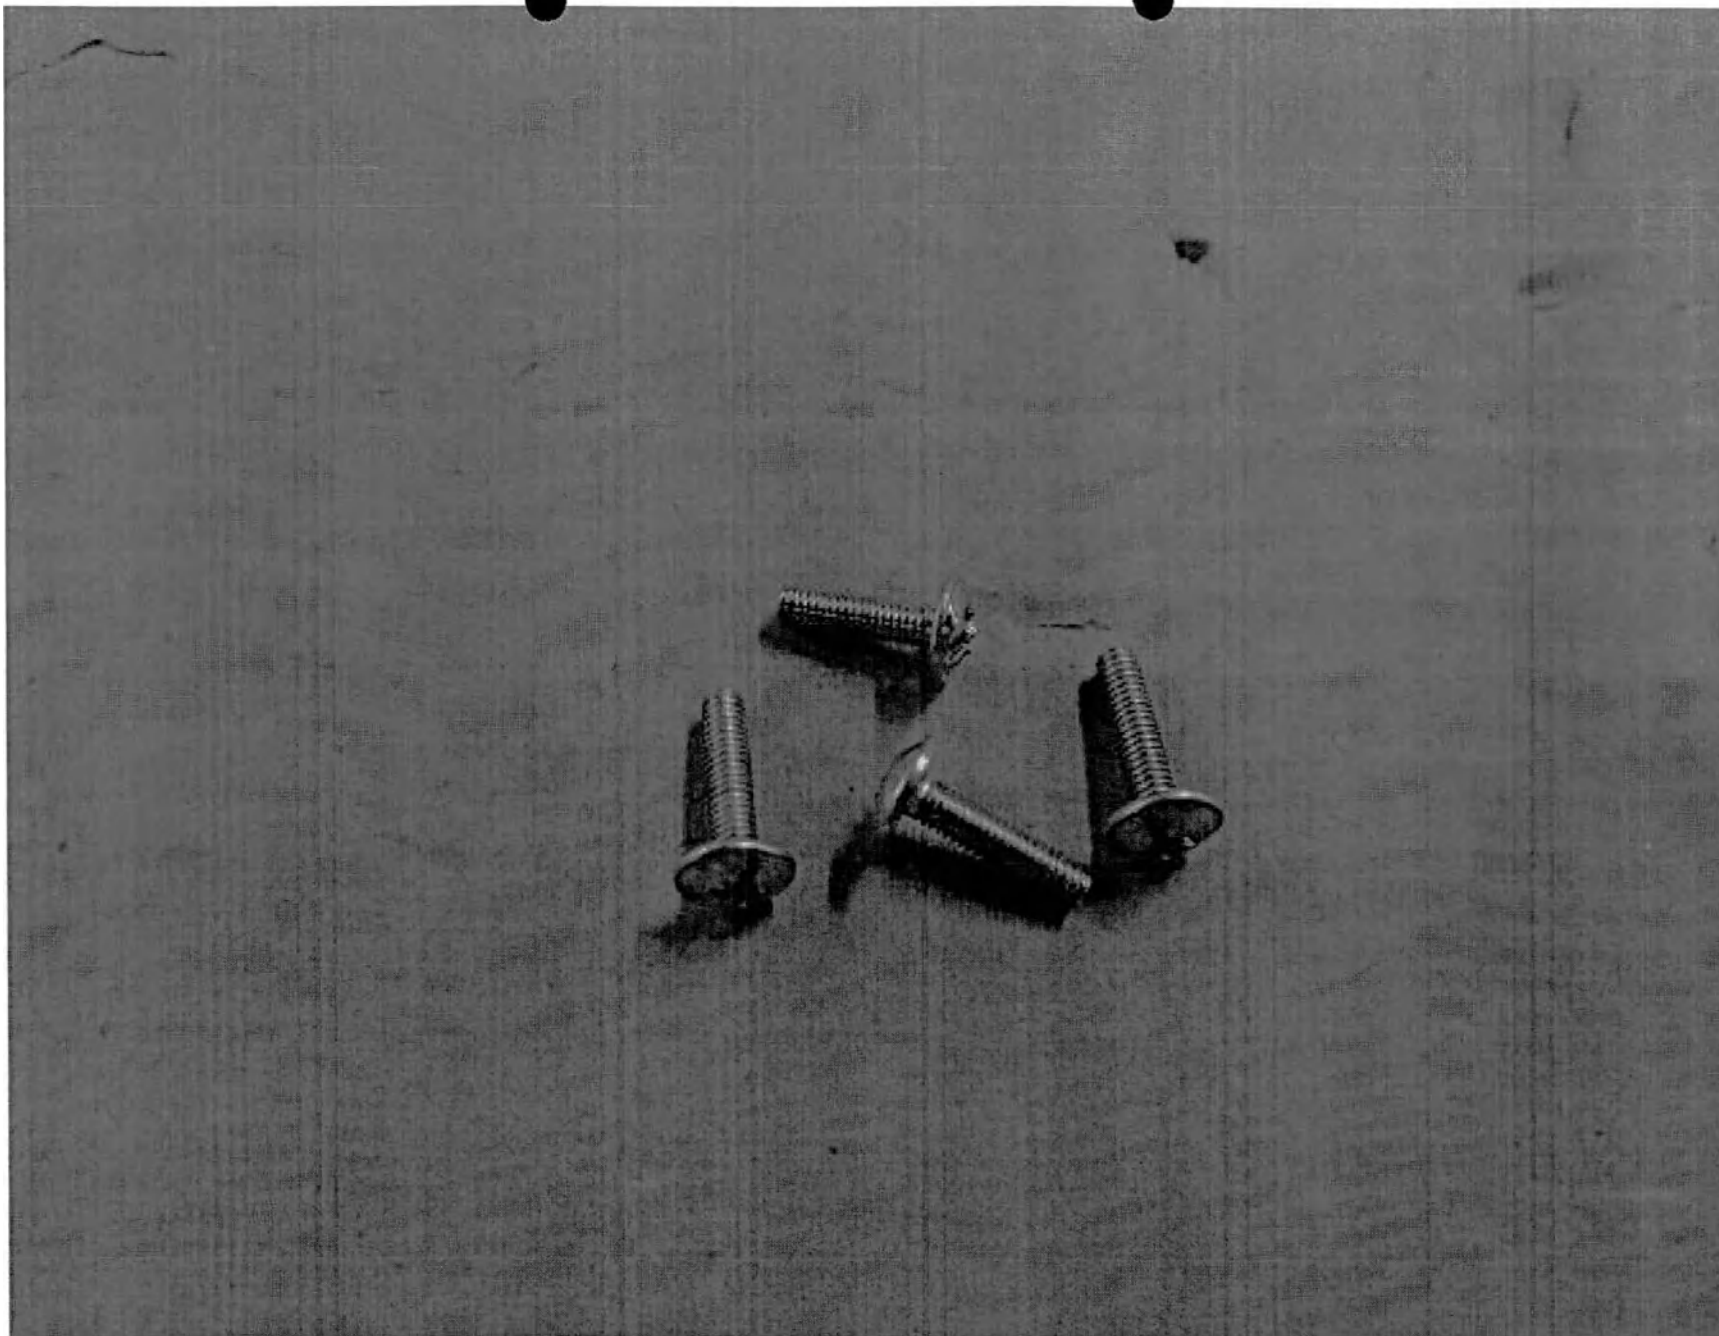


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Винт 4x16 комби**

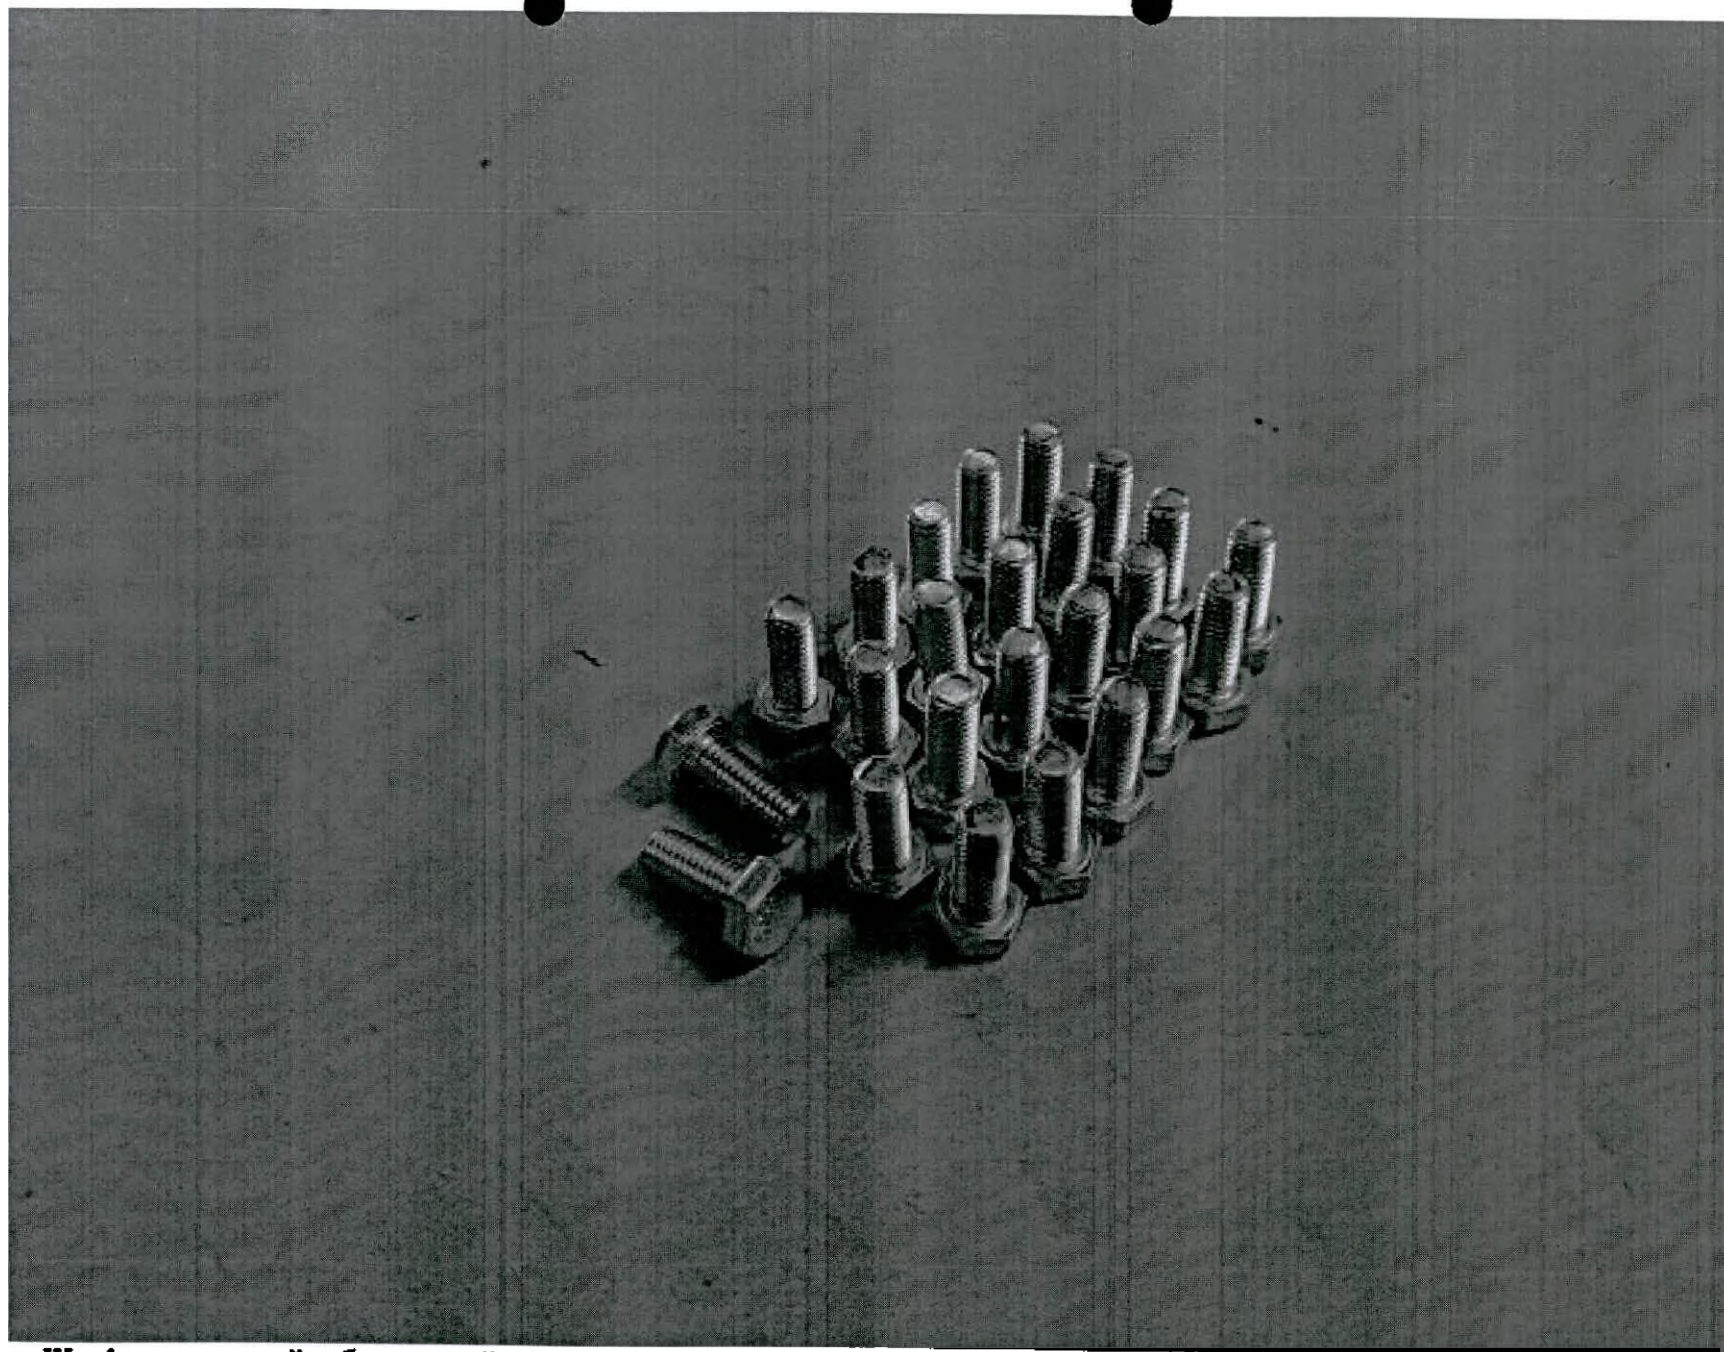


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Болт 8x20**

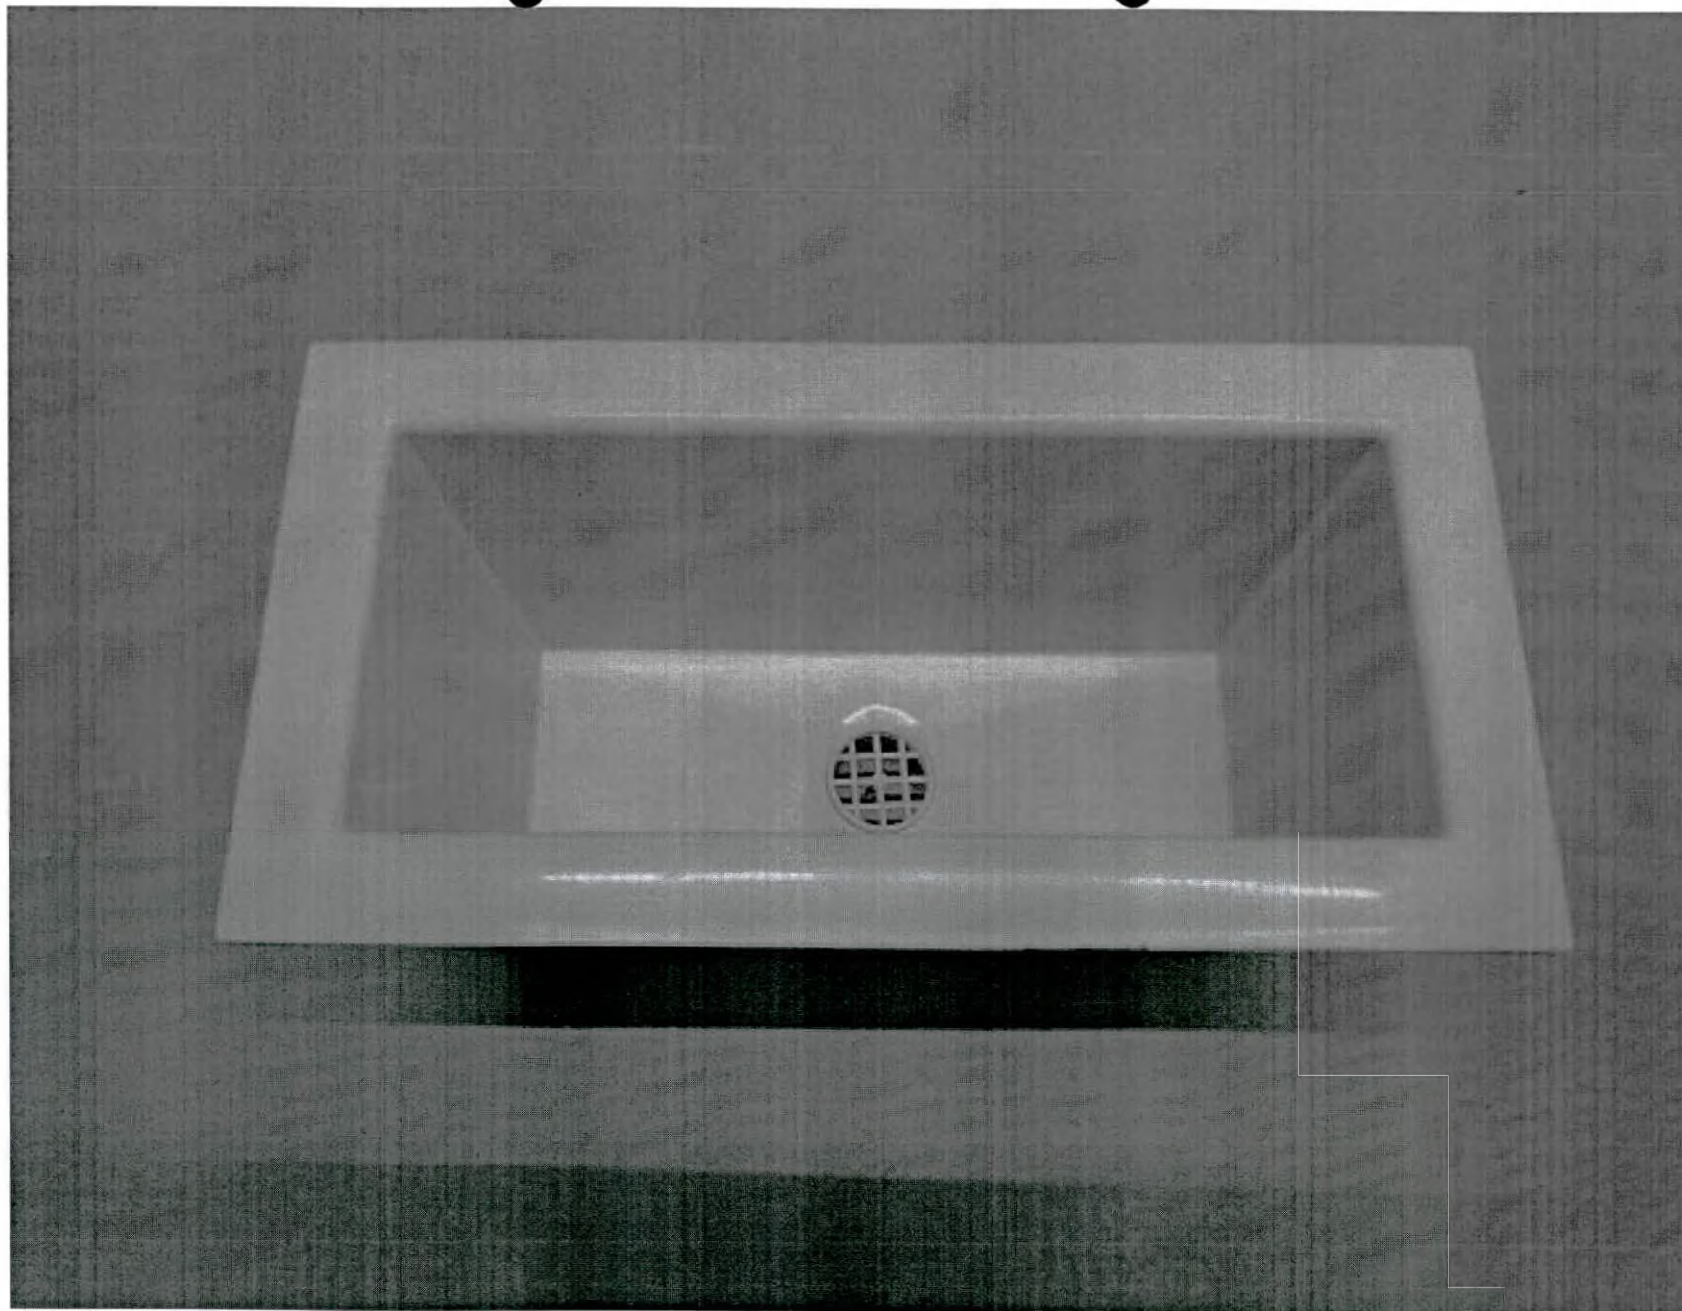


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Мойка

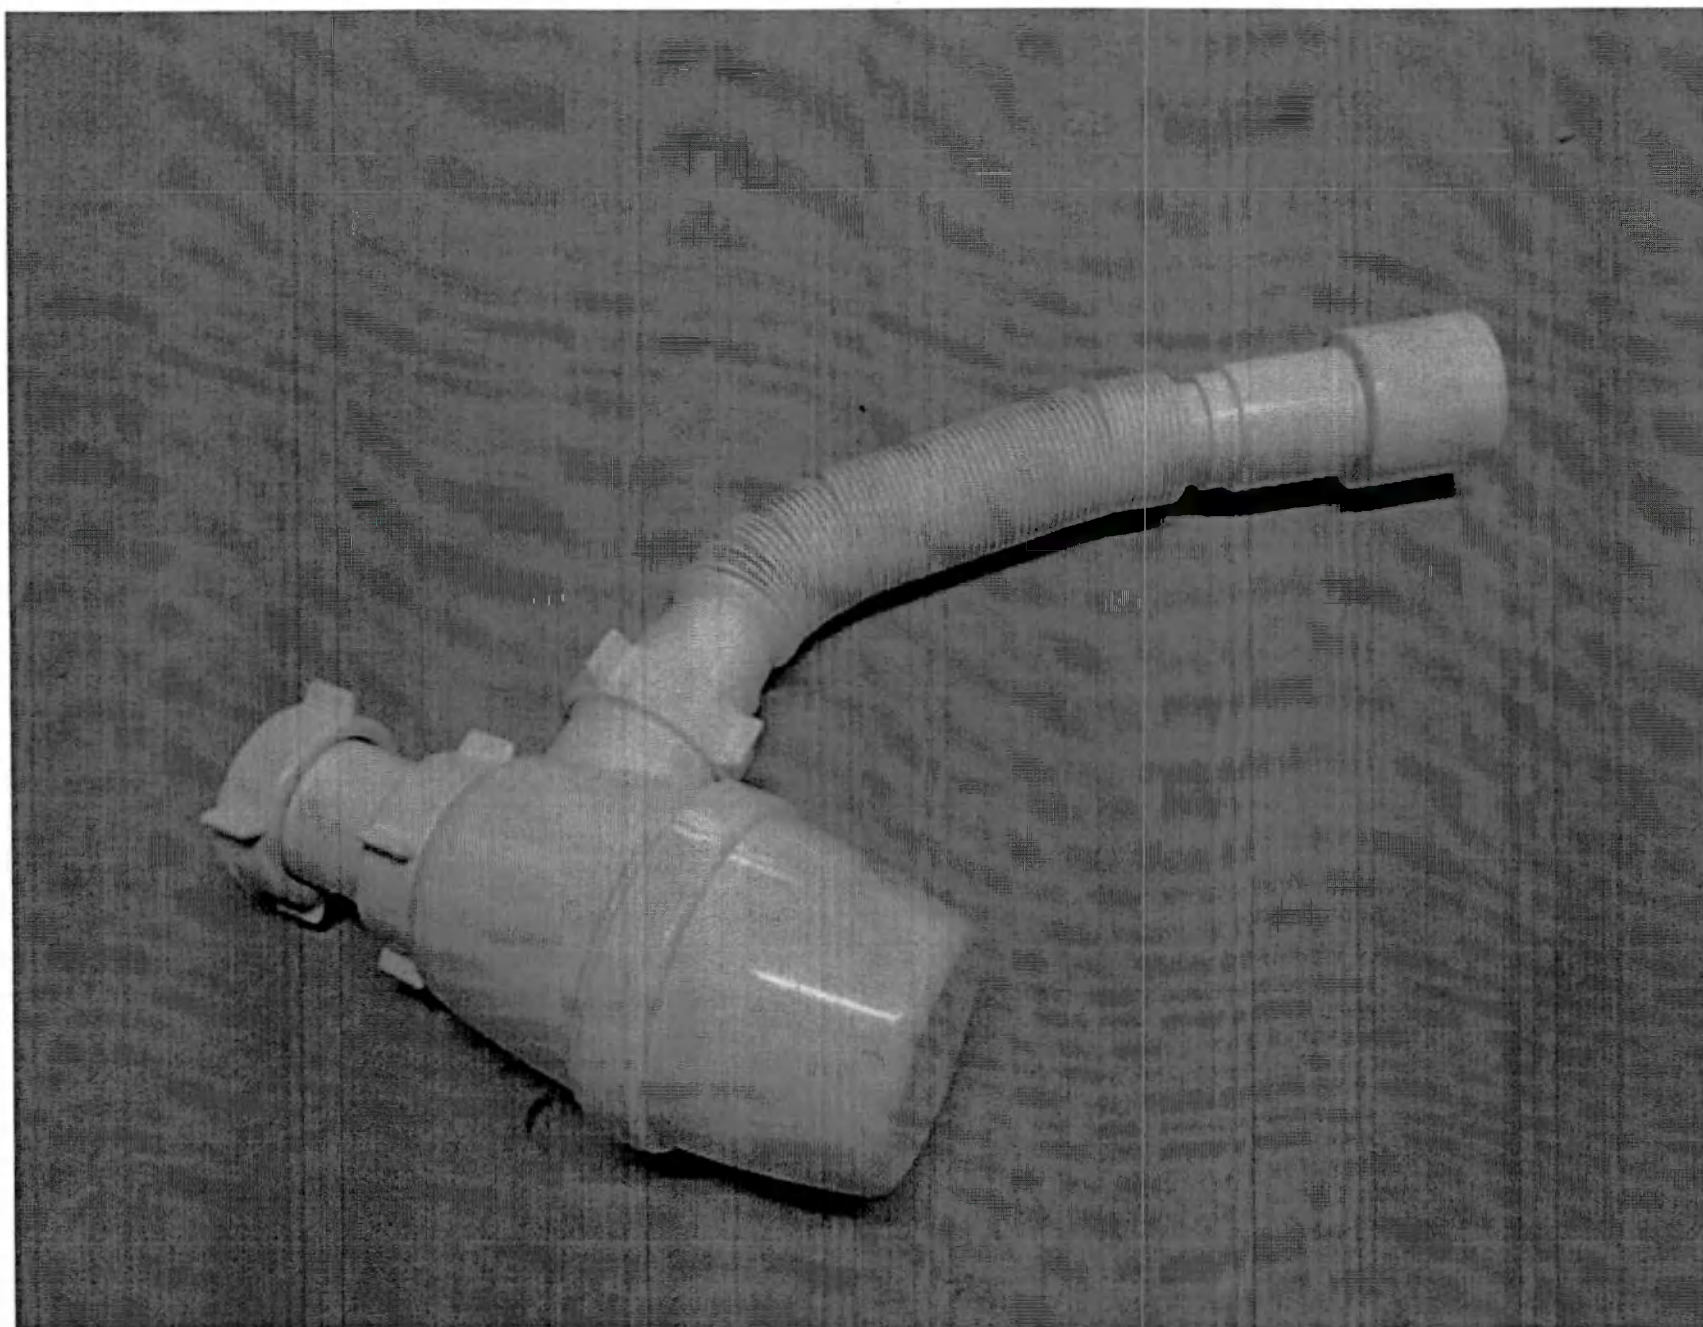

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Сифон

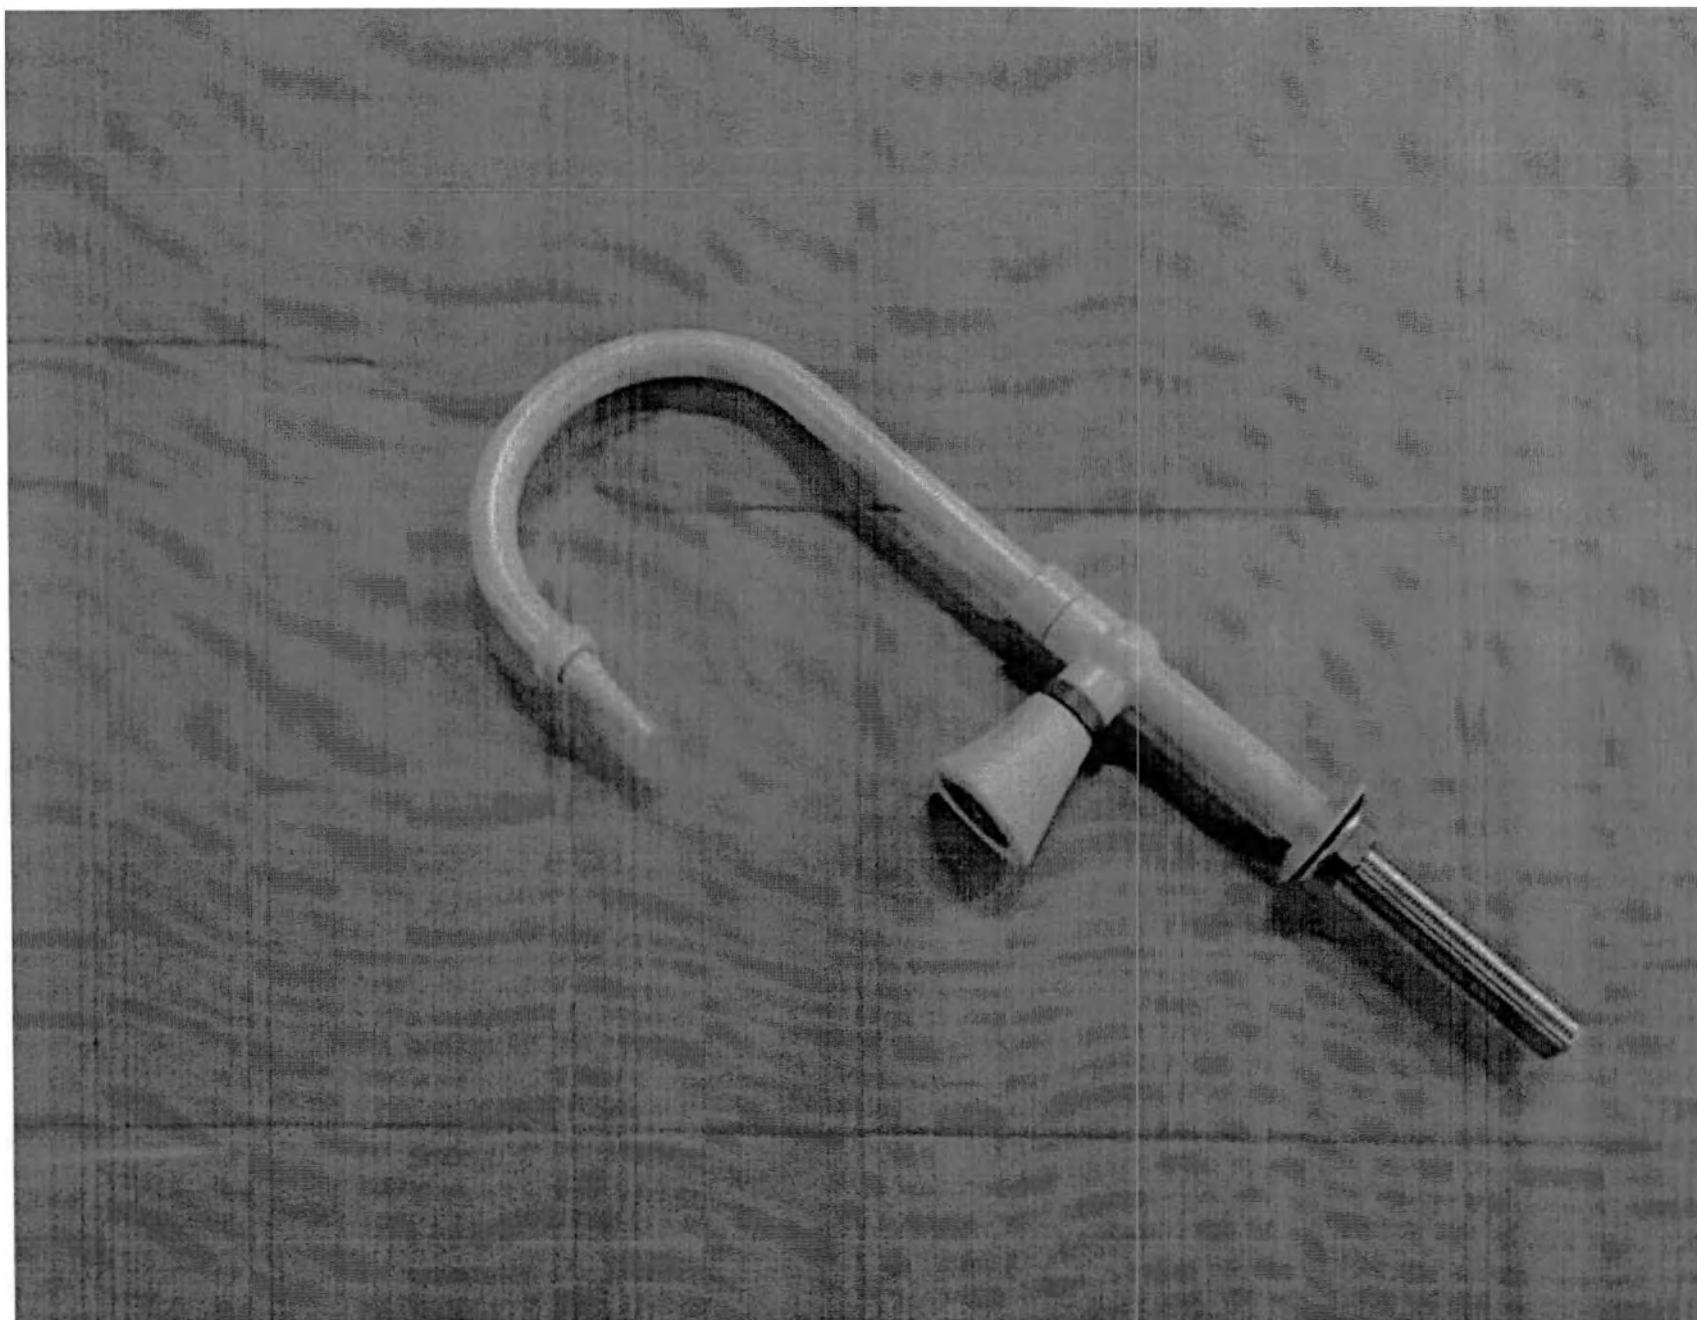


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Смеситель

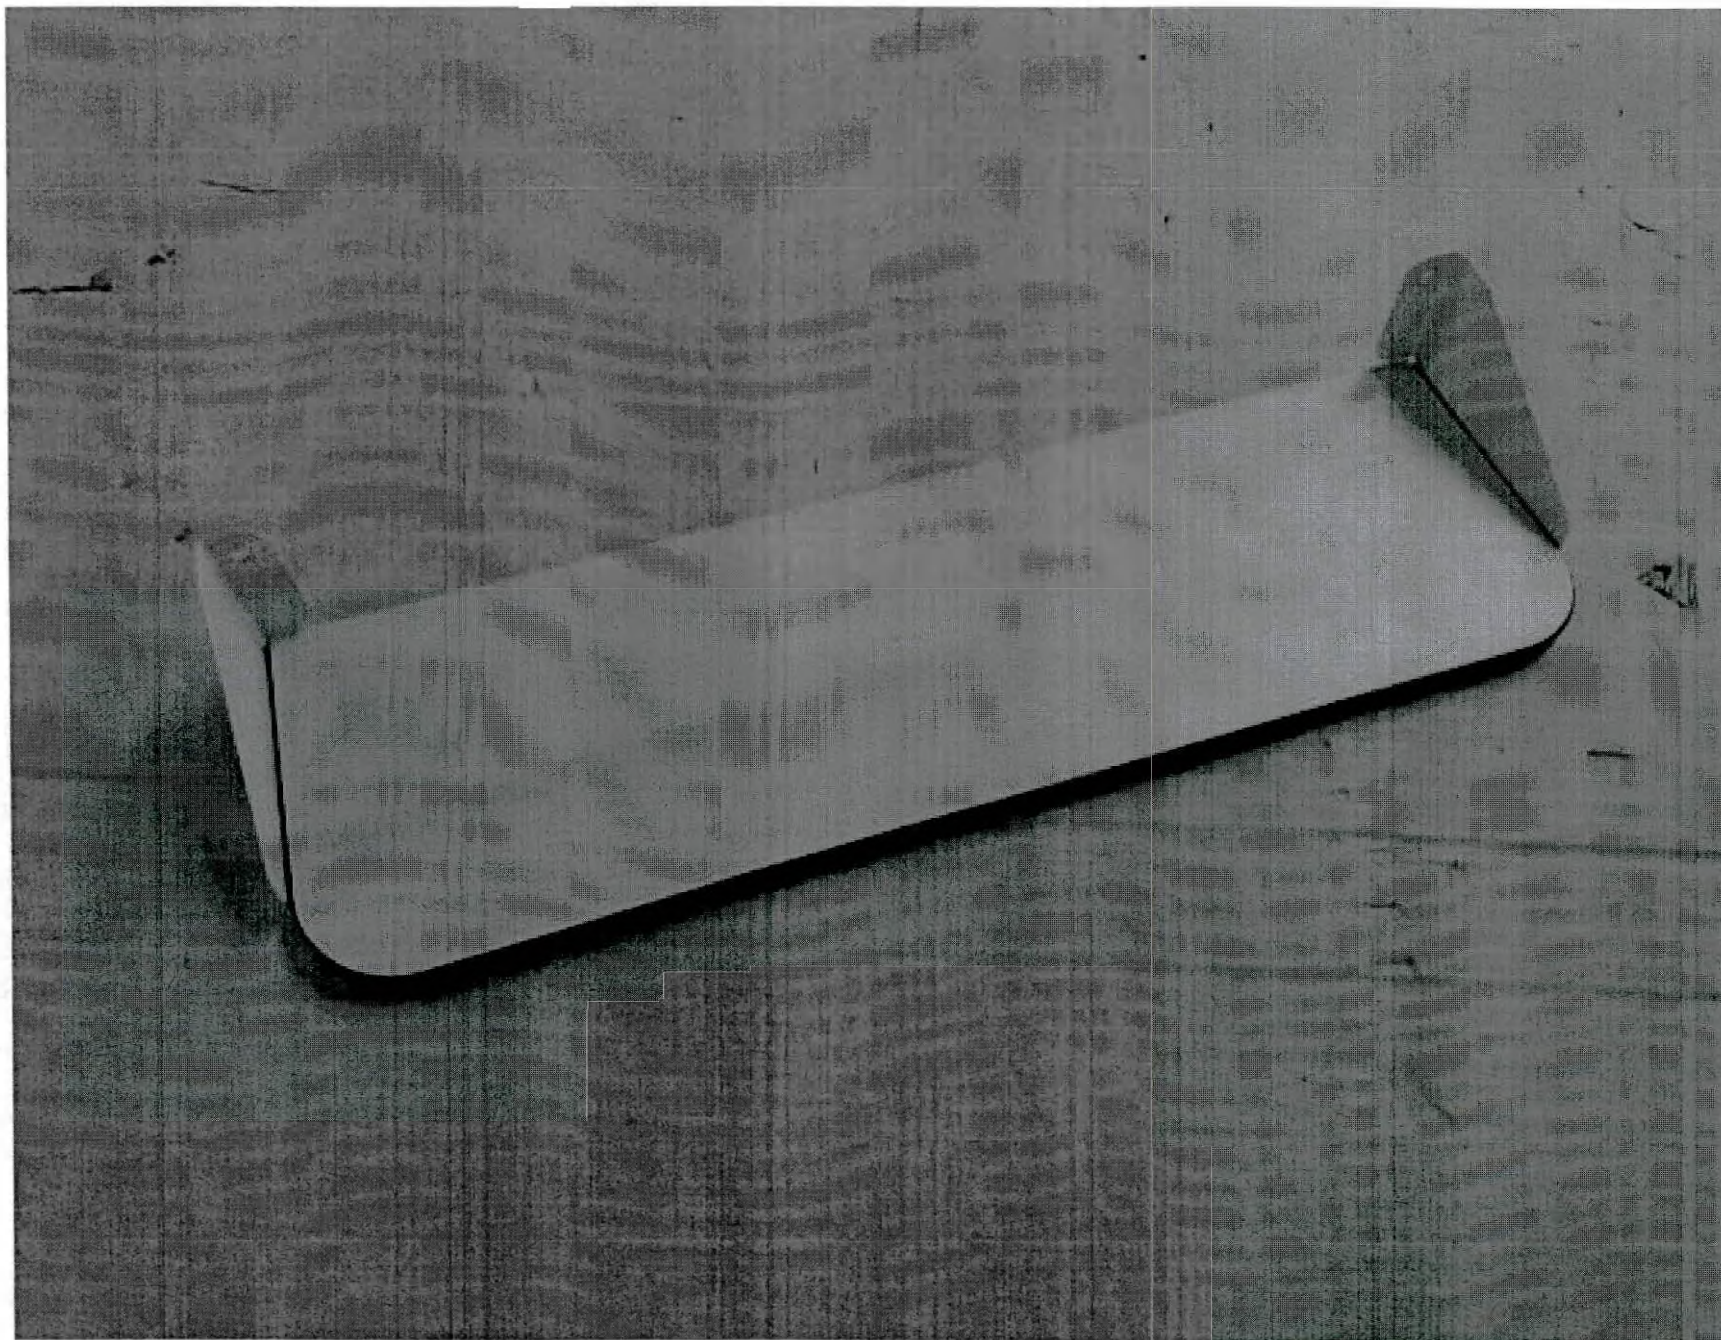


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Принадлежность: Полка боковая




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022. Принадлежность: Модуль подкатной под мойку ШВМ-2

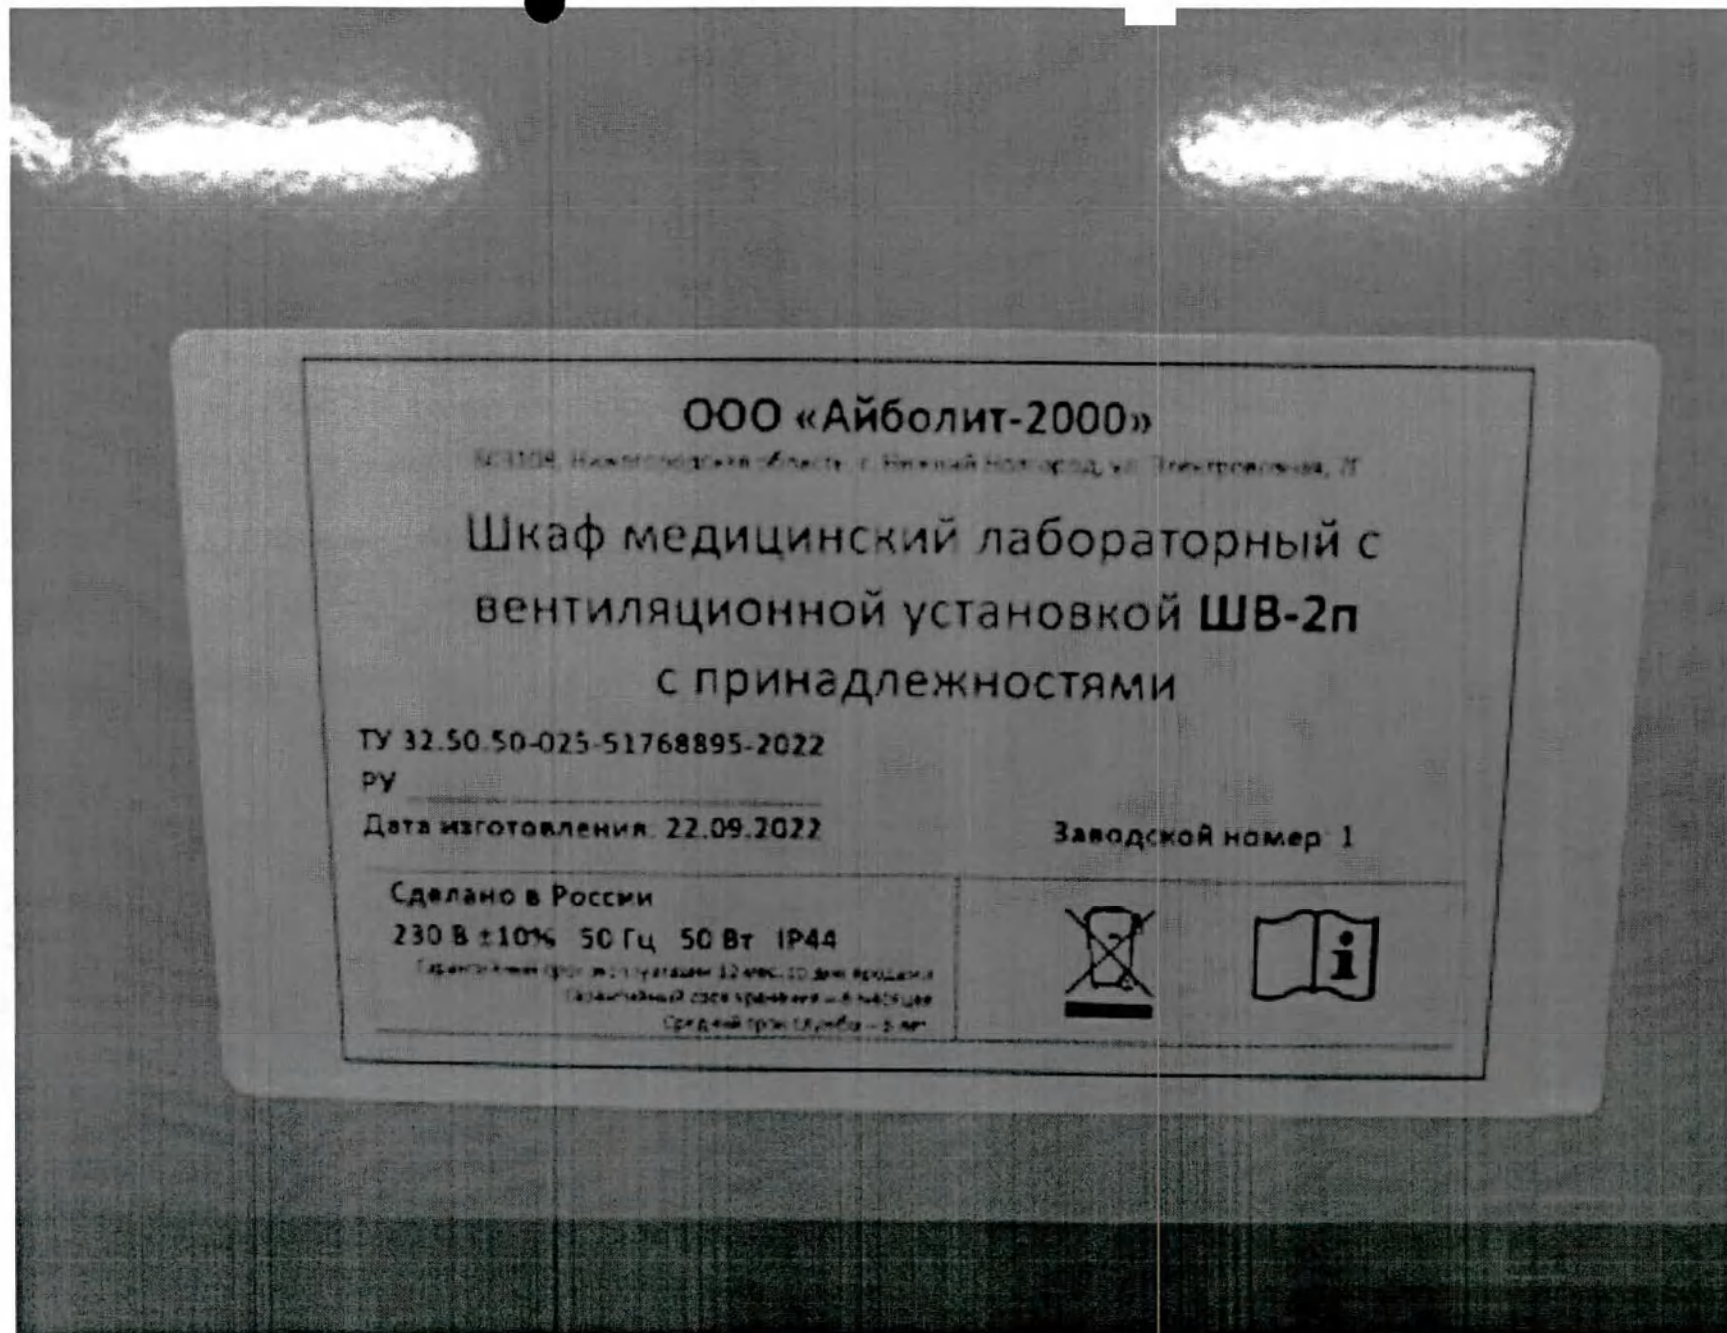


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка изделия

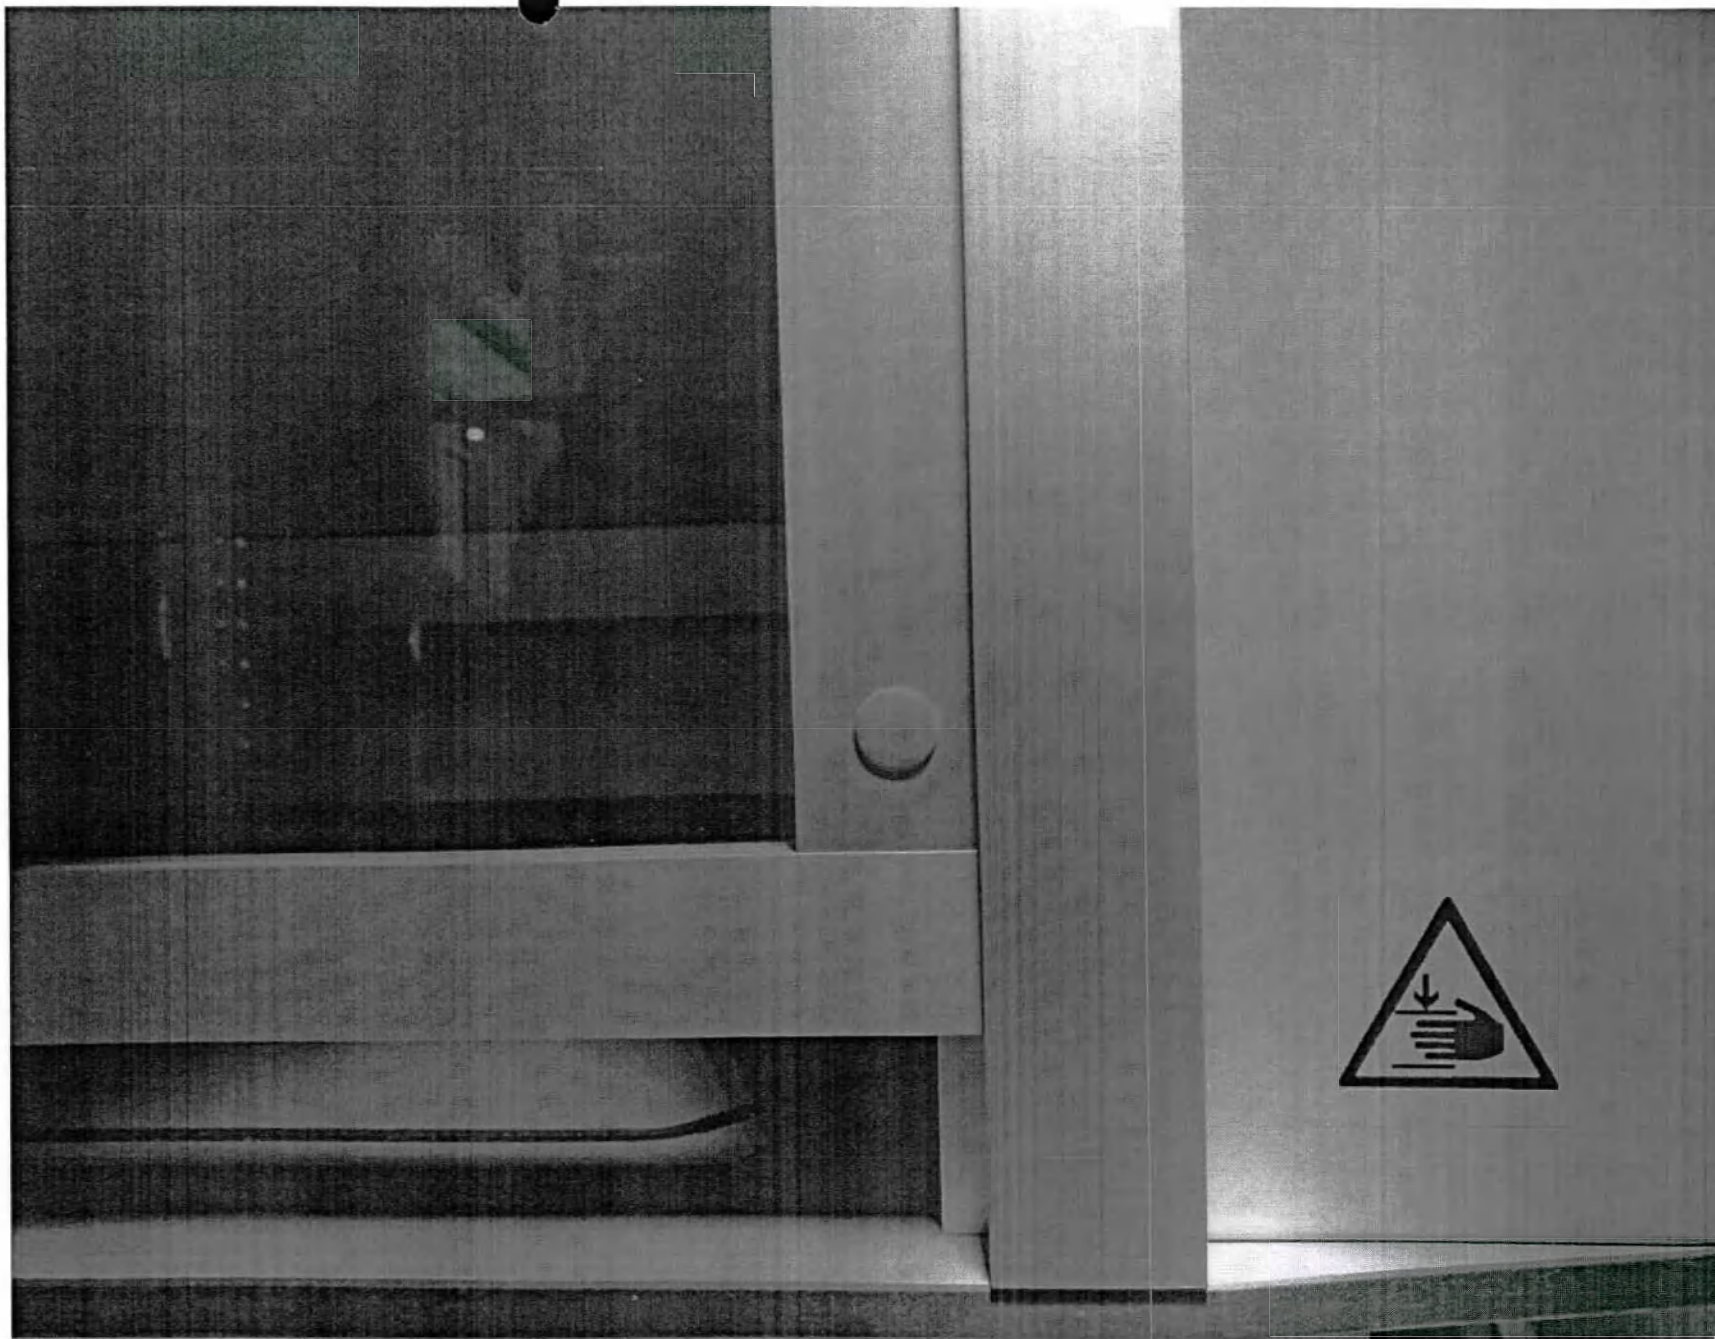

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка изделия. Символ «Опасность повреждения рук».

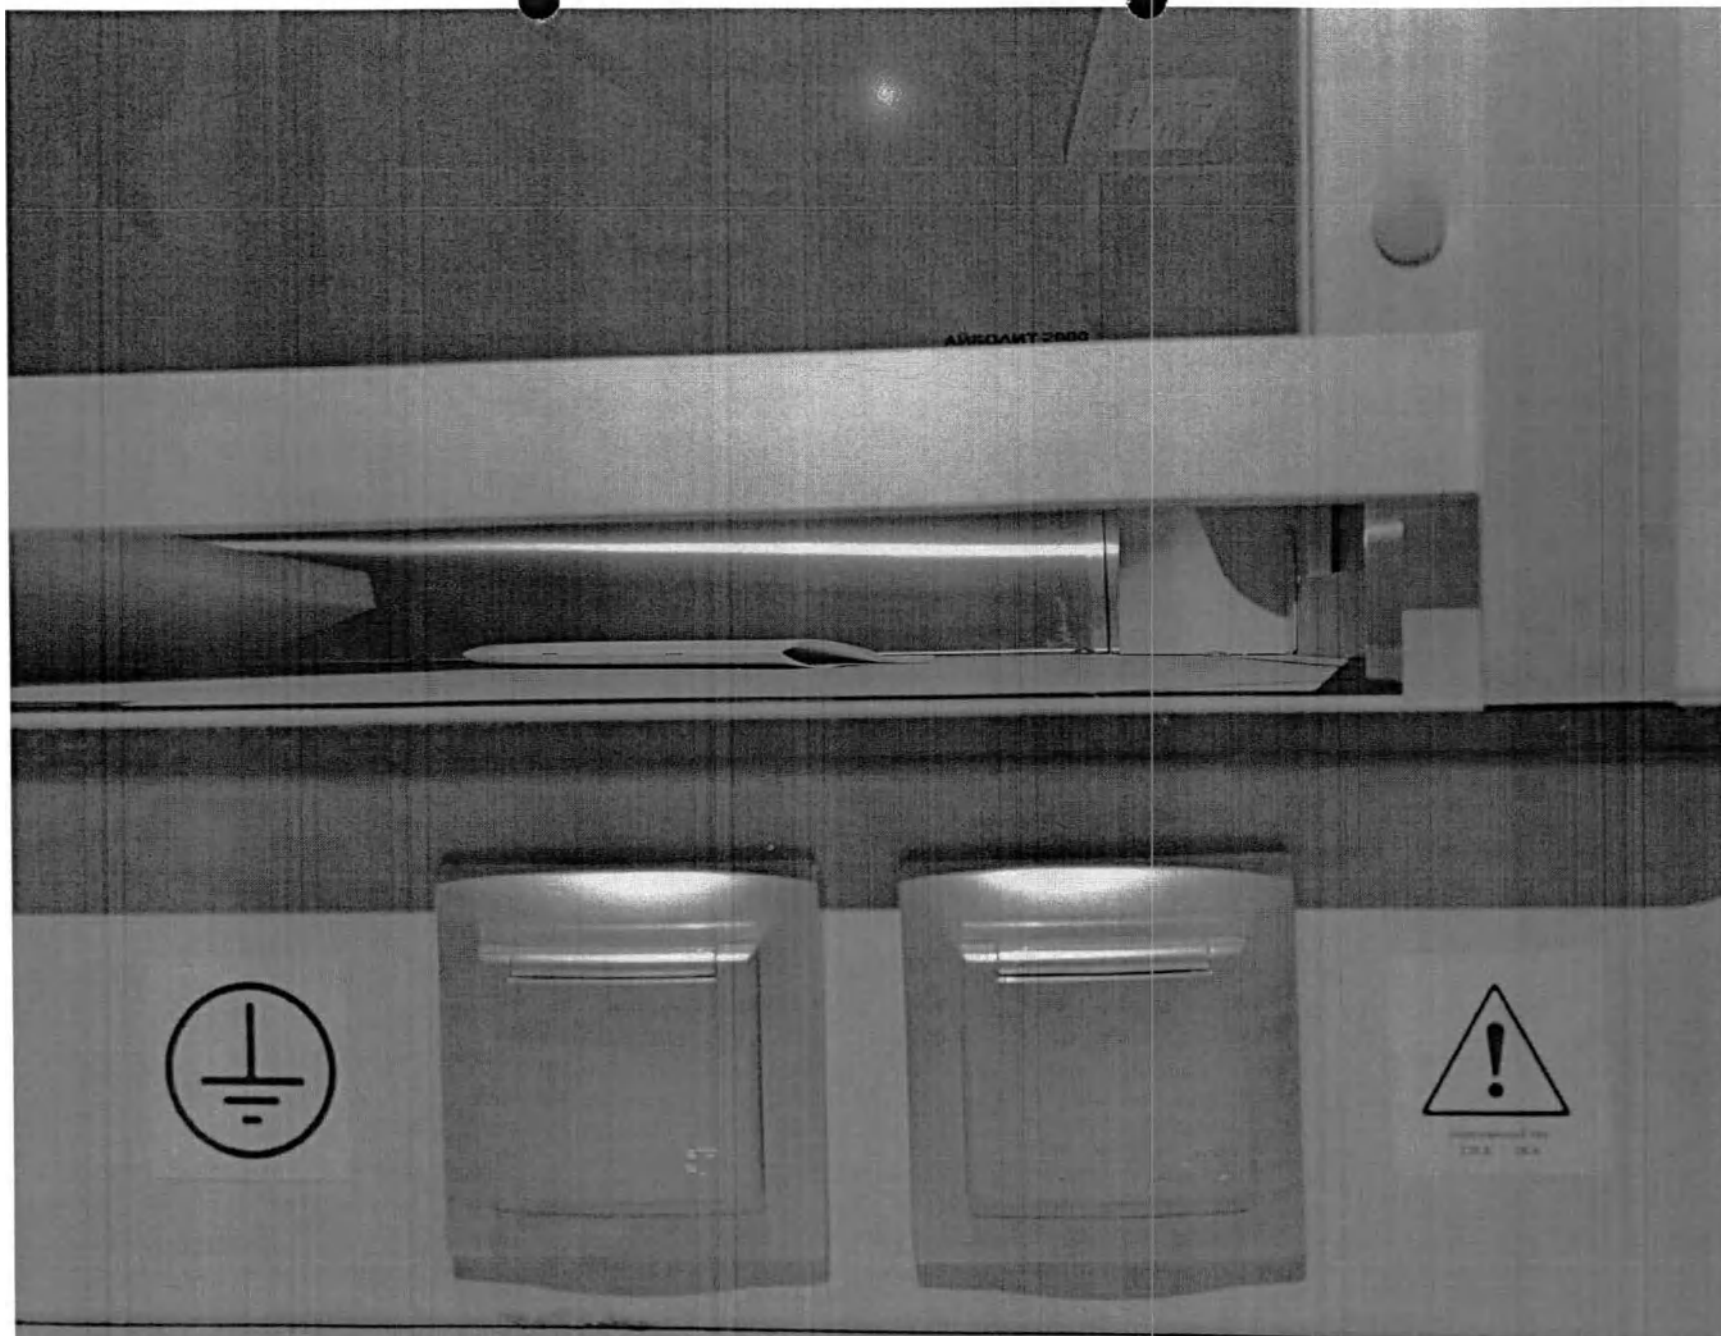

**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ПВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка розеток**

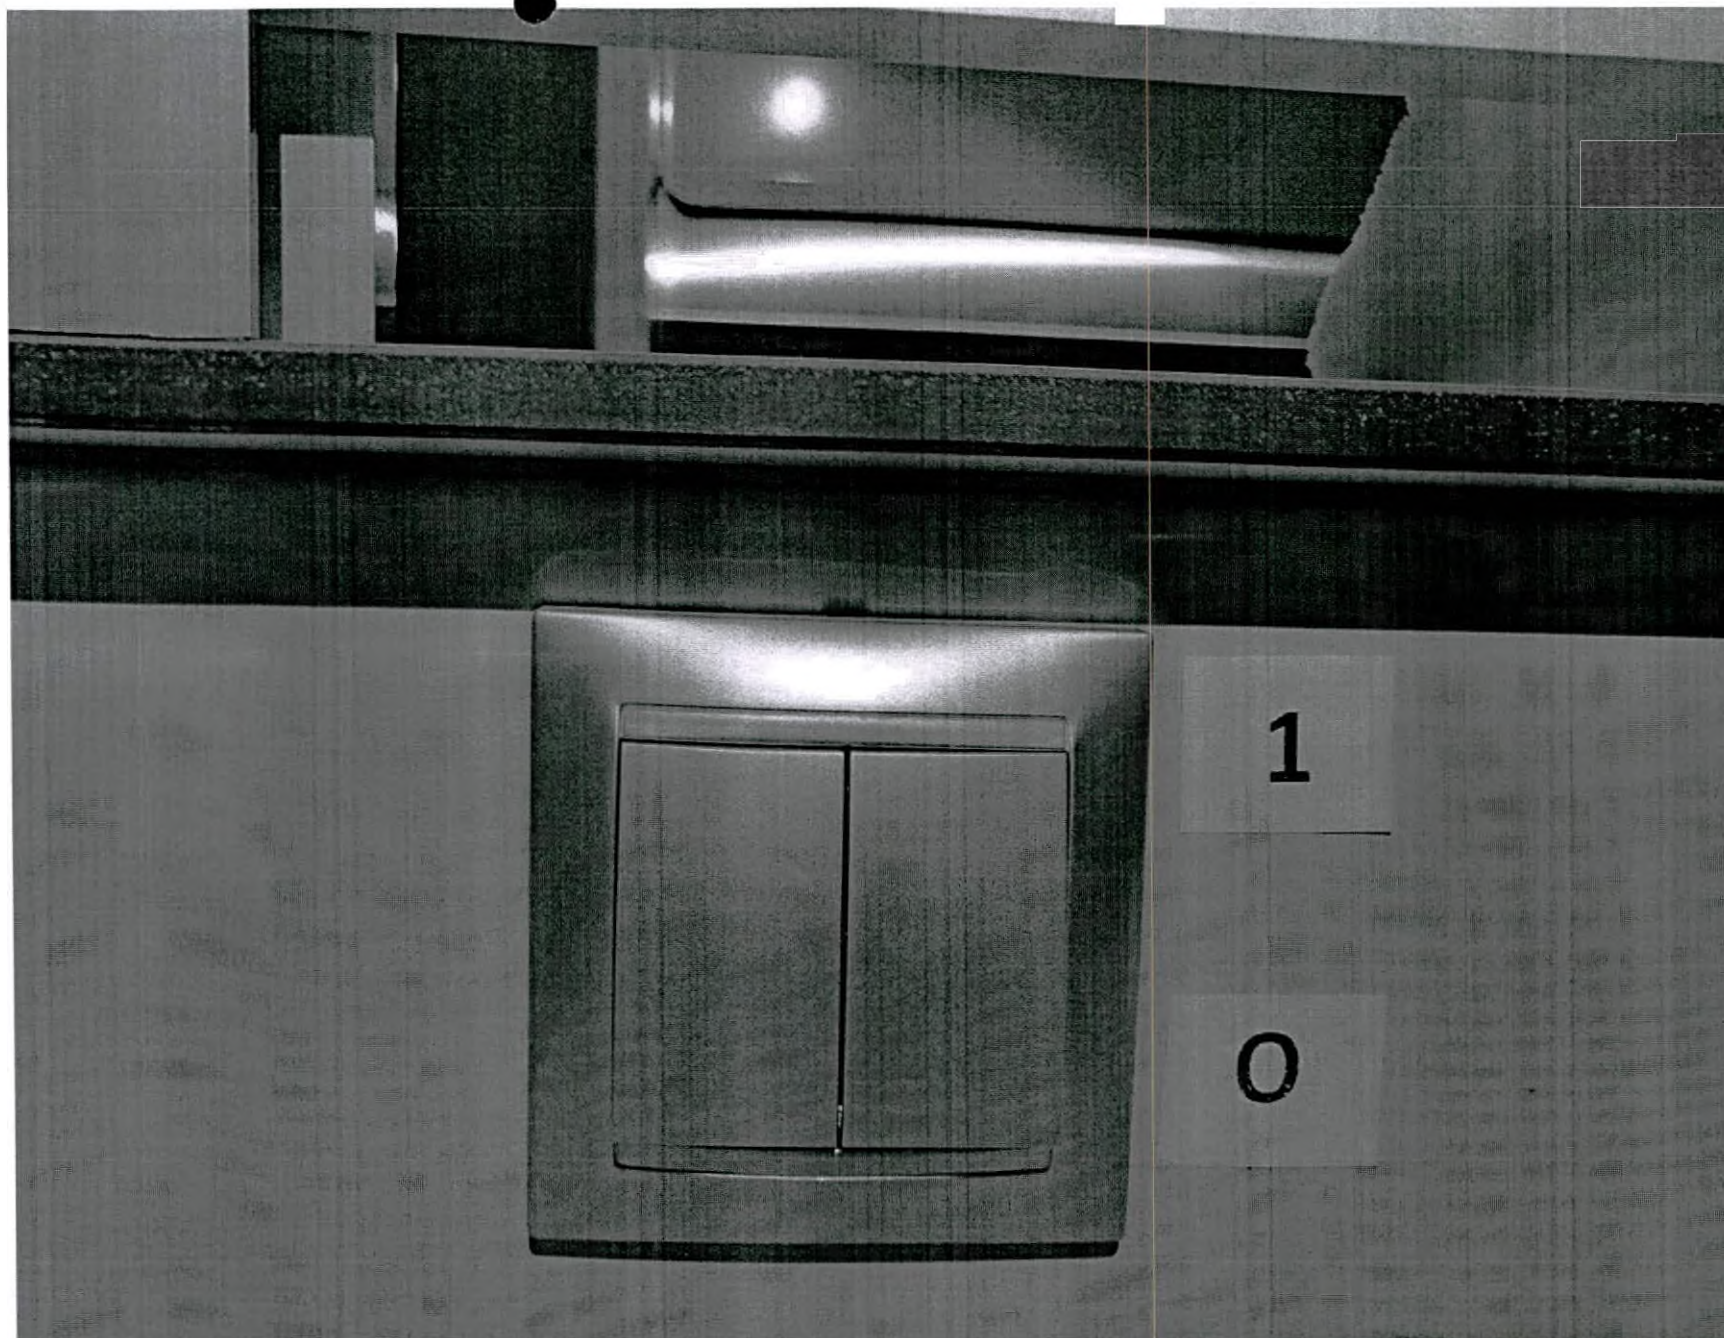

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка выключателя

ООО «Айболит-2000»

603108 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г

Полка боковая

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

ру

Дата изготовления: 22.09.2022 ____ Заводской номер: 2__

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

Средний срок службы – 6 лет



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка принадлежности: Полка боковая

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровазская, 78

Модуль подкатной под мойку ШВМ-2

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

ру

Дата изготовления: 22.09.2022

Заводской номер 1

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня
продажи

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

Средний срок службы – 6 лет.



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка принадлежности: Модуль подкатной под мойку ШВМ-2

ООО «Айболит-2000»

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями



Пакет 1 из 2

Шкаф

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022



Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА

СЕРЫЙ

Заводской номер № 1

ЦВЕТ ПЛАСТИКА

фисташковый

Дата изготовления 22.09.2022

Комплект поставки:

Камера шкафа в сборе – 1 шт.
Стойка задняя правая – 1 шт.
Стойка задняя левая – 1 шт.
Стойка передняя – 2 шт.
Лыжа – 2 шт.
Стяжка нижняя – 1 шт.
Винт 4х16 комби – 4 шт.
Болты 8х20 – 24 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.


Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.71

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №1 Шкаф

ООО «Айболит-2000»

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями

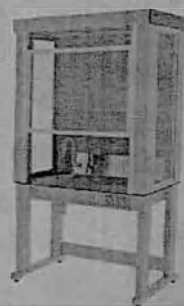

Пакет 2 из 2
Мойка, смеситель, сифон



ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА

СЕРЫЙ

ЦВЕТ ПЛАСТИКА

фисташковый

Заводской номер

N1

Дата изготовления

22.08.2022

Комплект поставки:

Мойка - 1 шт.

Сифон - 1 шт.

Смеситель - 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.


Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.7Г

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №2 Мойка, смеситель, сифон

ООО «Айболит-2000»
**Шкаф медицинский лабораторный
с вентиляционной установкой с принадлежностями**



Пакет 1 из 1
**Модуль подкатной
под мойку ШВМ-2**
ТУ 32.50.50-025-51768895-2022



Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА **СЕРЫЙ**
ЦВЕТ ПЛАСТИКА **фисташковый**

Заводской номер *N 1*

Дата изготовления *22.05.2022*

Комплект поставки:
Модуль подкатной под мойку ШВМ-2 – 1 шт.


Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.
Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.
Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВЗНАЯ, Д.71

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2п с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка потребительской (транспортной) упаковки принадлежности: Модуль подкатной под мойку ШВМ-2




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.

Общий вид

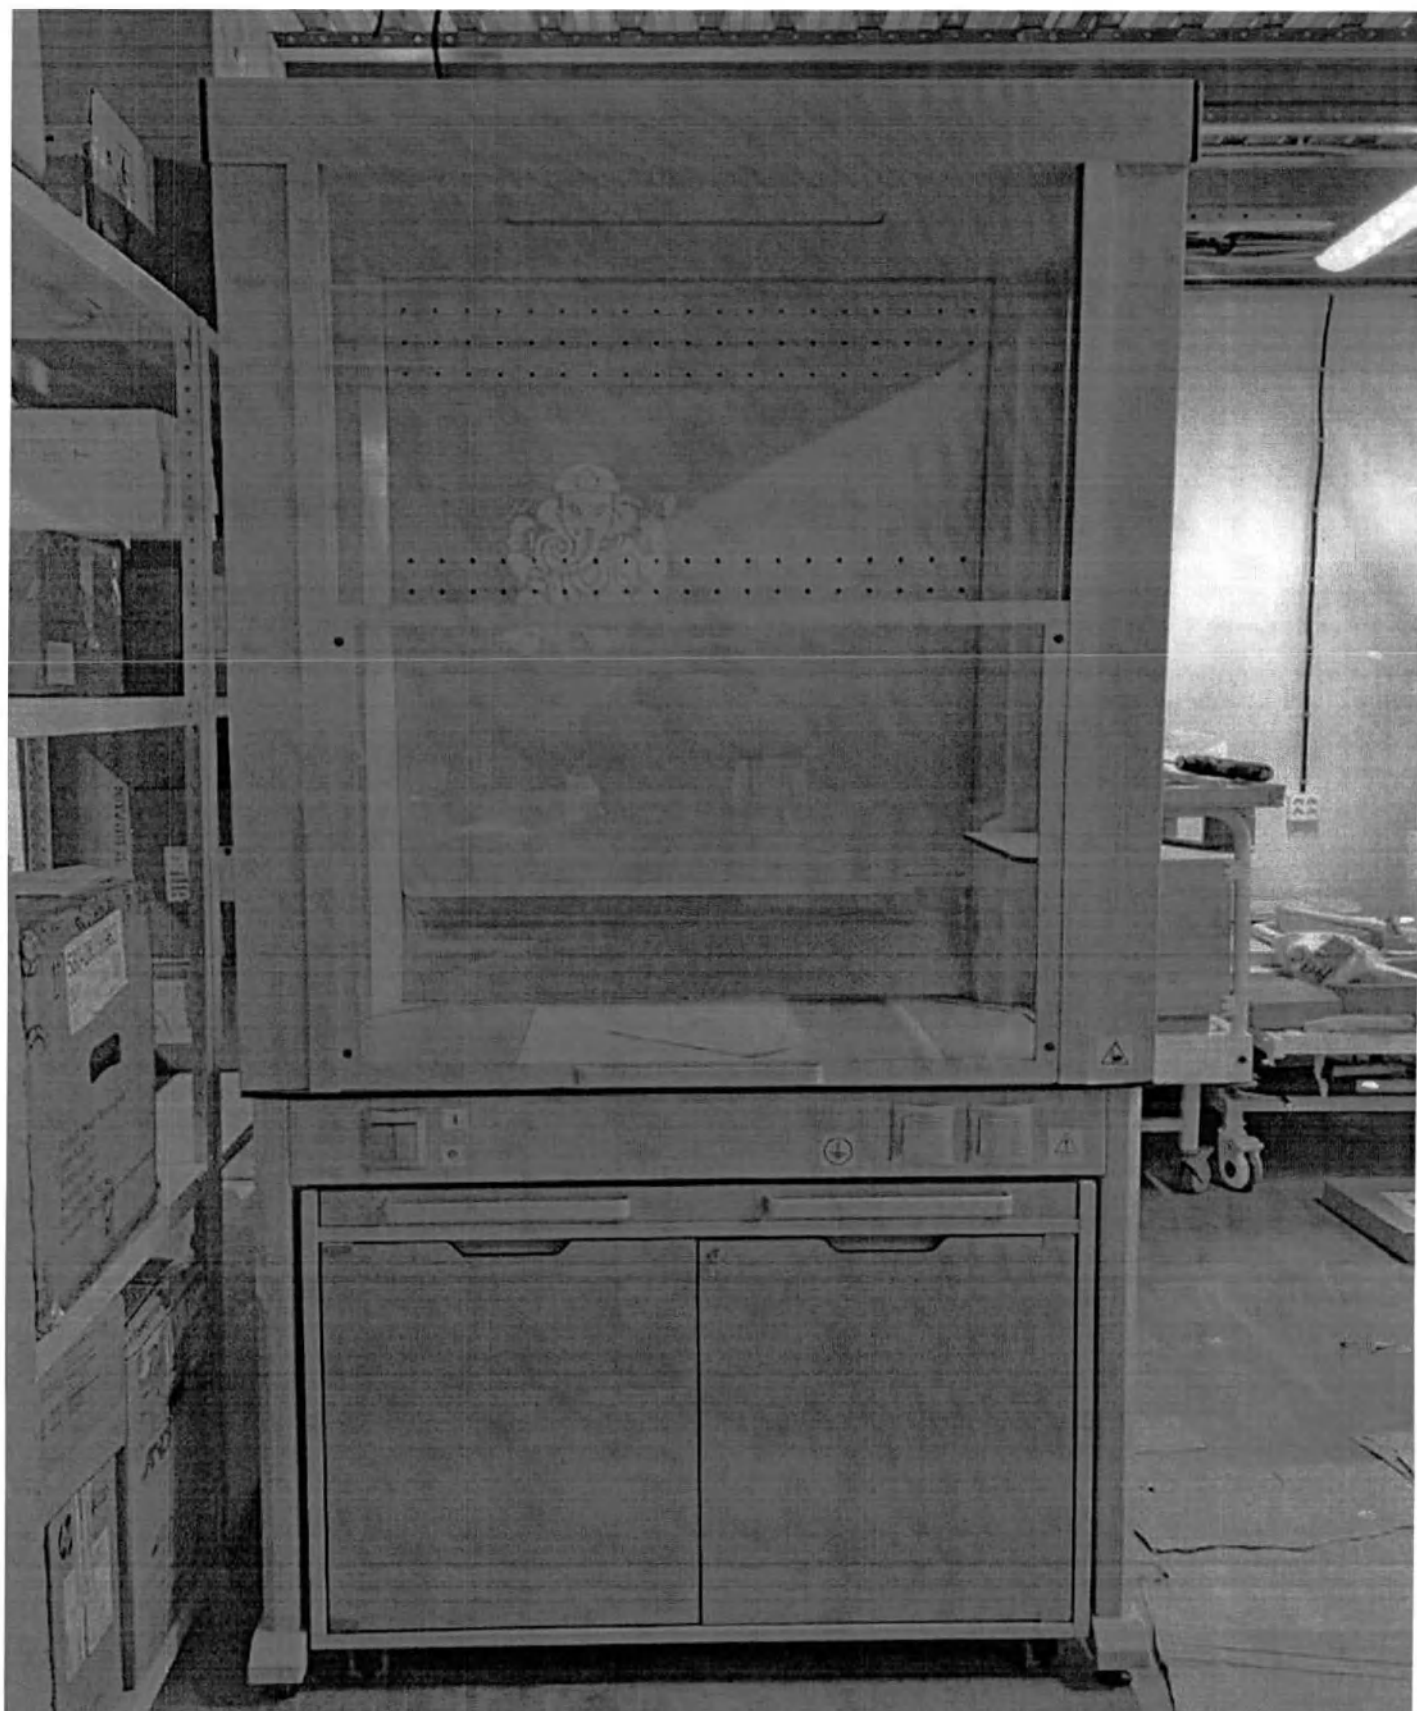


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Общий вид с принадлежностями

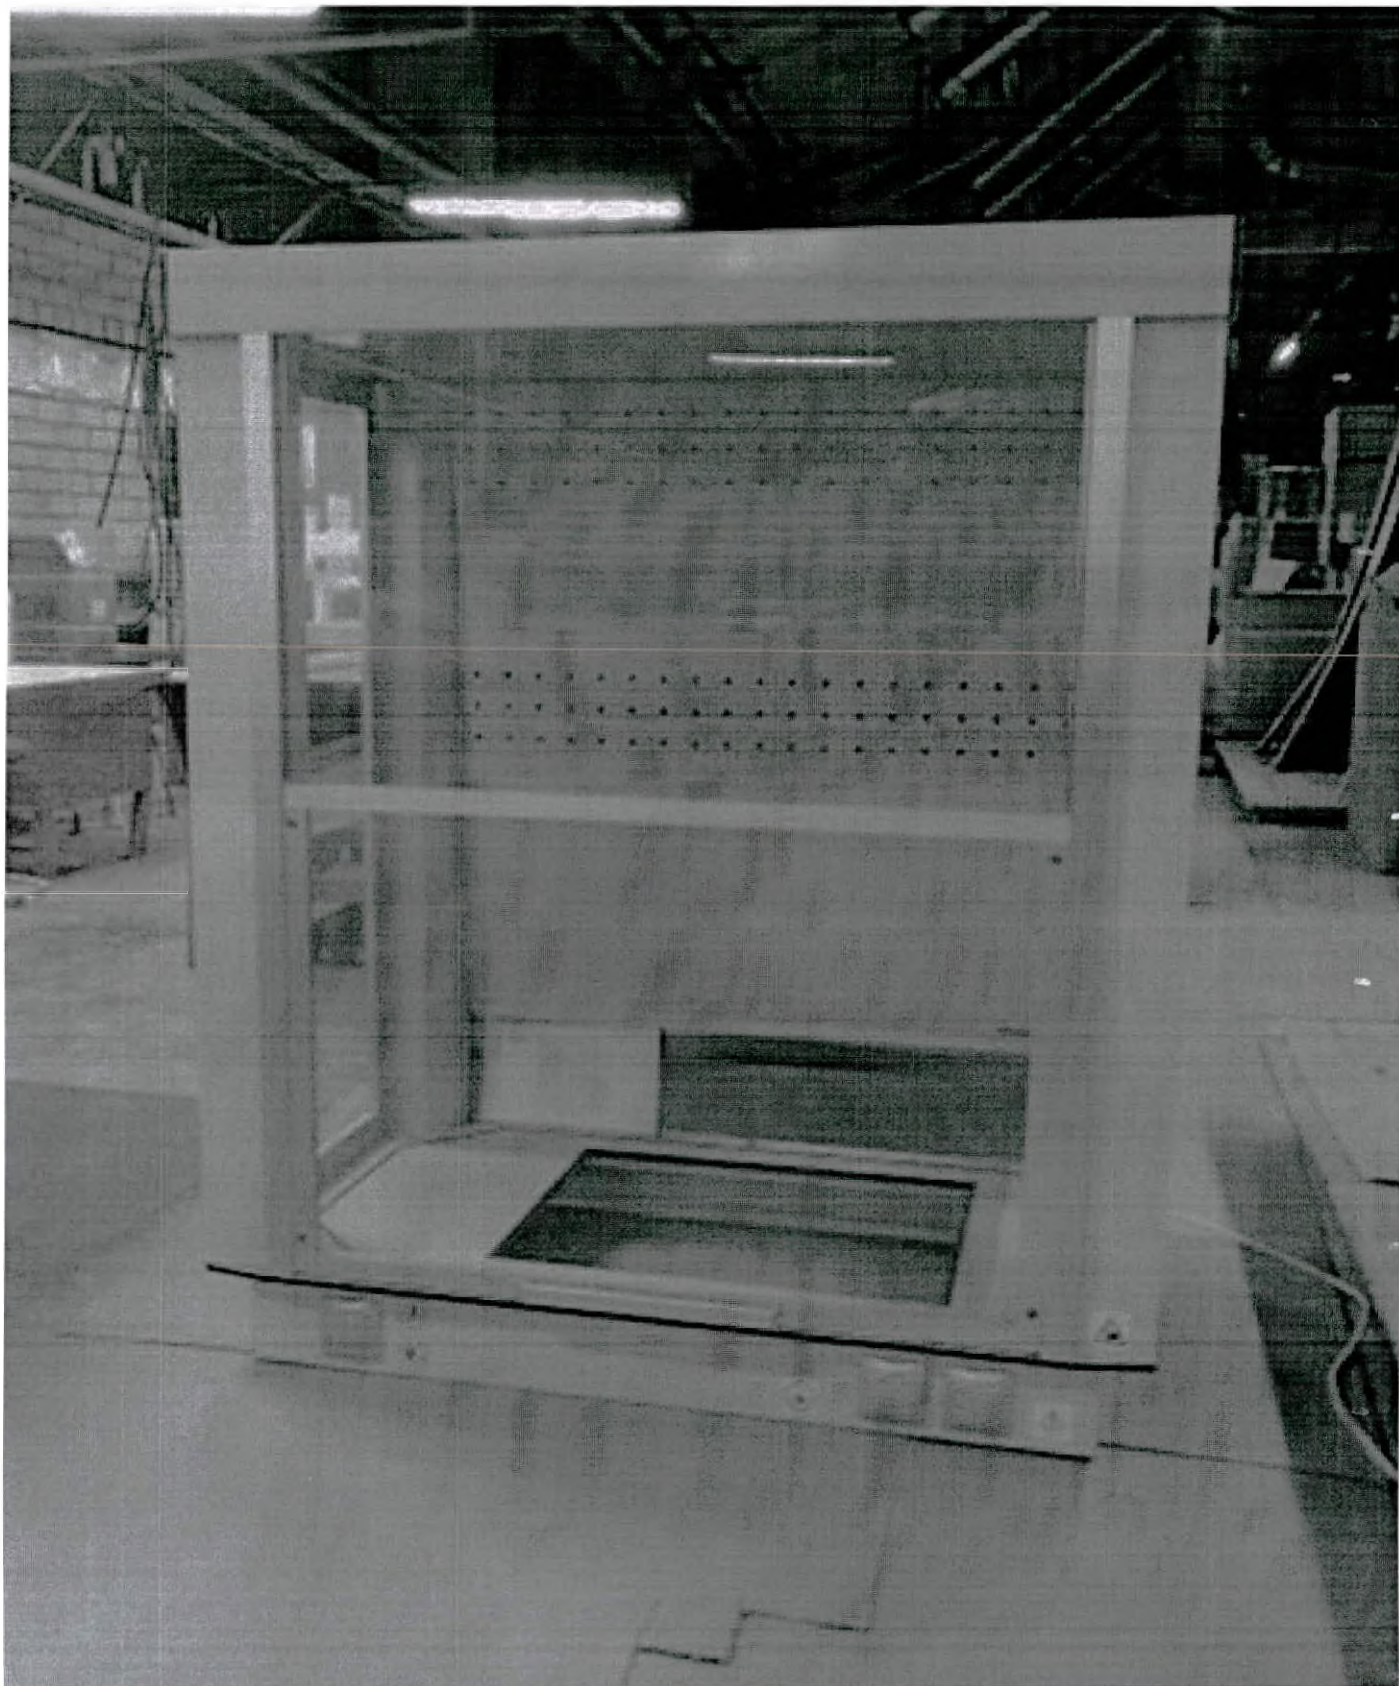


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.


Камера шкафа в сборе

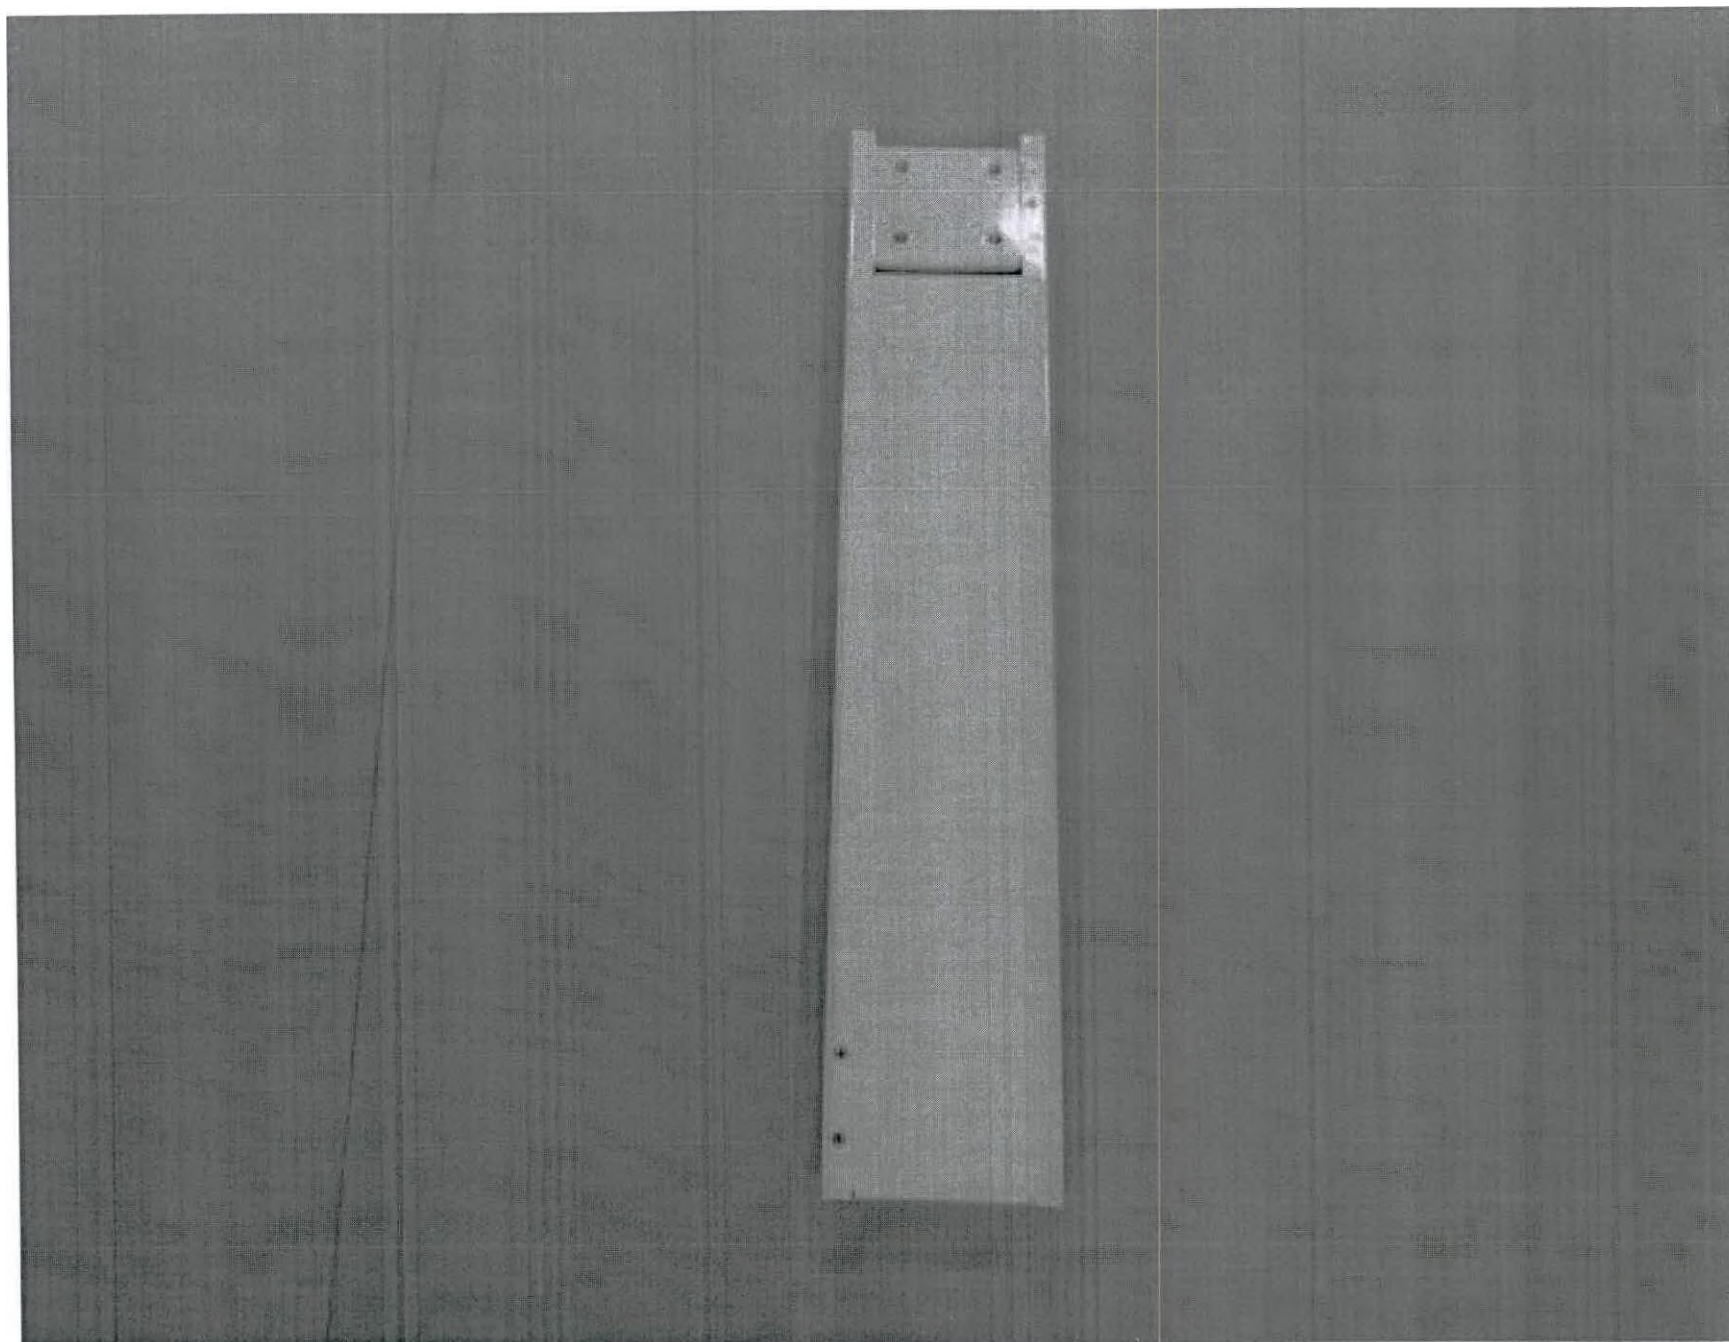


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ПВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя правая**

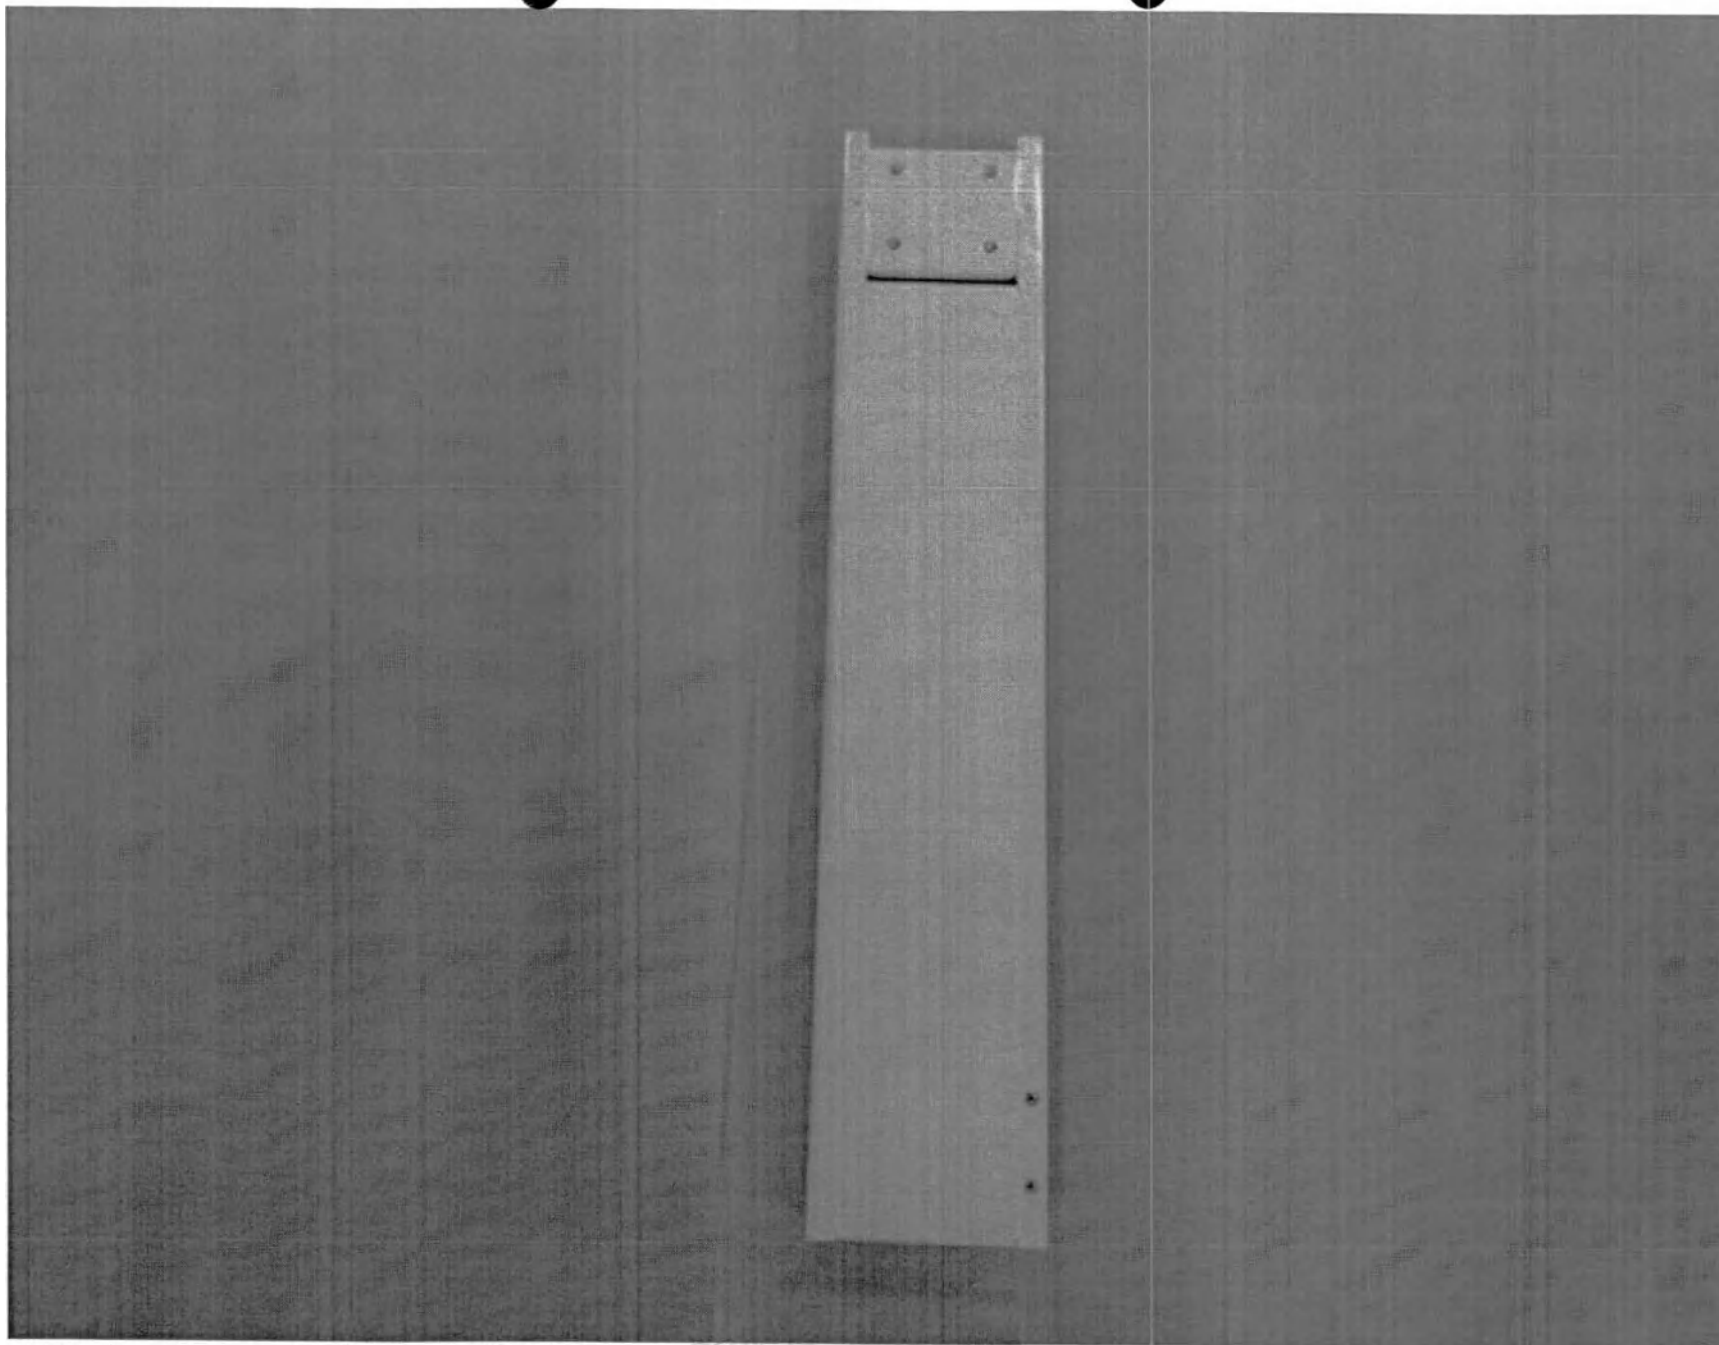


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя левая

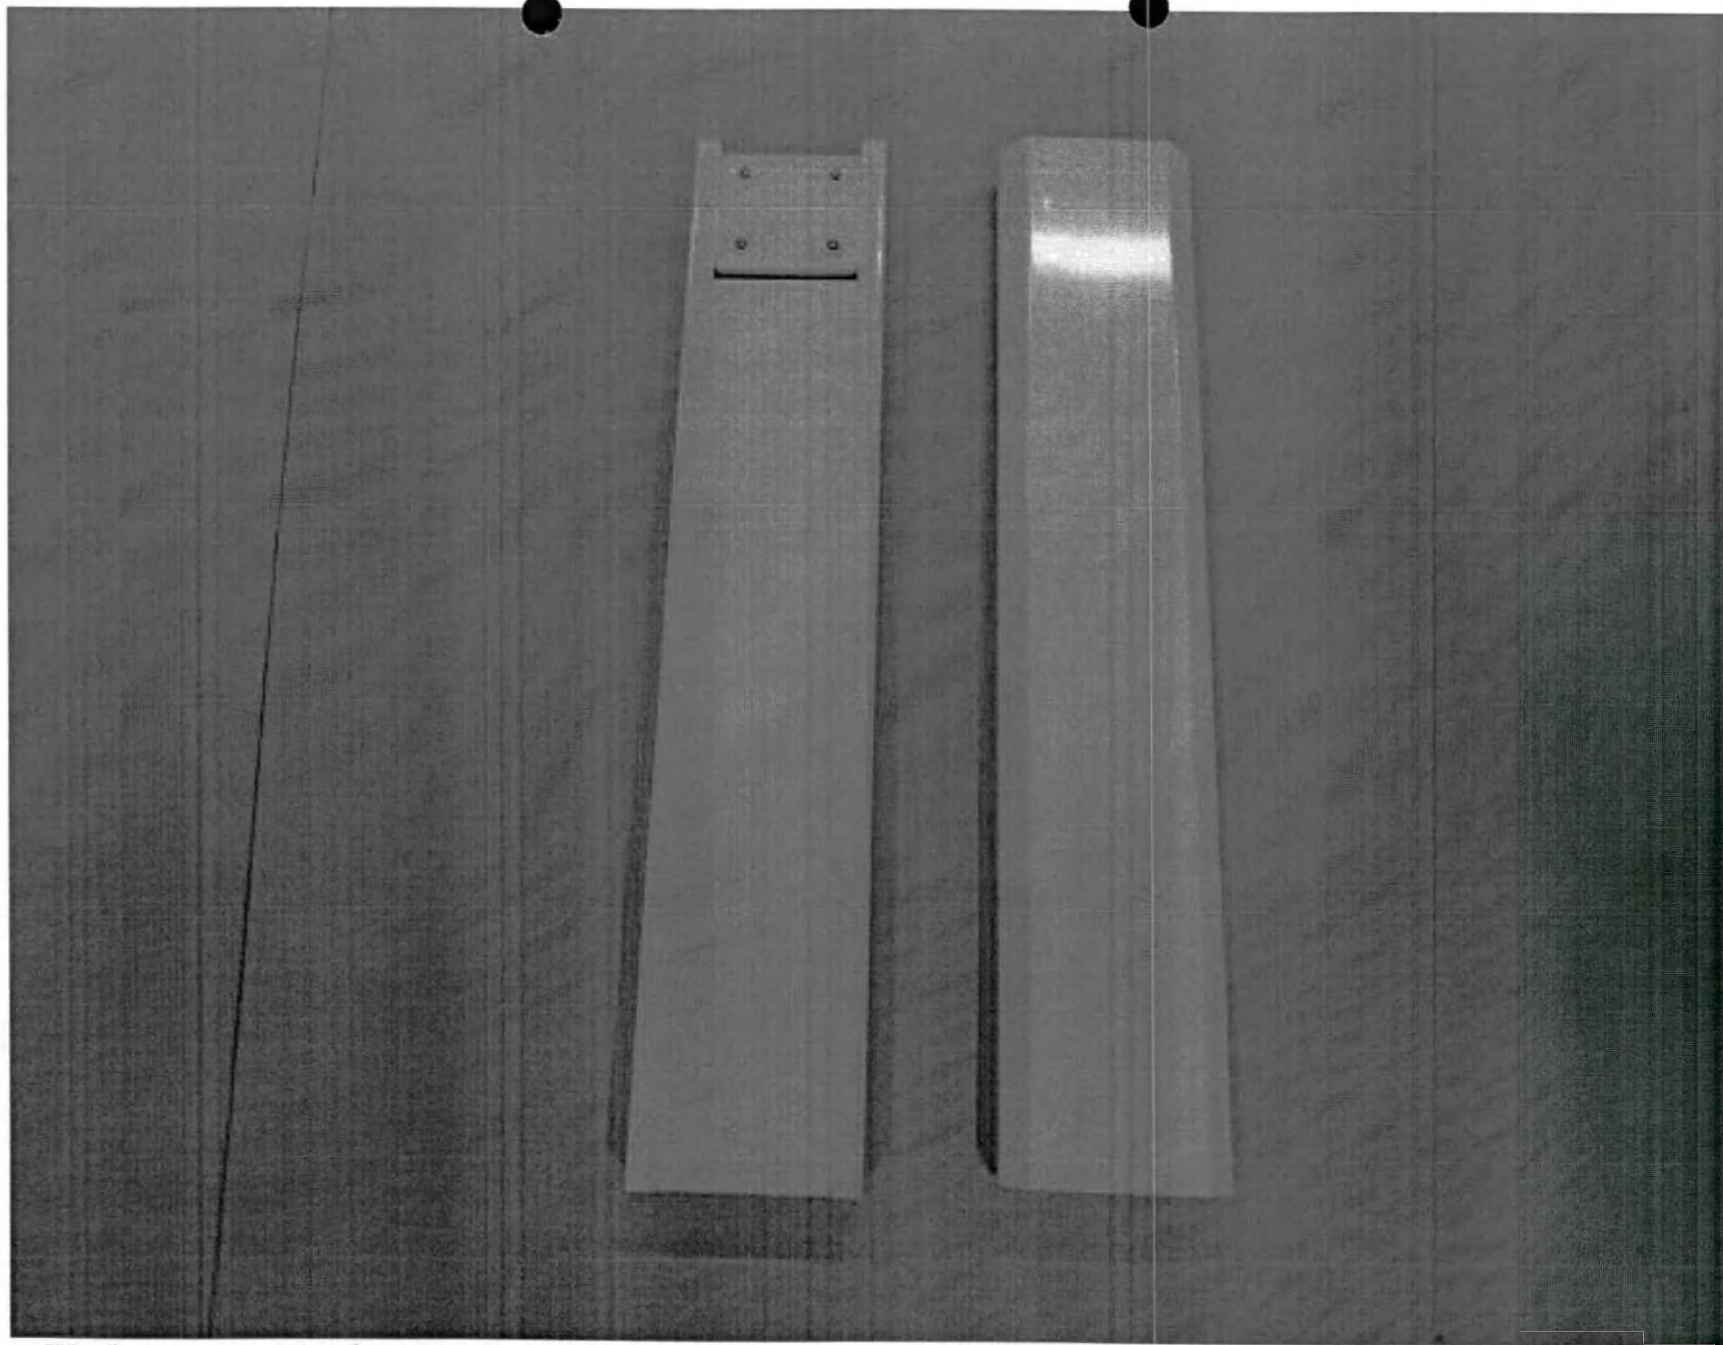


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка передняя

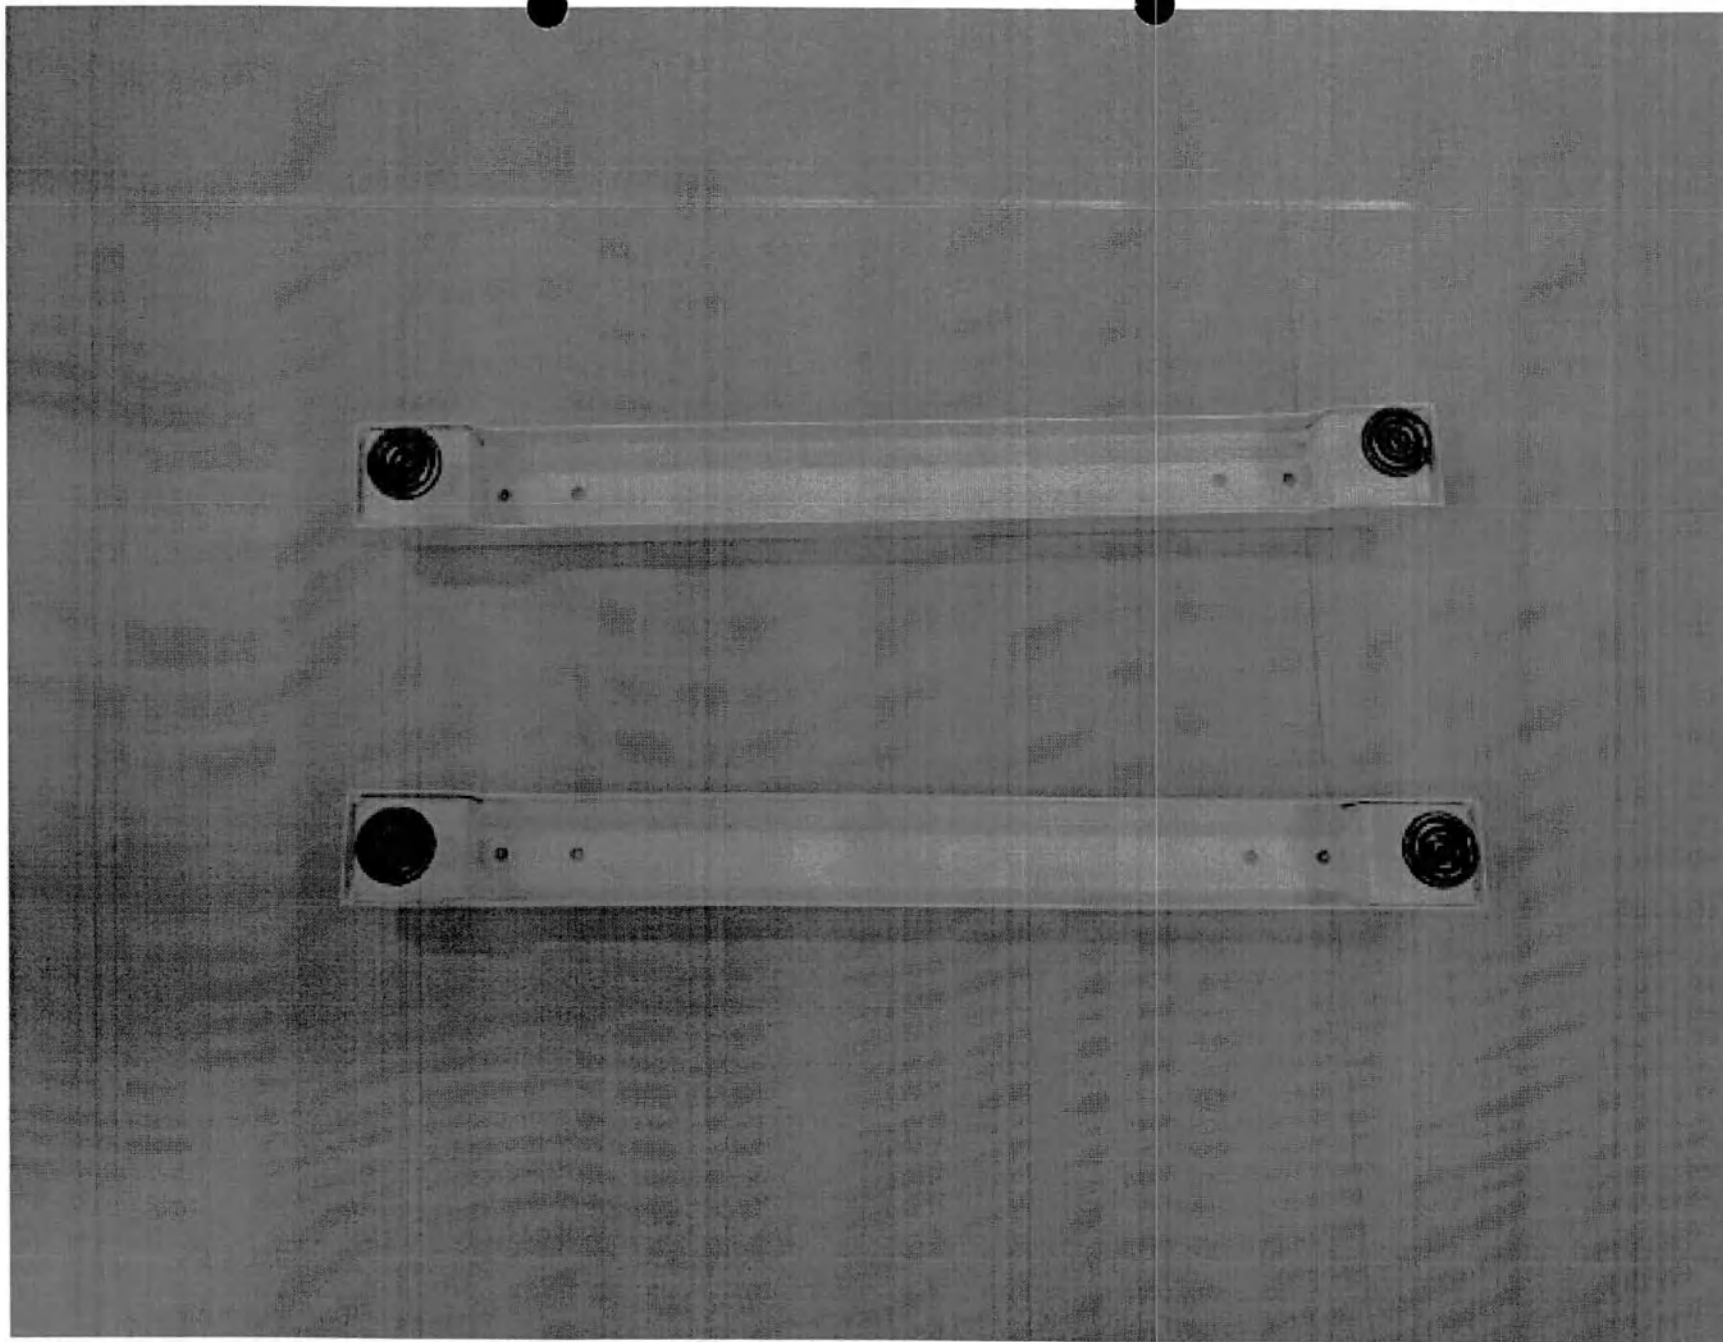


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Лыжа

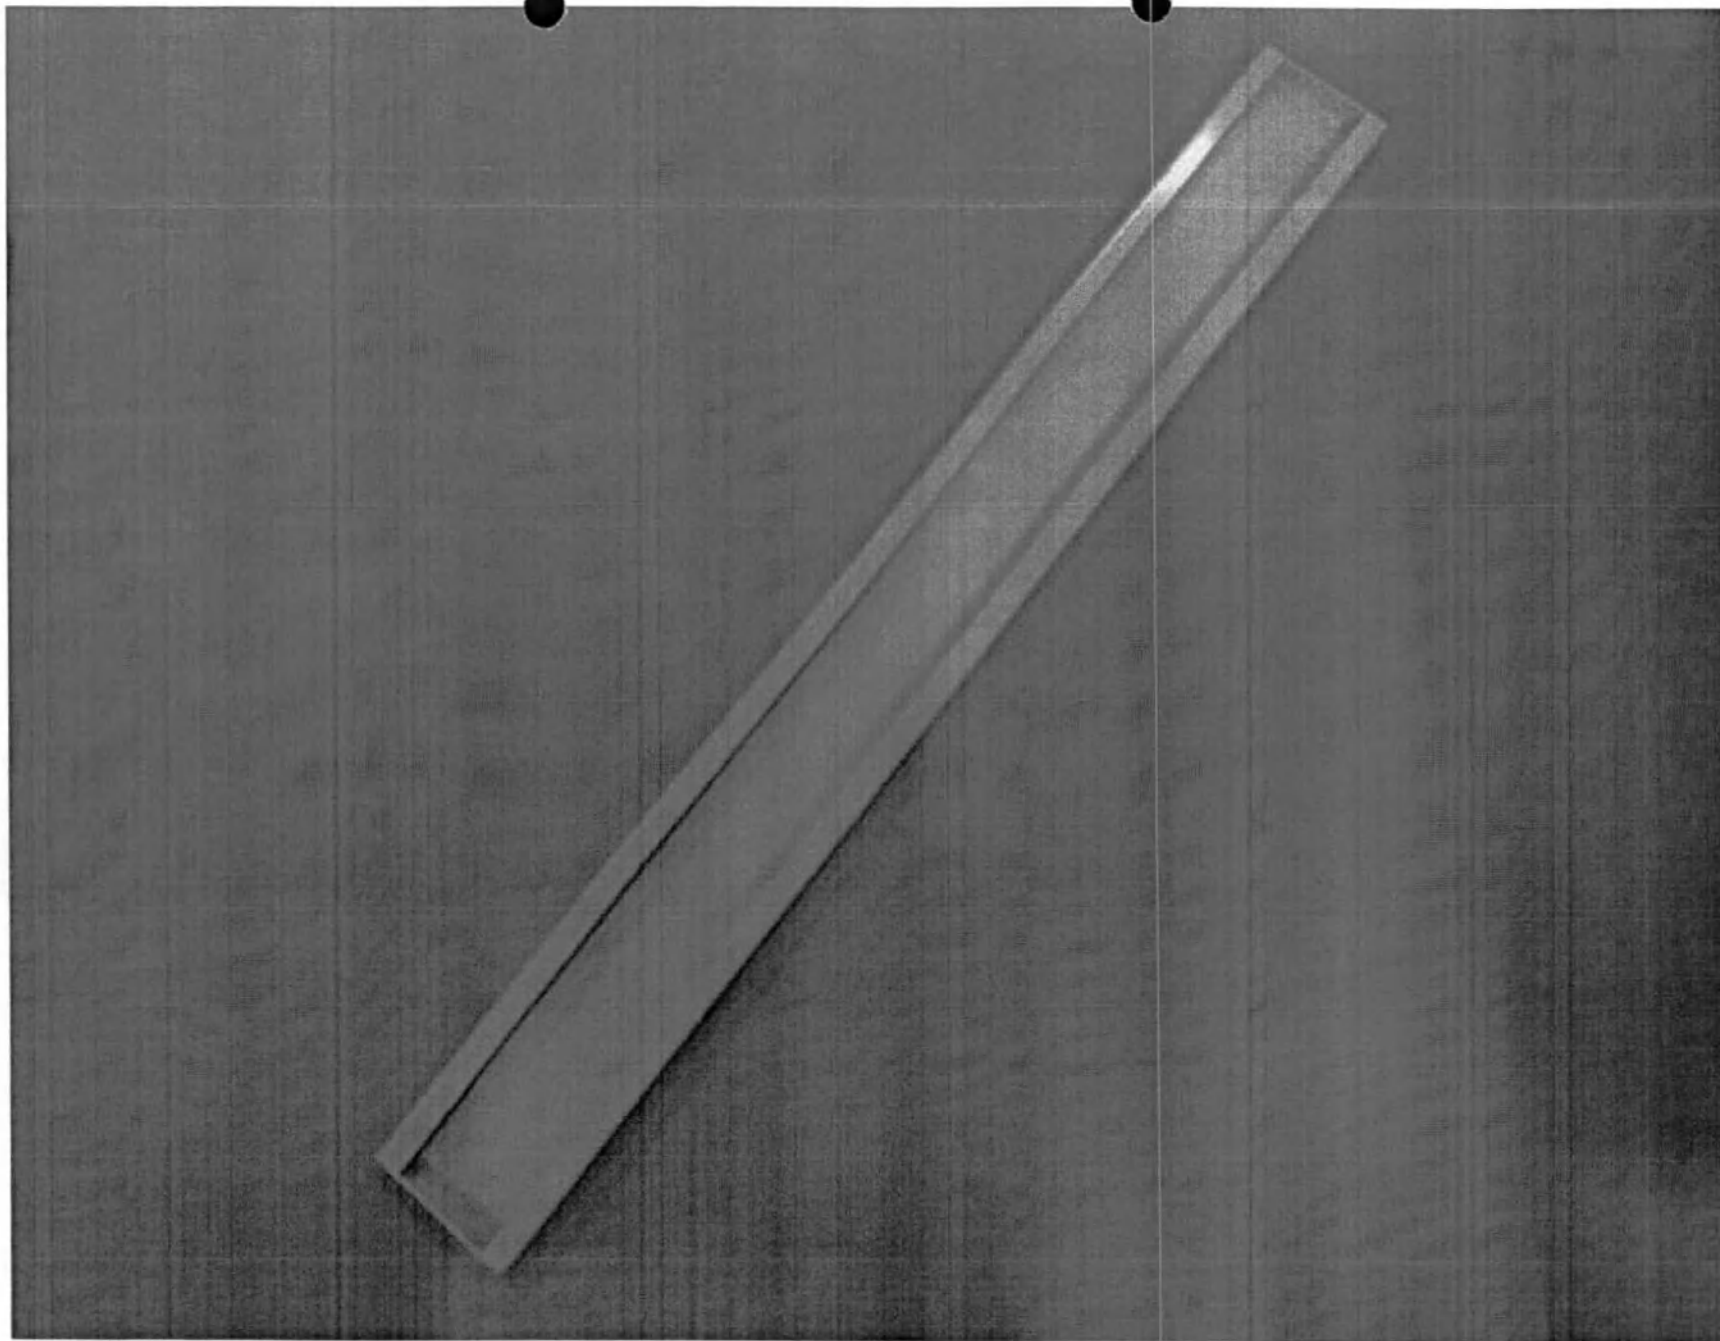


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стяжка нижняя

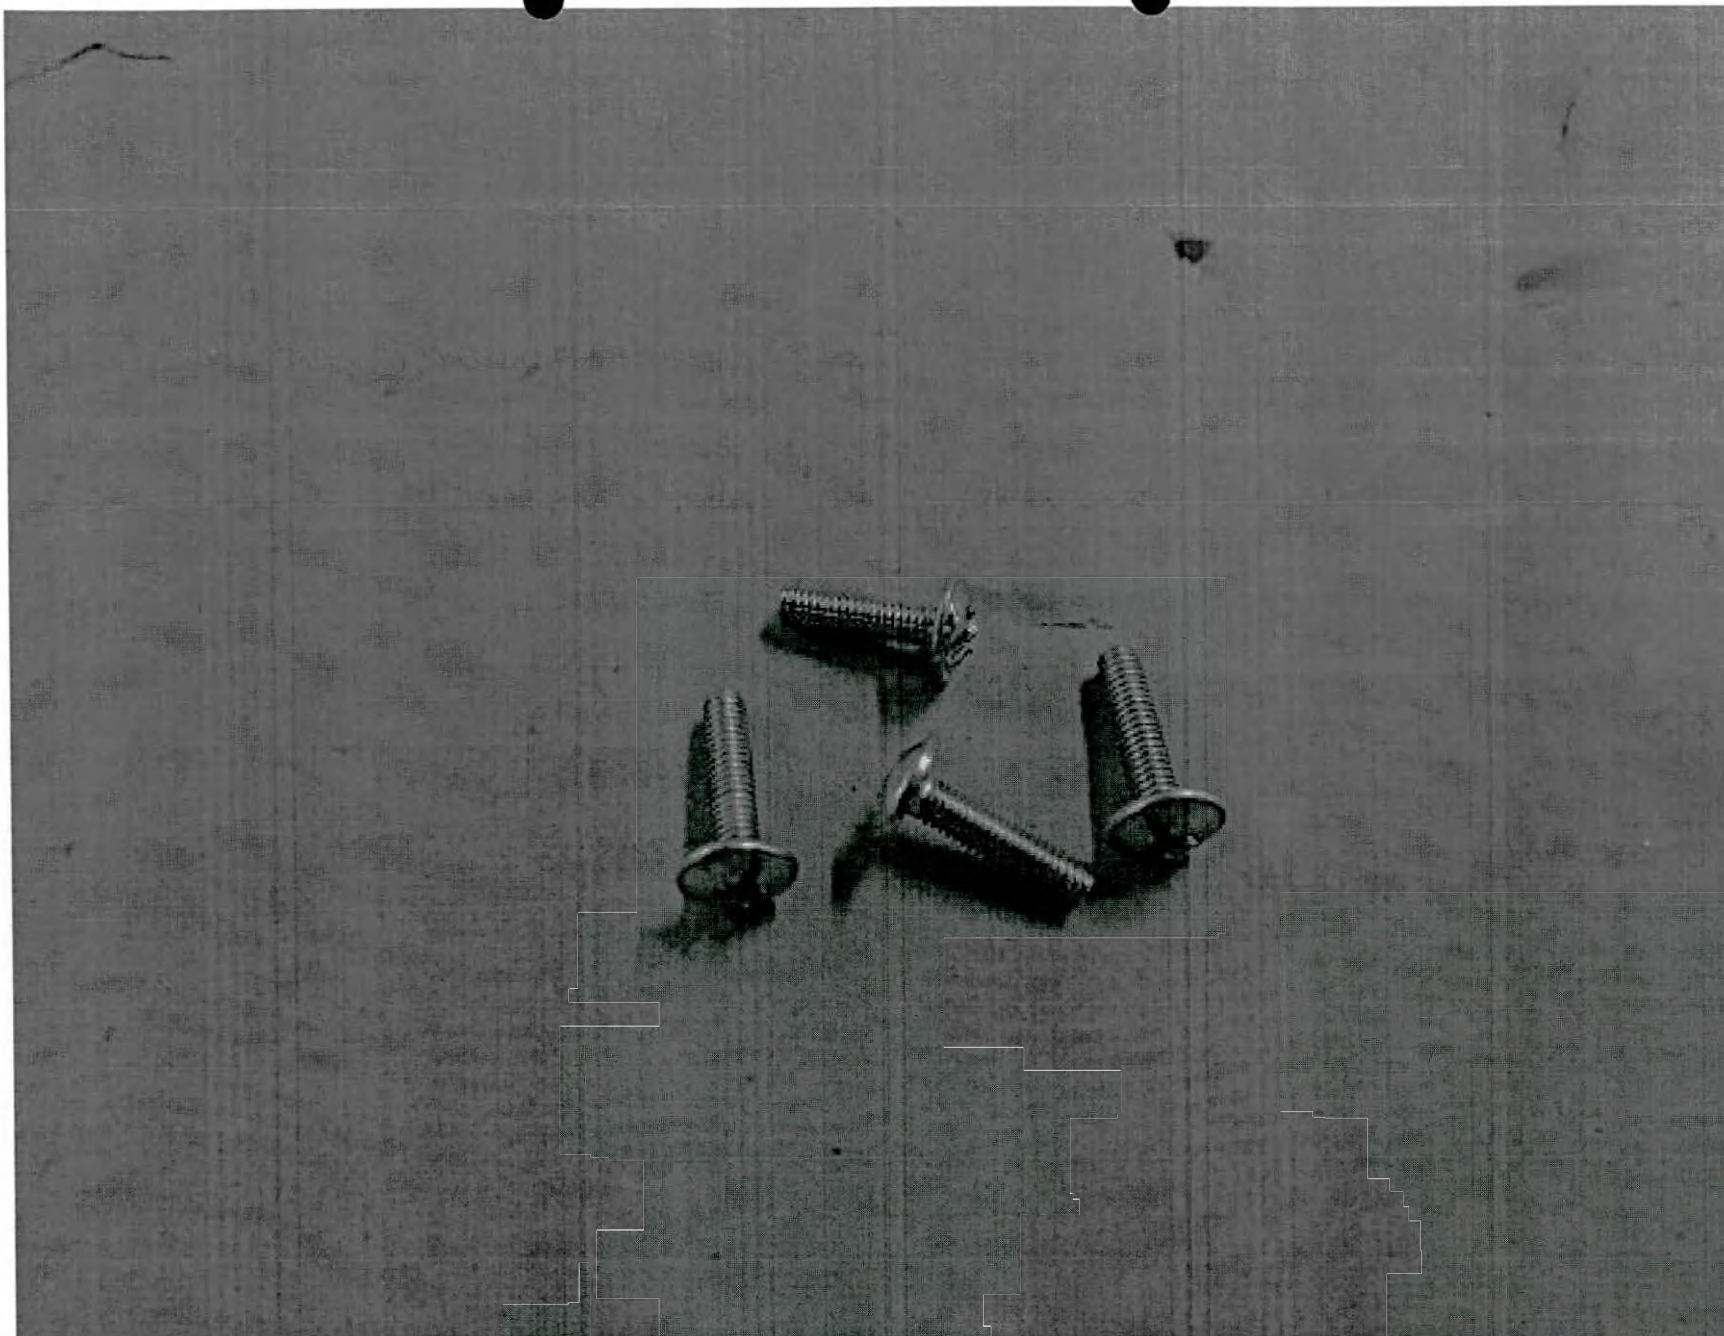


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Винт 4x16 "комби"

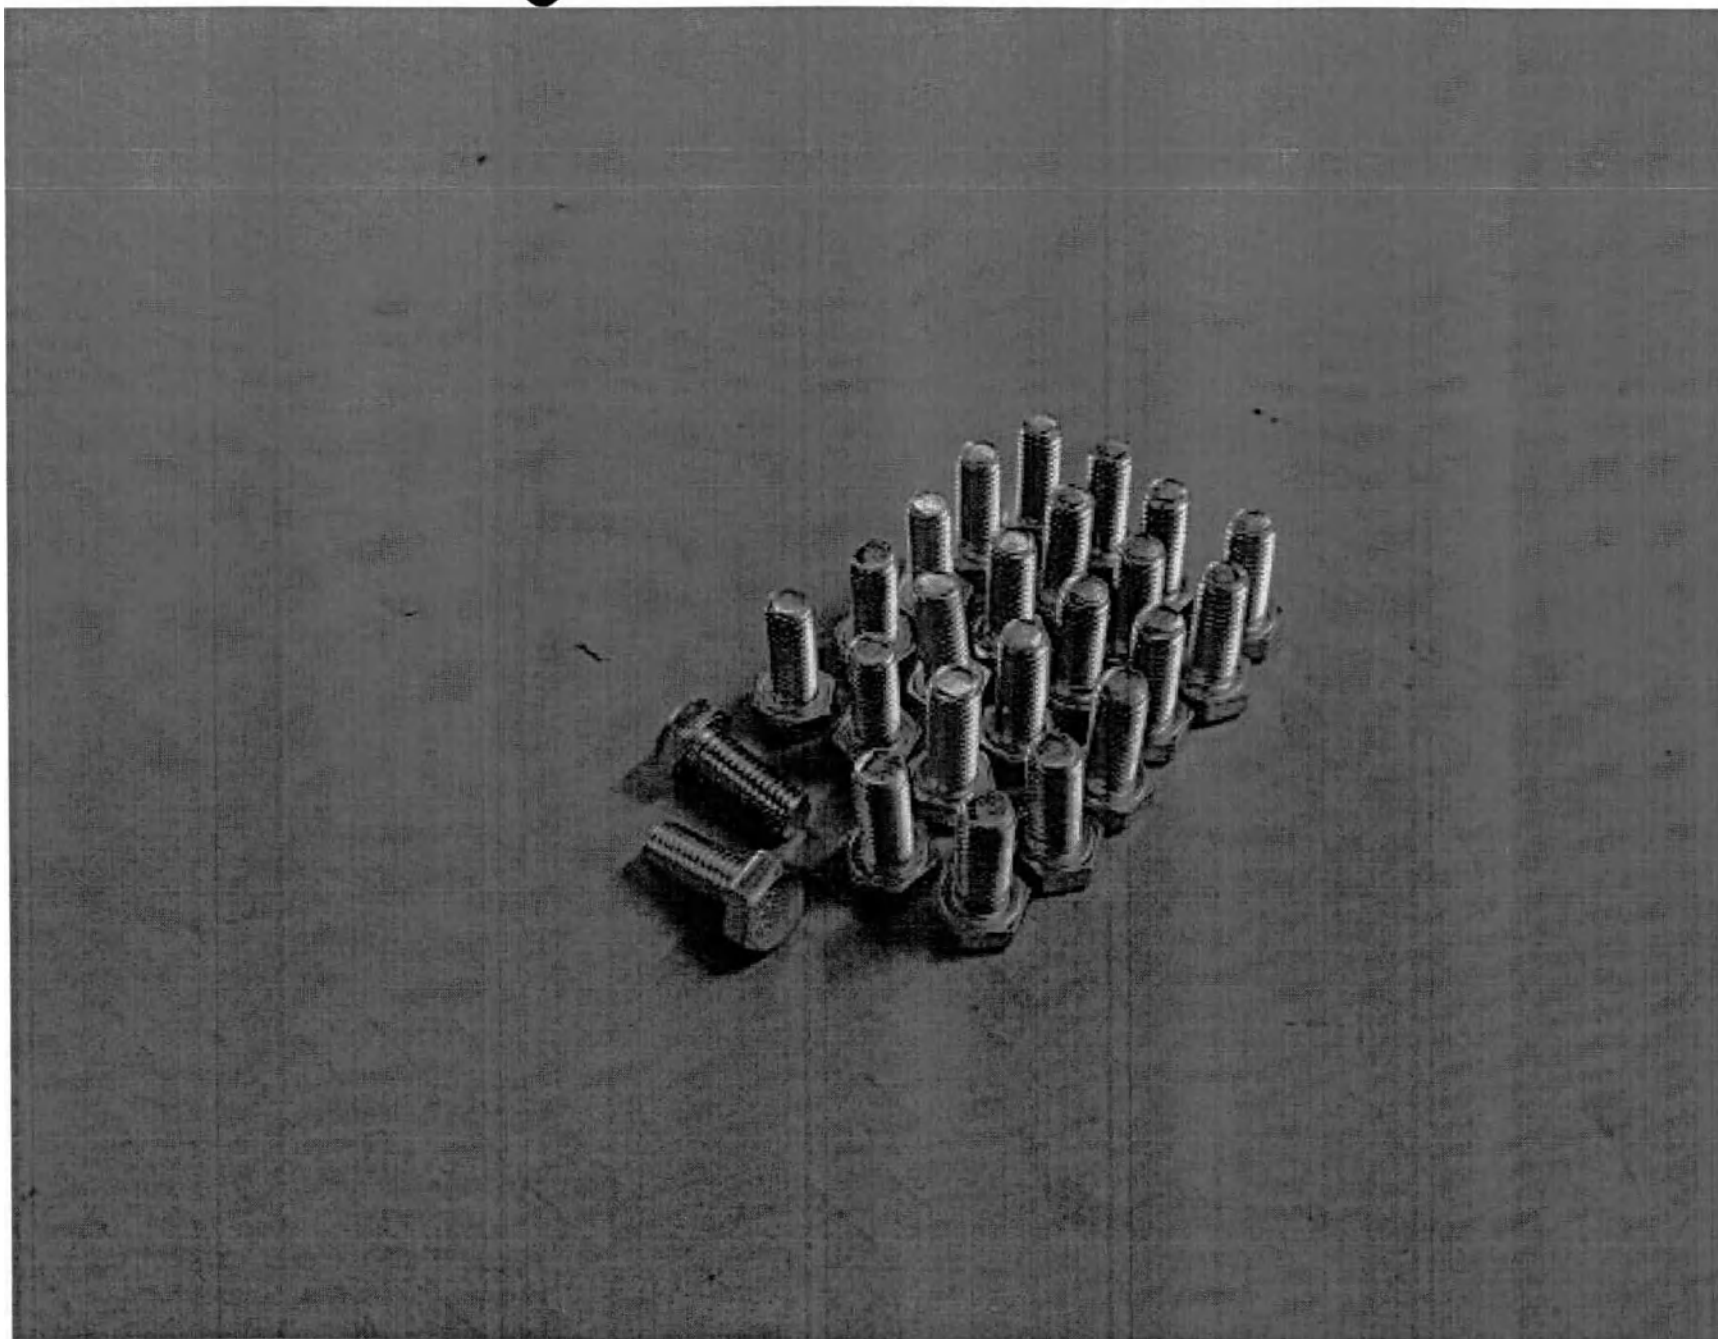


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Болт 8x20**

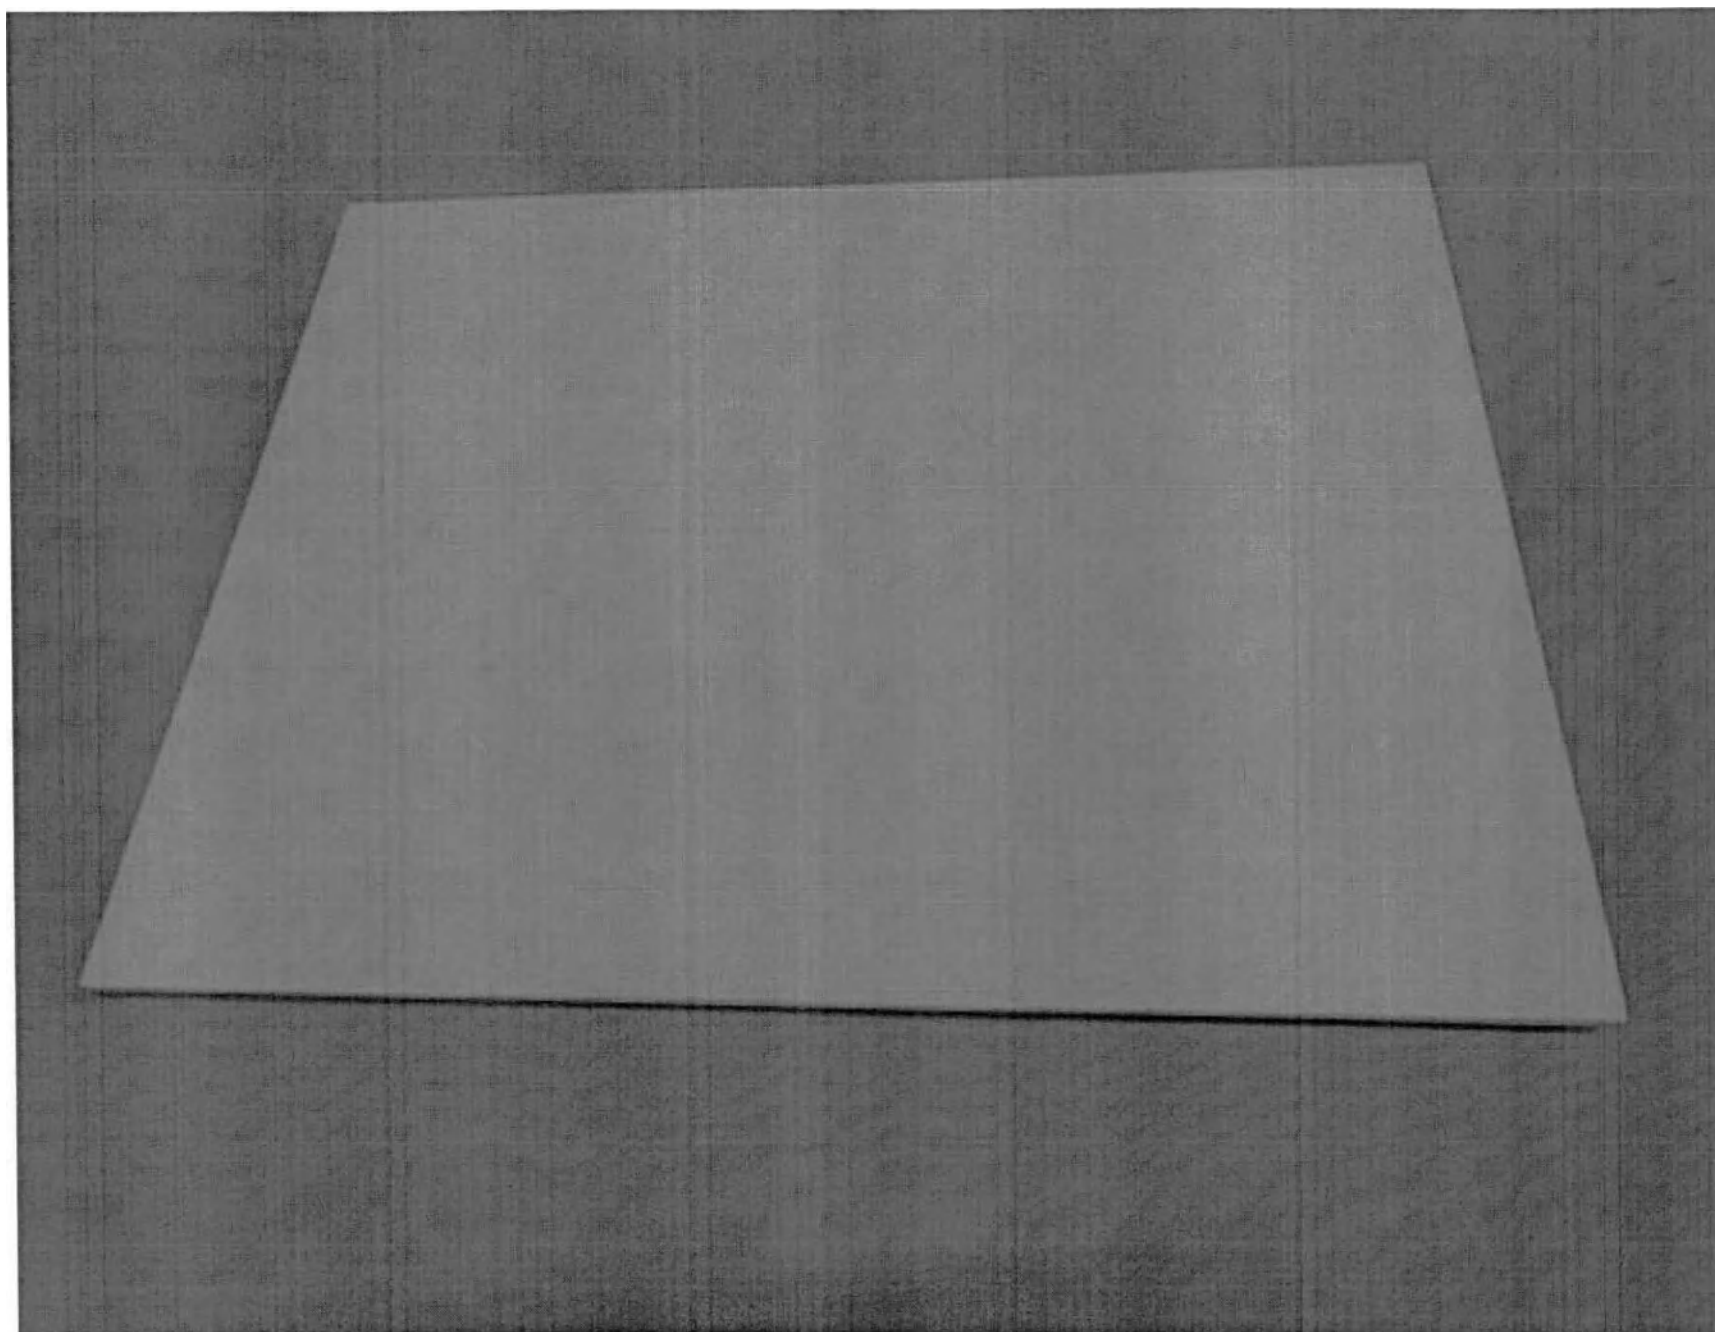

**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Огнеупорная вставка**

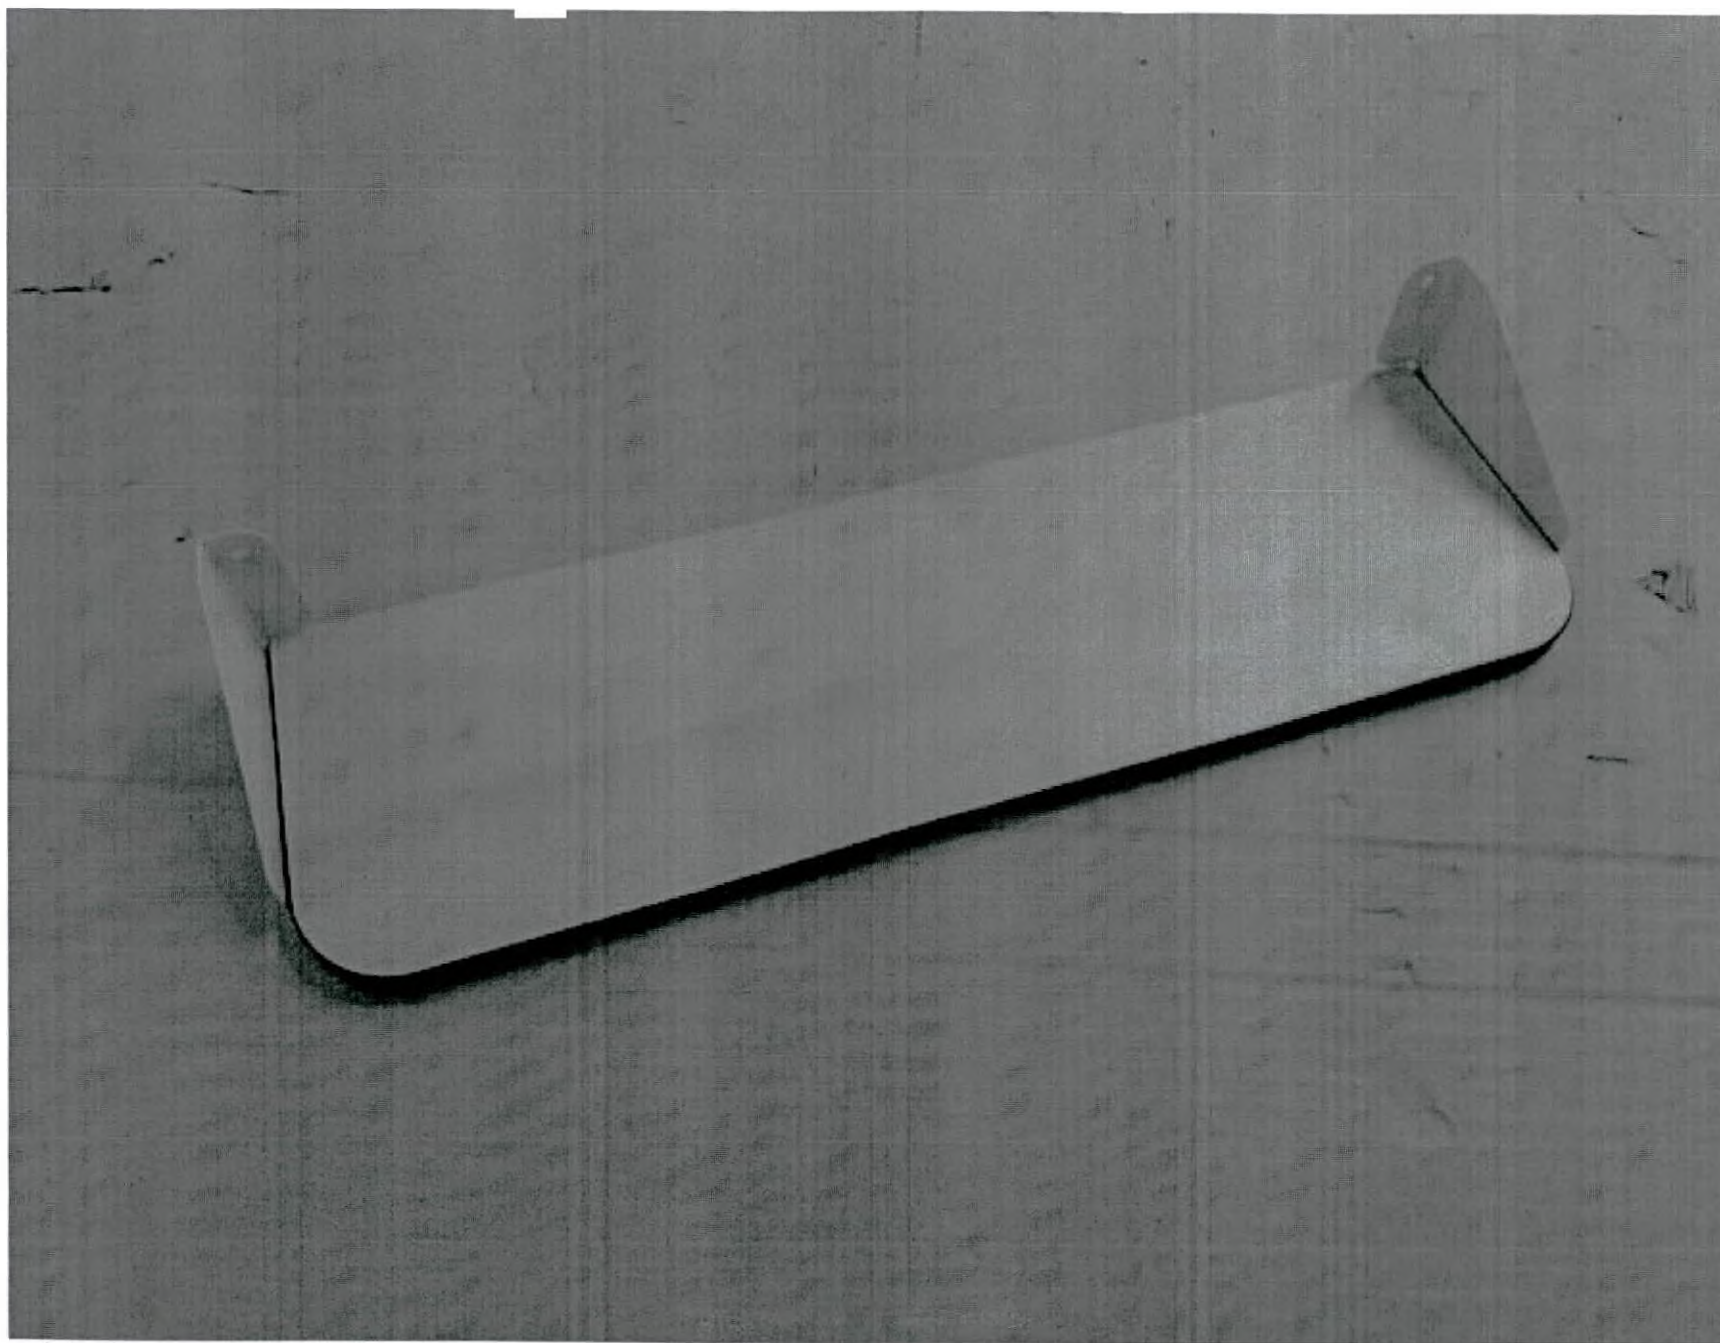

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Принадлежность: Полка боковая

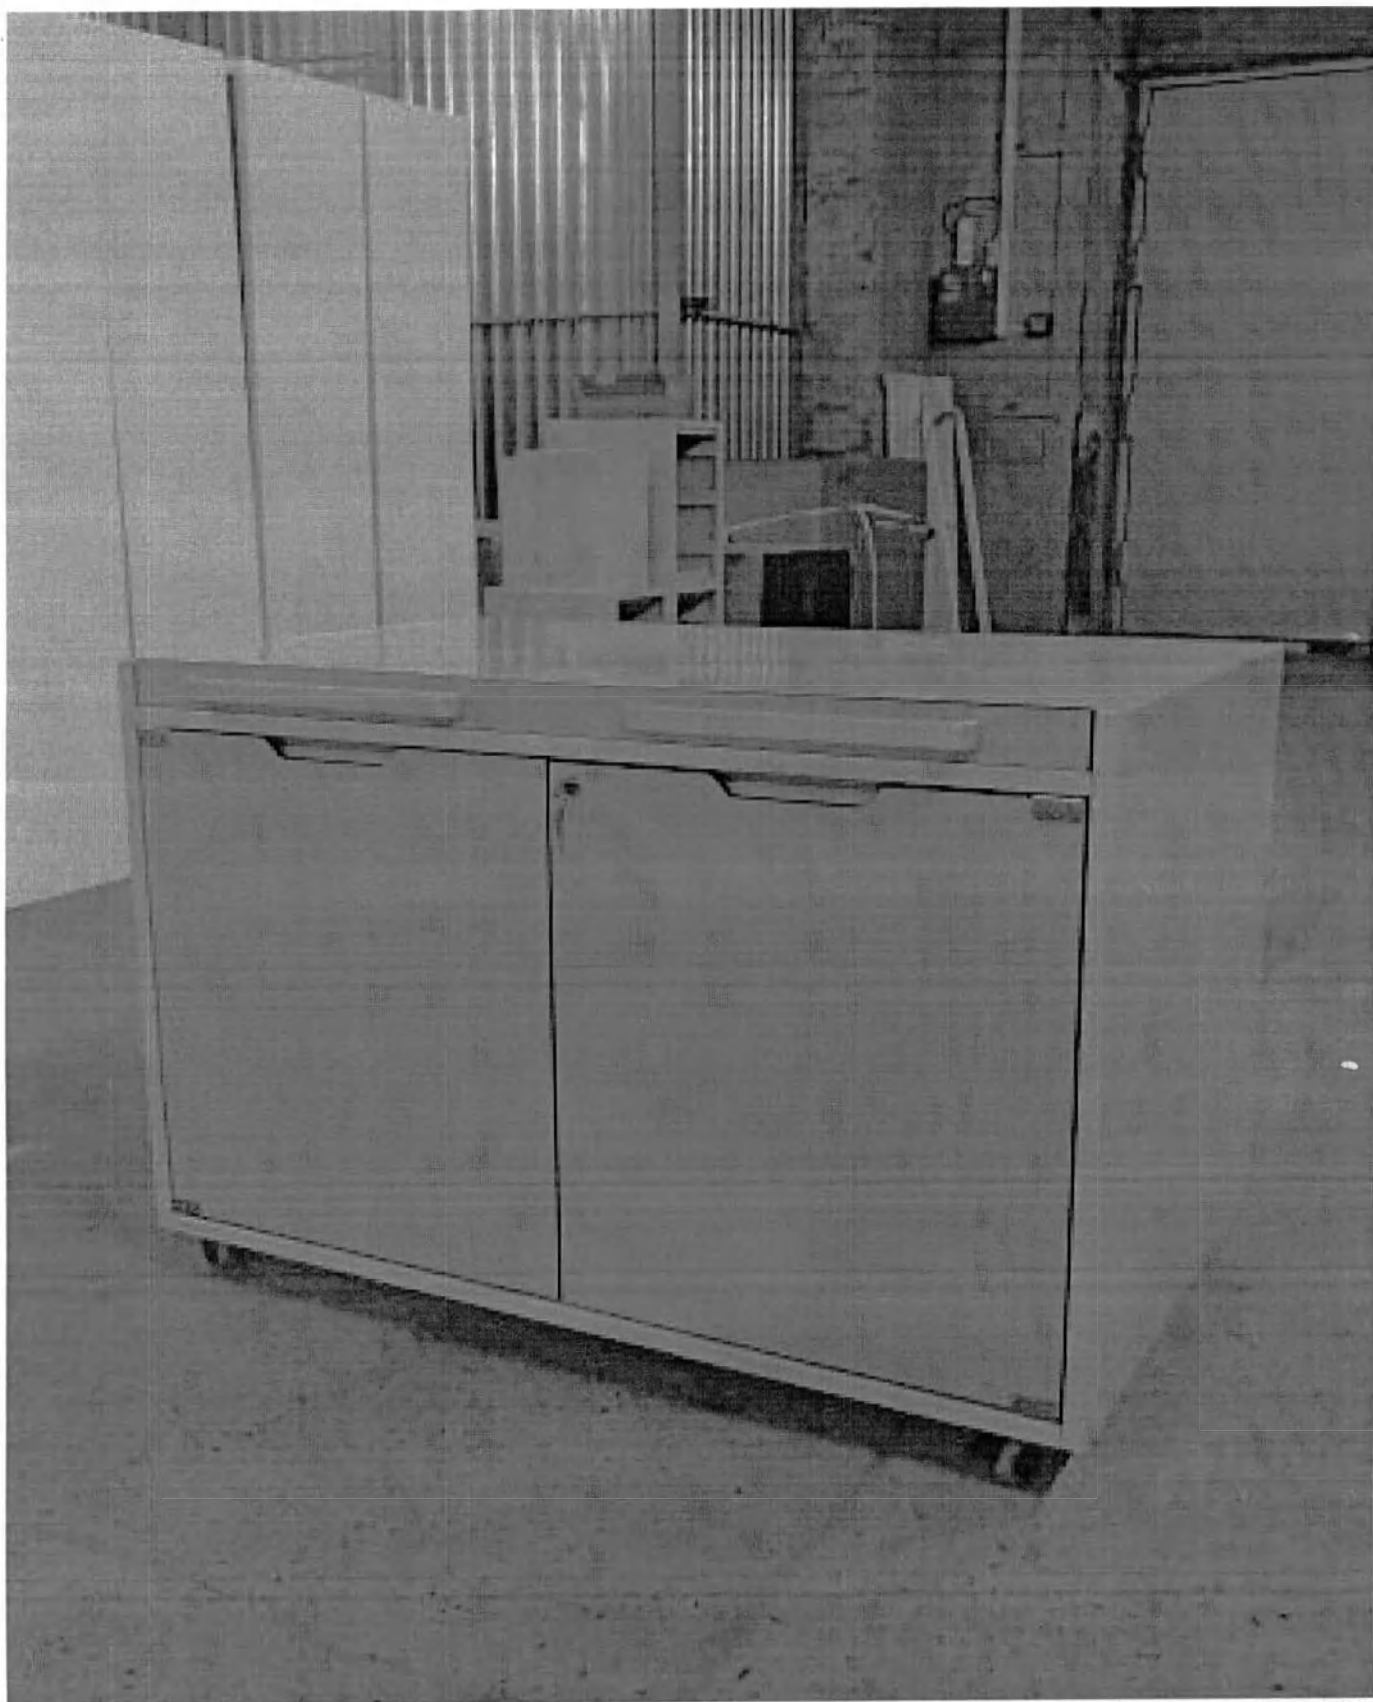

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022. Принадлежность: Модуль подкатной ШВМ-1

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 71

Шкаф медицинский лабораторный с
вентиляционной установкой ШВ-1к
с принадлежностями

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

ру

Дата изготовления: 22.09.2022

Заводской номер: 1


Сделано в России

230 В $\pm 10\%$ 50 Гц 50 Вт IP44


Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев


Средний срок службы - 6 лет.




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка изделия

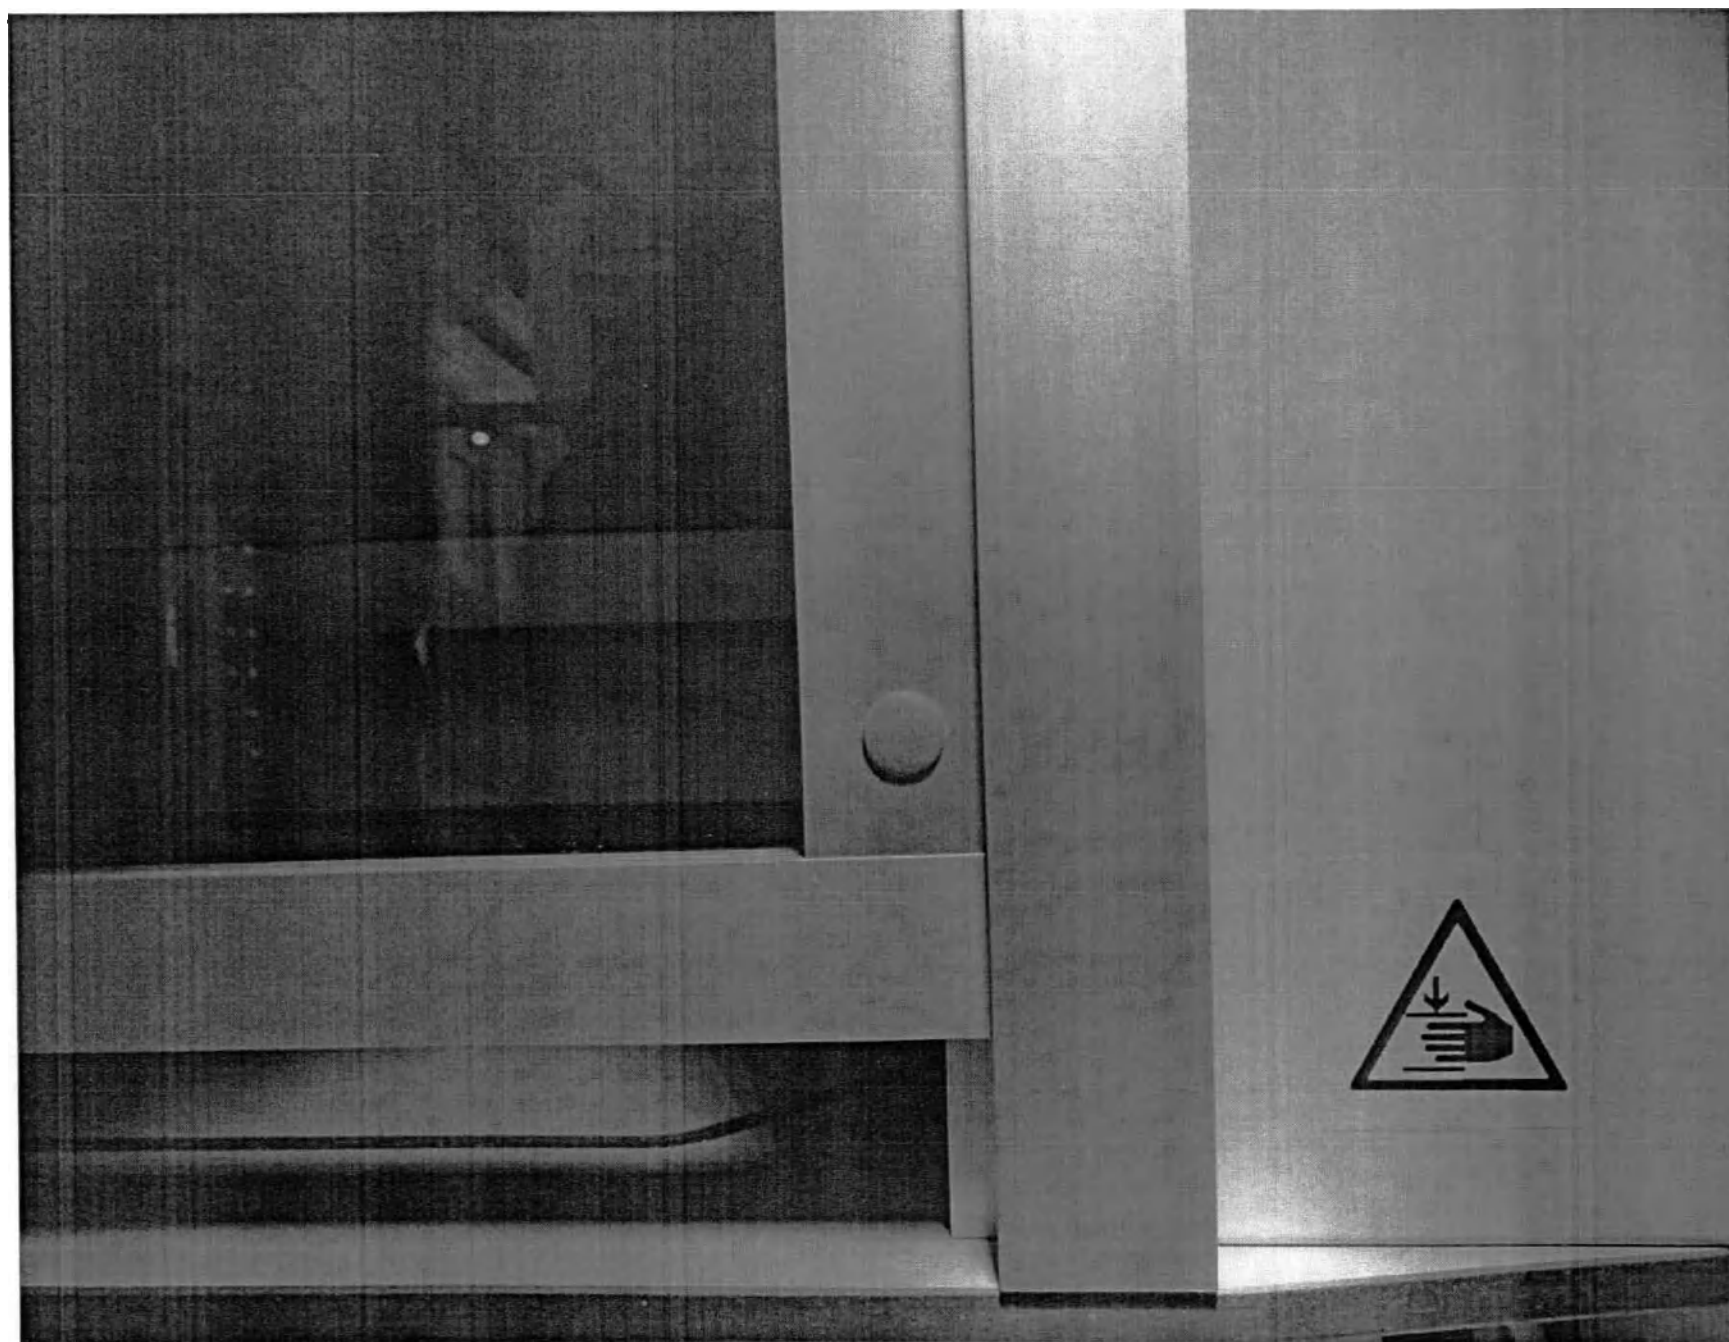

**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка изделия. Символ «Опасность повреждения рук».**

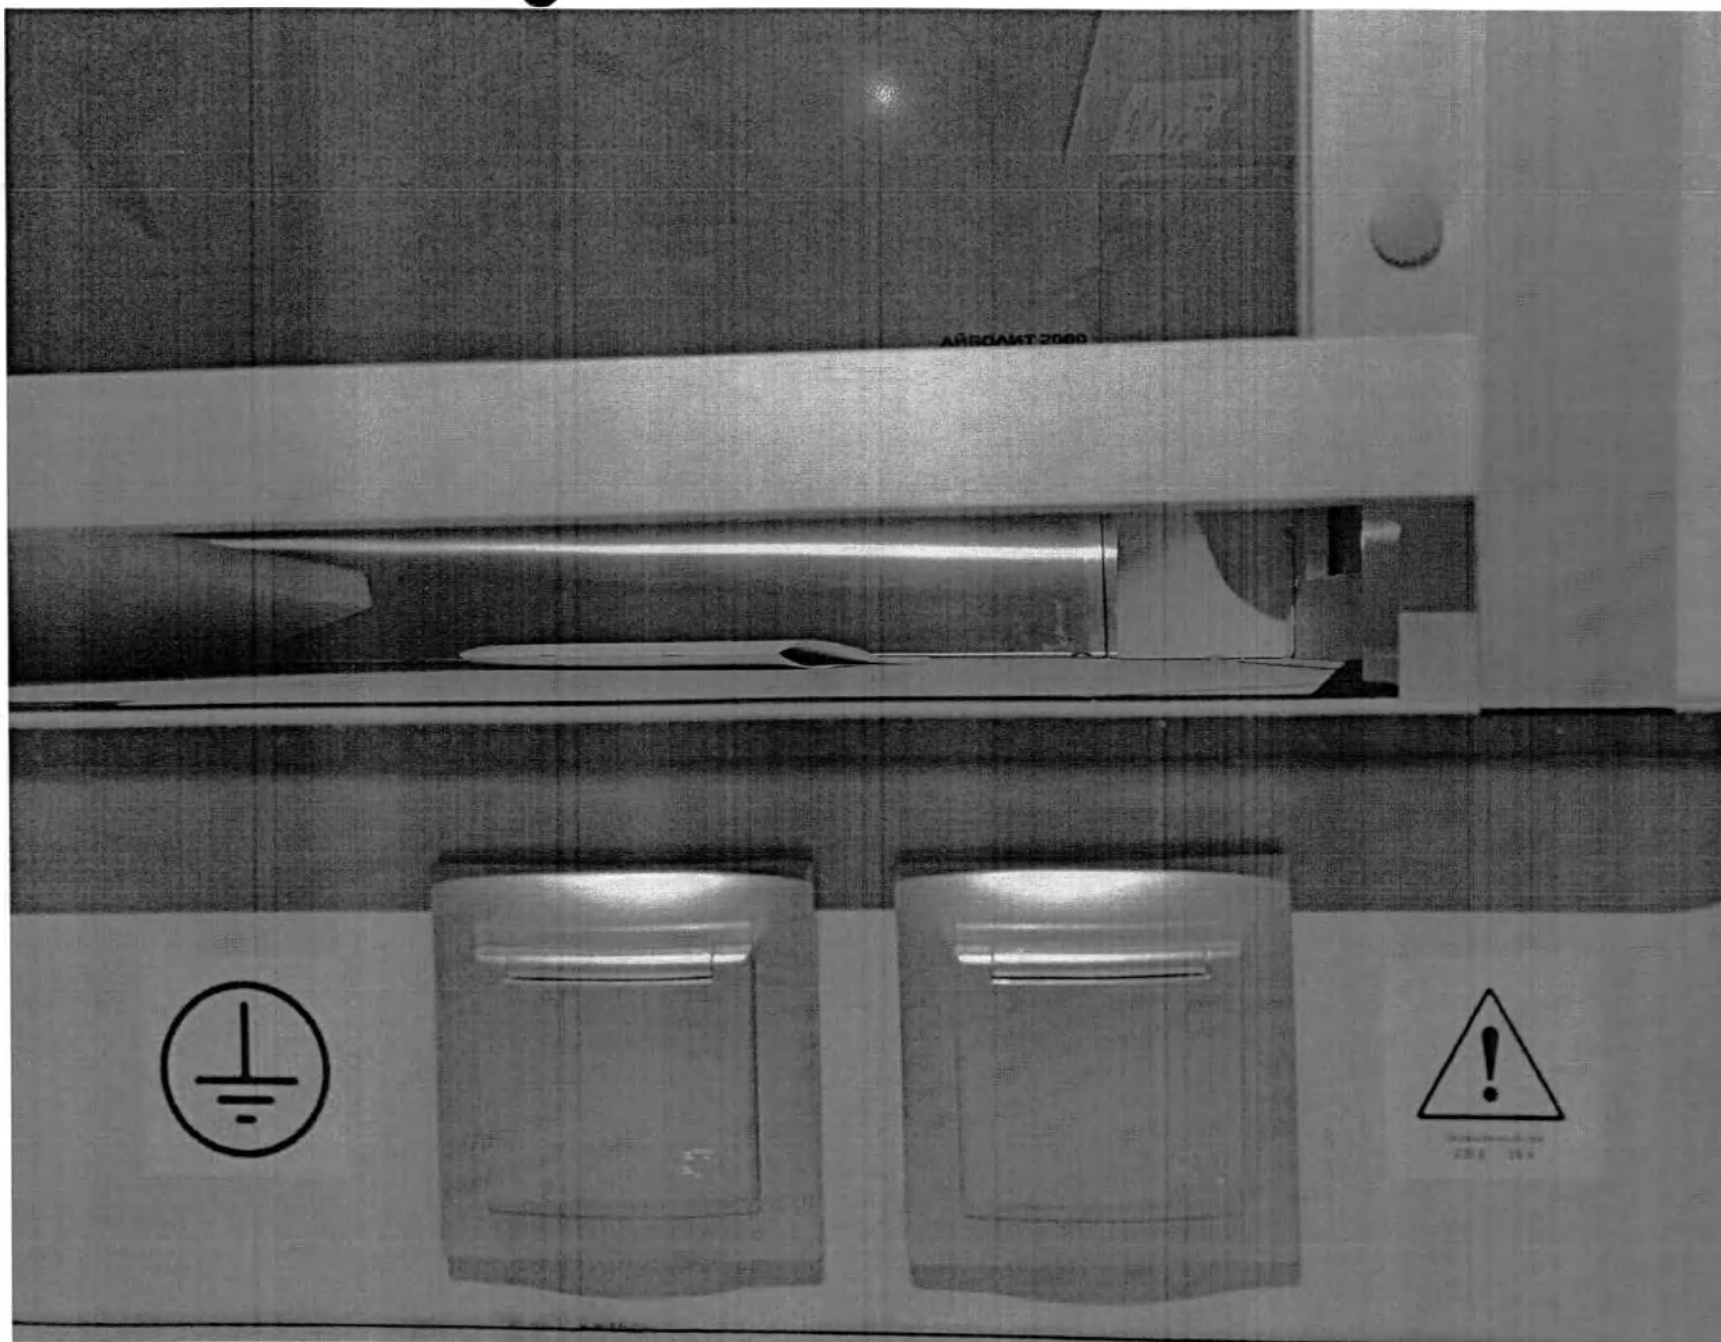

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка розеток

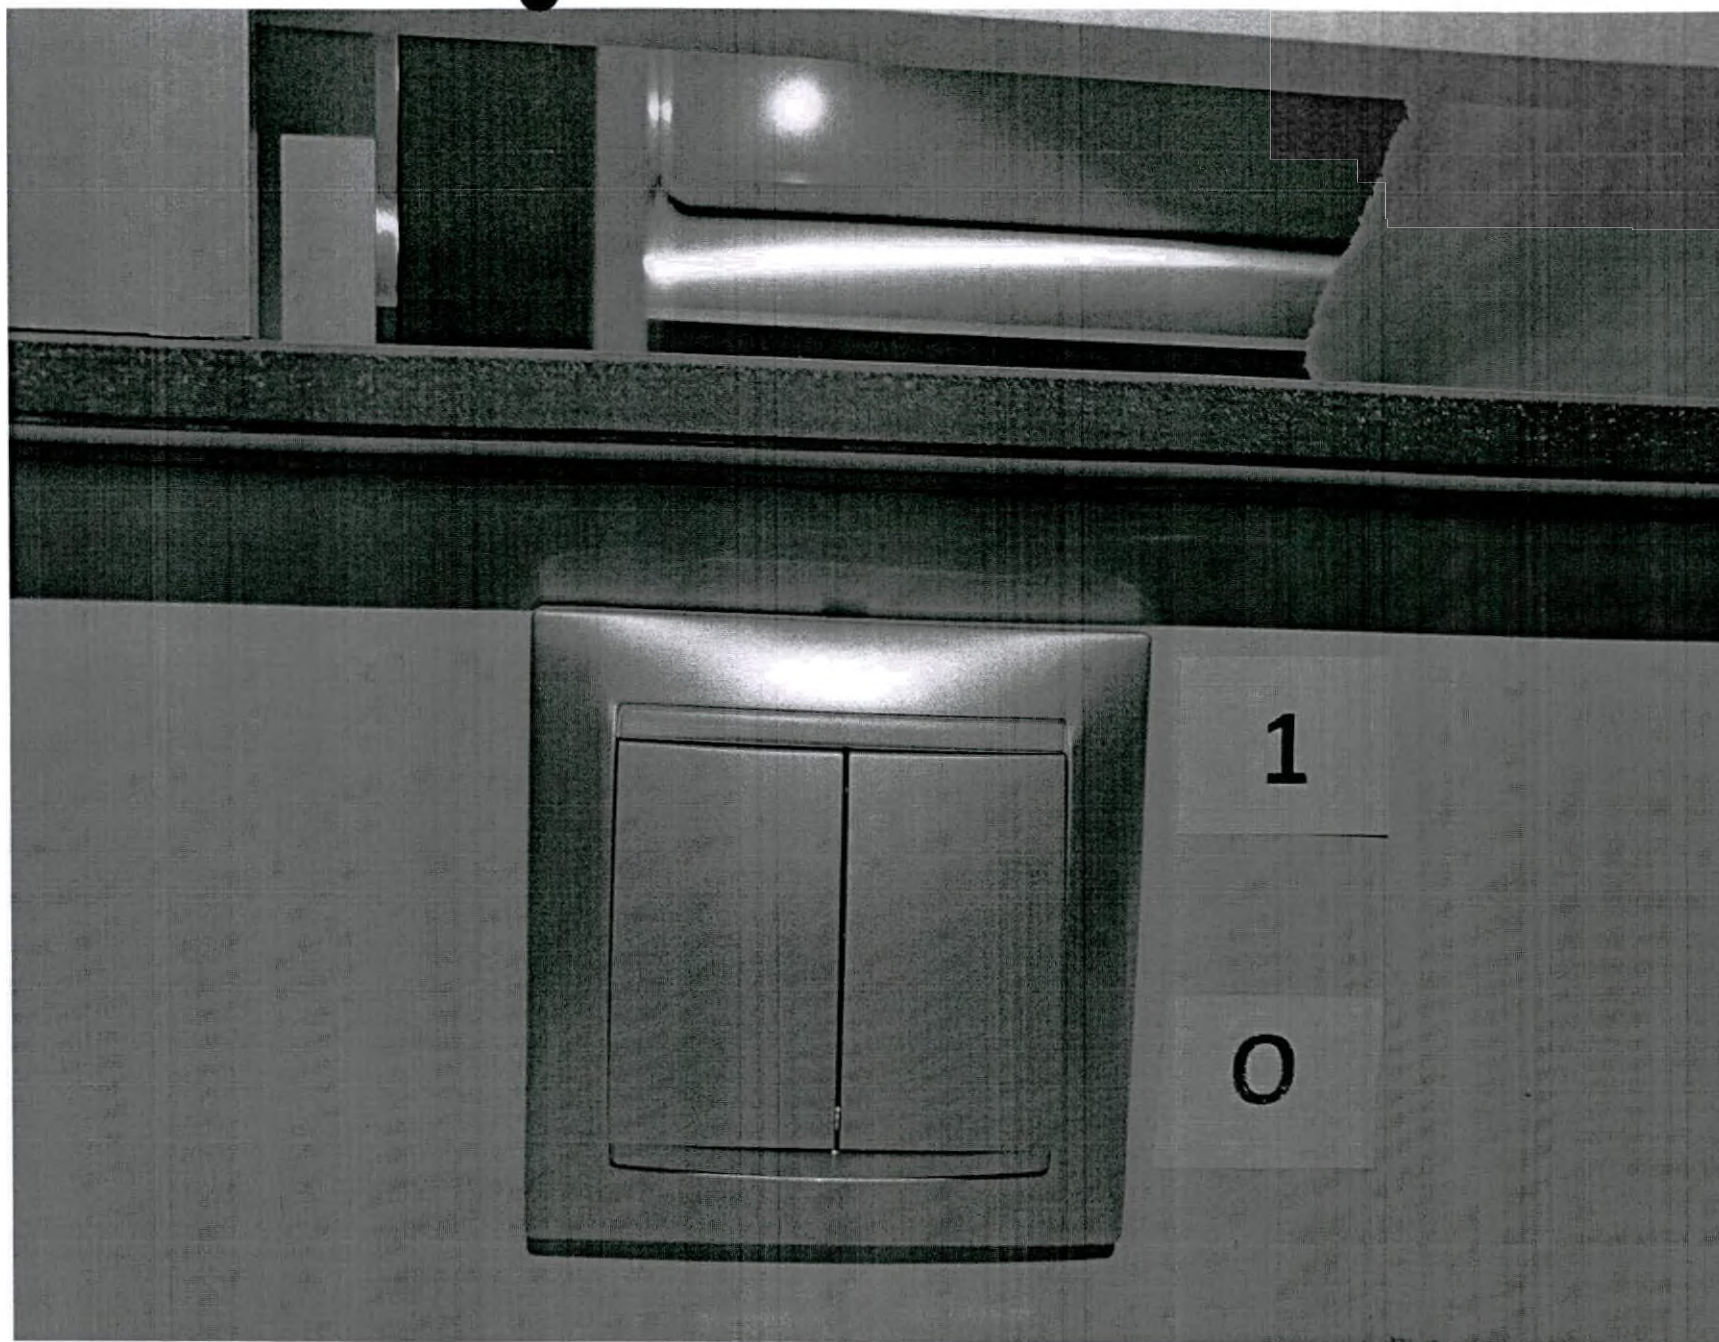

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка выключателя

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г

Полка боковая

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

РУ _____

Дата изготовления: 22.09.2022 _____ Заводской номер: 3 _____

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи


Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

Средний срок службы – 6 лет.



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка принадлежности: Полка боковая

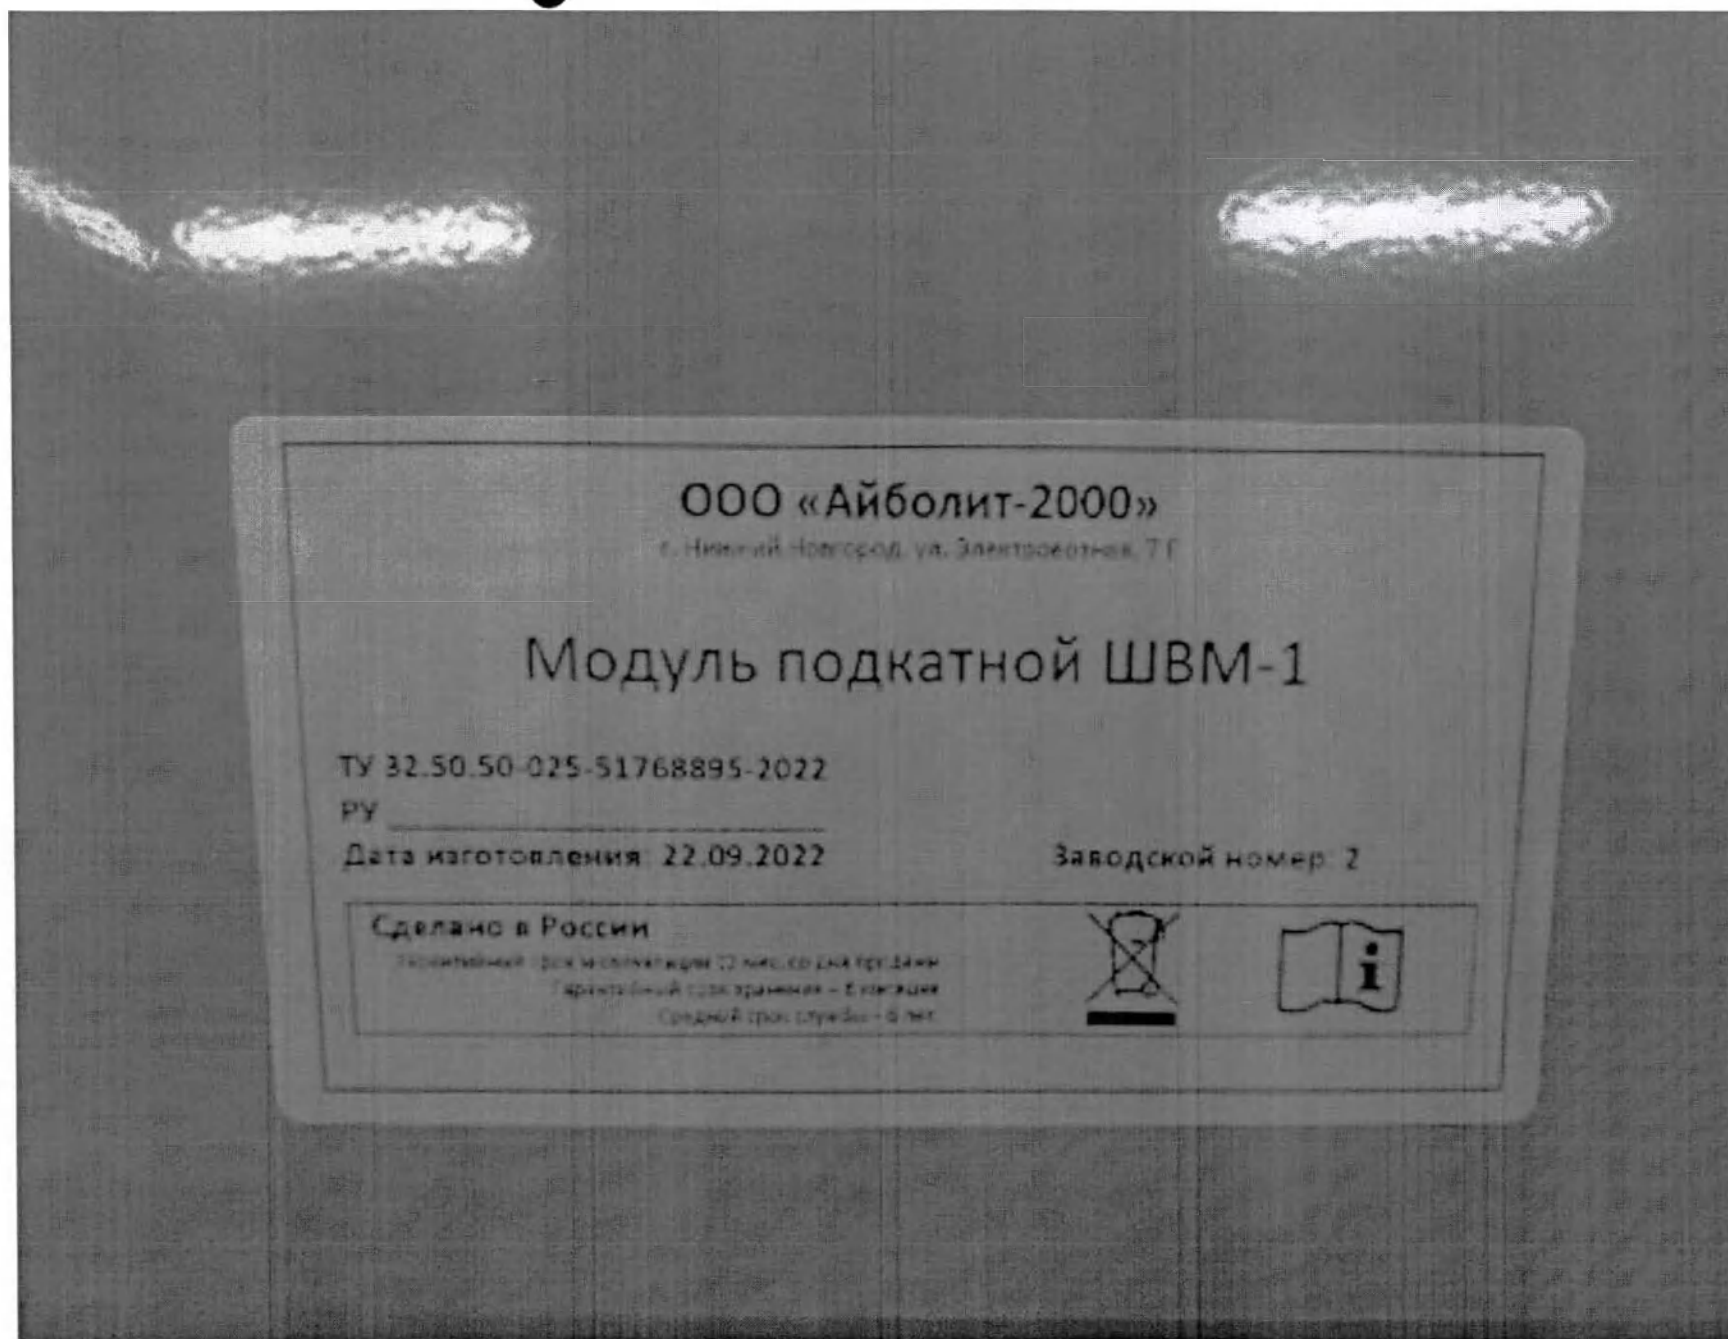

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка принадлежности: Модуль подкатной ШВМ-1

ООО «Айболит-2000»

**Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной
установкой ШВ-1к с принадлежностями**



Пакет 1 из 2

Шкаф

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022



Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА

СЕРЫЙ

ЦВЕТ ПЛАСТИКА

фисташковый

Заводской номер

№1

Дата изготовления

22 09 2022

Комплект поставки:

Камера шкафа в сборе – 1 шт.
Стойка задняя правая – 1 шт.
Стойка задняя левая – 1 шт.
Стойка передняя – 2 шт.
Лыжа – 2 шт.
Стяжка нижняя – 1 шт.
Винт 4х16 комби – 4 шт.
Болты 8х20 – 24 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.7Г

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №1 Шкаф

ООО «Айболит-2000»

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями



Пакет 2 из 2

Огнеупорная вставка

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022



Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА **СЕРЫЙ**
ЦВЕТ ПЛАСТИКА **фисташковый**

Заводской номер №1

Дата изготовления 22.09.2022

Комплект поставки:
Огнеупорная вставка – 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условий хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.
Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.7Г

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №2 Огнеупорная вставка

ООО «Айболит-2000»

**Шкаф медицинский лабораторный
с вентиляционной установкой с принадлежностями**



**Пакет 1 из 1
Модуль подкатной
ШВМ-1**



ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА СЕРЫЙ
ЦВЕТ ПЛАСТИКА фисташковый

Комплект поставки:
Модуль подкатной ШВМ-1 – 1 шт.

Заводской номер №2

Дата изготовления 24.09.2022

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВЗНАЯ, Д.71

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-1к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке принадлежности: Модуль подкатной ШВМ-1




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Общий вид




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Общий вид с принадлежностями




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ
32.50.50-025-51768895-2022.
Камера шкафа в сборе

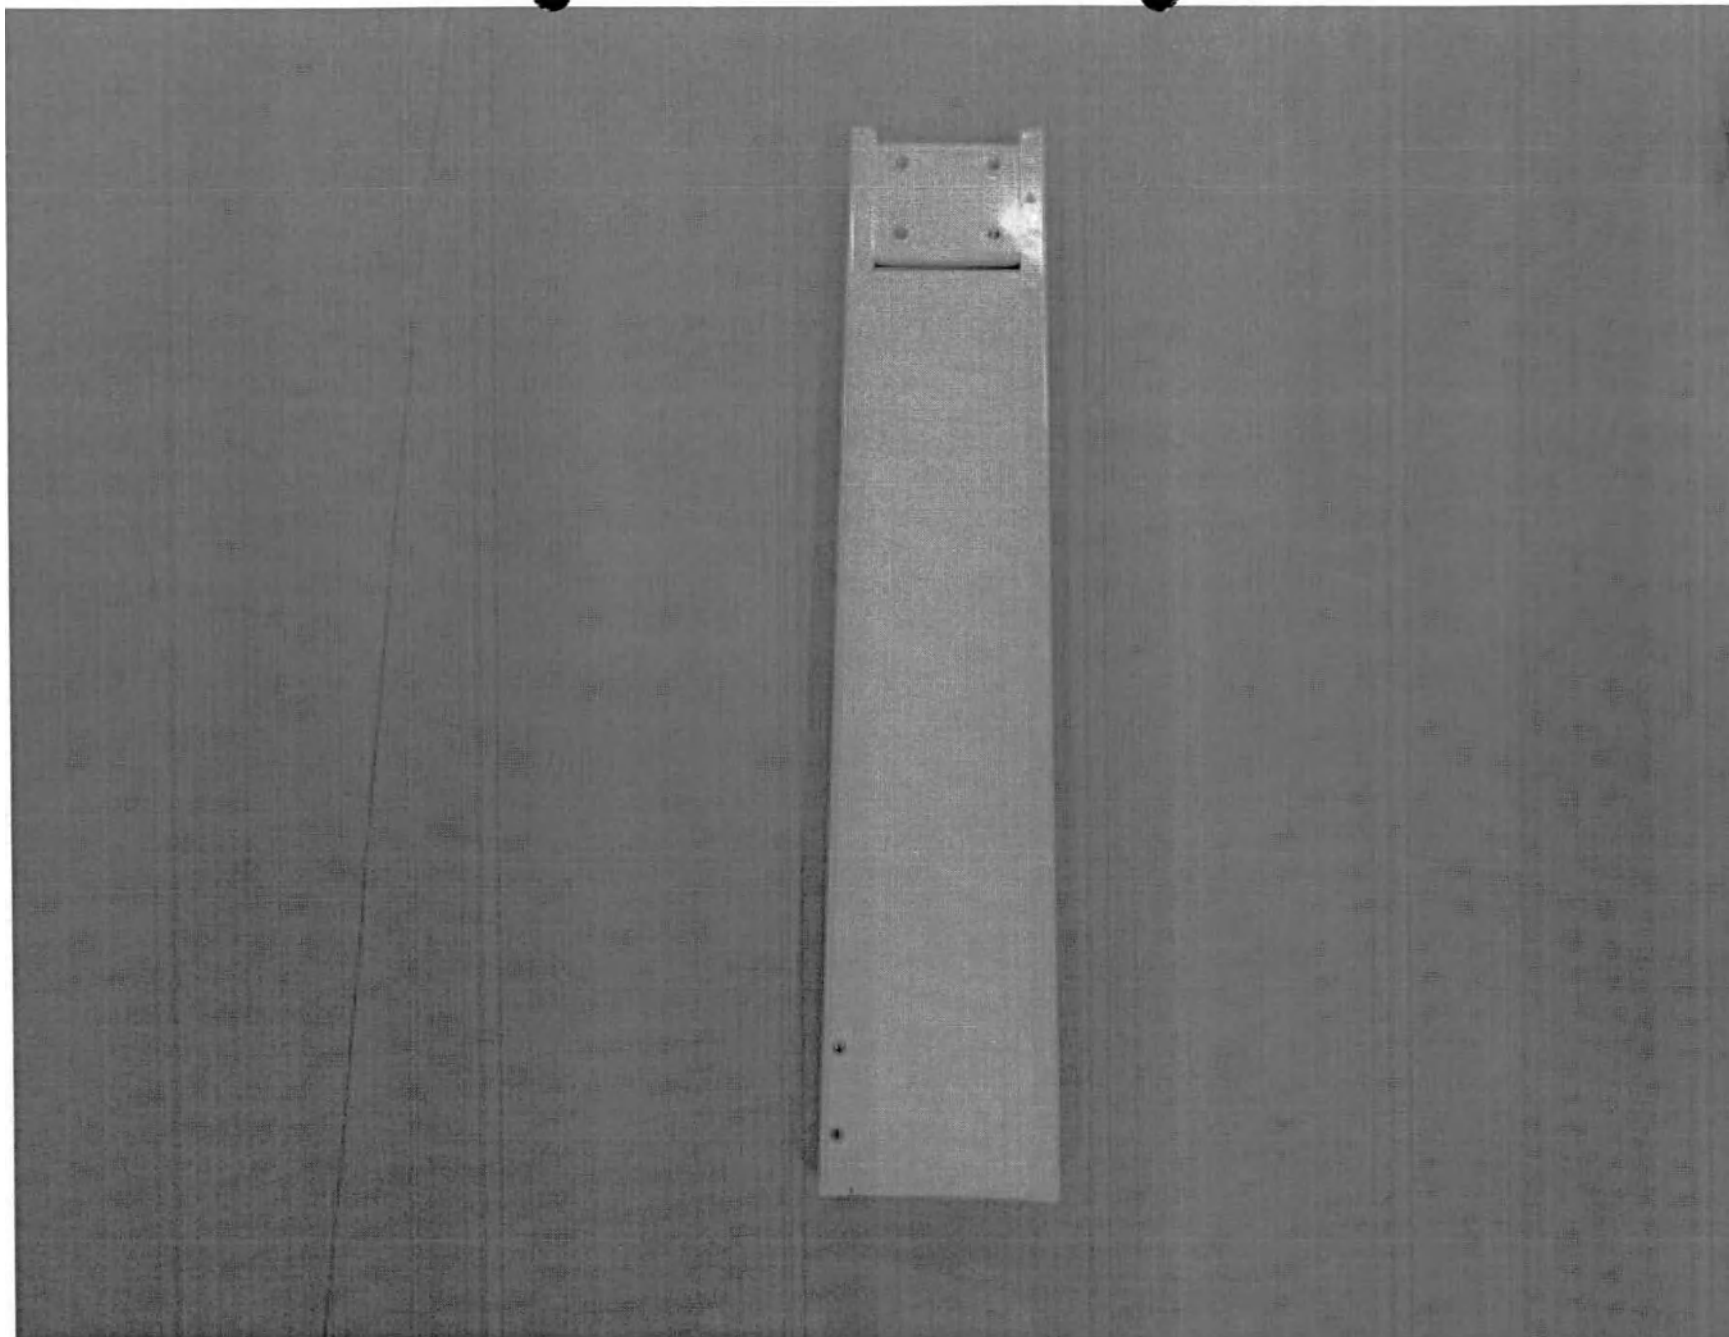


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя правая**

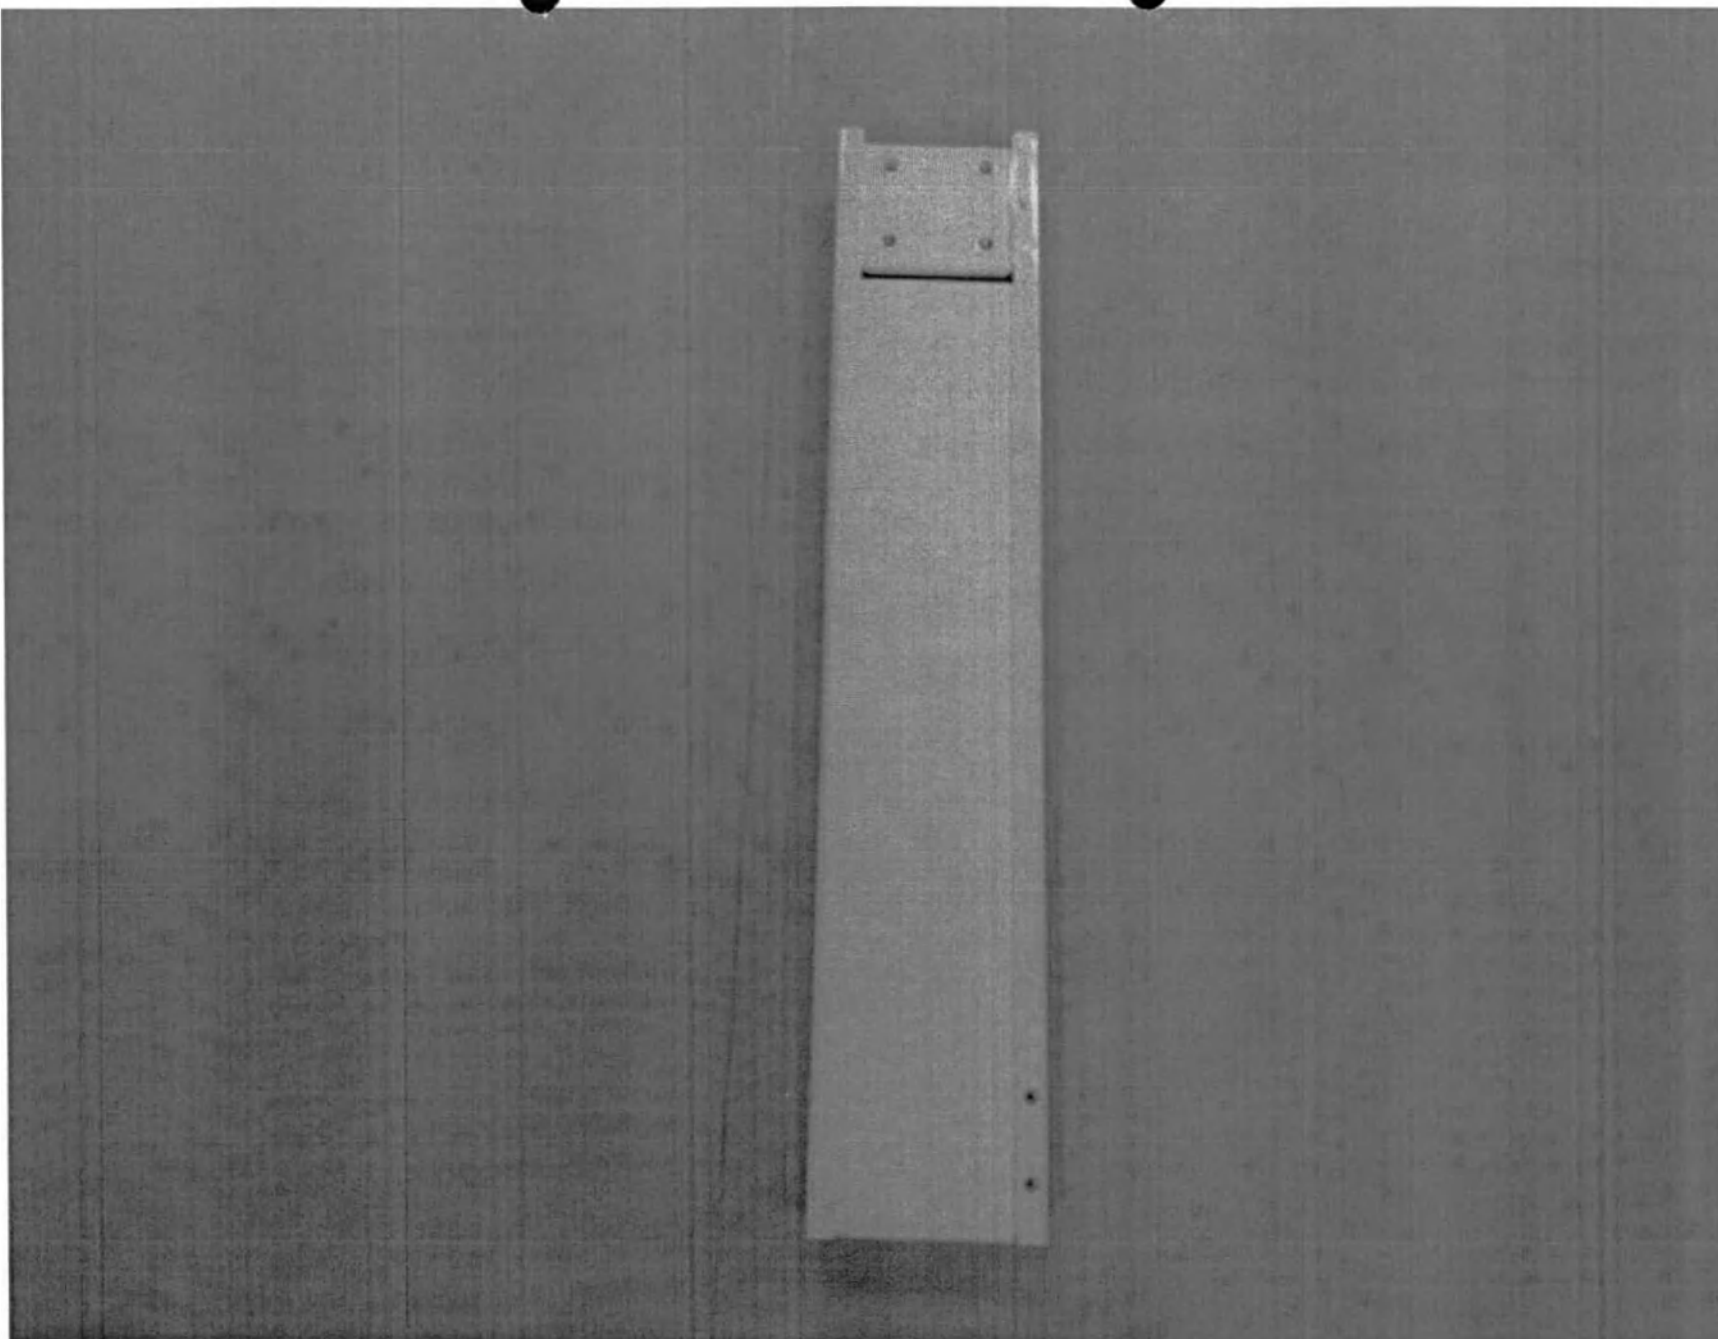


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка задняя левая

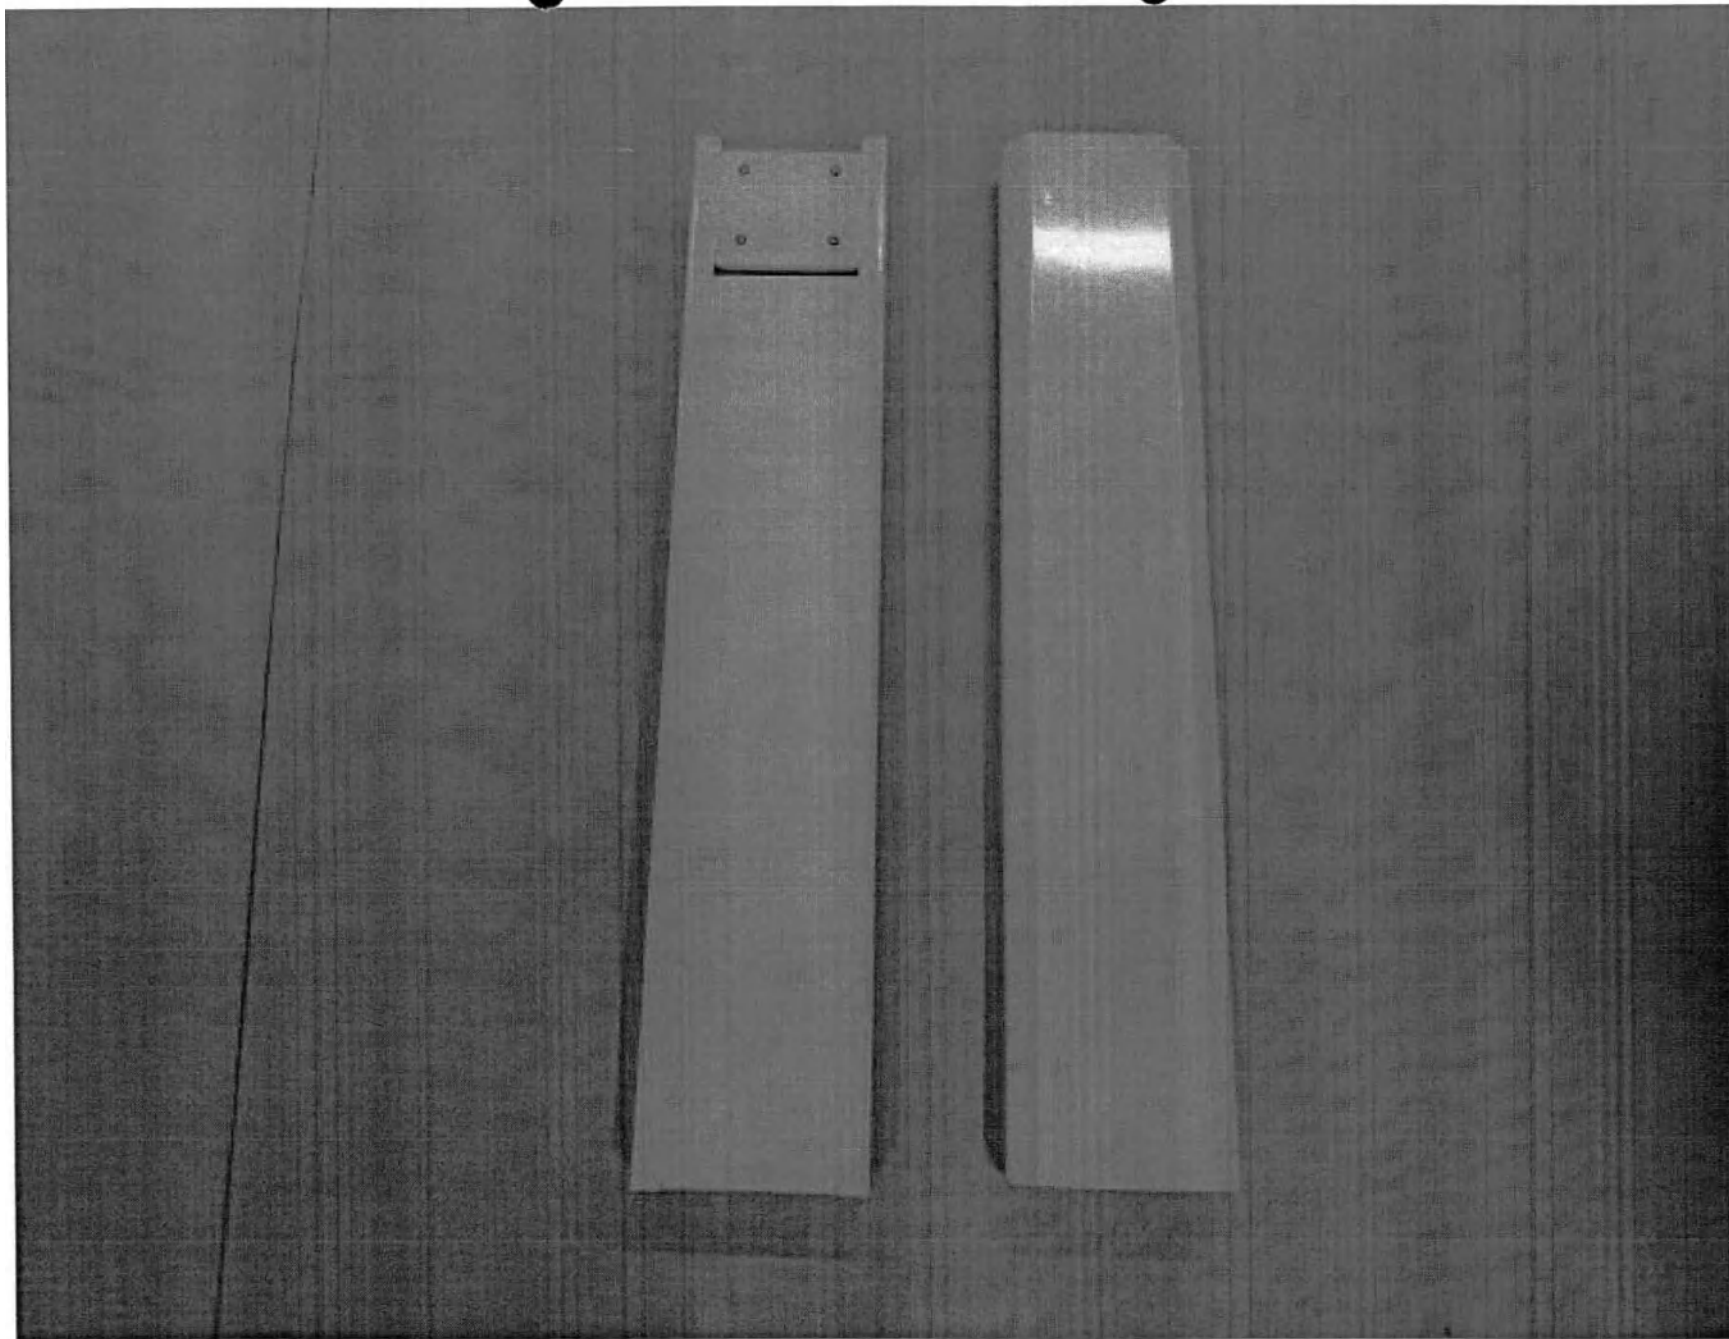


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стойка передняя**

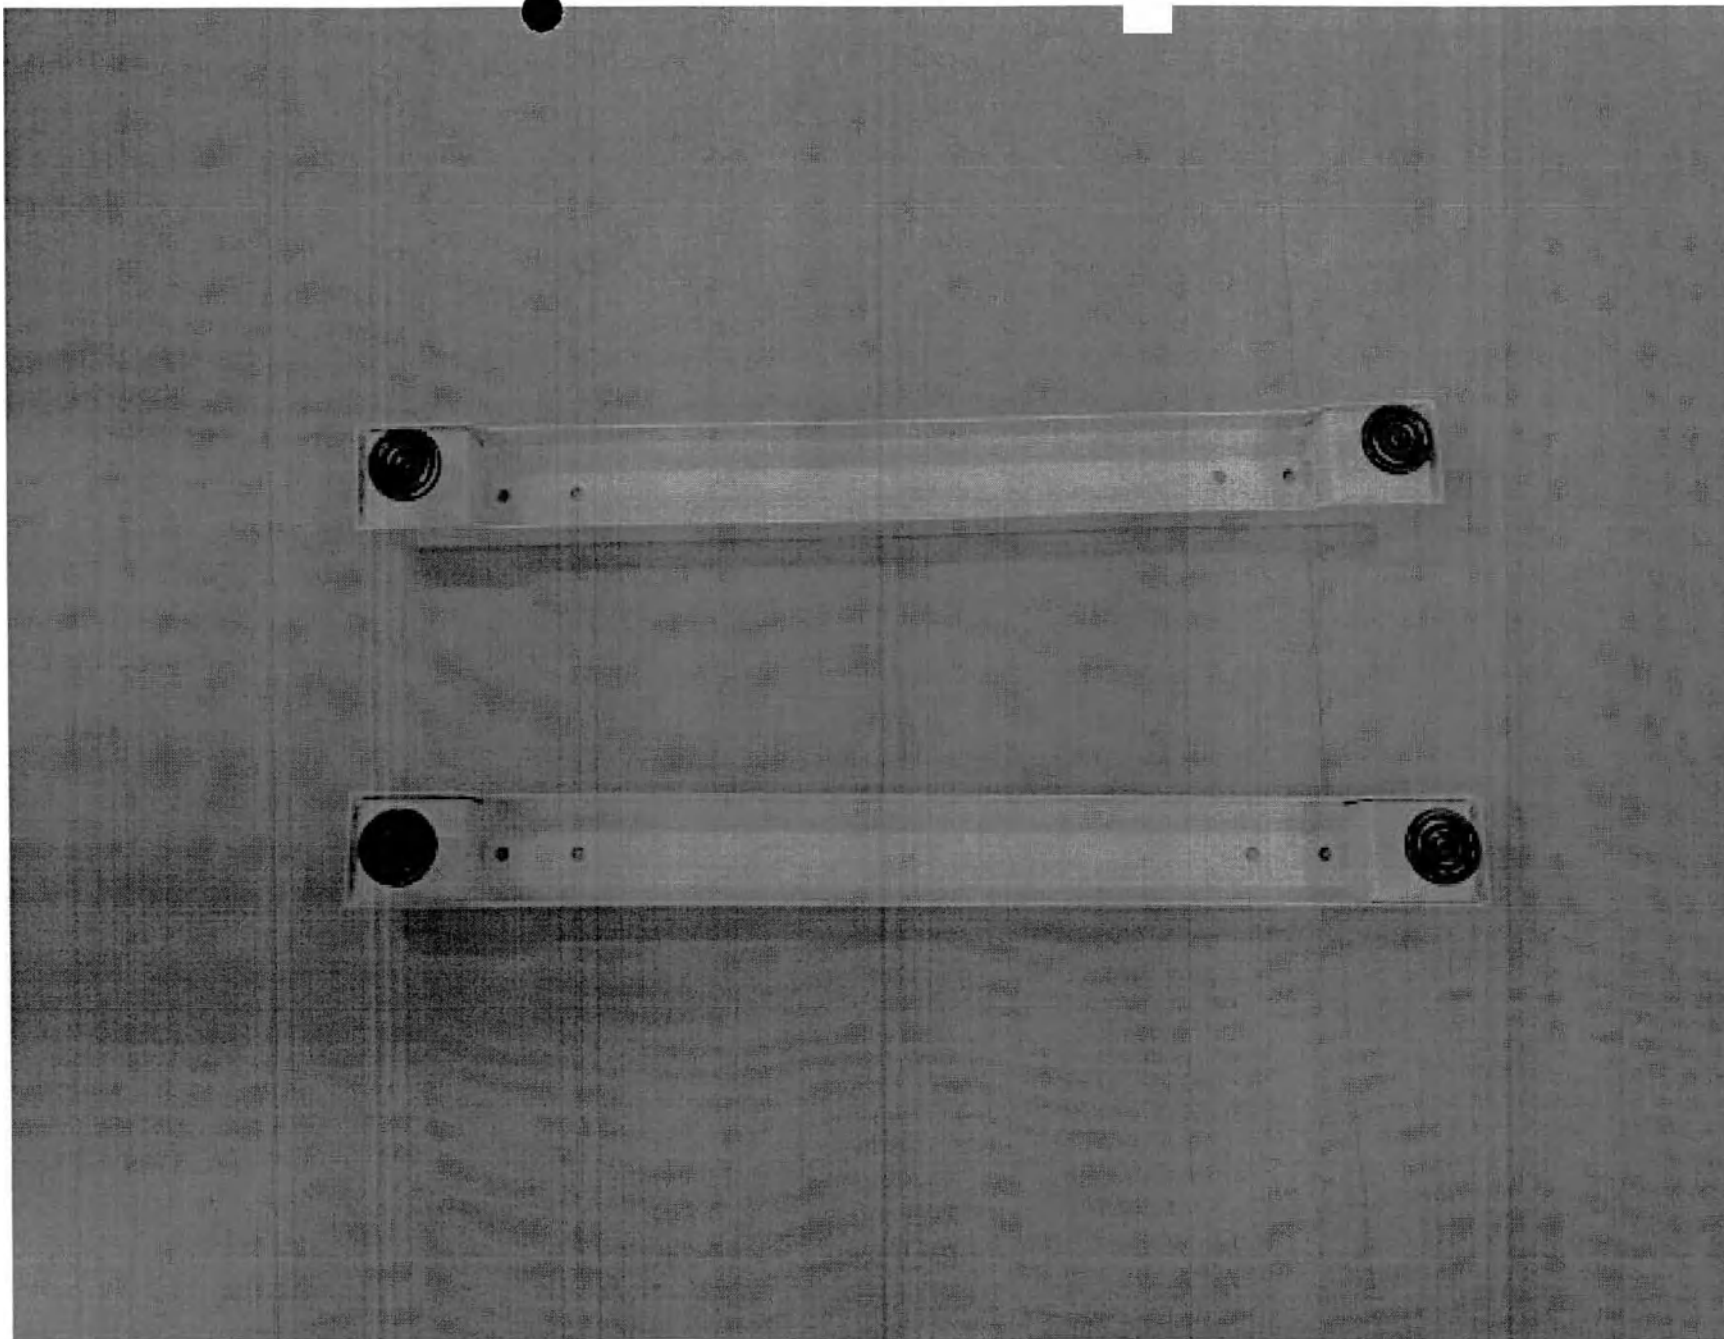


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Лька

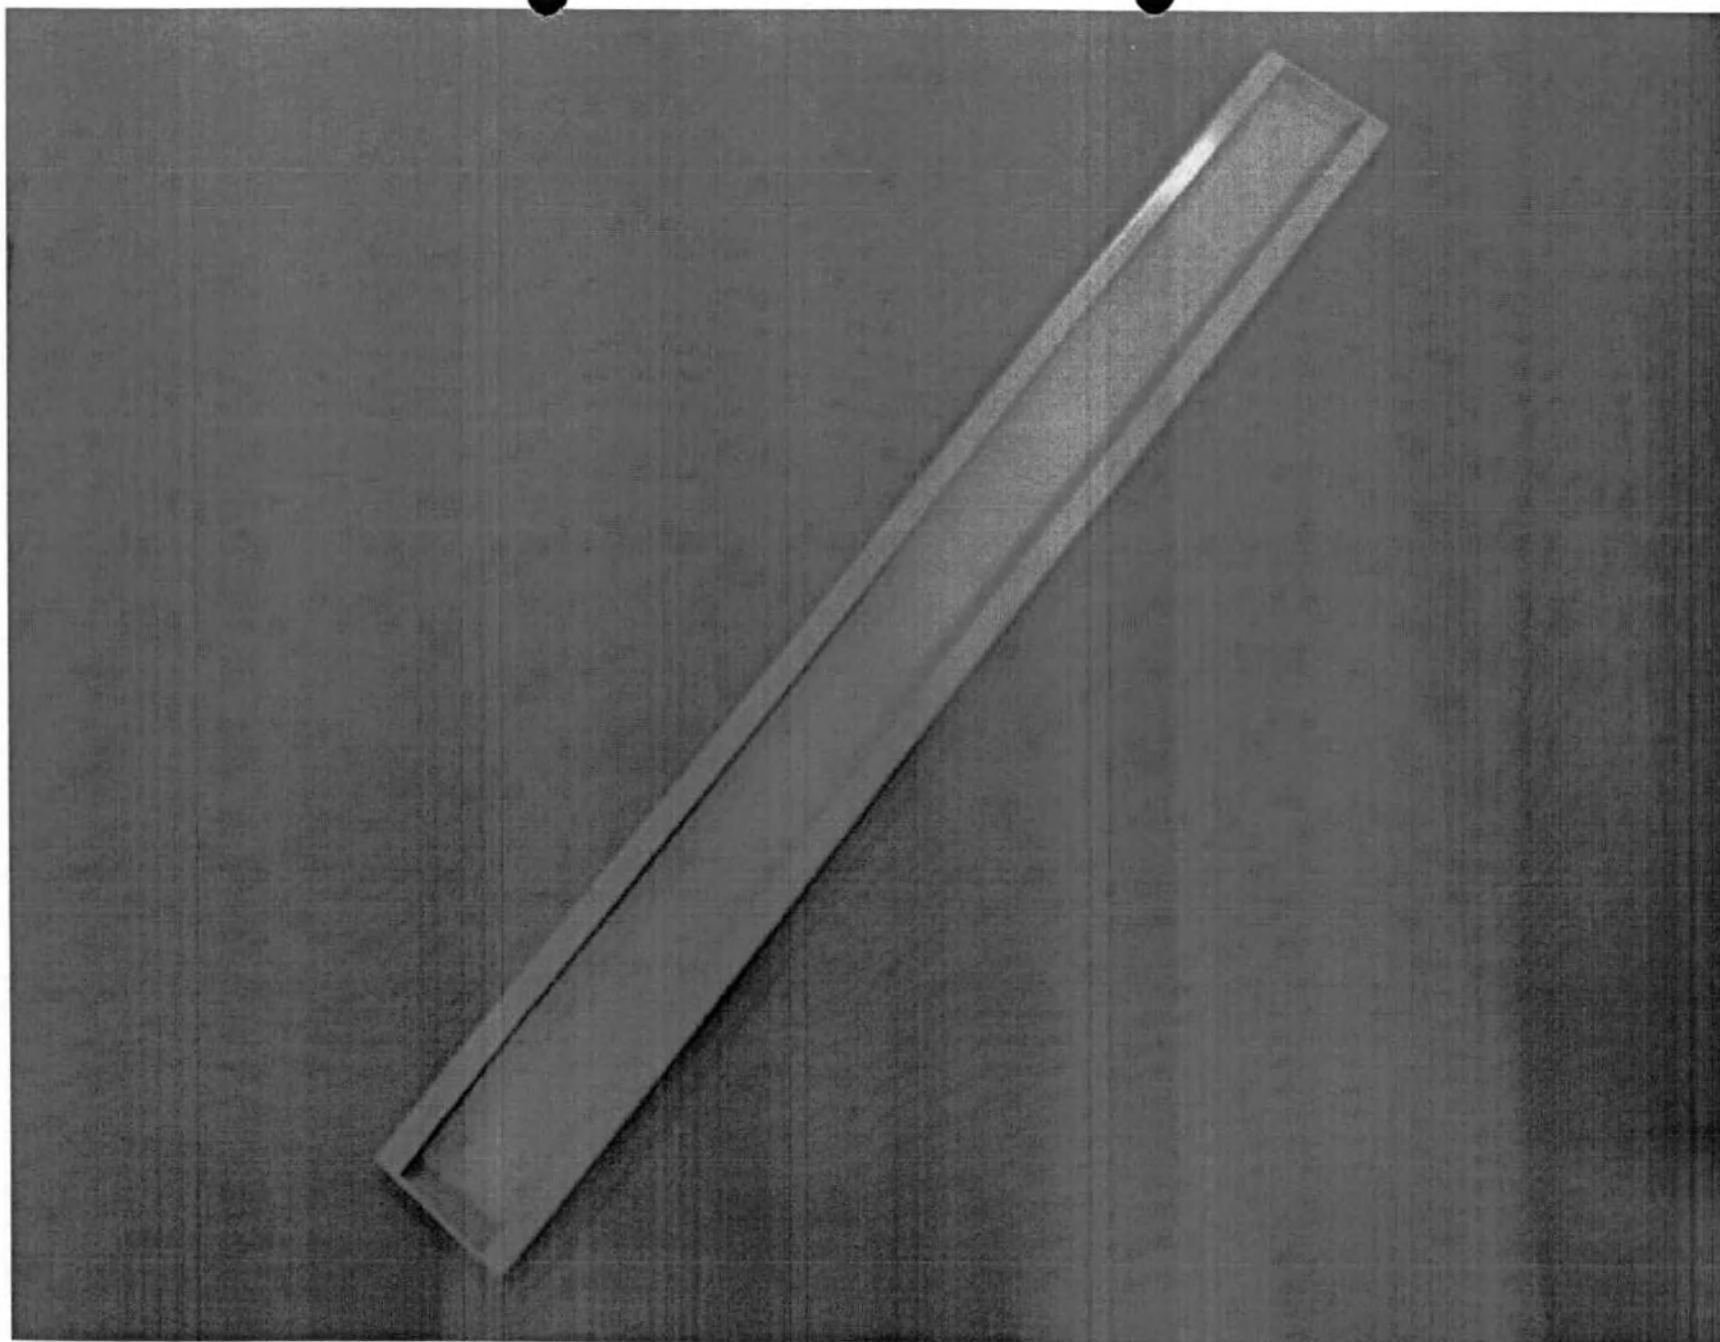


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Стяжка нижняя

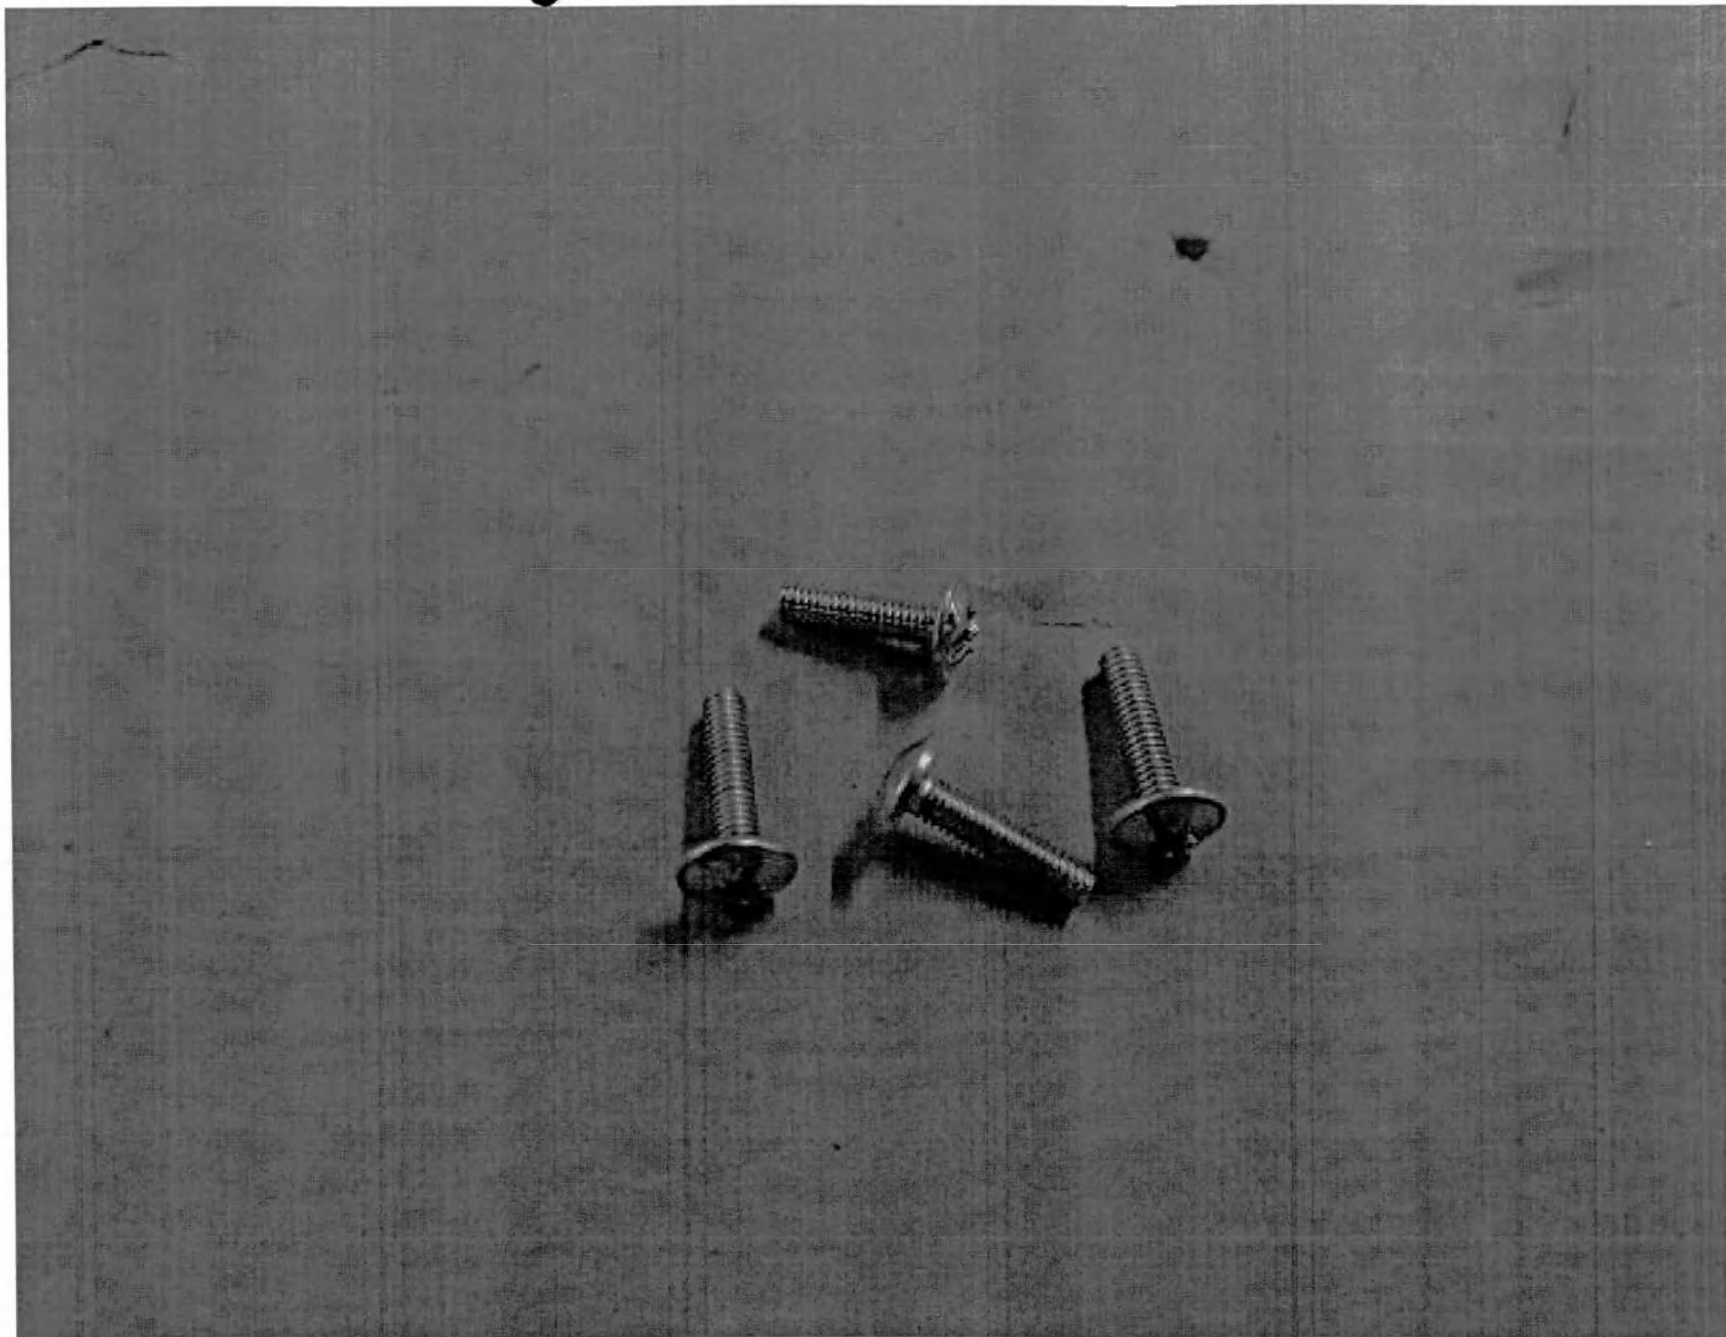


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Винт 4х16 комби

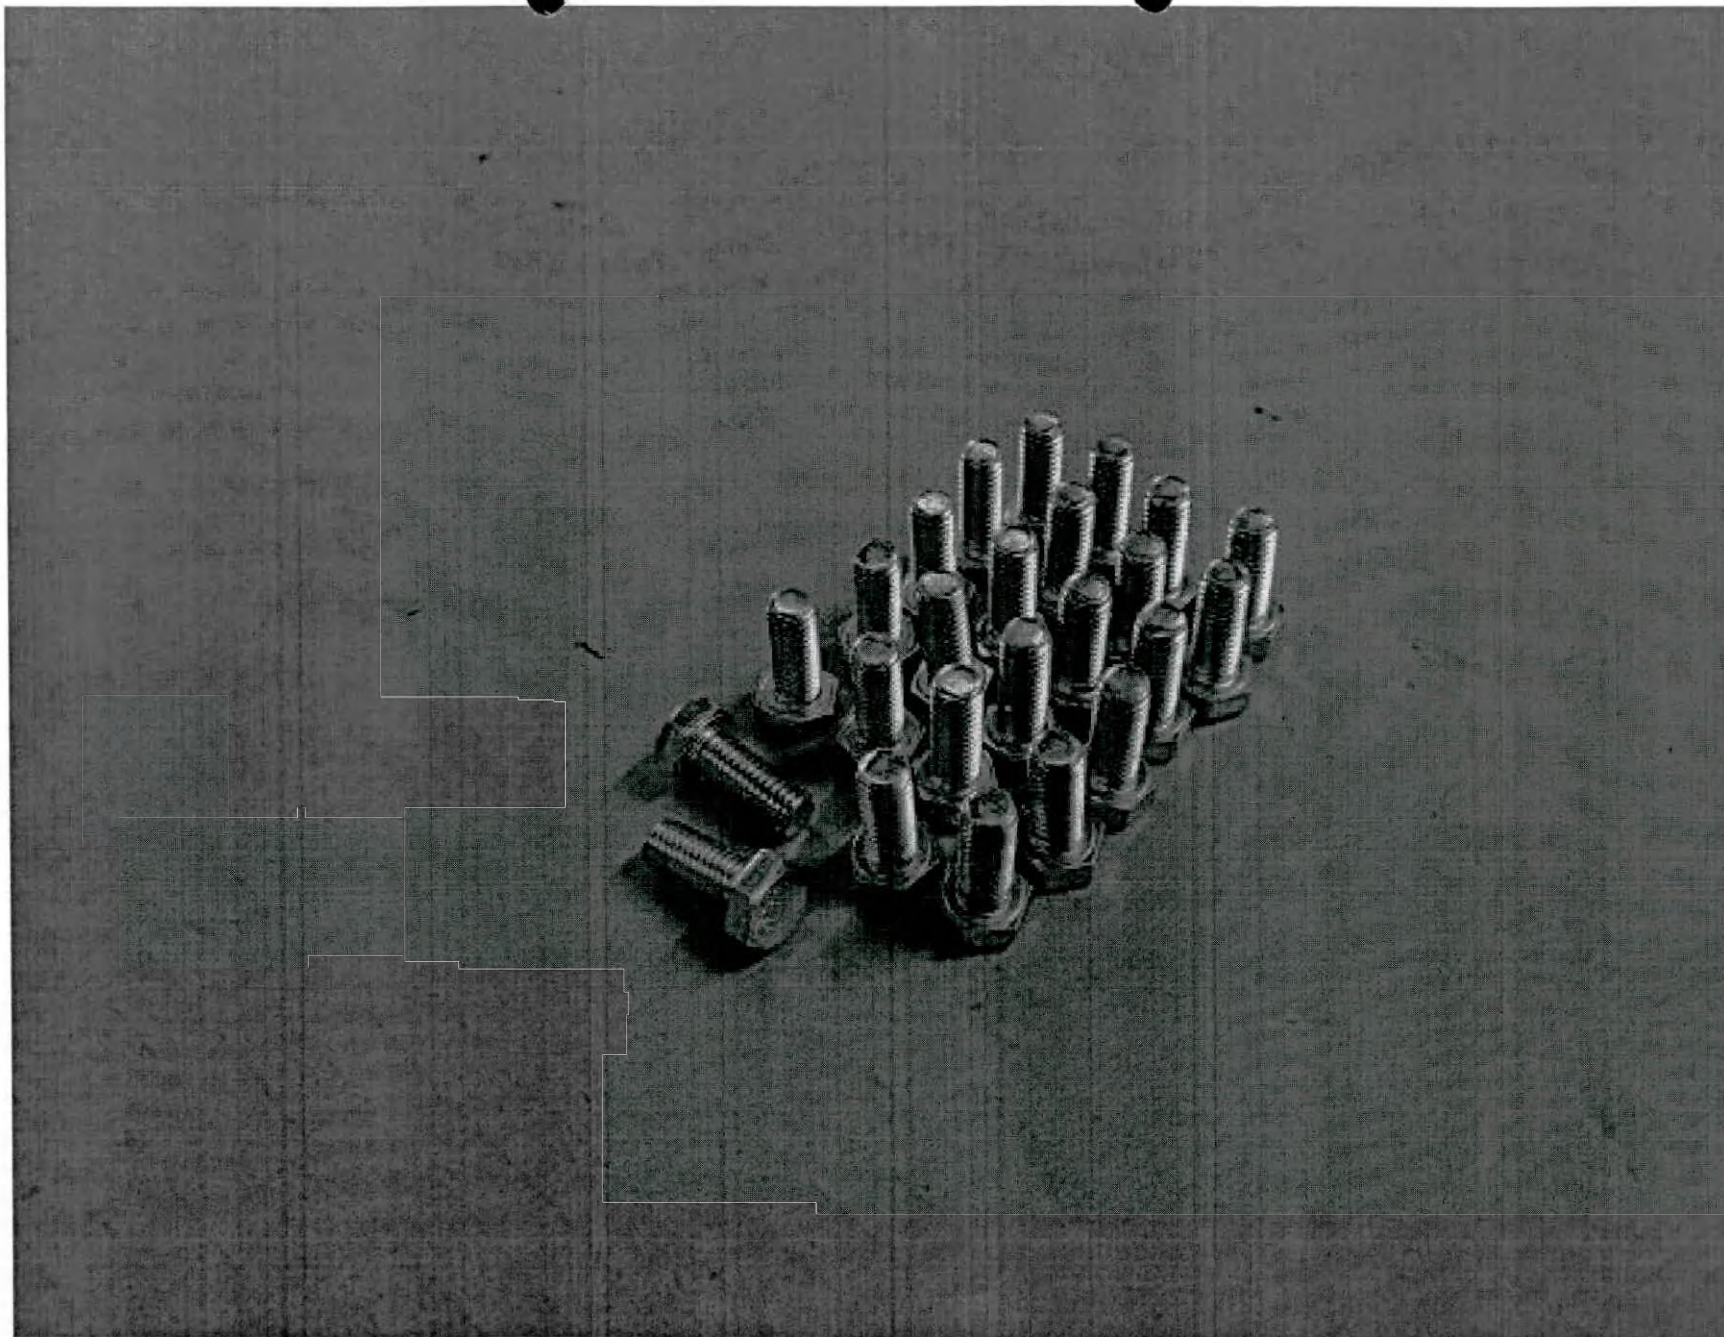


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Болт 8x20

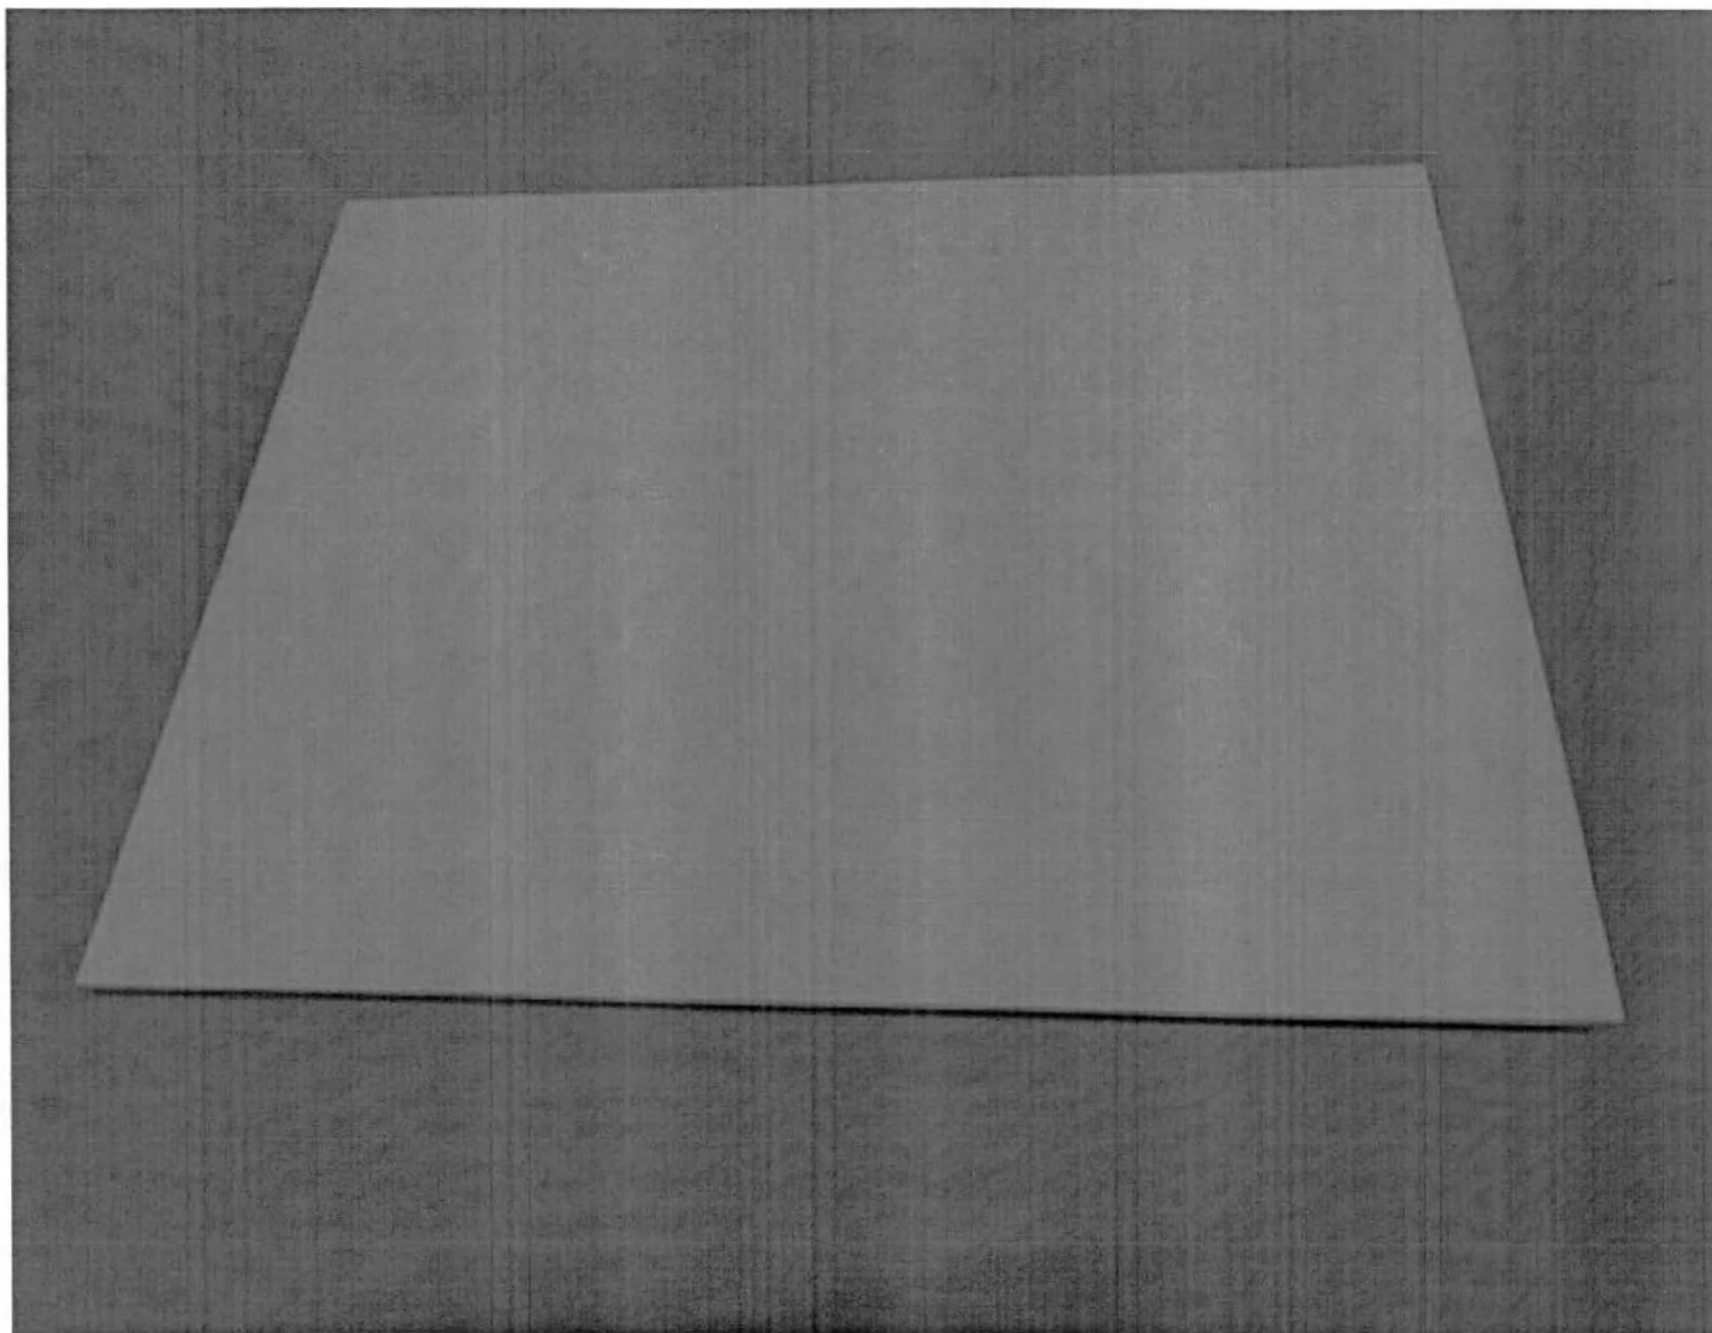


**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Огнеупорная вставка**

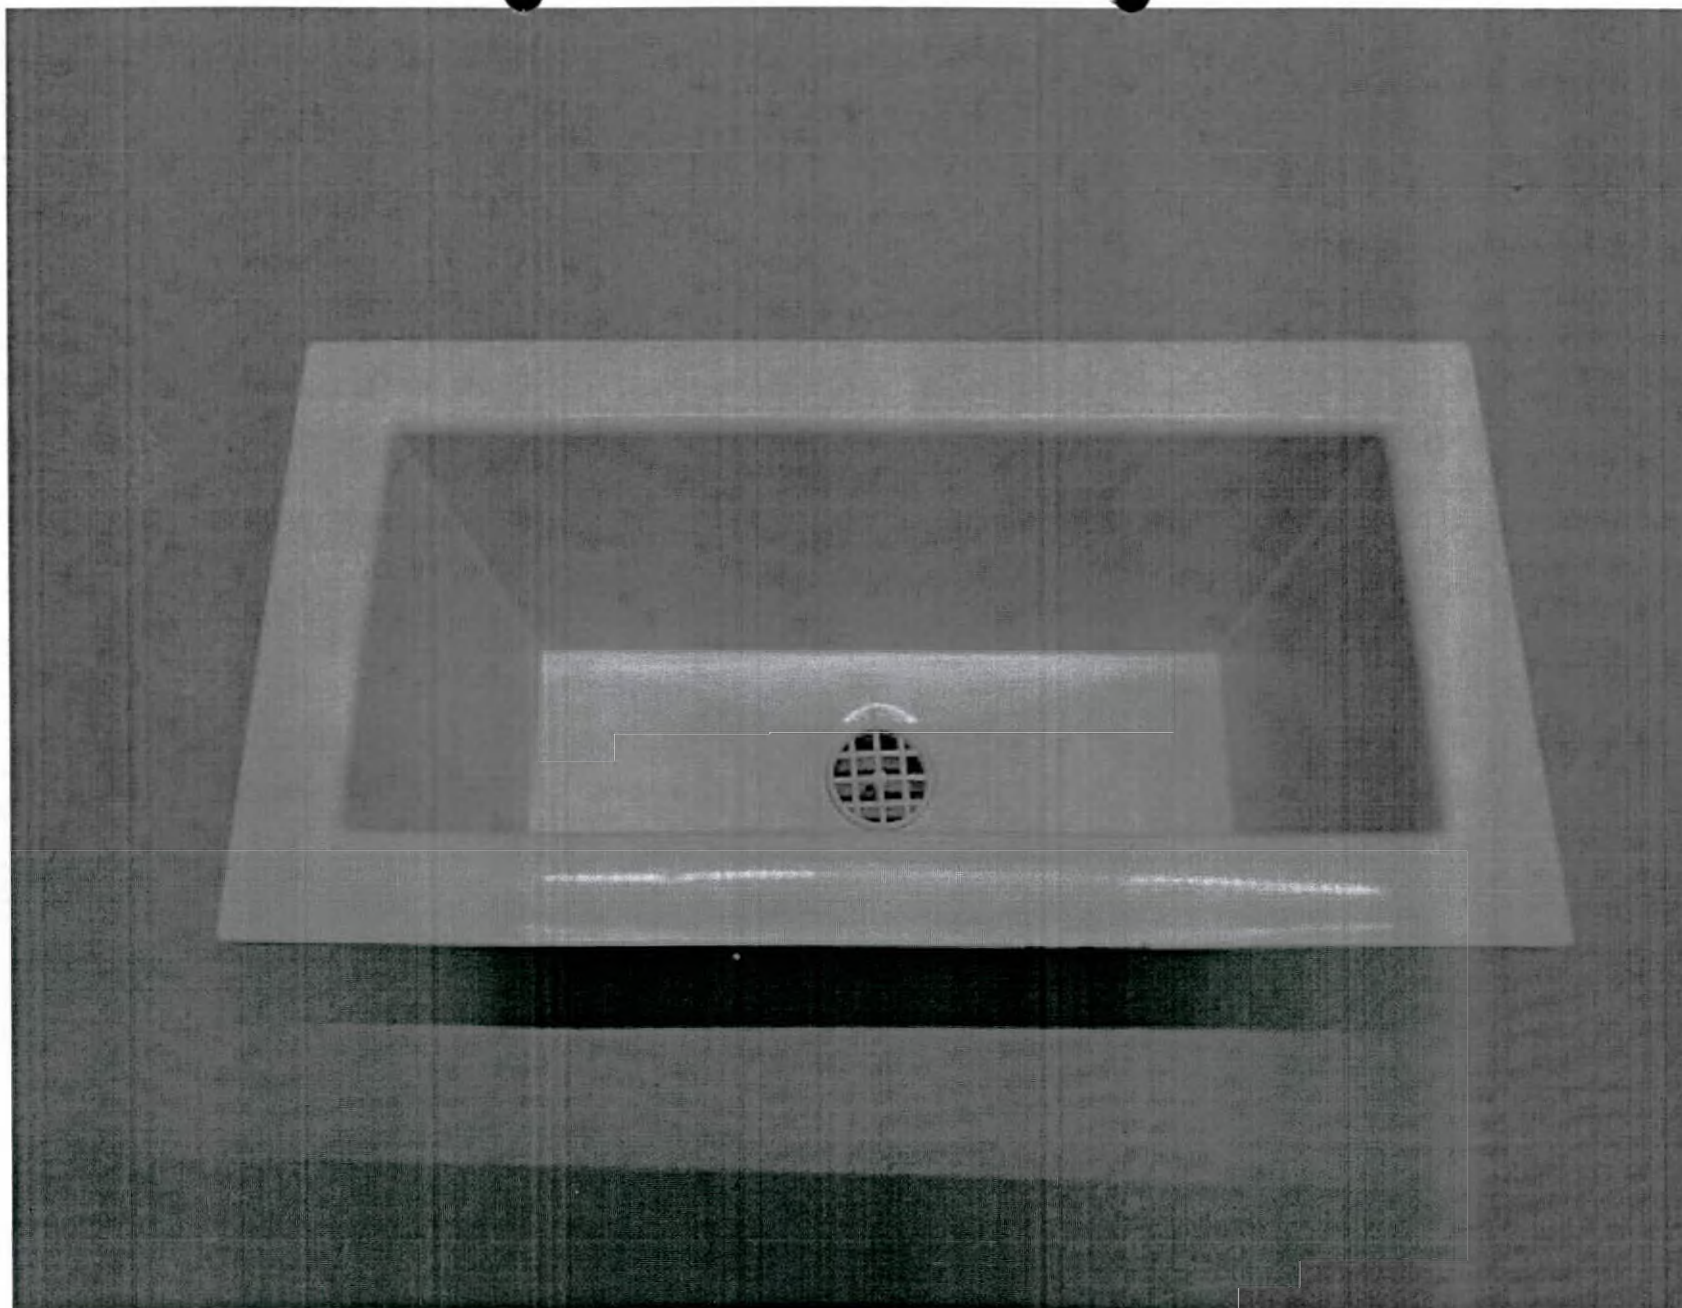


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Мойка

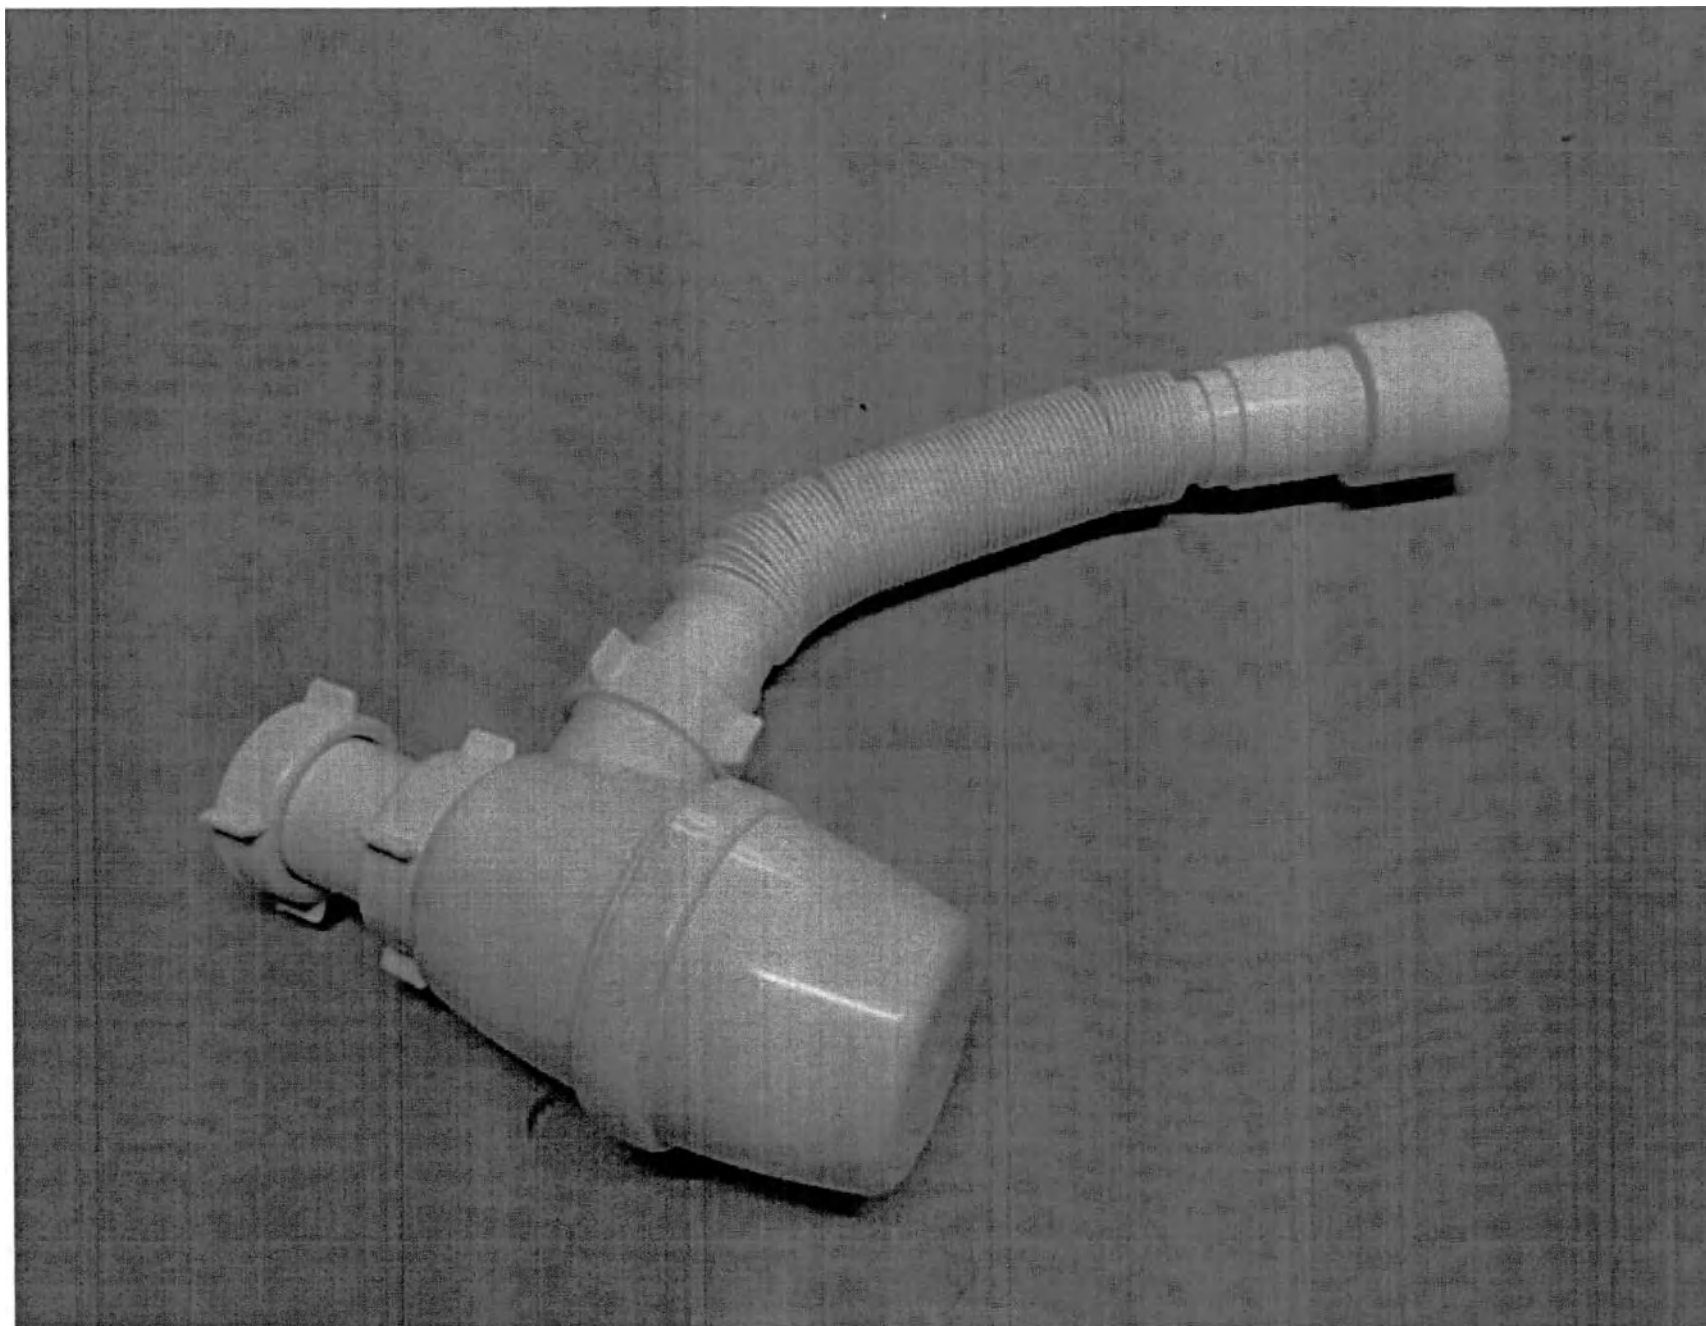

**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Сифон**

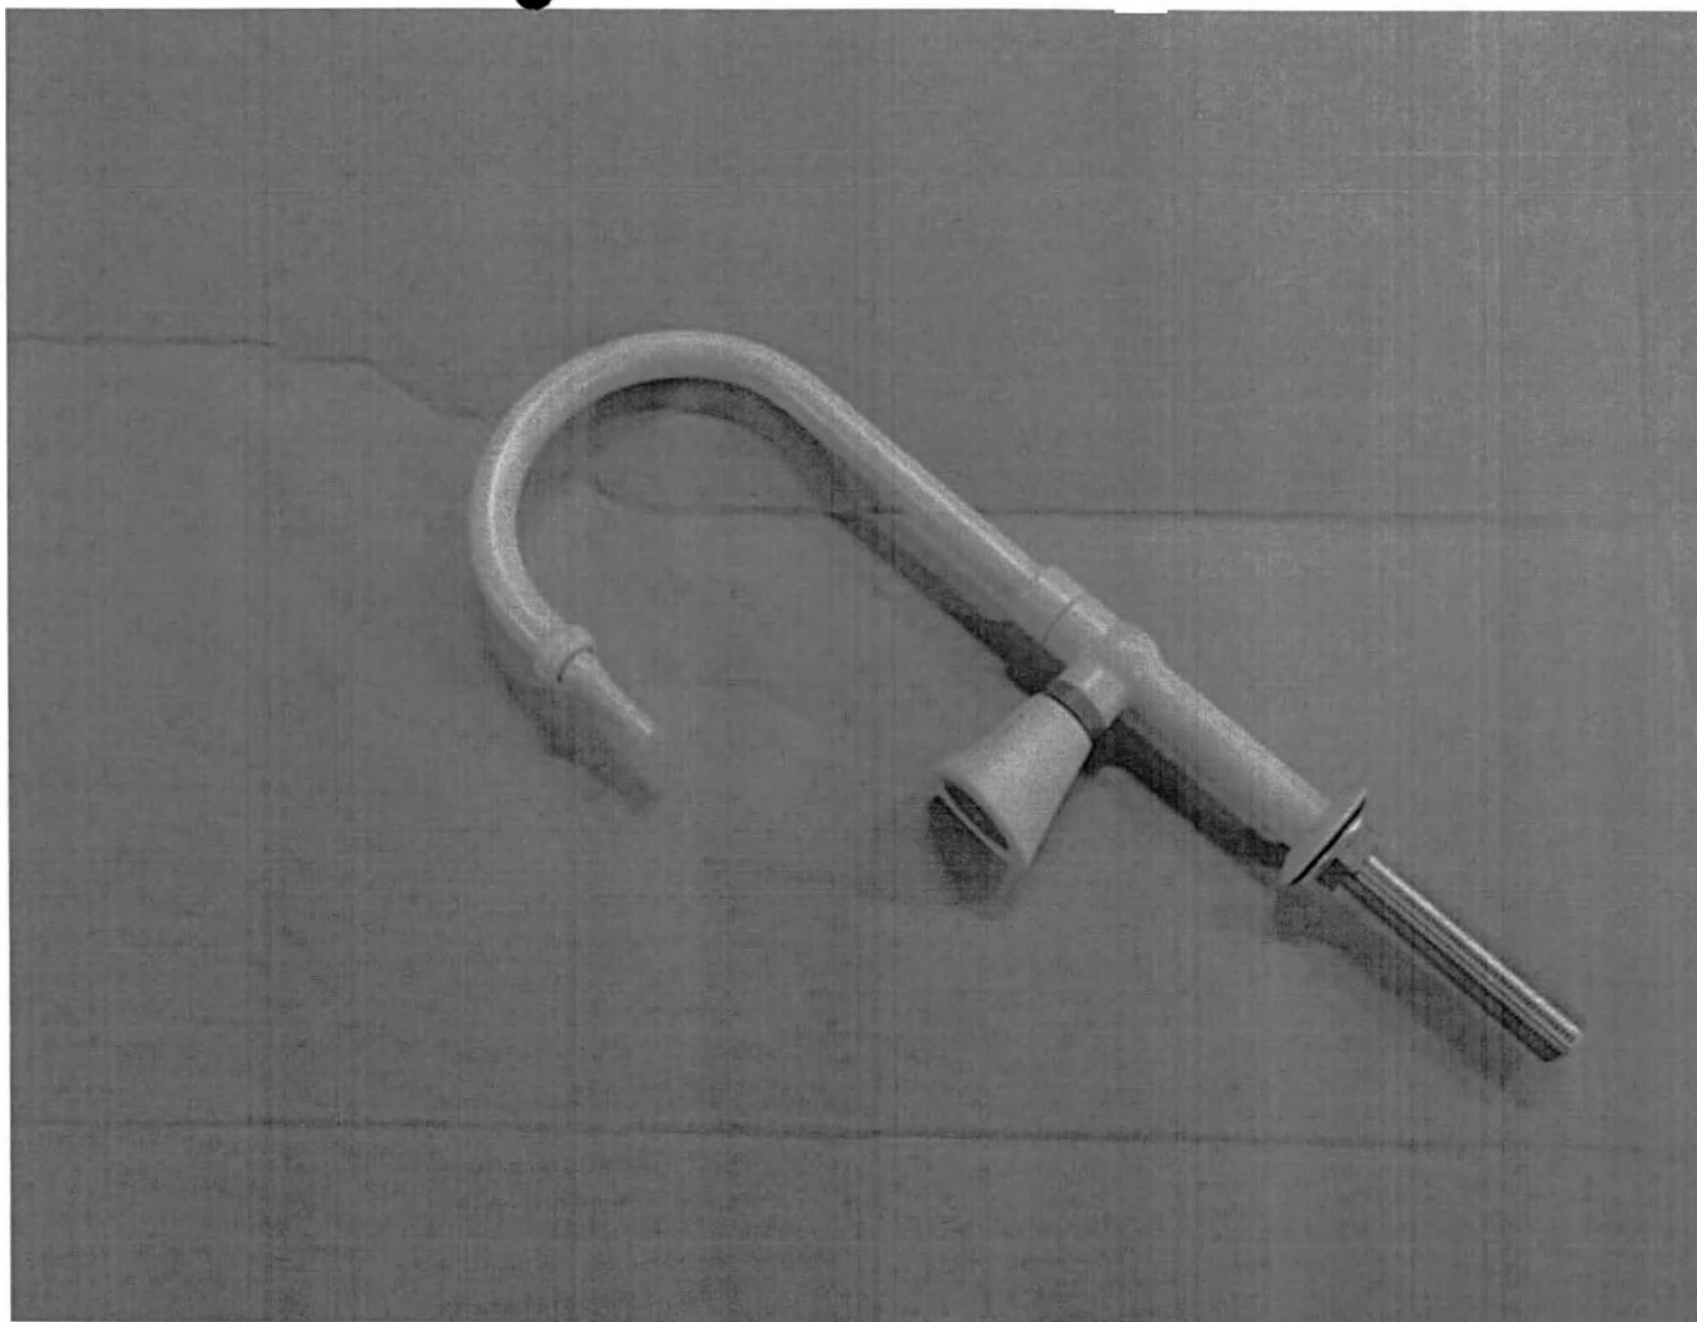


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Смеситель

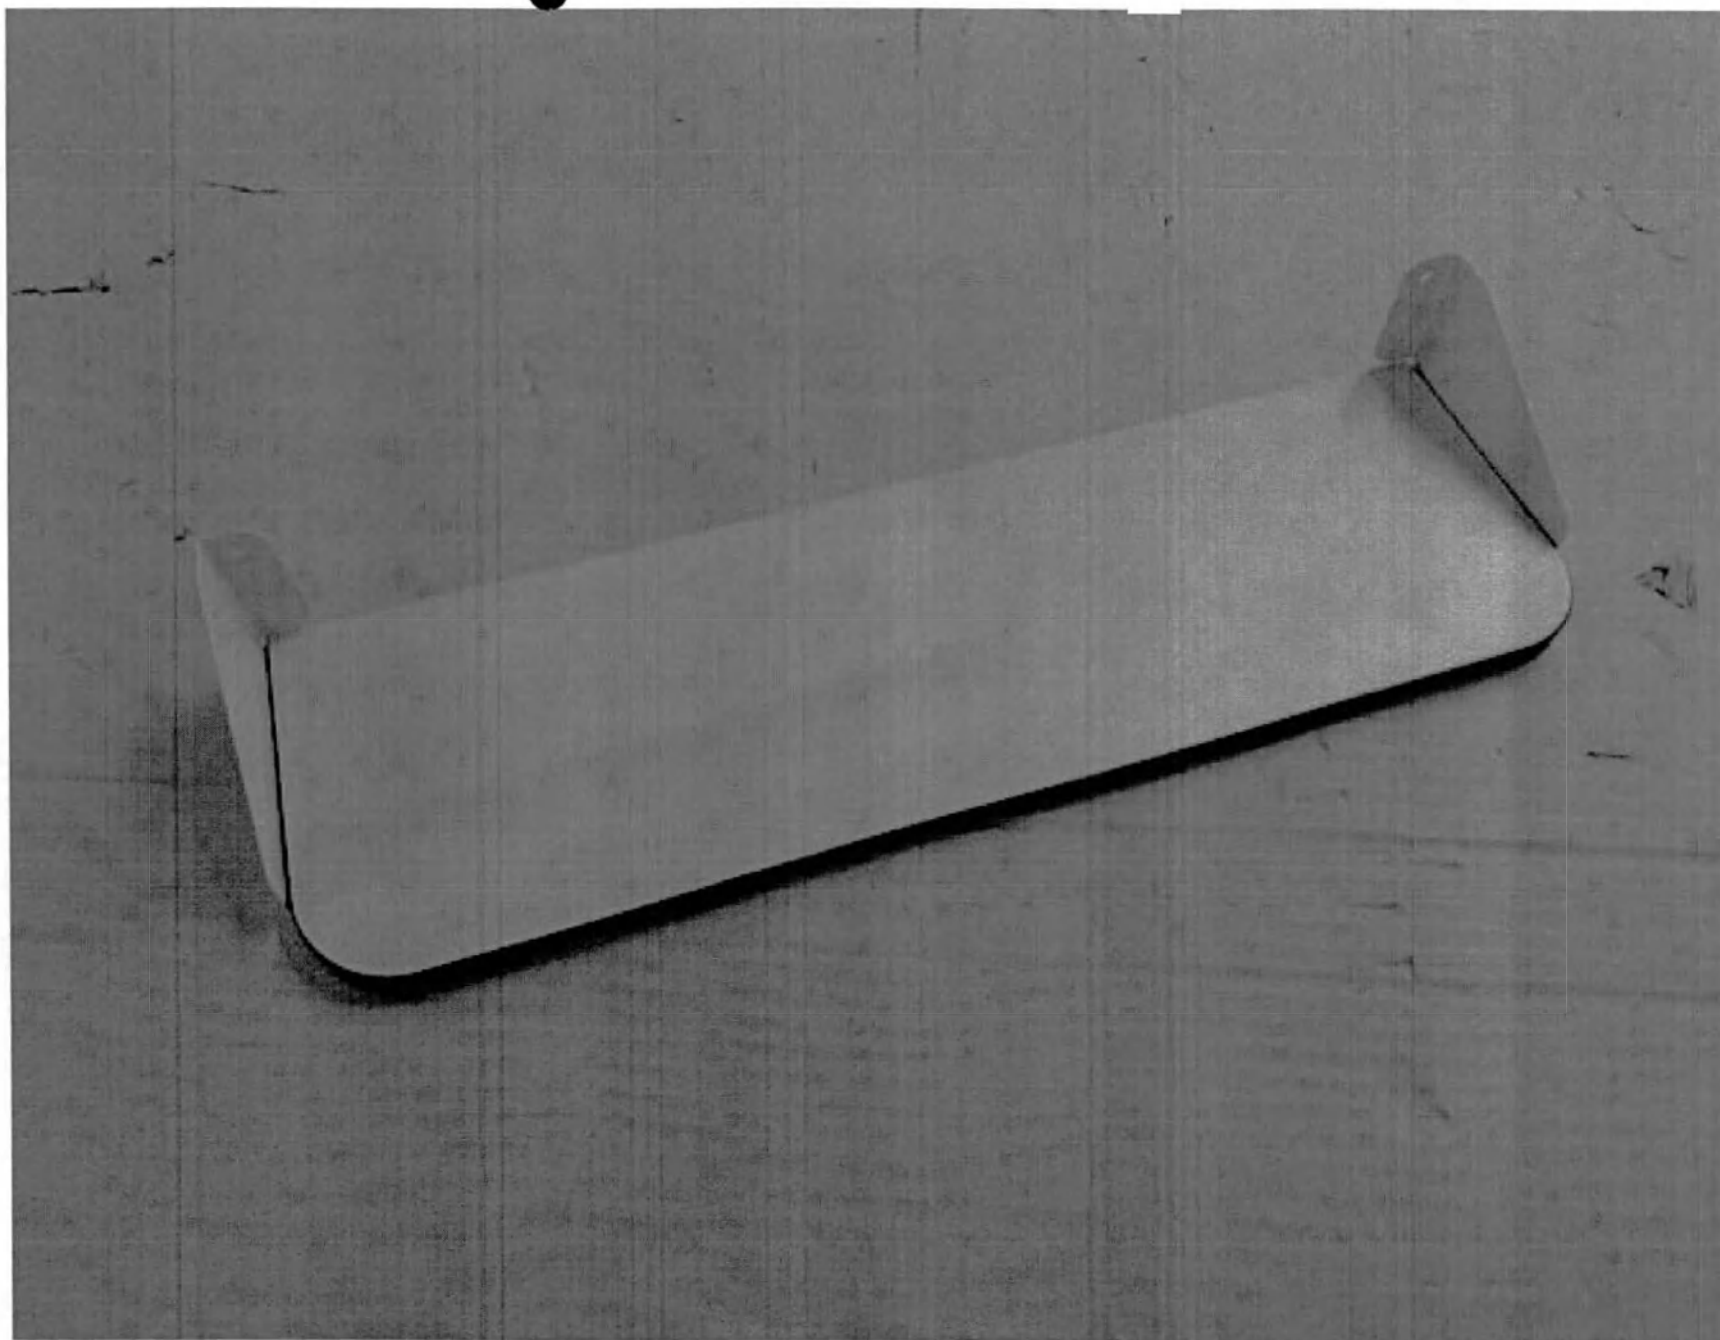


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Принадлежность: Полка боковая




«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022. Принадлежность: Модуль подкатной под мойку ШВМ-2

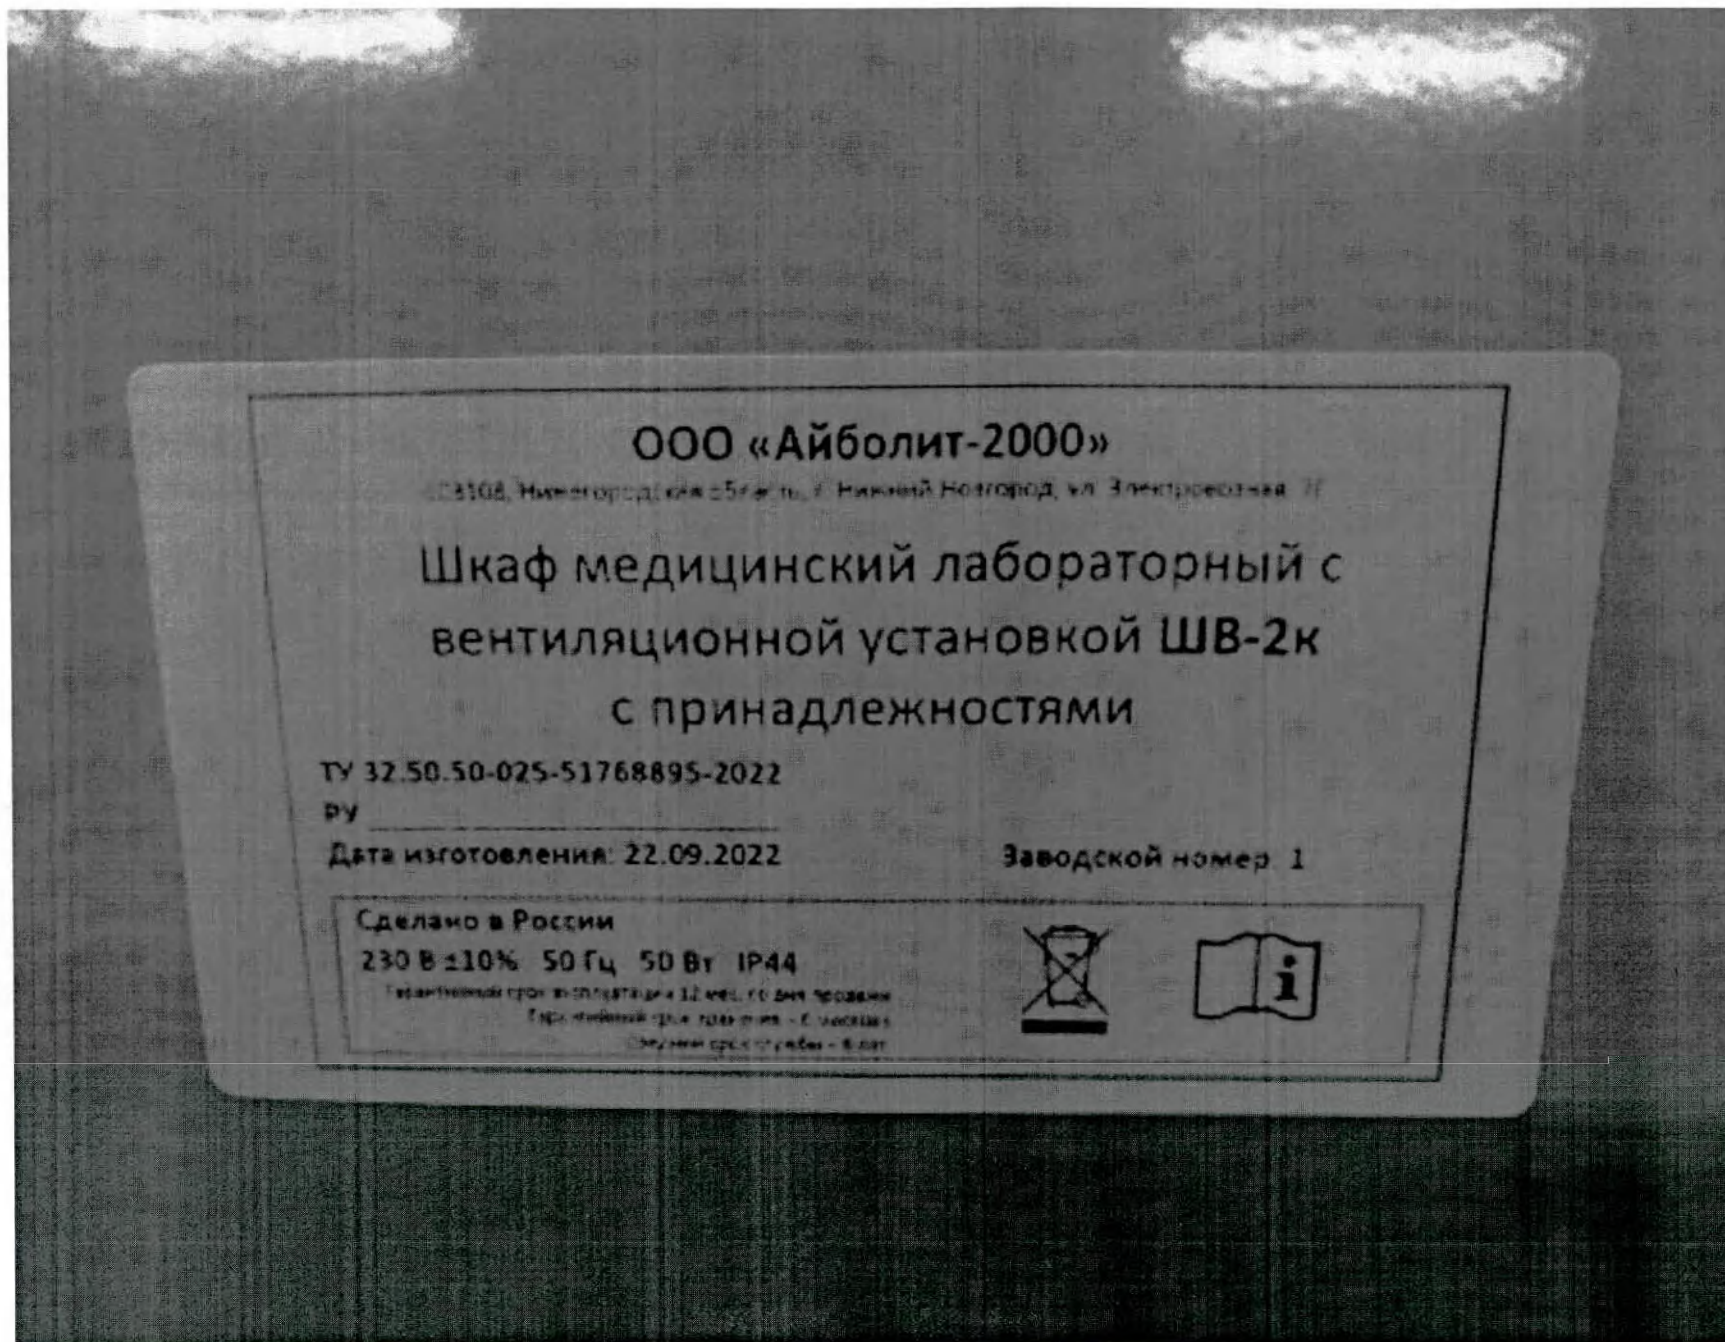


«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка изделия

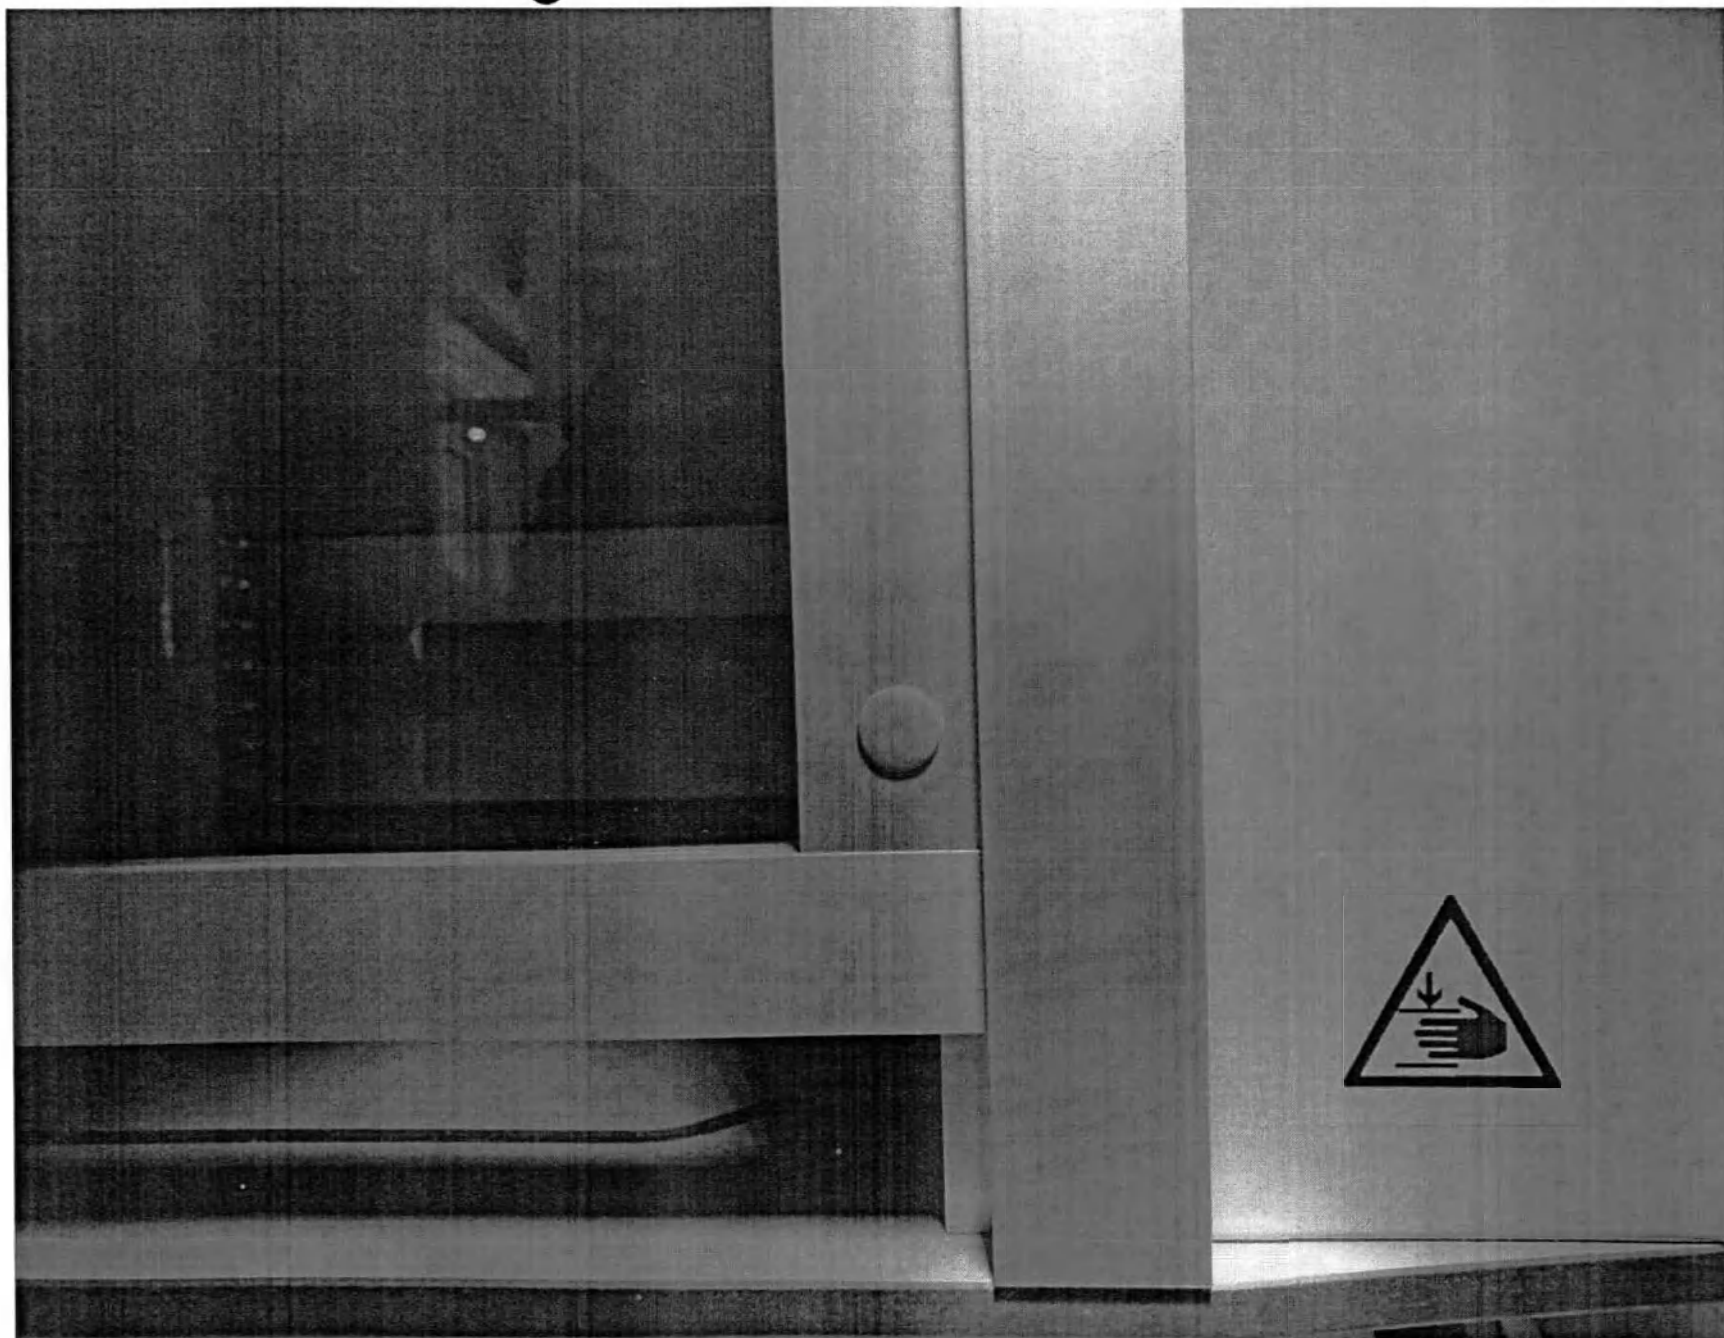

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка изделия. Символ «Опасность повреждения рук».

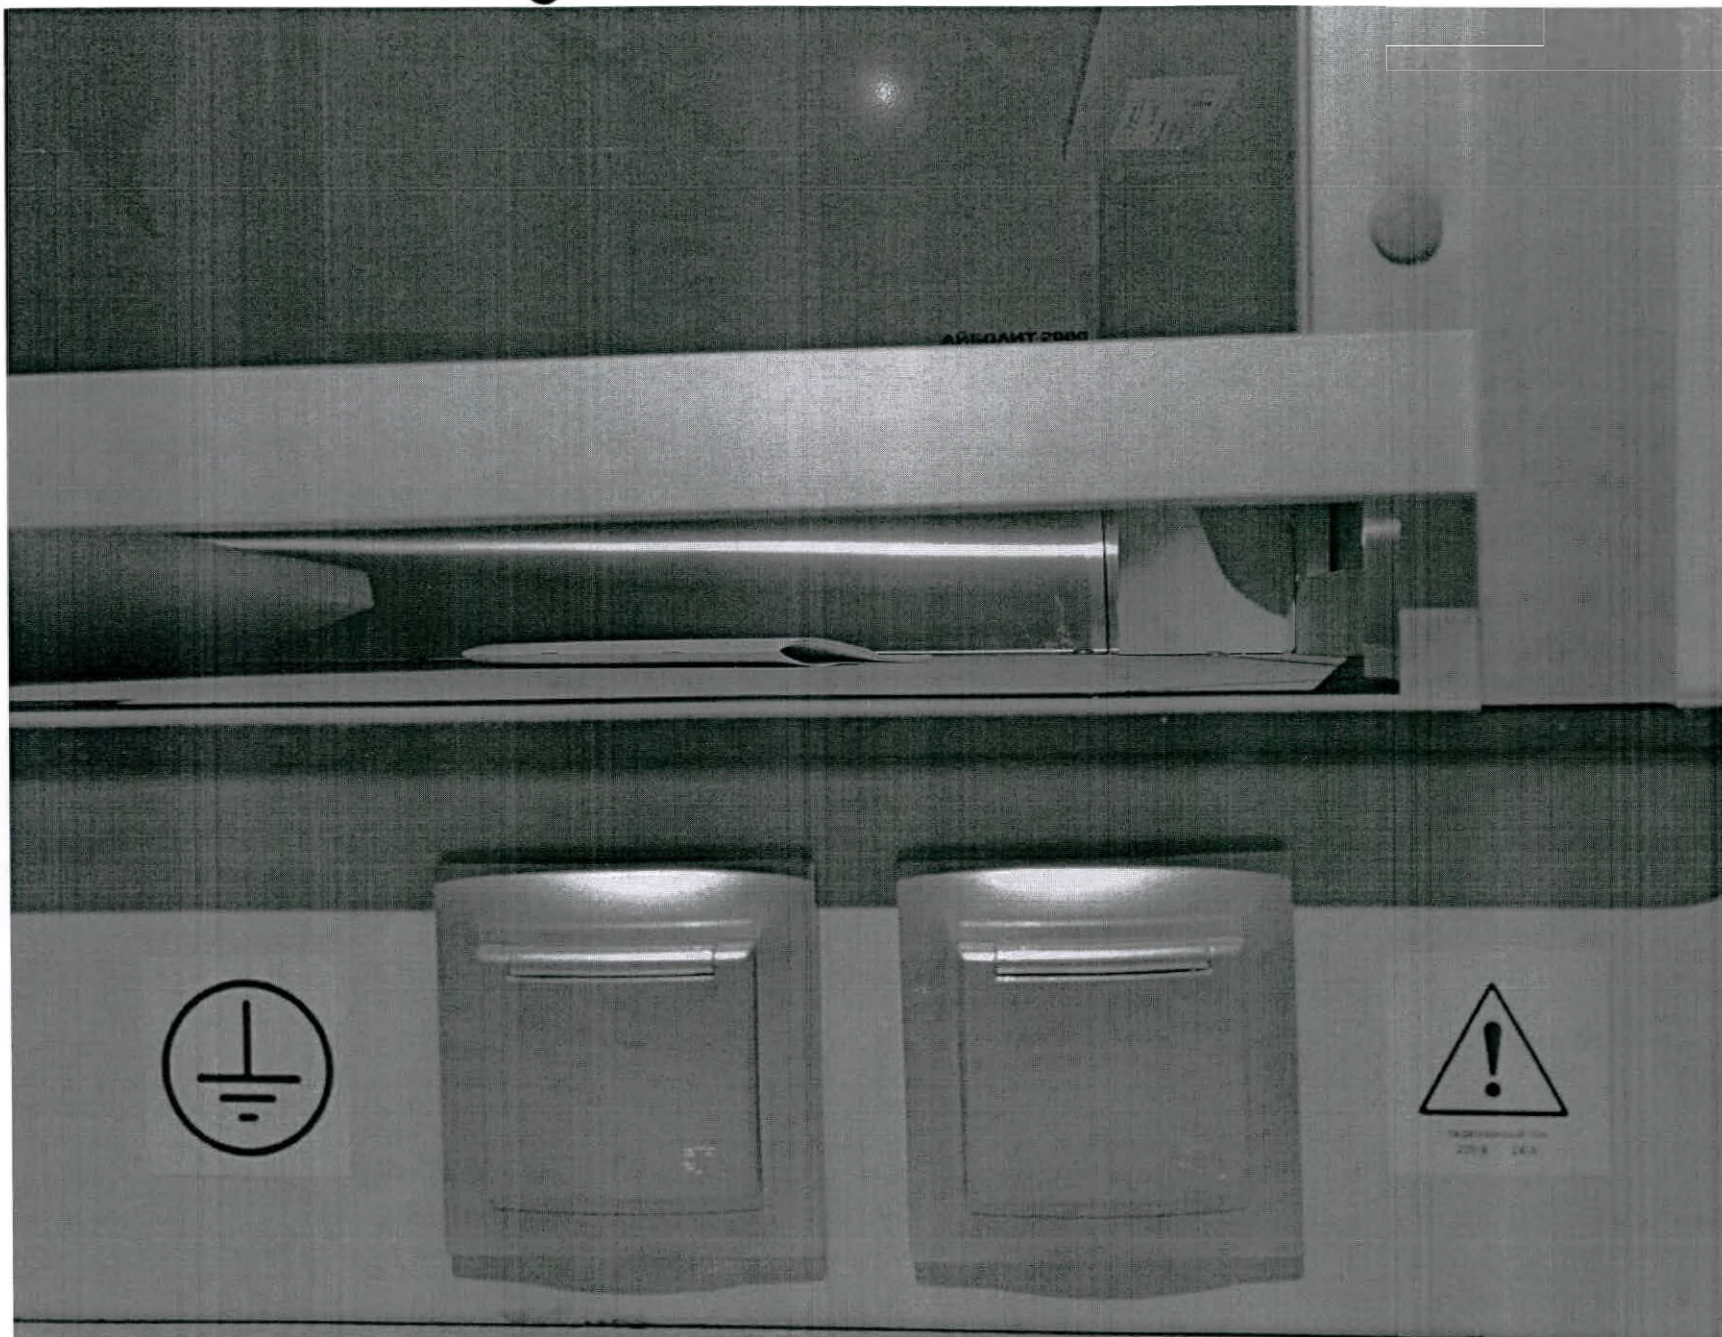

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка розеток

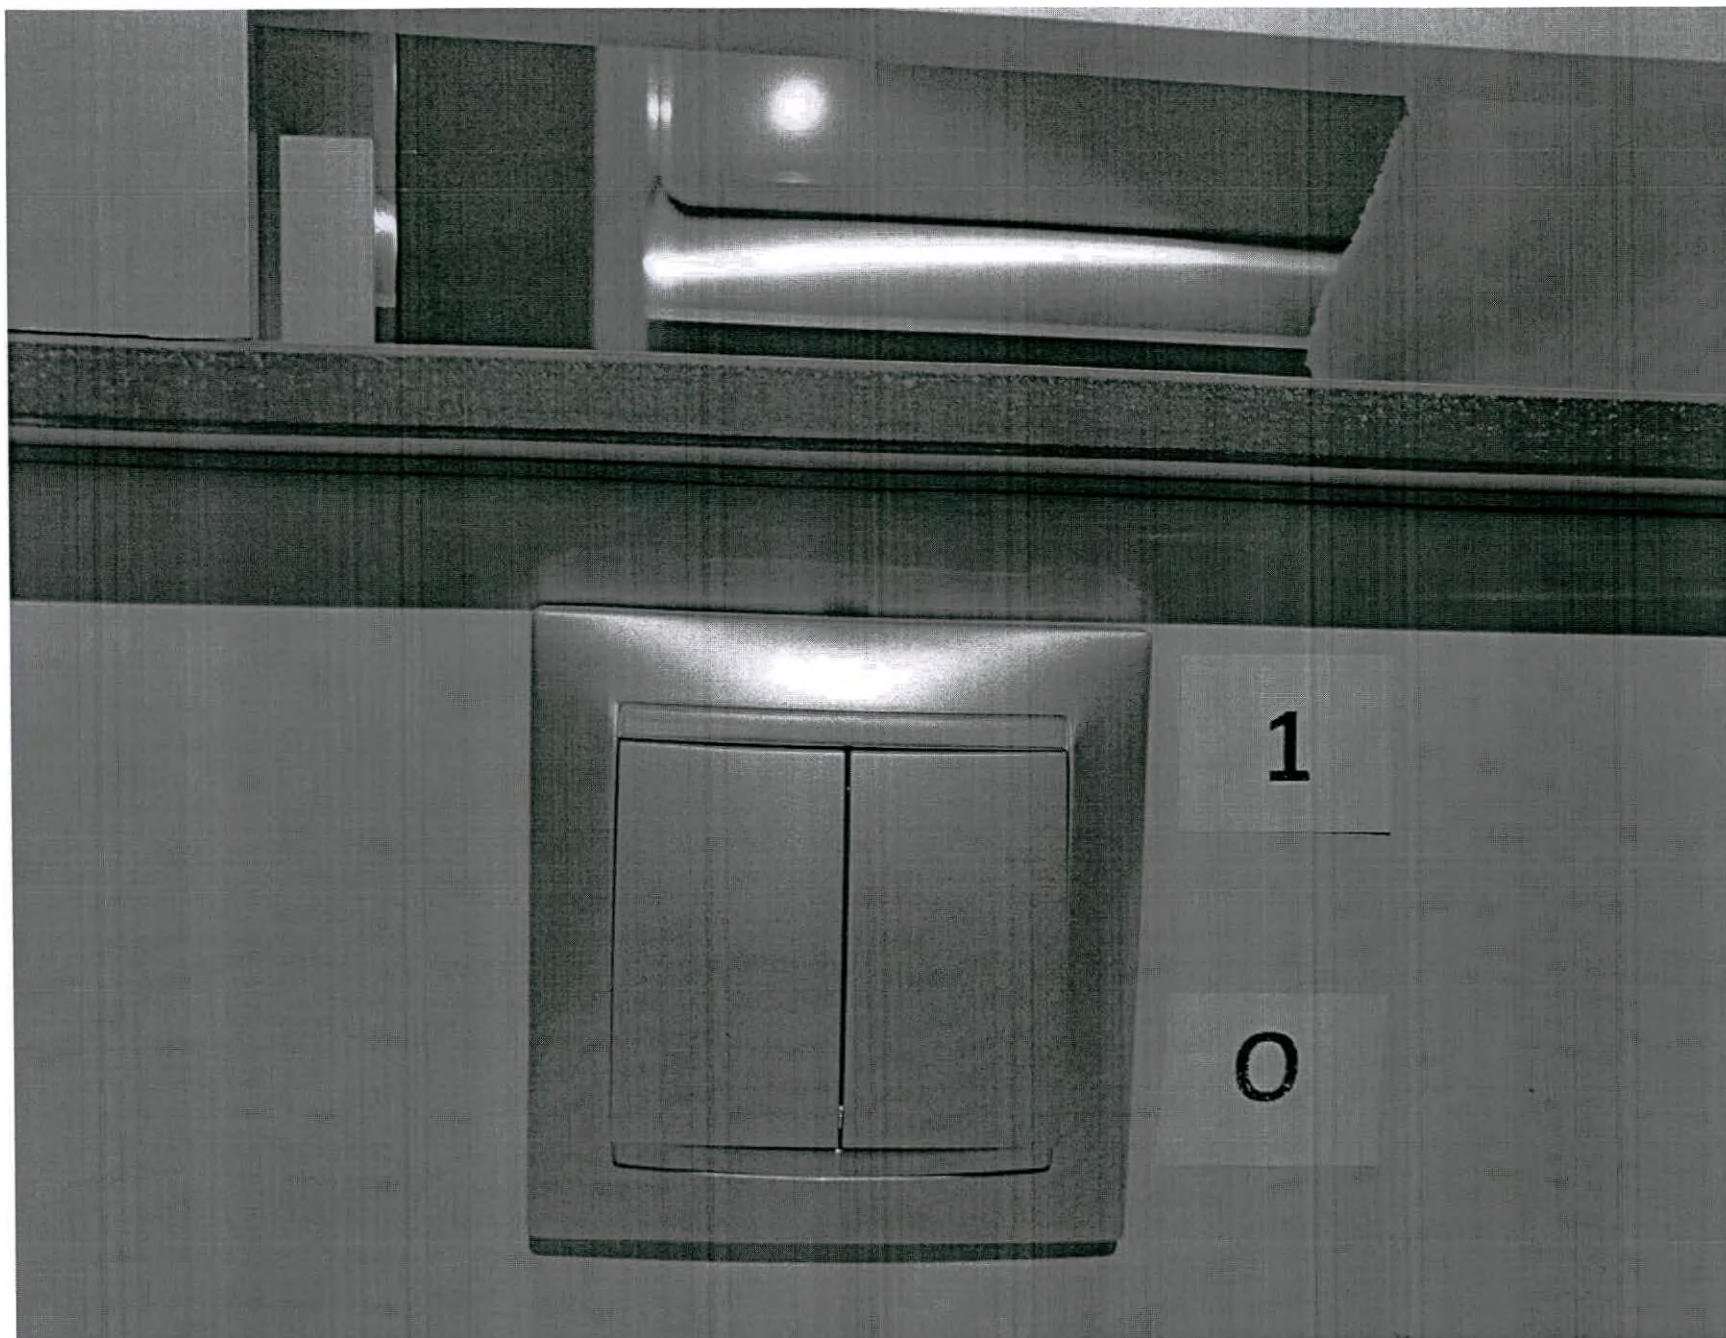

**«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка выключателя**

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7

Полка боковая

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

РУ

Дата изготовления: 22.09.2022 _____ Заводской номер: 4 _____

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

Средний срок службы – 6 лет



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка принадлежности: Полка боковая

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровазная, 77

Модуль подкатной под мойку ШВМ-2

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

РУ

Дата изготовления: 22.09.2022

Заводской номер: 2

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 лет со дня

продажи

Гарантийный срок хранения - в упаковке

Средний срок службы - 5 лет



«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка принадлежности: Модуль подкатной под мойку ШВМ-2

ООО «Айболит-2000»

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями

Пакет 1 из 3

Шкаф

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022



Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА

СЕРЫЙ

ЦВЕТ ПЛАСТИКА

фисташковый

Заводской номер

№1

Дата изготовления

22.09.2022

Комплект поставки:

Камера шкафа в сборе – 1 шт.
Стойка задняя правая – 1 шт.
Стойка задняя левая – 1 шт.
Стойка передняя – 2 шт.
Ляжка – 2 шт.
Стяжка нижняя – 1 шт.
Винт 4х16 комби – 4 шт.
Болты 8х20 – 24 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.
Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВЗНАЯ, Д.71

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №1 Шкаф


ООО «Айболит-2000»

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной
установкой ШВ-2к с принадлежностями

Пакет 2 из 3

Огнеупорная вставка

ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

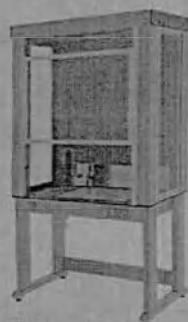

Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА

СЕРЫЙ

ЦВЕТ ПЛАСТИКА

фисташковый

Комплект поставки:

Огнеупорная вставка – 1 шт.

Заводской номер № 1

Дата изготовления 22.09.2022

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.
Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условий хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.
Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.7Г

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №2 Огнеупорная вставка

ООО «Айболит-2000»

Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями



Пакет 3 из 3

Мойка, смеситель, сифон



ТУ 32.50.50-025-51768895-2022

Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА

СЕРЫЙ

ЦВЕТ ПЛАСТИКА

ФИСТАШКОВЫЙ

Заводской номер №1

Дата изготовления 22.09.2022

Комплект поставки:

Мойка – 1 шт.

Смеситель – 1 шт.


Сифон – 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C. Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C. Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.77

«Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

Маркировка потребительской (транспортной) упаковки. Пакет №3 Мойка, смеситель, сифон

ООО «Айболит-2000»
**Шкаф медицинский лабораторный
с вентиляционной установкой с принадлежностями**



Пакет 1 из 1
Модуль подкатной
под мойку ШВМ-2
ТУ 32.50.50-025-51768895-2022



Регистрационное удостоверение _____

ЦВЕТ КОРПУСА **СЕРЫЙ**
ЦВЕТ ПЛАСТИКА **ФИСТАШКОВЫЙ**

Заводской номер №2

Дата изготовления 22.09.2022


Комплект поставки:
Модуль подкатной под мойку ШВМ-2 – 1 шт.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.
Изделие в транспортной таре следует хранить в отапливаемых хранилищах в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150: температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; относительная влажность до 80%, при температуре 25°C.
Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д.7Г


Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.
Маркировка потребительской (транспортной) упаковки принадлежности: Модуль подкатной под мойку ШВМ-2




Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия: пакет №1 Шкаф, на примере, для варианта исполнения «Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

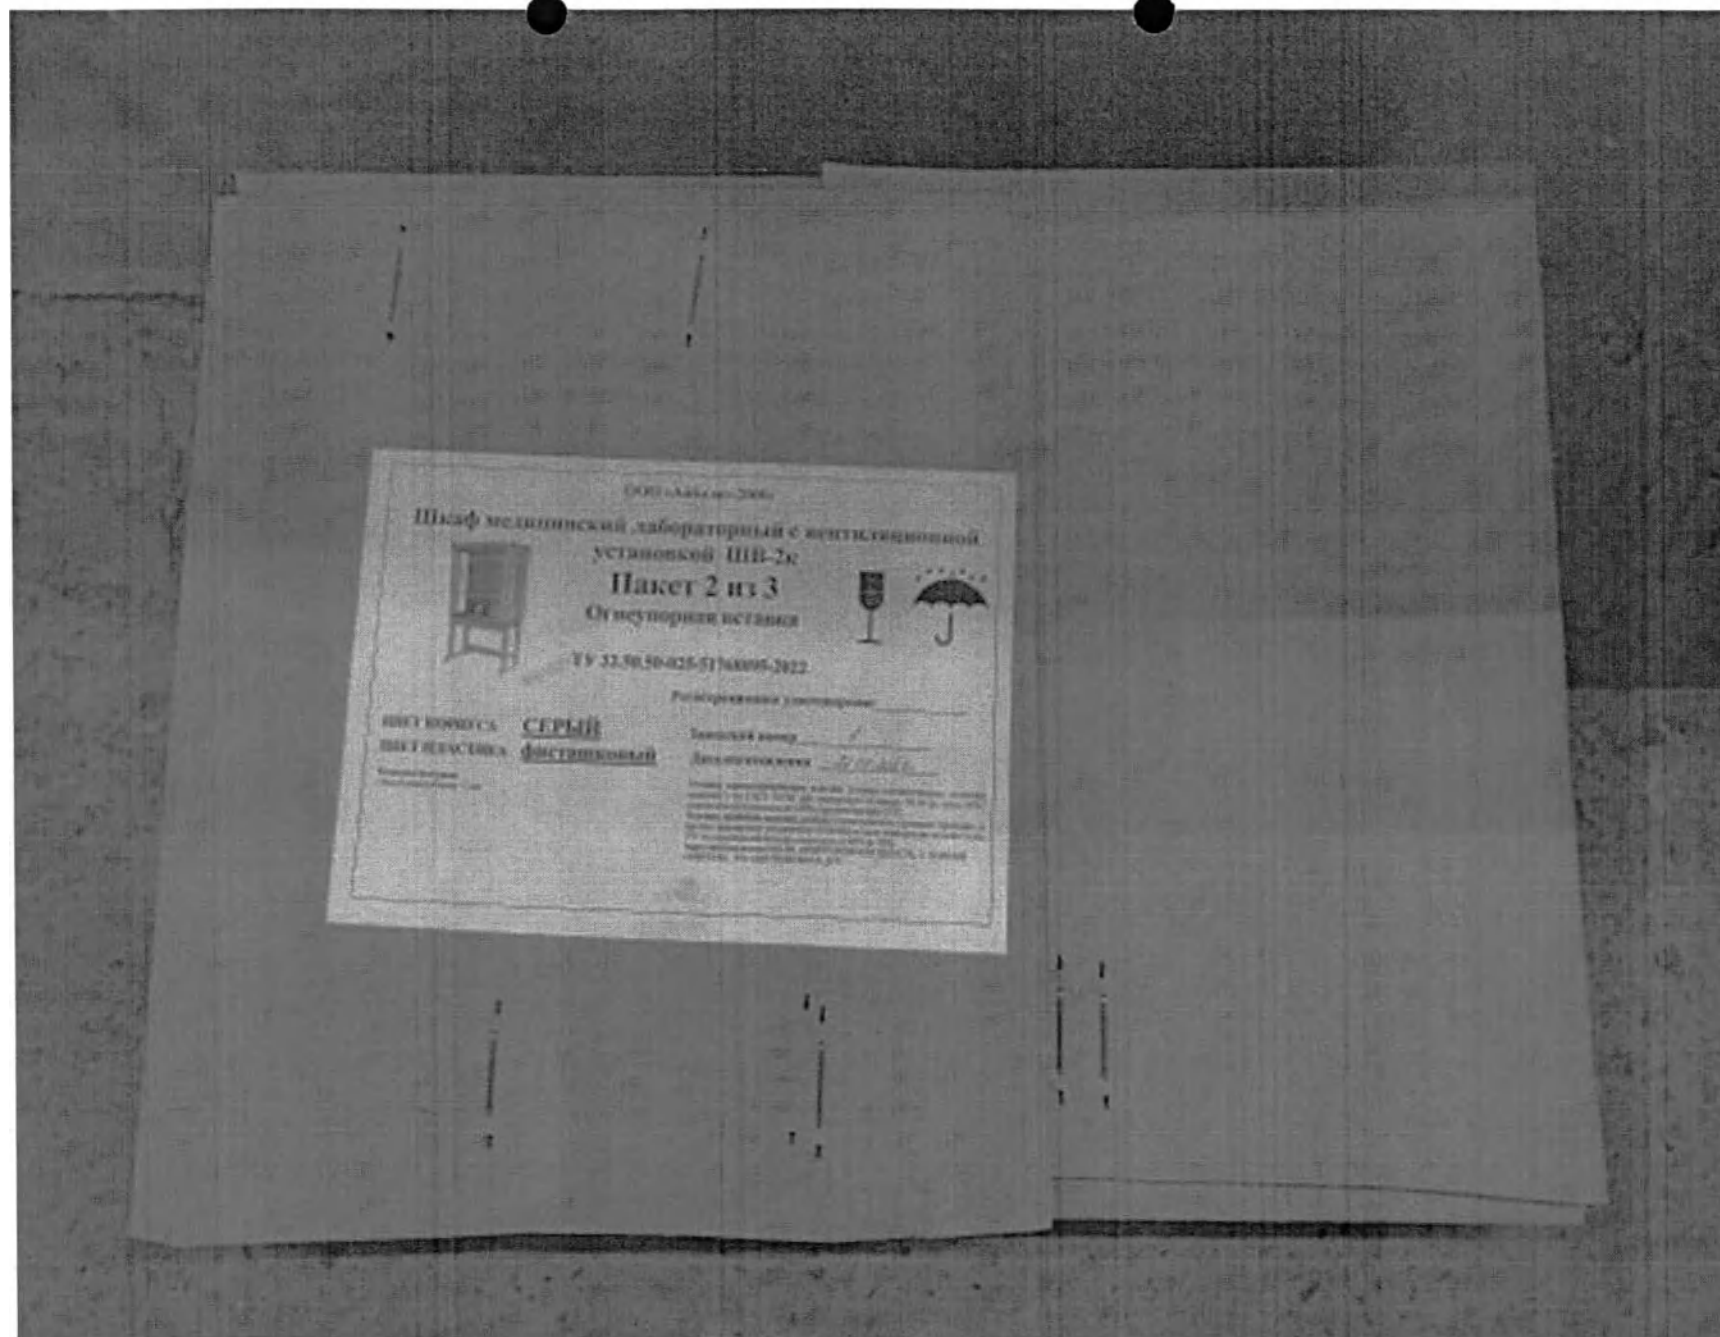


Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия: пакет №2 Огнеупорная вставка, на примере, для варианта исполнения «Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

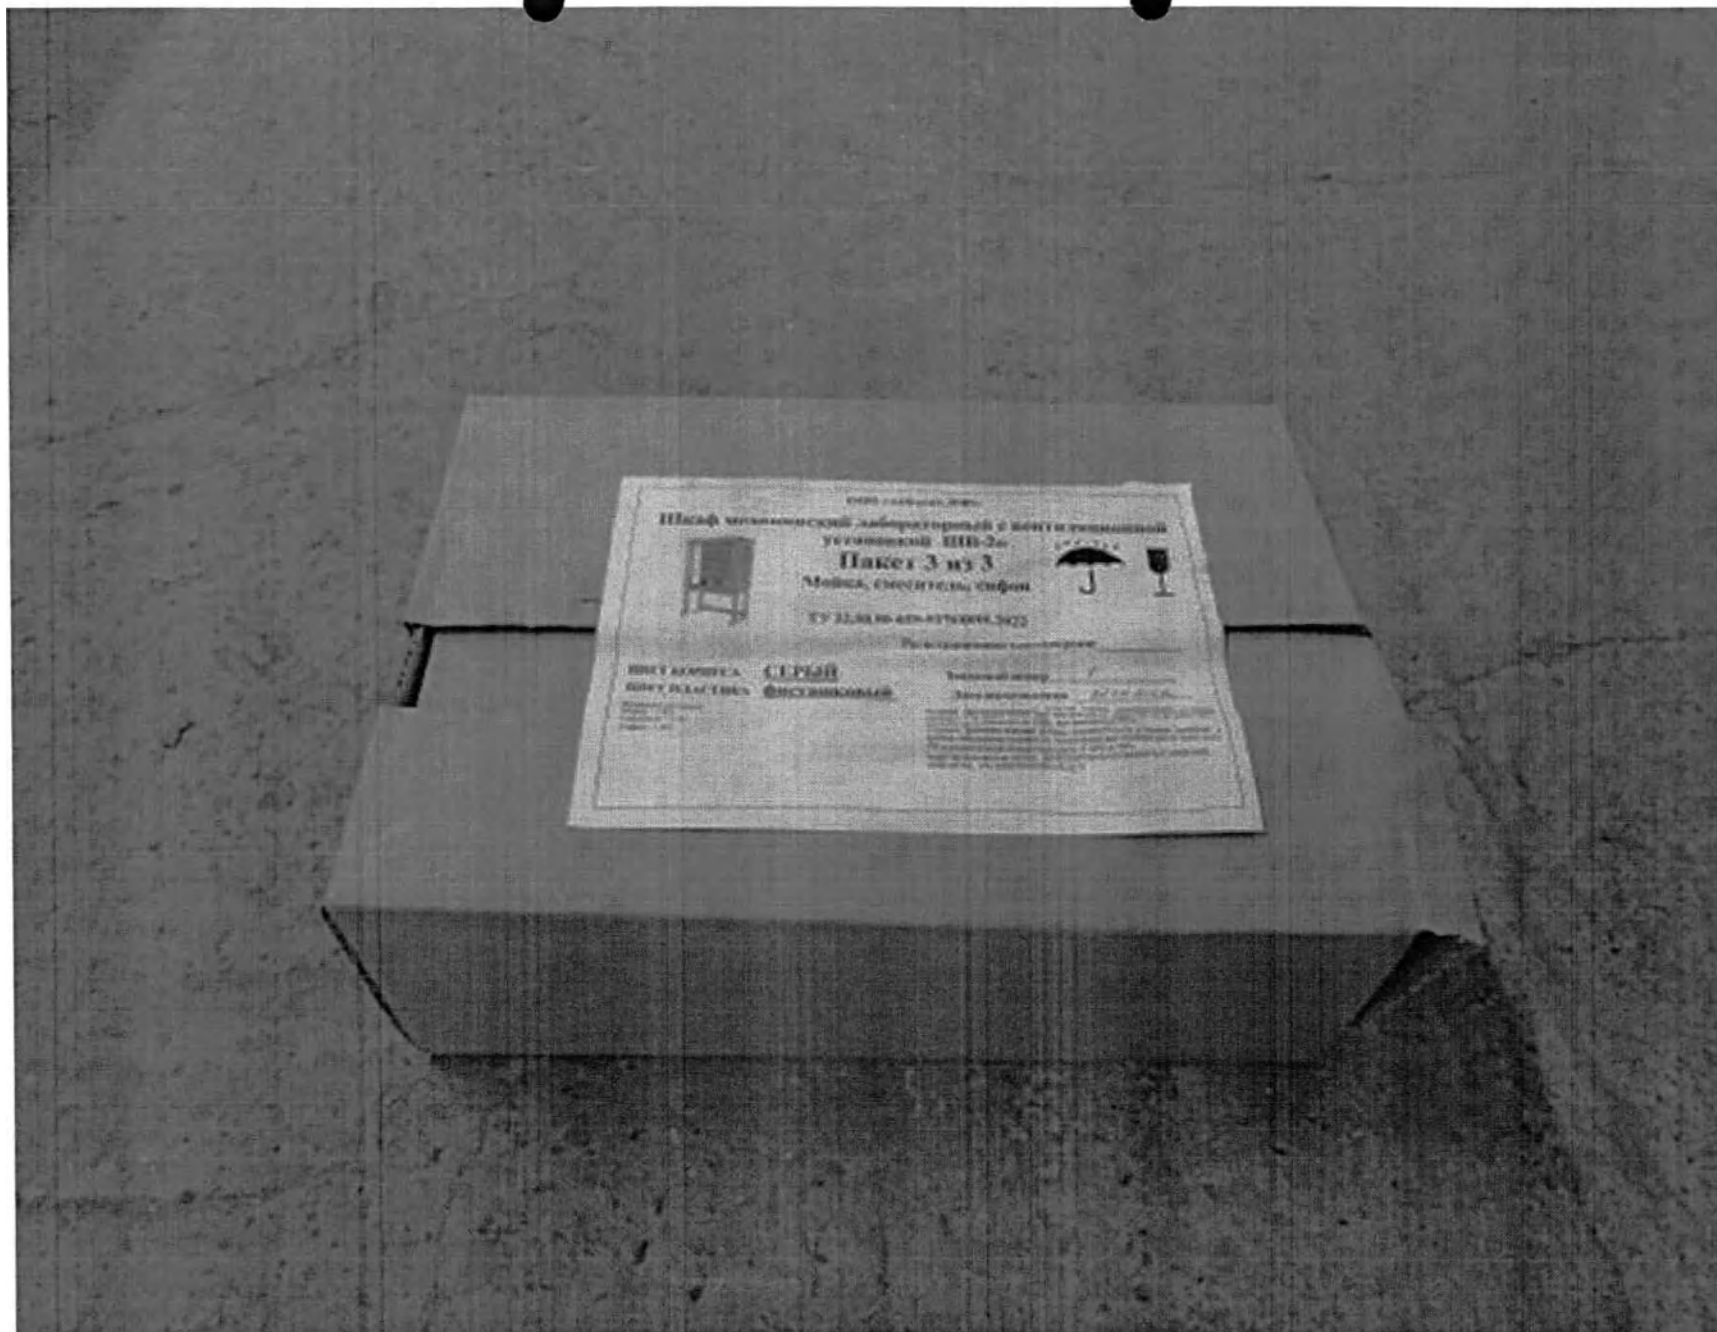

Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия: пакет №3 Мойка, смеситель, сифон, на примере, для варианта исполнения «Шкаф медицинский лабораторный с вентиляционной установкой ШВ-2к с принадлежностями» ТУ 32.50.50-025-51768895-2022.

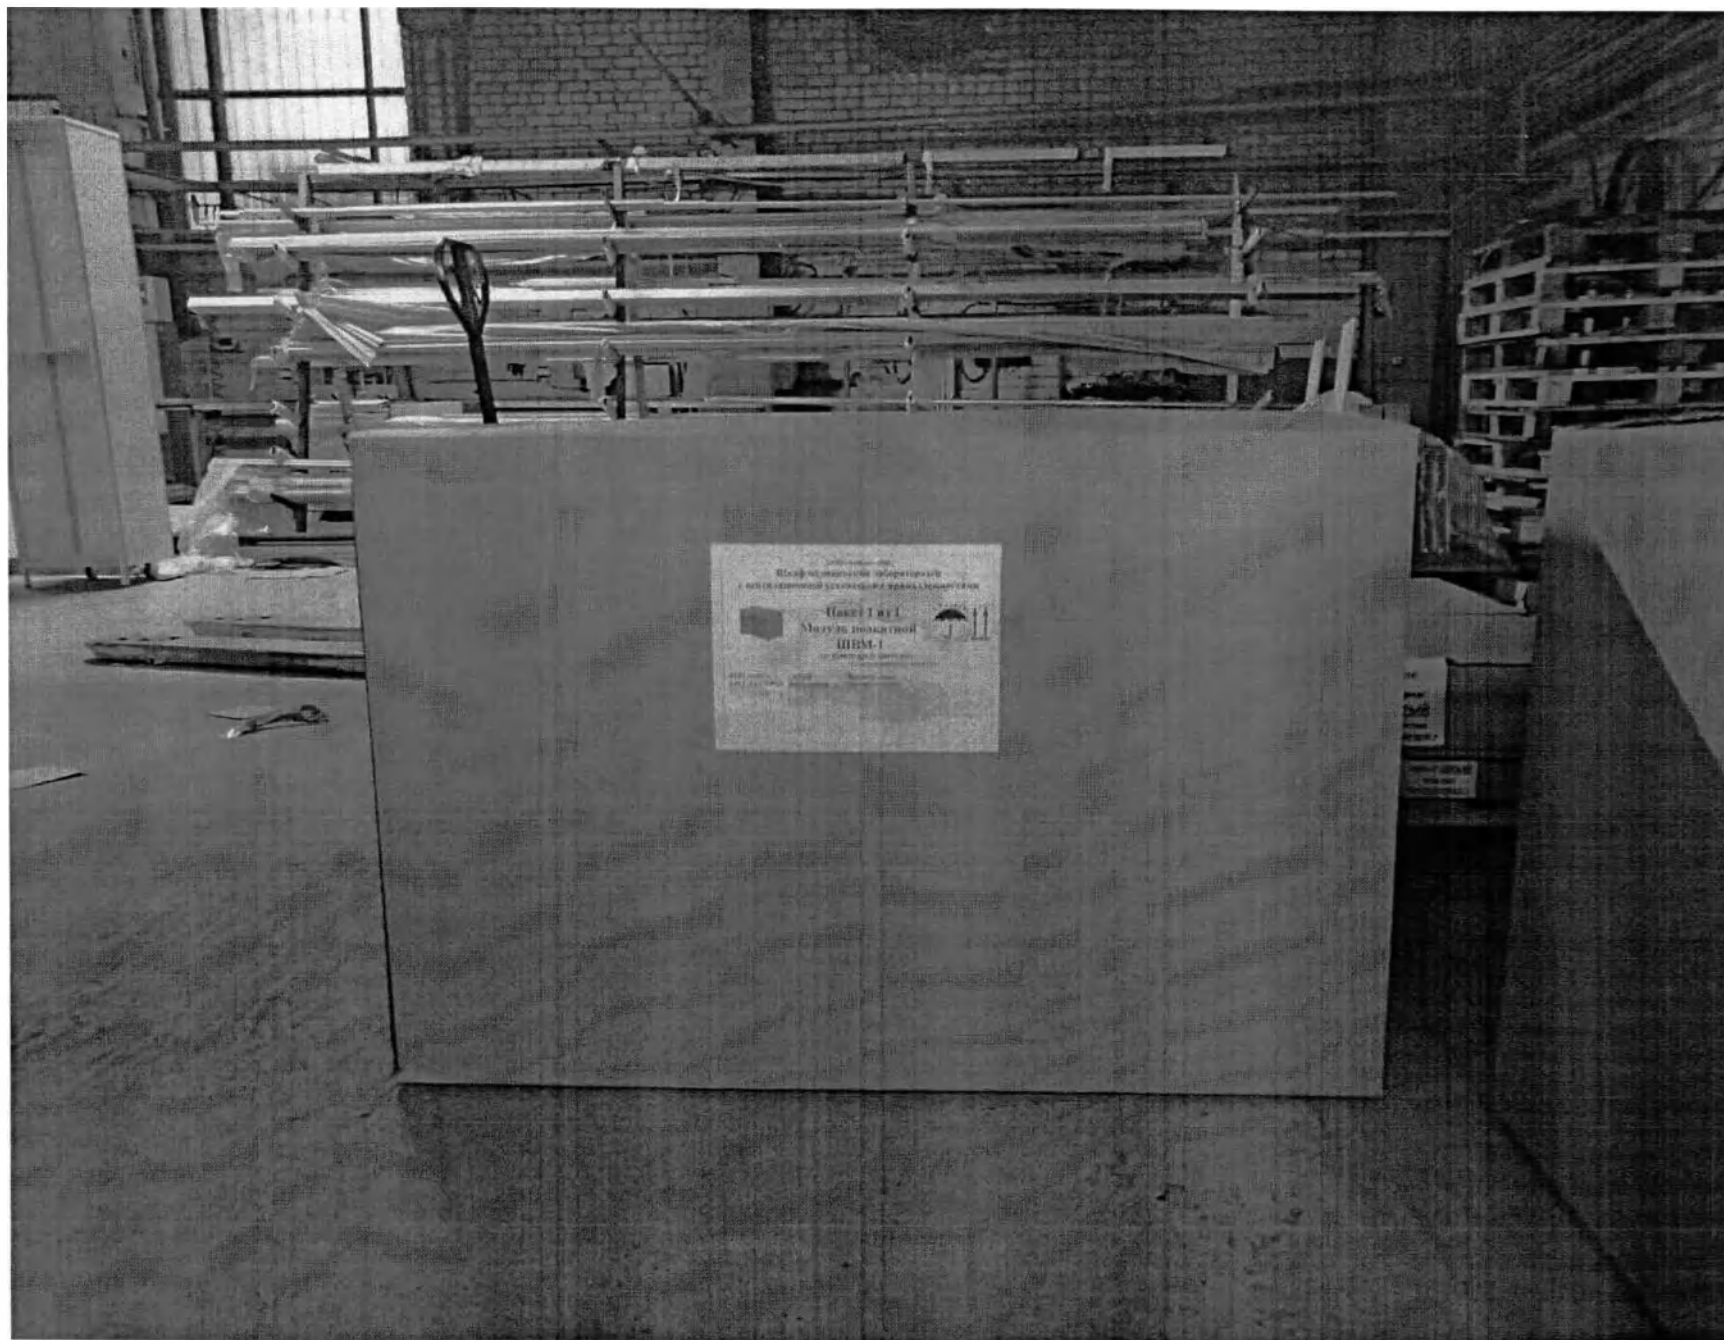

Общий вид потребительской (транспортной) упаковки принадлежности: Модуль подкатной ШВМ-1

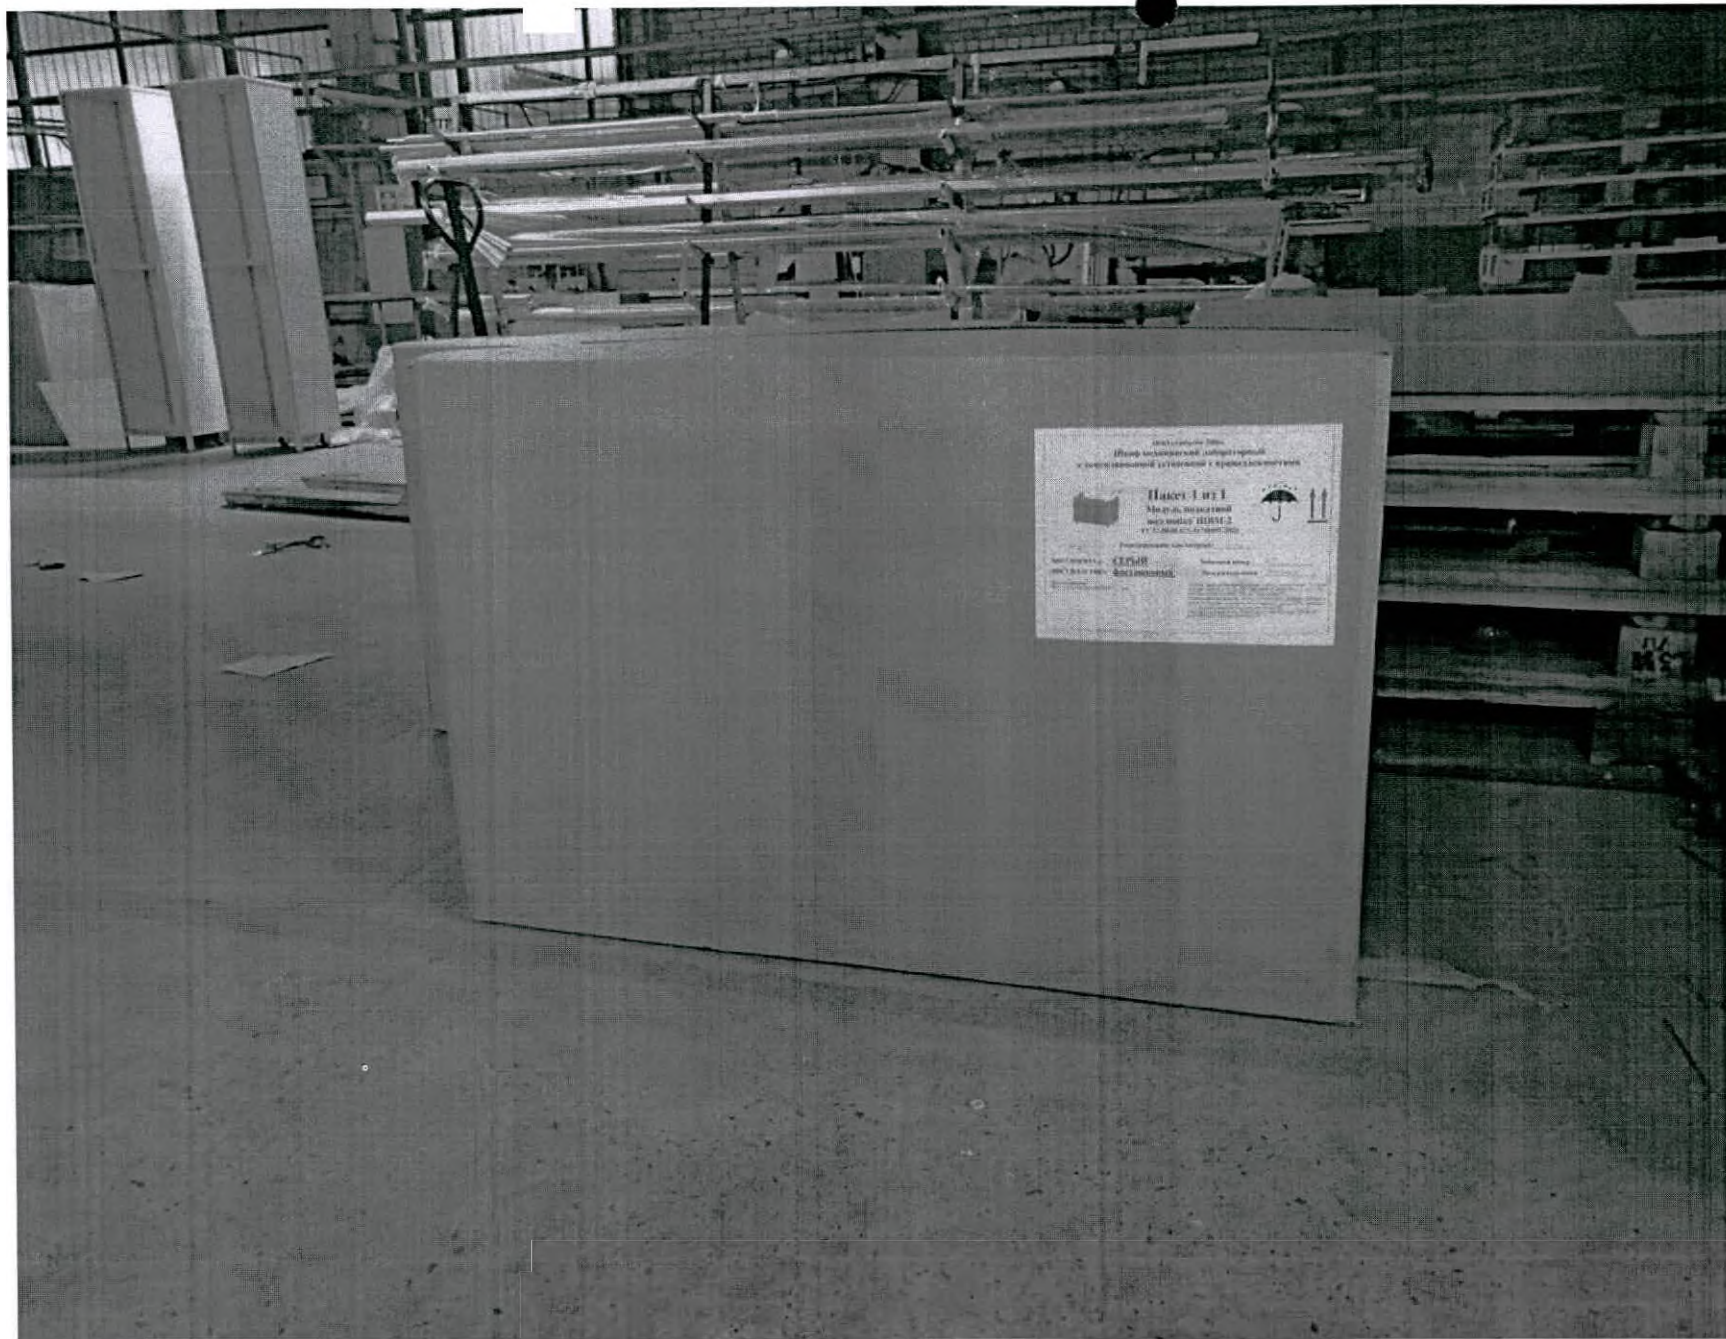

Общий вид потребительской (транспортной) упаковки принадлежности.: Модуль подкатной под мойку ШВМ-2

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

98 (девятью восемью) листов
цифрами прописью

Должность слух-т по сертифф-ции

Подпись Рахманова / Р

« 10 » мач 20 23 г. М. П.

