

Руководитель Группы регистрации



Горшкова Н.А.

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Iron Binding Capacity (Atellica CH TIBC))



Рисунок 1 Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Iron Binding Capacity (Atellica CH TIBC)): общий вид изделия

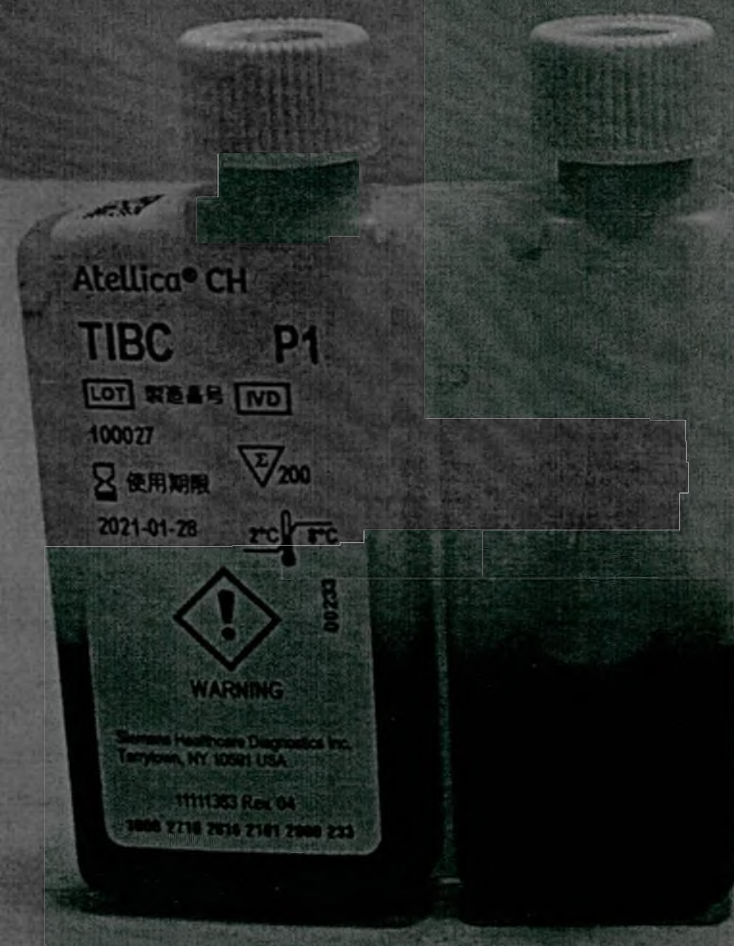


Рисунок 2 Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Iron Binding Capacity (Atellica CH TIBC)): Упаковка 1 (Реагент 1. Atellica CH TIBC)



Рисунок 3 Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Total Iron Binding Capacity (Atellica CH TIBC)): Упаковка 2 (Реагент 2, Atellica CH TIBC)

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

