

Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения амилазы на анализаторах биохимических серии
Atellica (Atellica CH Amylase_2 (Atellica CH AMY_2))



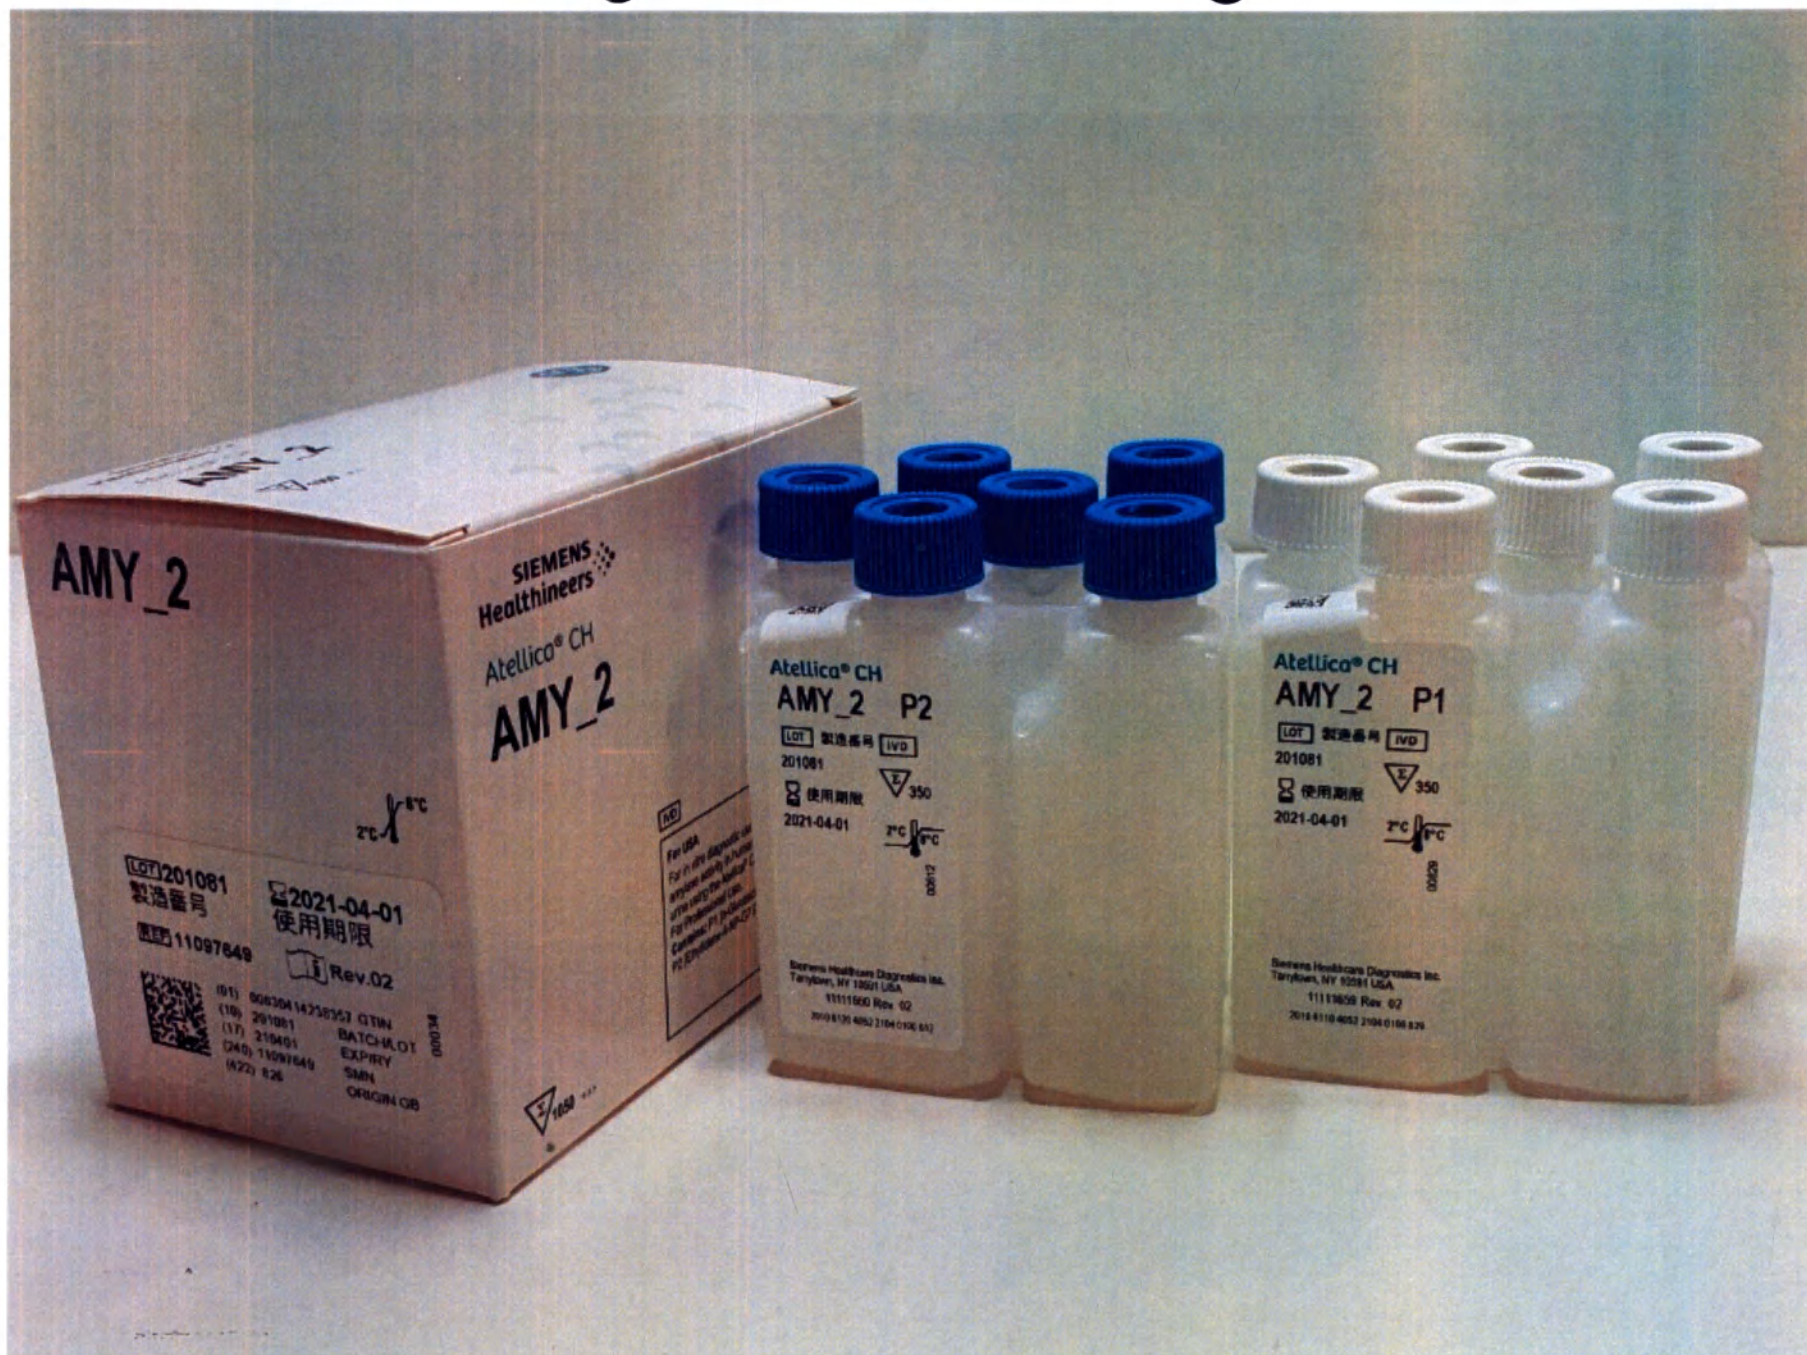


Рисунок 1. Набор реагентов для определения амилазы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Amylase_2 (Atellica CH AMY_2)): общий вид изделия

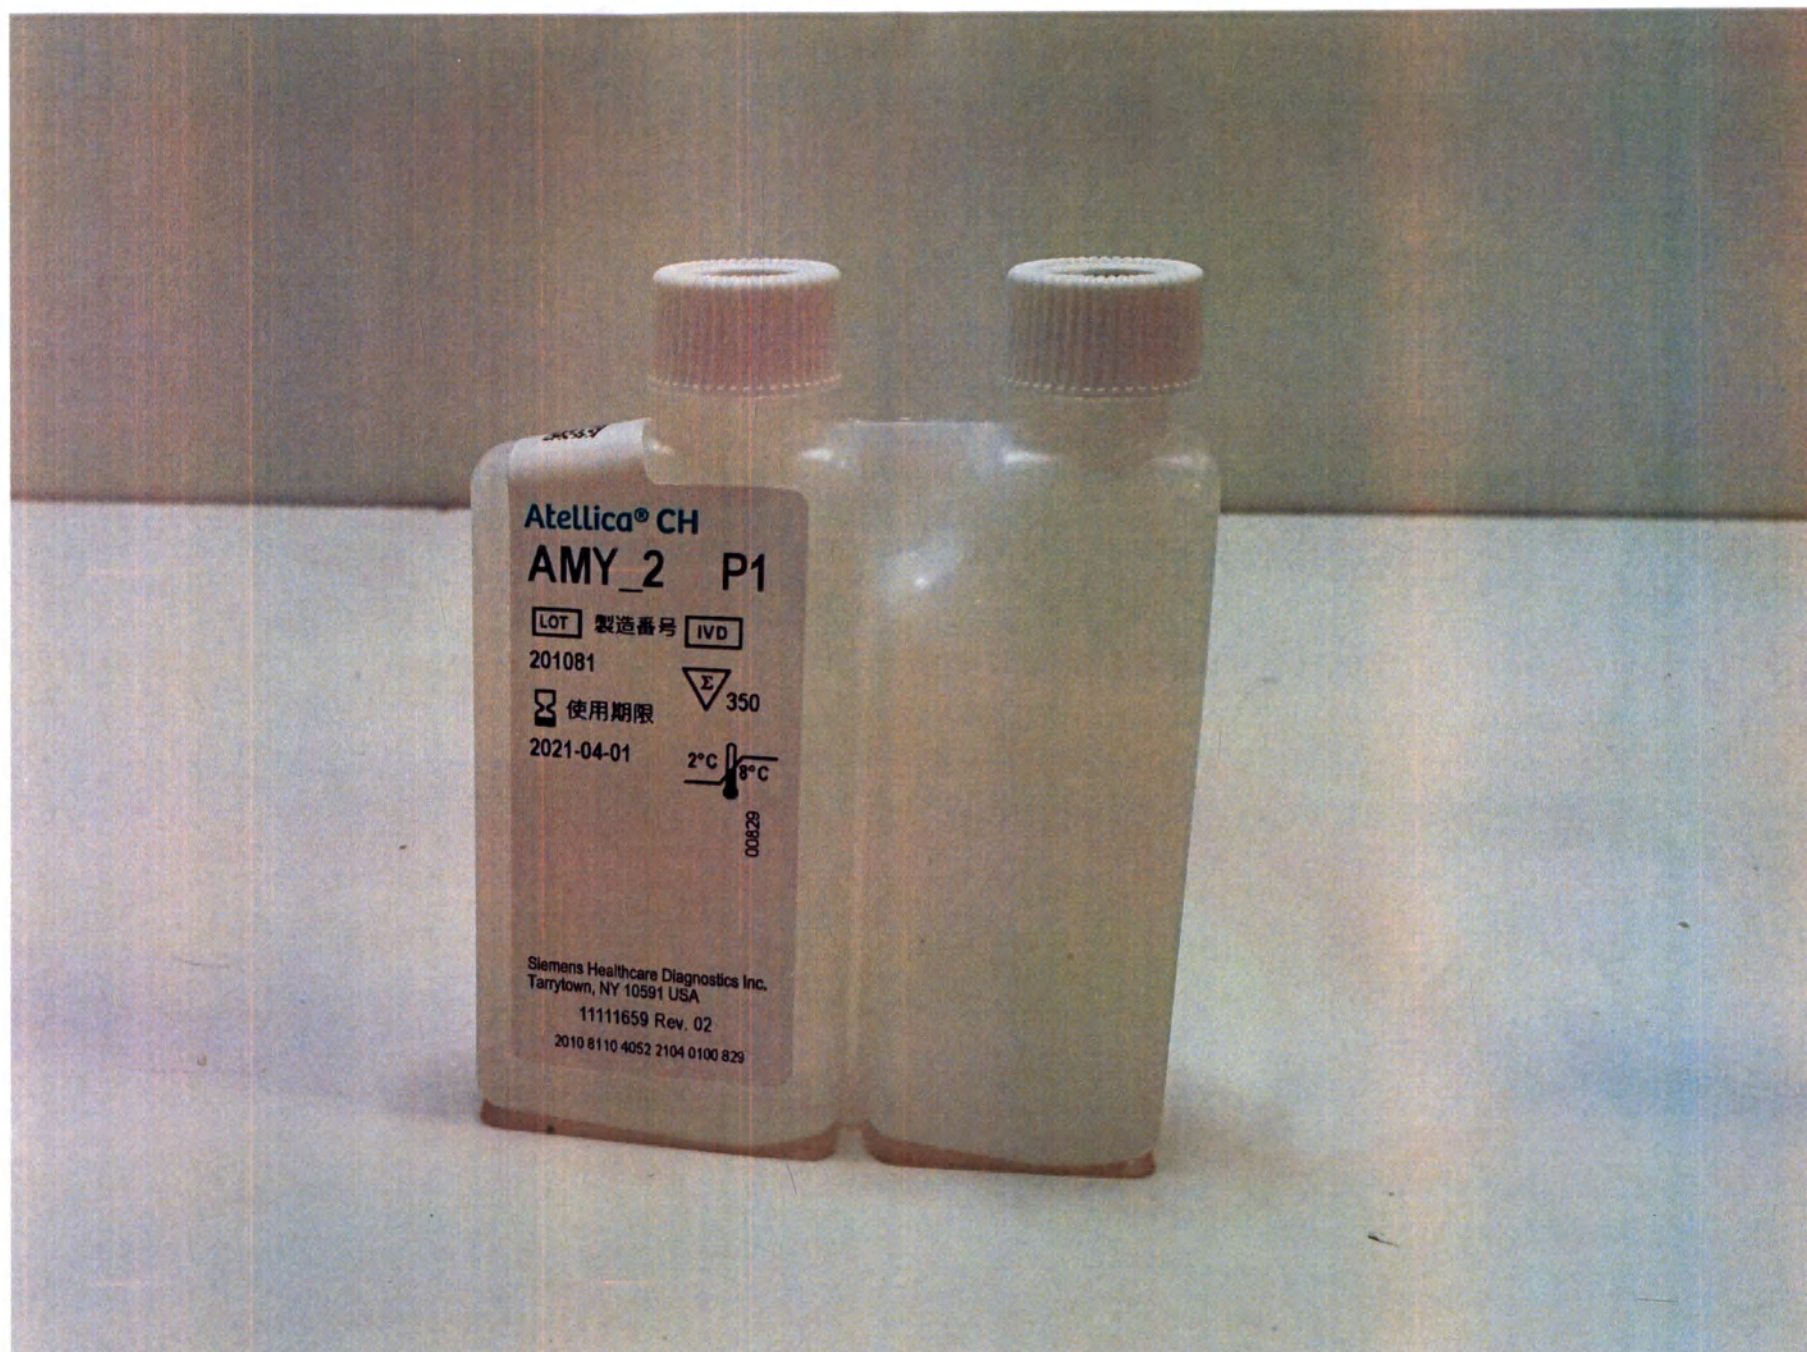

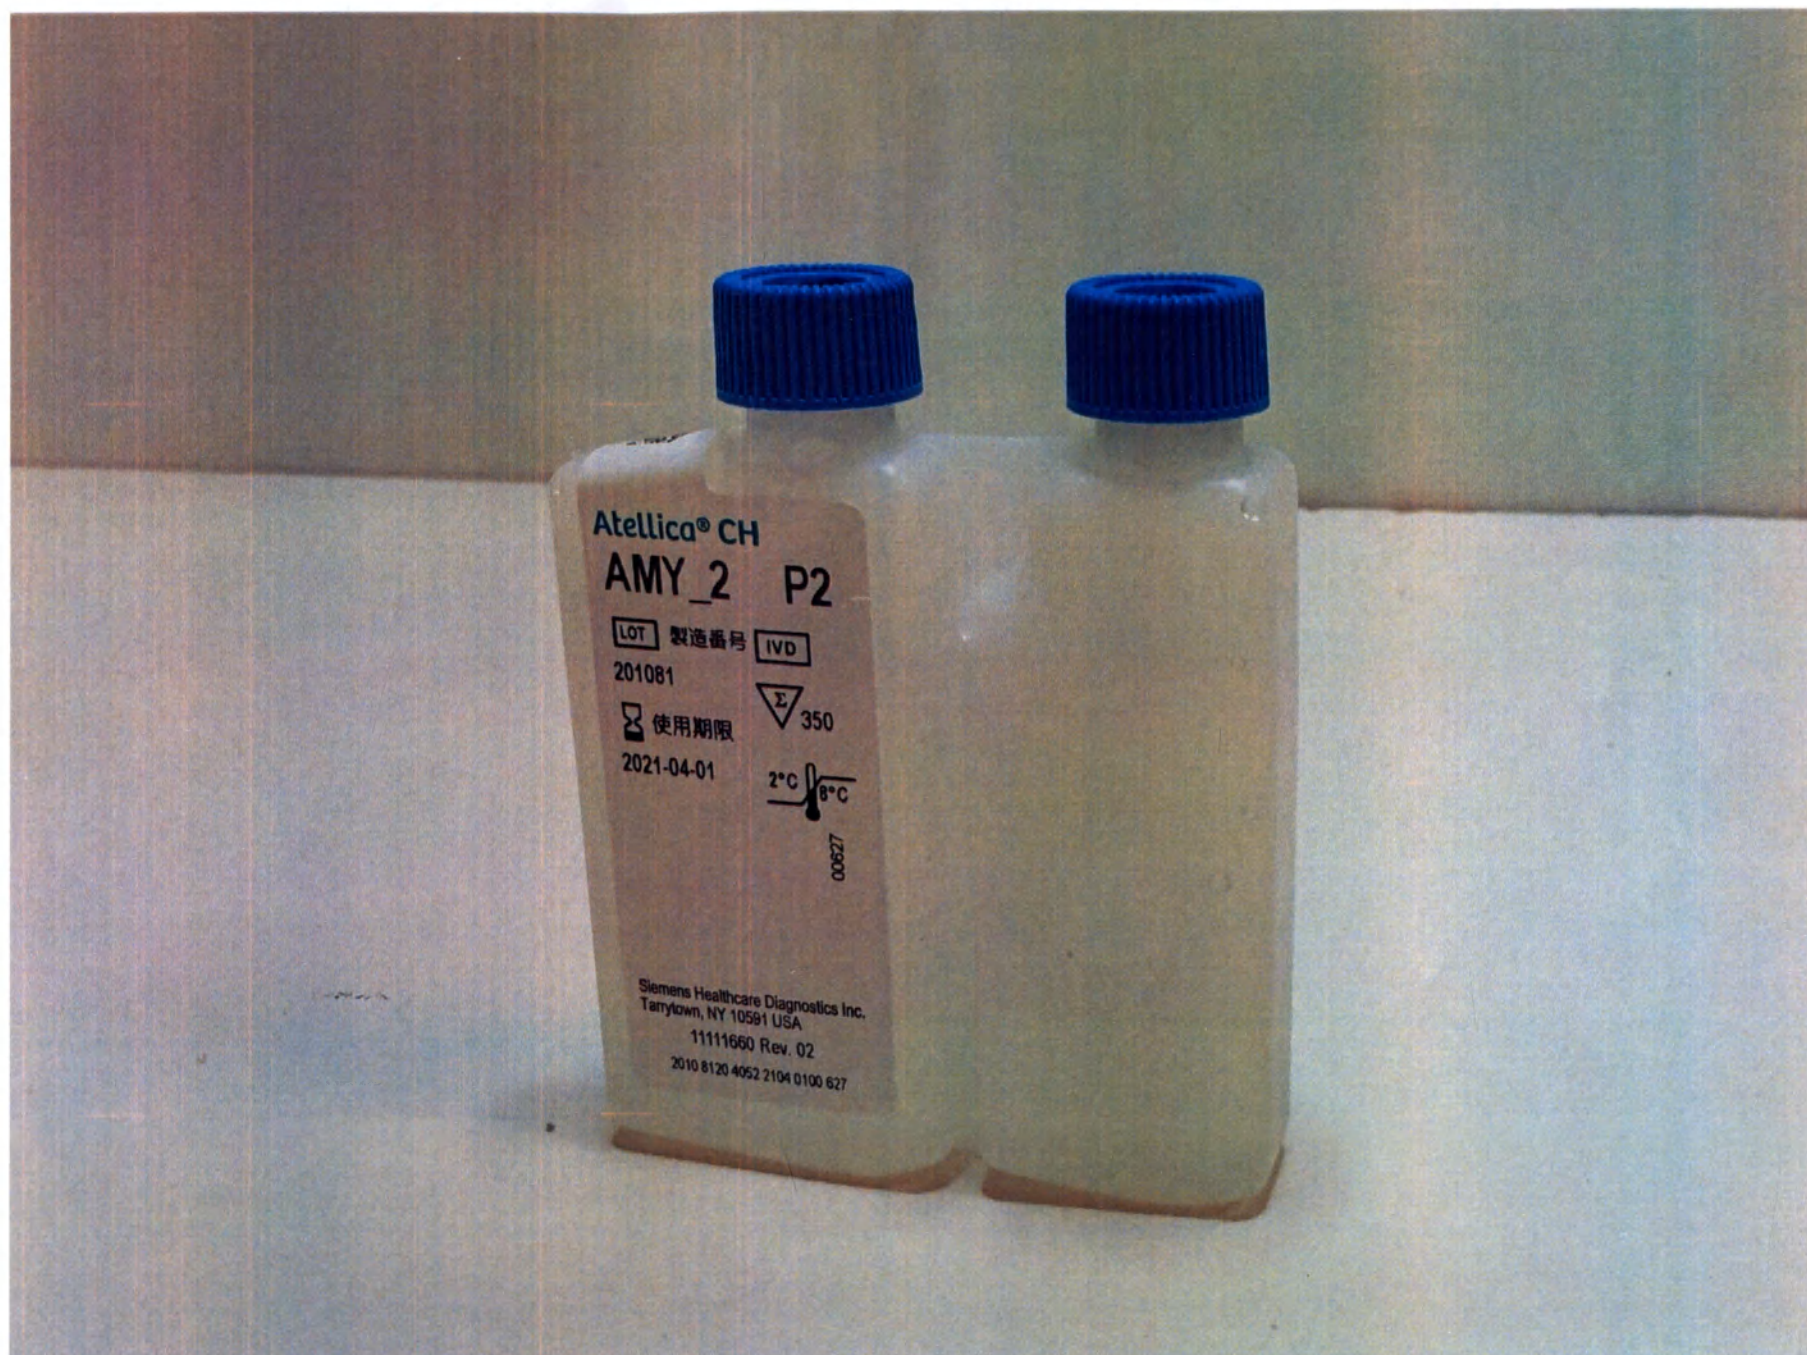

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

