



УТВЕРЖДАЮ

Финансовый директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»

 Гуляева В.Г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека (auto-Bilirubin-D liquicolor)

ETI10741300-1

auto-BILIRUBIN-D

liquicolor

HumaStar

REF 10741300

LOT 22002

Σ 200

LOT

RGT1 / R1 2 x 100 Σ 0020

RGT2 / R2 2 x 100 Σ 0020

⌚ 2023-12-31

⌚ 2...8°C

IVD ⓘ CE

(01)04033145191988(10)22002(93)0(17)231231

Human



Danger

H290, H315

H319, H314



Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21·65205 Wiesbaden·Germany

Human

Diagnostics Worldwide

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека (auto-Bilirubin-D liquidolor)

Вариант исполнения 1, в составе:

- Раствор соляной кислоты (R1), 2 флакона по 100 тестов;
- Реагент окрашивающий (R2), 2 флакона по 100 тестов;
- Инструкция по применению, 1 шт.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Температура хранения и транспортирования от +2 °C до +8 °C

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения.

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1.

Символы, применяемые в маркировке изделия, приведены на оригинальной упаковке.

Кат. № 10741300

ЛОТ № 22002


Годен до: 31.12.2023



Human

Diagnostics Worldwide

Фотографическое изображение 2 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquidolor» с русскоязычным стикером, Вариант исполнения 1

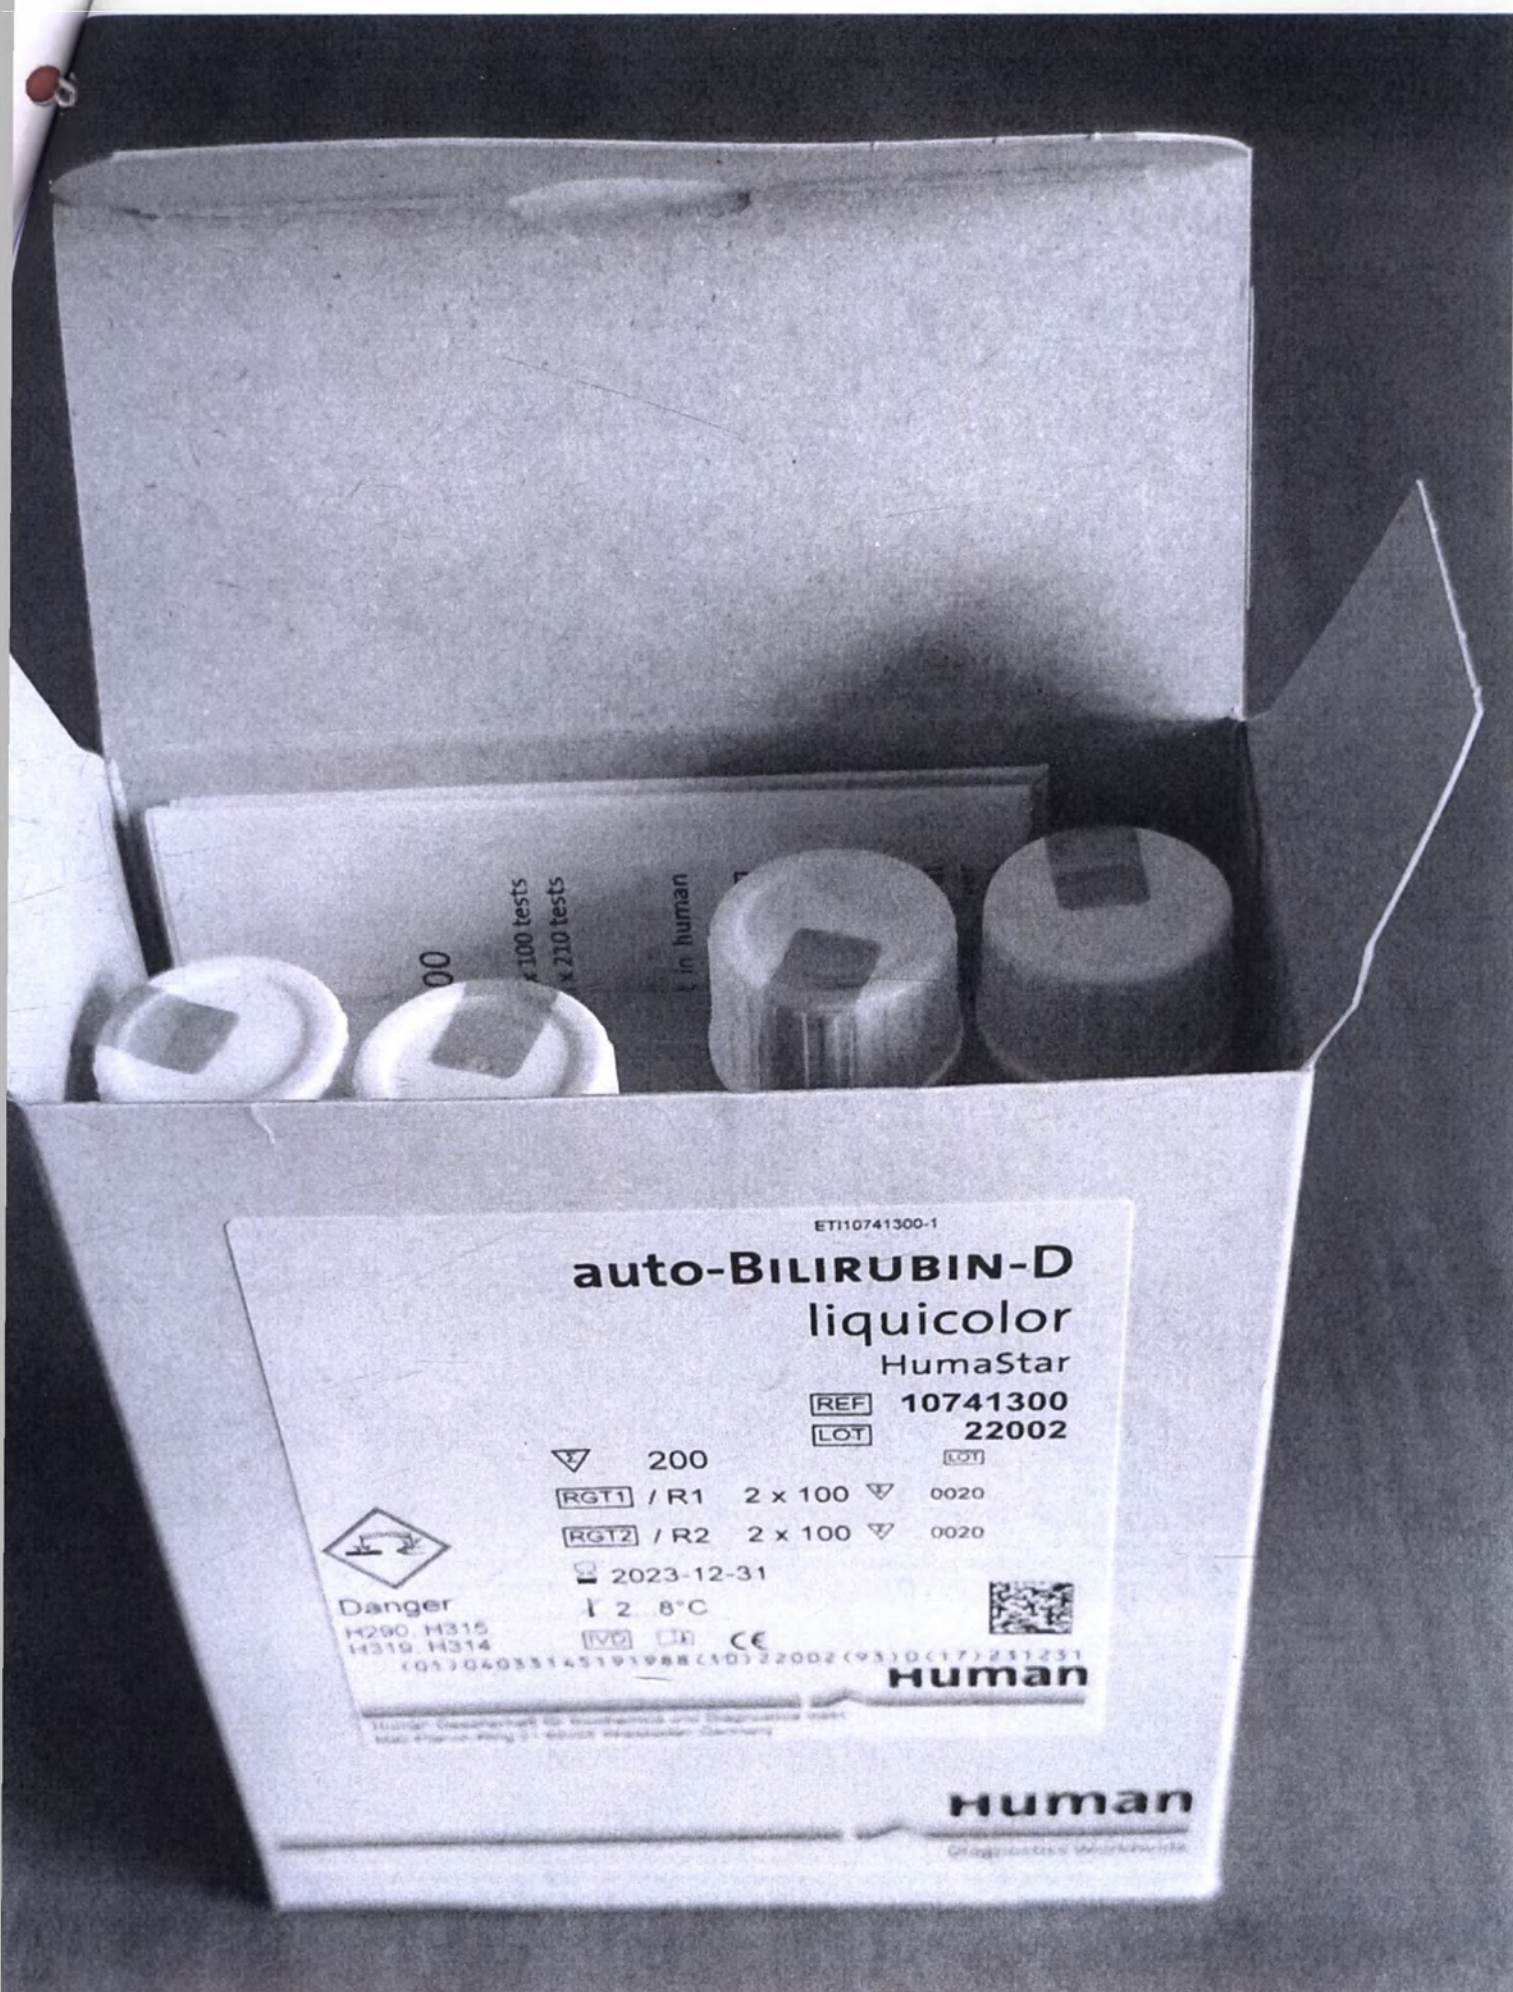

Фотографическое изображение 3 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquicolor», Вариант исполнения 1



Фотографическое изображение 4 – Содержимое потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquicolor», Вариант исполнения 1

ETI10741301-1

ETI 1210053G1

auto-BILIRUBIN-D liquicolor HumaStar

LOT

0020

RGT1 / R1 100 ∇

⌚ 2023-12-31


⬇ 2...8°C

IVD ⓘ



Warning

human

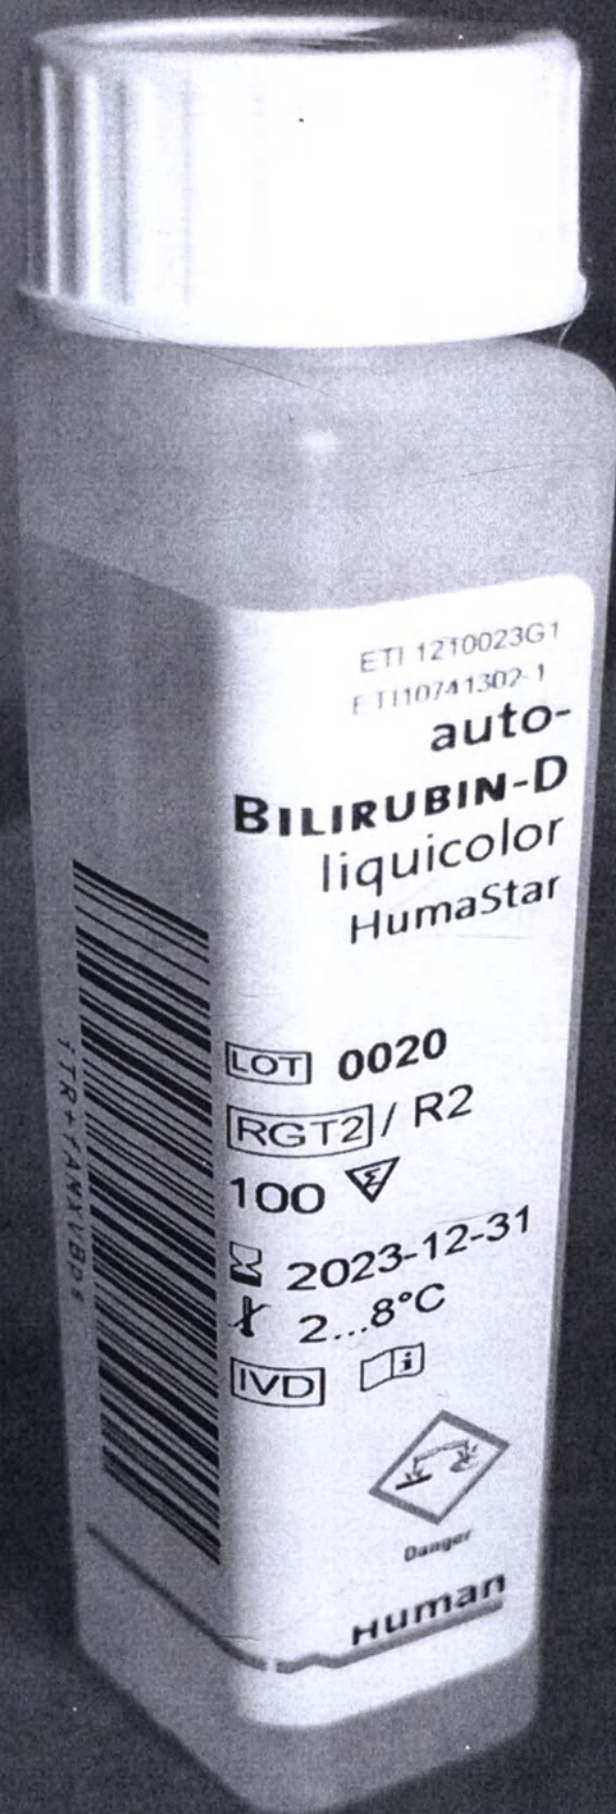

ETI 1210023G1
E T110741302-1

auto-
BILIRUBIN-D
liquicolor
HumaStar

LOT 0020

RGT2 / R2

100

2023-12-31


2...8°C

IVD



Danger

human

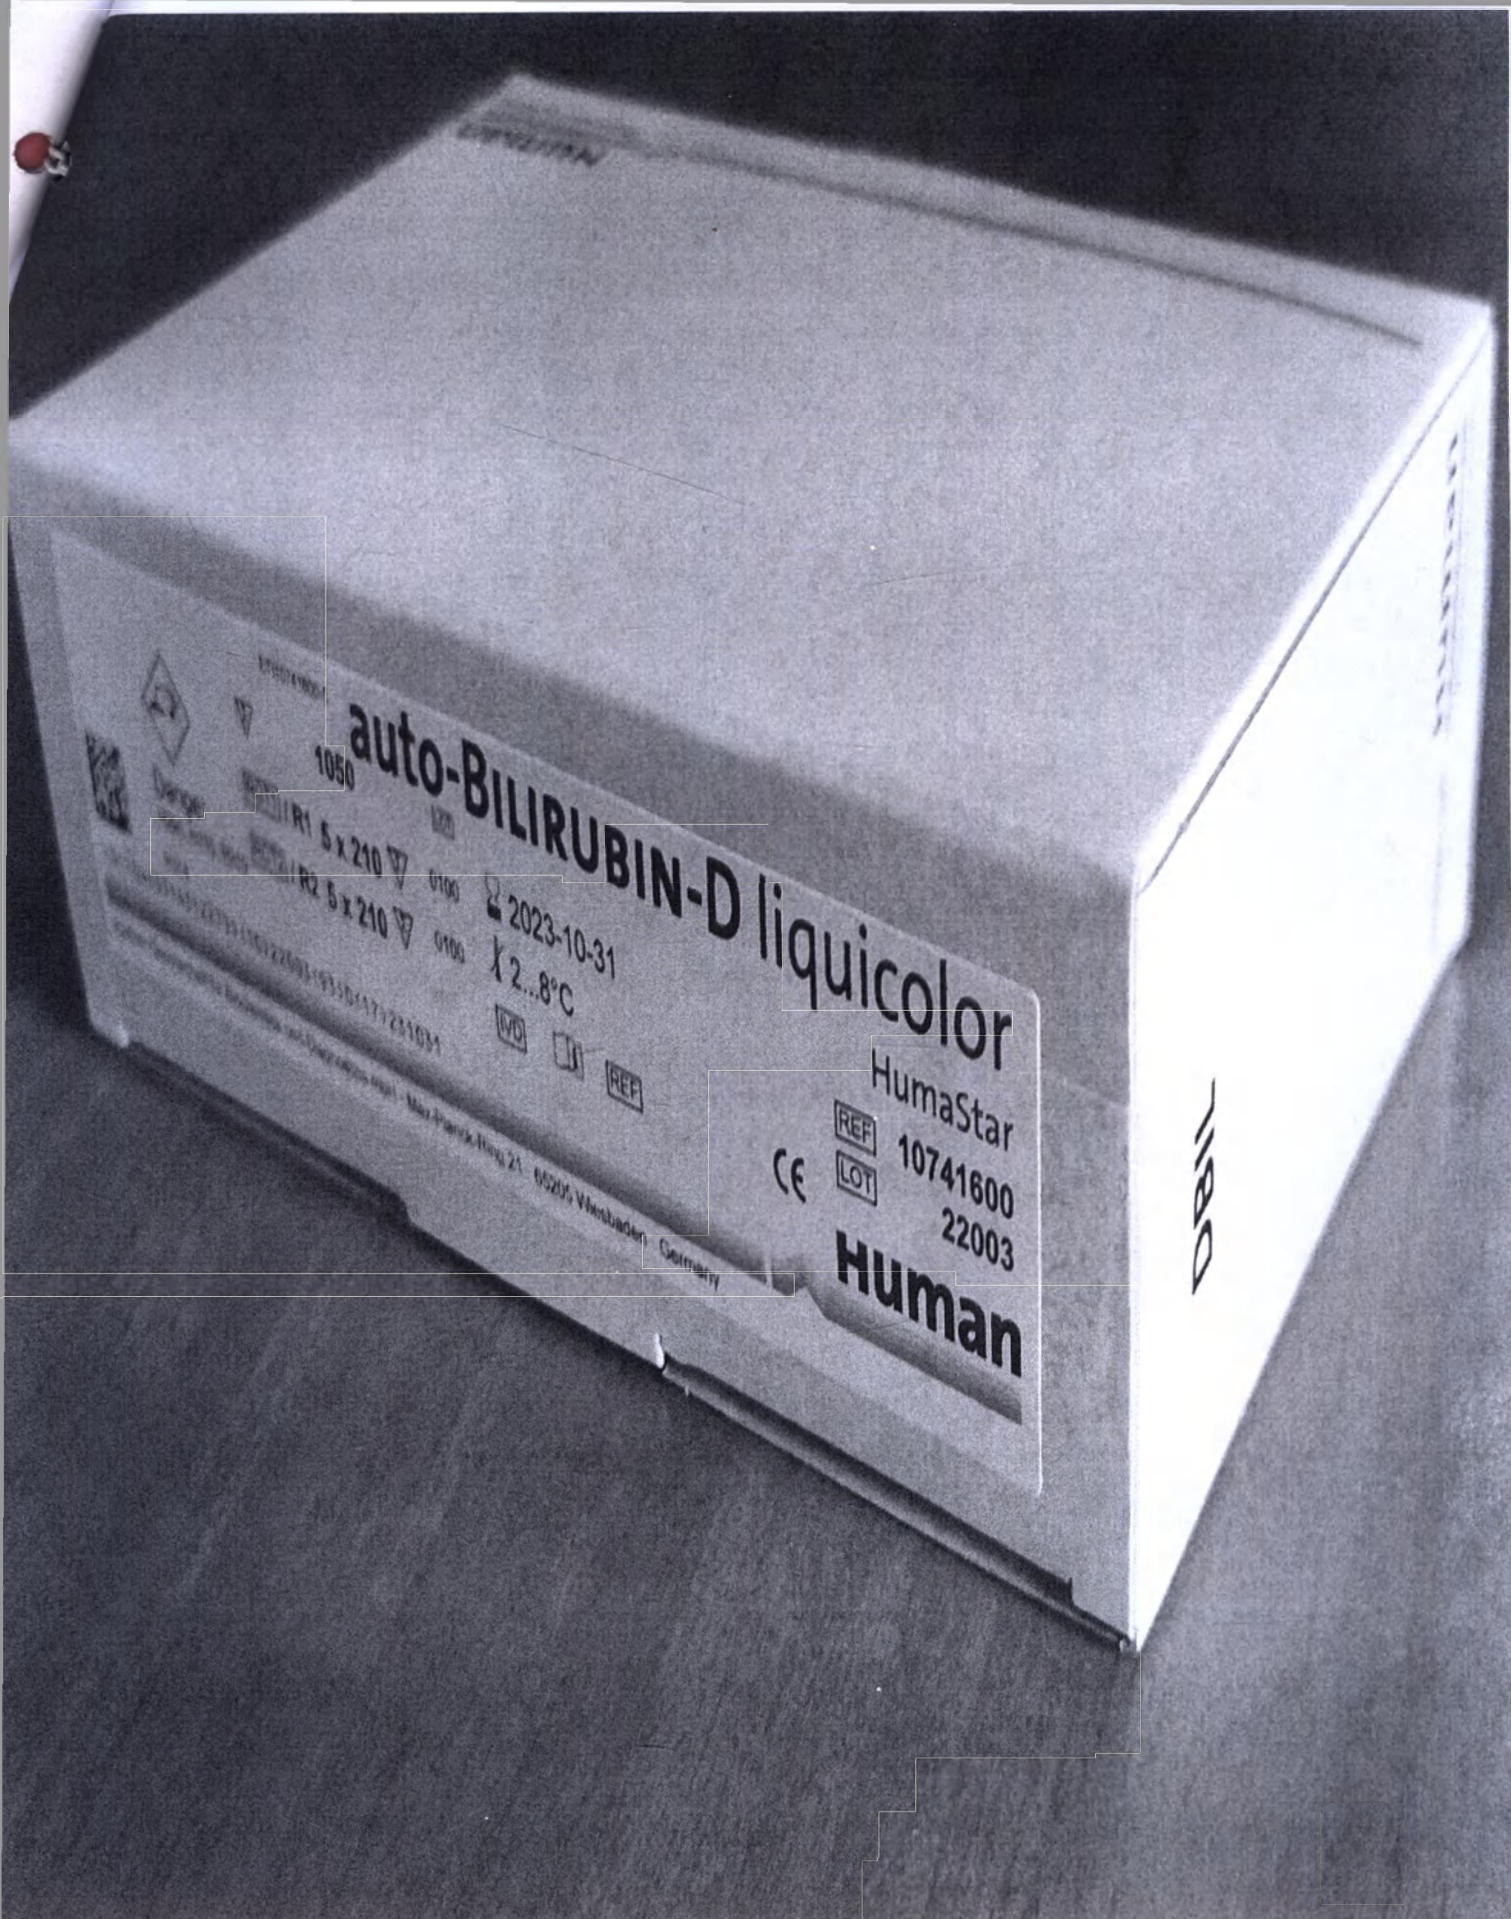

Фотографическое изображение 7 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquicolor», Вариант исполнения 2

ET110741600-5

auto-BILIRUBIN-D liquicolor



Danger
H290, H315, H319
H314



1050

LOT

RGT1

/ R1 5 x 210



0100

RGT2

/ R2 5 x 210



0100



2023-10-31



2...8°C



REF

10741600

LOT

22003

Human

HumaStar

(01) 04033145122739 (10) 22003 (93) 0 (17) 231031

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH · Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany

Фотографическое изображение 8 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquicolor», Вариант исполнения 2

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека (auto-Bilirubin-D liquidcolor)

Вариант исполнения 2, в составе:

- Ректор соевый (R1), 5 флаконов по 210 тестов.
- Реактив окрашивающий (R2), 5 флаконов по 210 тестов.
- Инструмент по пробоотбору, 1 шт.

Противодатка

НУМАН Gesellschaft für Biochemie und Diagnostik mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Температура хранения и транспортирования от +2 °C до +8 °C

Рекомендованное Удостоверение № РЭН _____ от _____ г.

Материальное изделие для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",
13943, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1


Сведения, приведенные в маркировке изделия, приведены на
оригинальной упаковке.

Кат. № 10741600
ЛОТ № 22003
Годен до 31.10.2023




нуман
Diagnostics Worldwide

Фотографическое изображение 9 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquidcolor» с русскоязычным стикером, Вариант исполнения 2

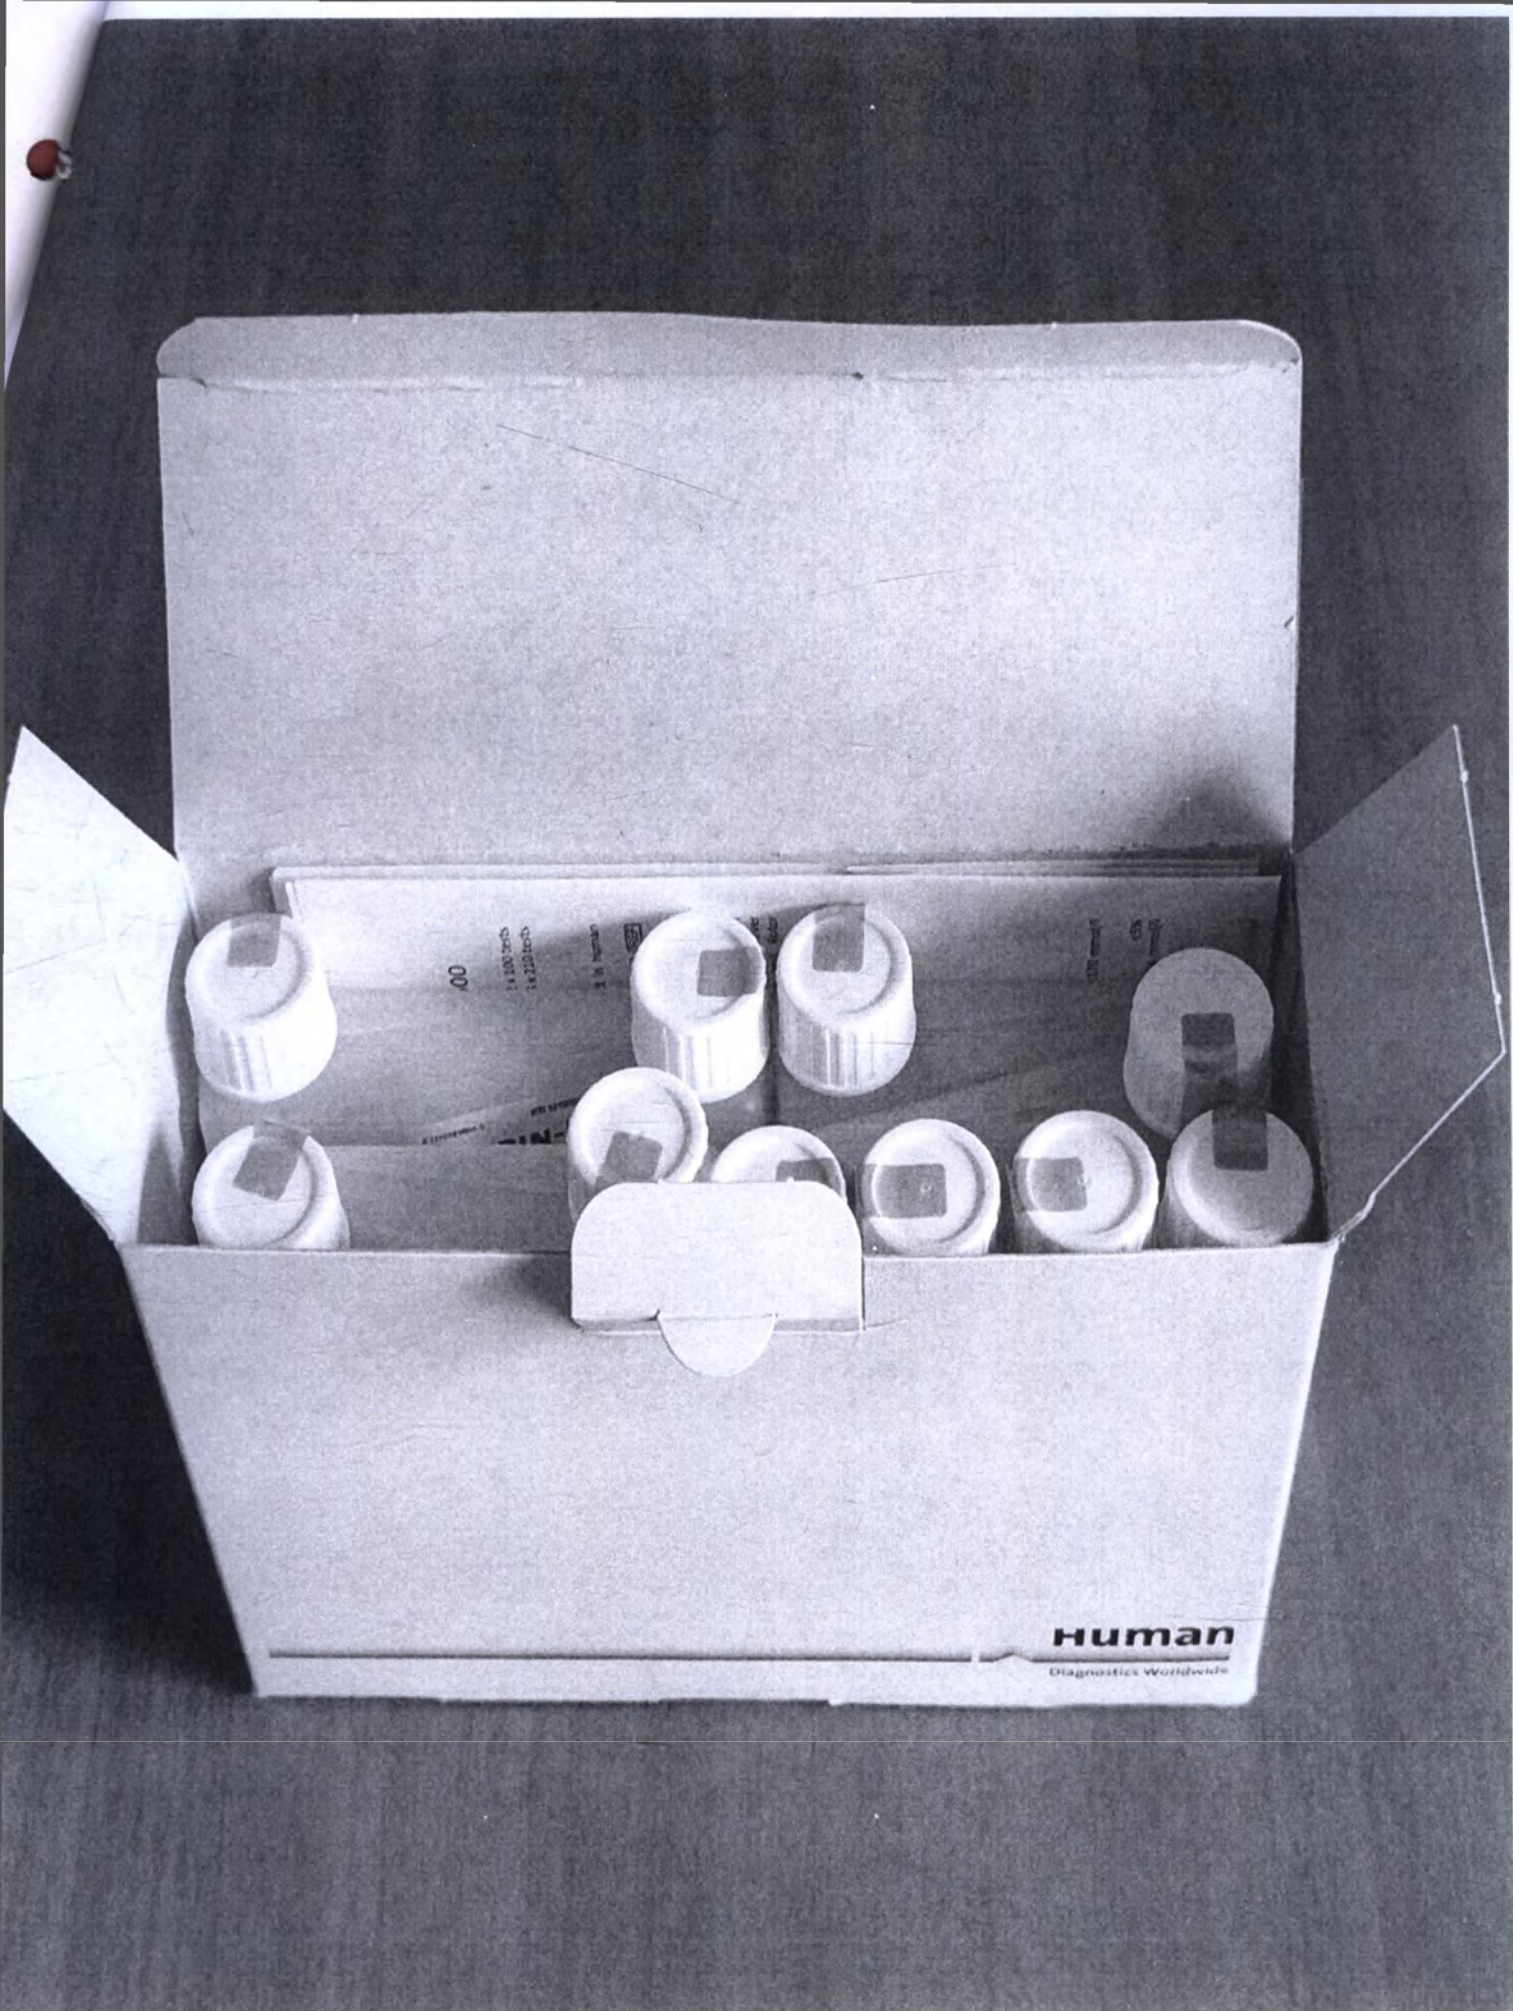

Фотографическое изображение 10 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquicolor», Вариант исполнения 2

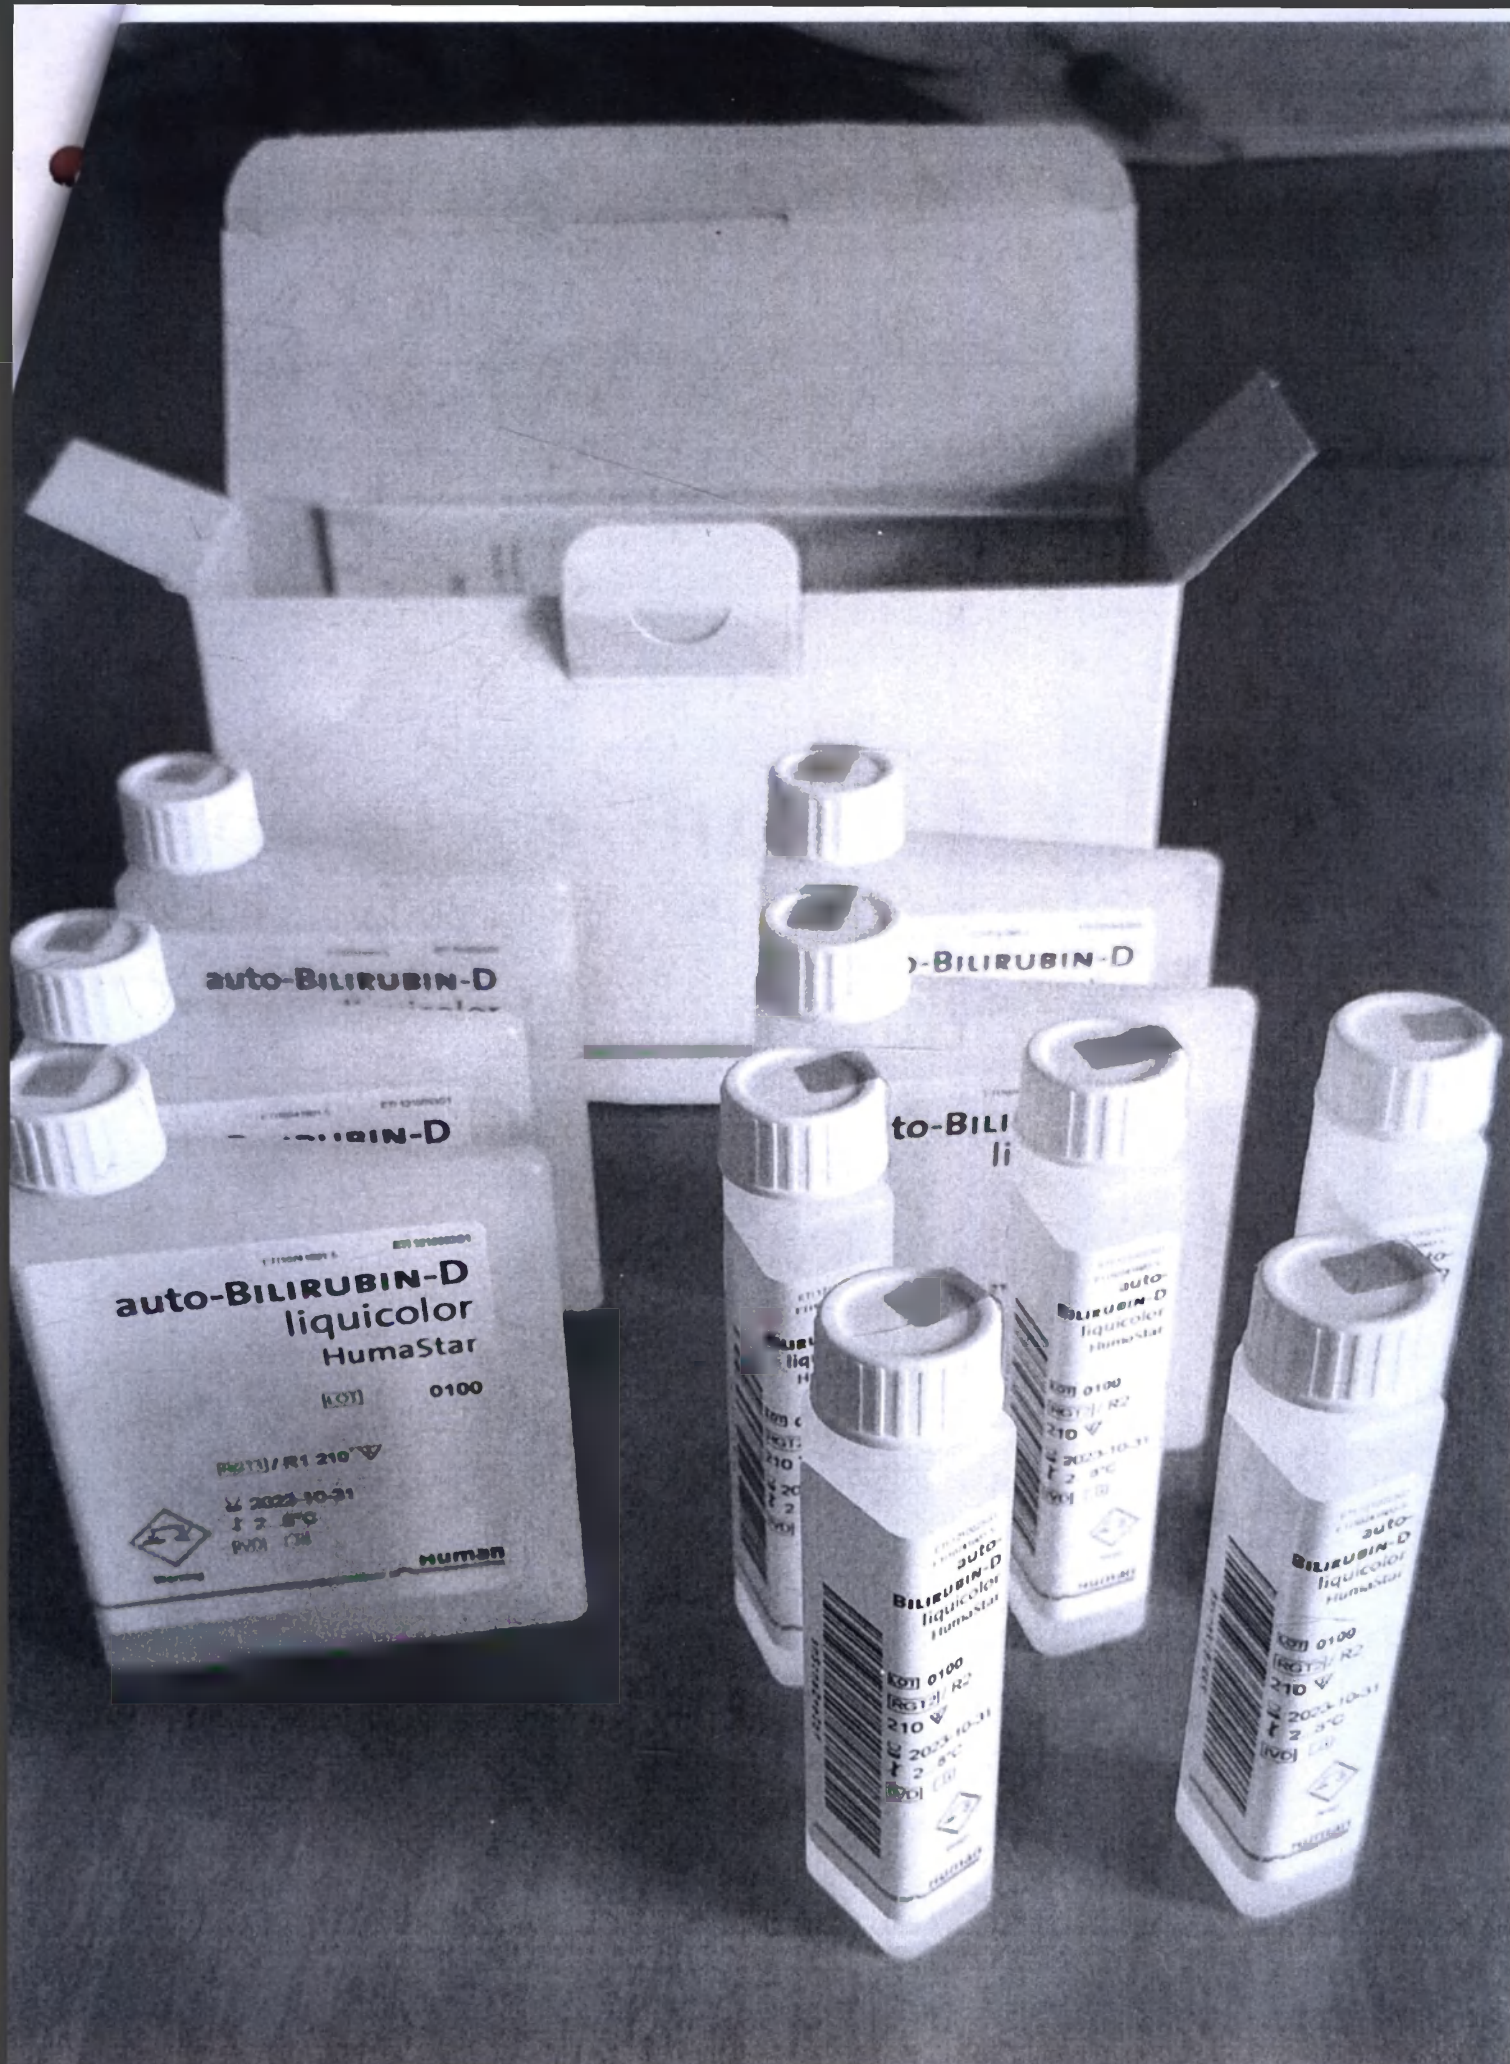

Фотографическое изображение 11 – Содержимое потребительской упаковки Набора реагентов «auto-Bilirubin-D liquicolor», Вариант исполнения 2

ETI10741601-5

ETI 1210053G1

auto-BILIRUBIN-D liquicolor HumaStar

LOT

0100

RGT1 / R1 210 

 2023-10-31


 2...8°C

IVD 



Warning

human

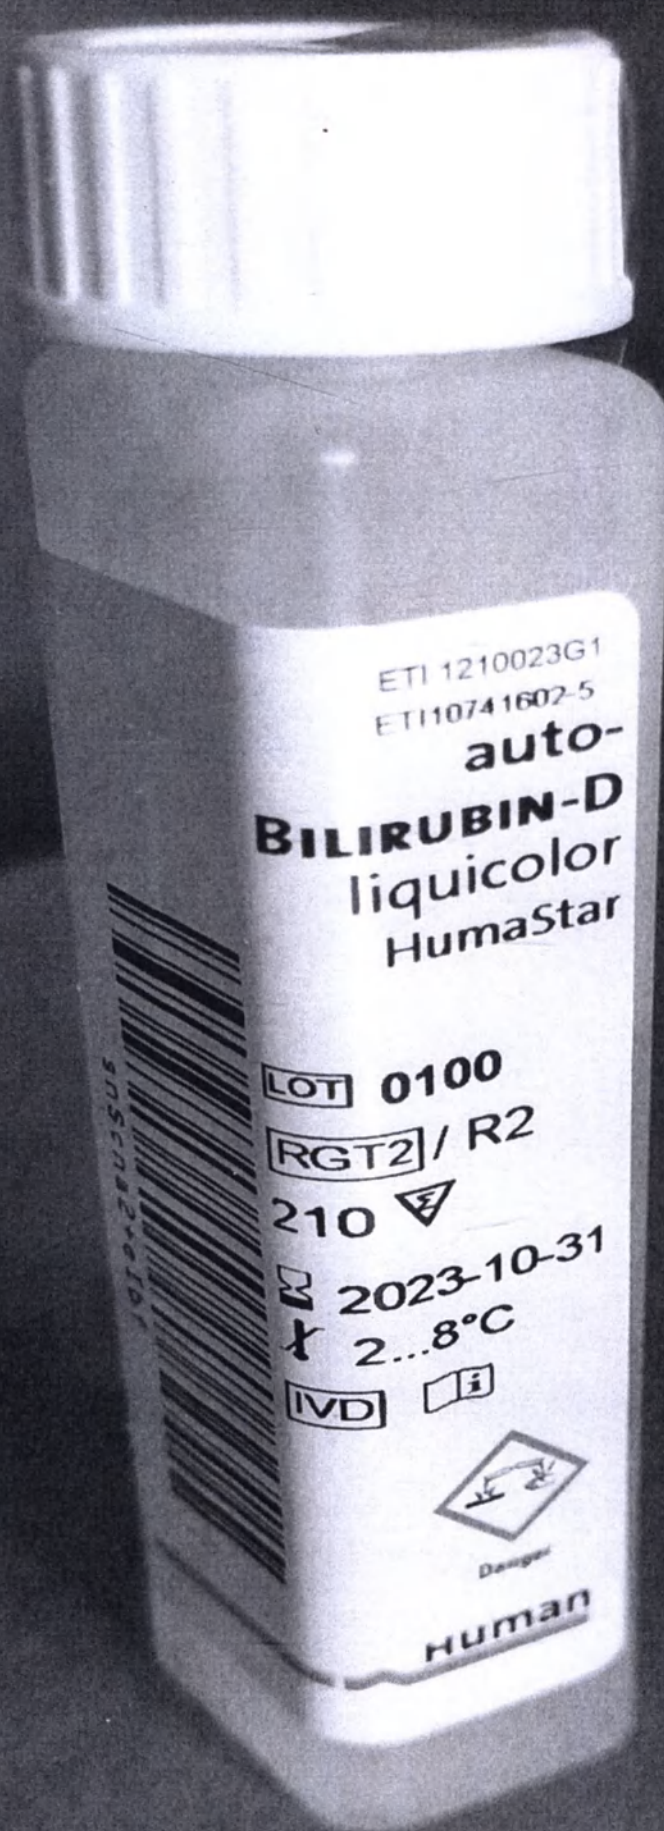

ETI 1210023G1
ETI10741602-5

auto-
BILIRUBIN-D
liquicolor
HumaStar



LOT 0100

RGT2 / R2

210

2023-10-31

2...8°C

IVD



Danger

human

 Гуляева В.Г.