



Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

10 » августа 2021 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro**

Набор реагентов для определения панкреатической амилазы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Pancreatic Amylase\_2 (Atellica CH PAMY\_2))



Рисунок 1 Набор реагентов для определения панкреатической амилазы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Pancreatic Amylase\_2 (Atellica CH PAMY 2)): общий вид изделия


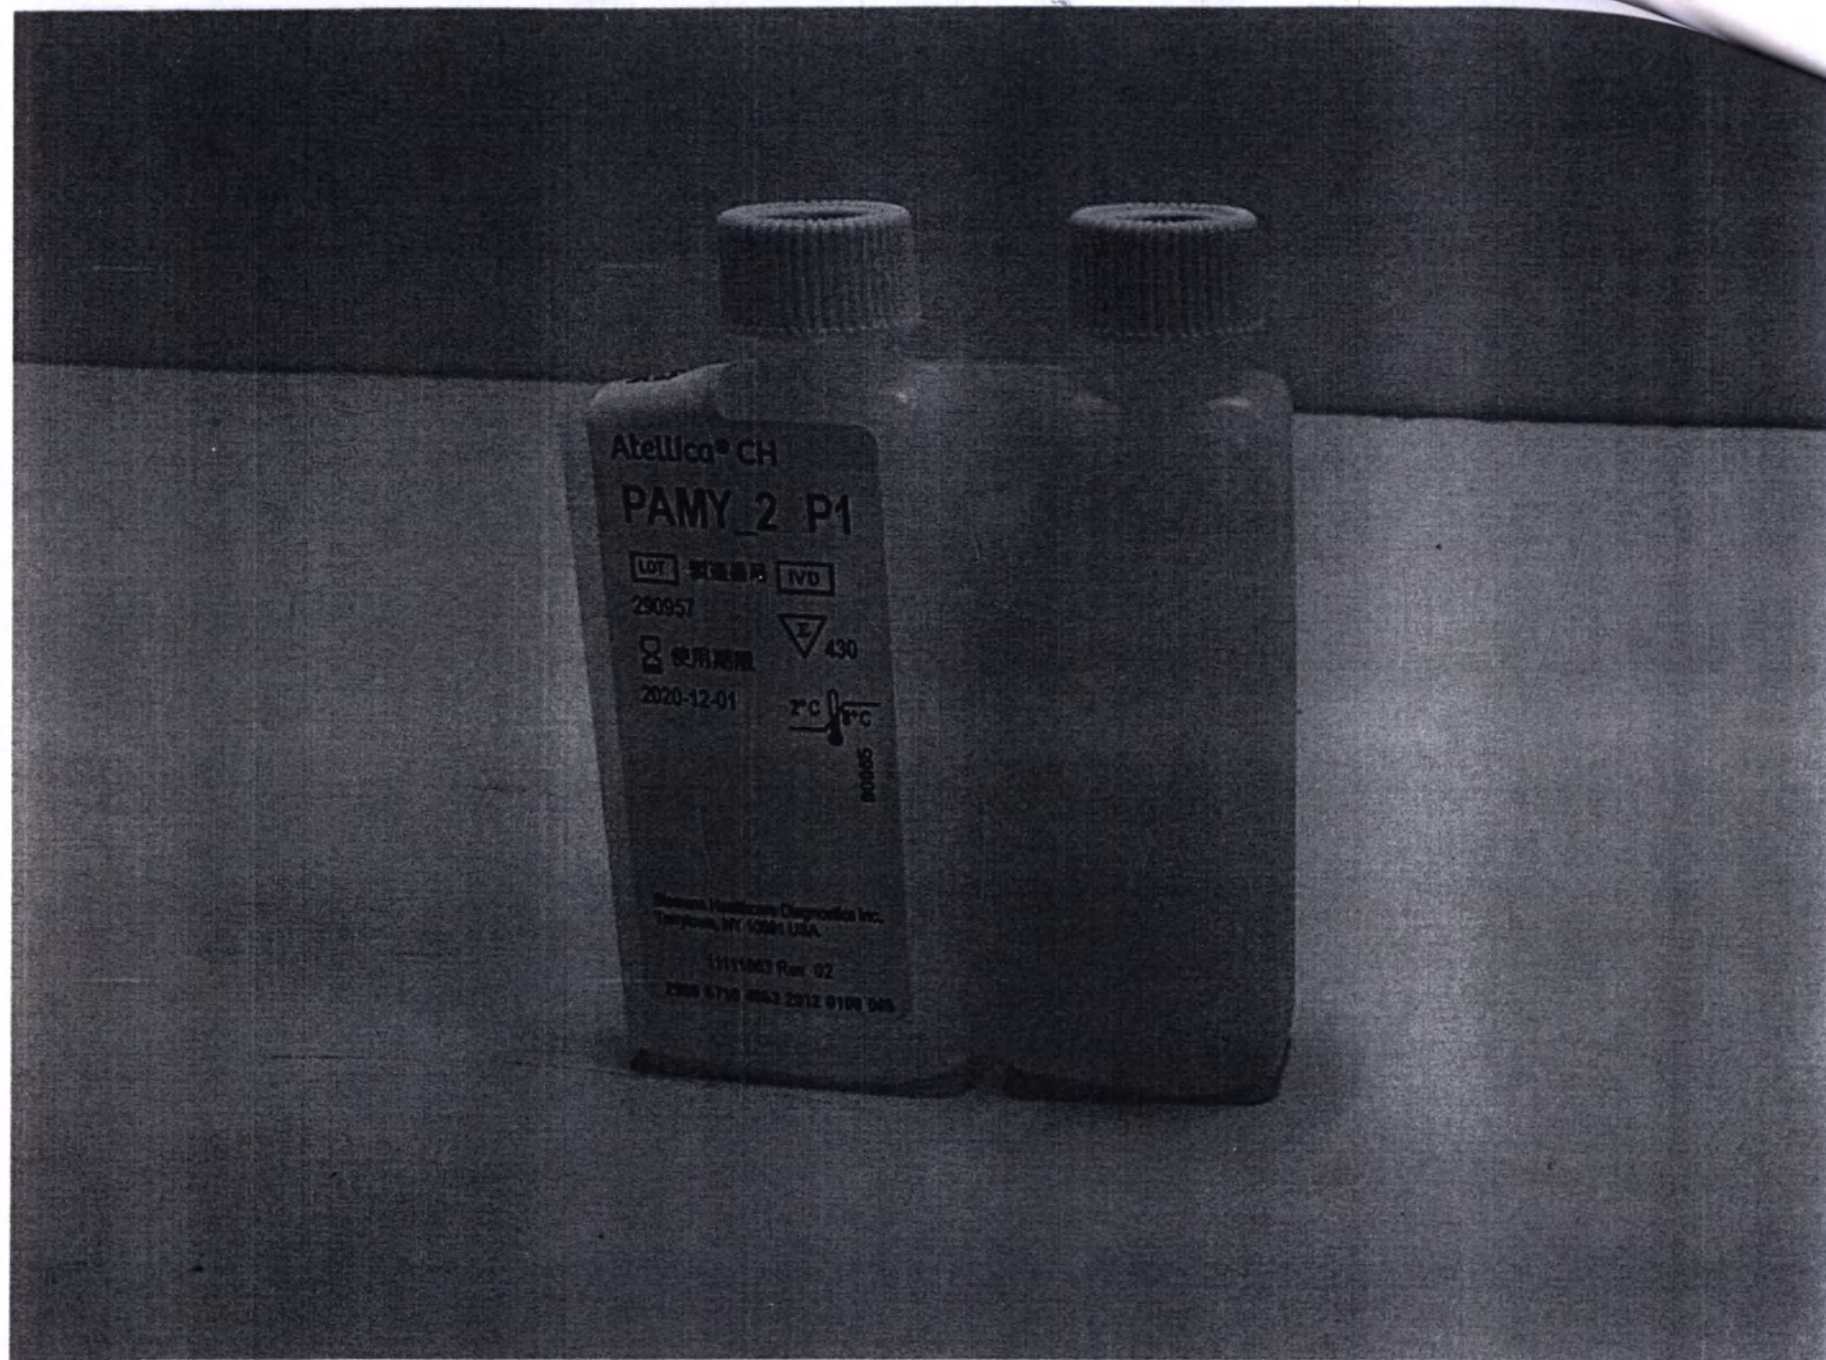


Рисунок 2 Набор реагентов для определения панкреатической амилазы на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Pancreatic Amylase\_2 (Atellica CH PAMY 2)): общий вид, упаковка 1





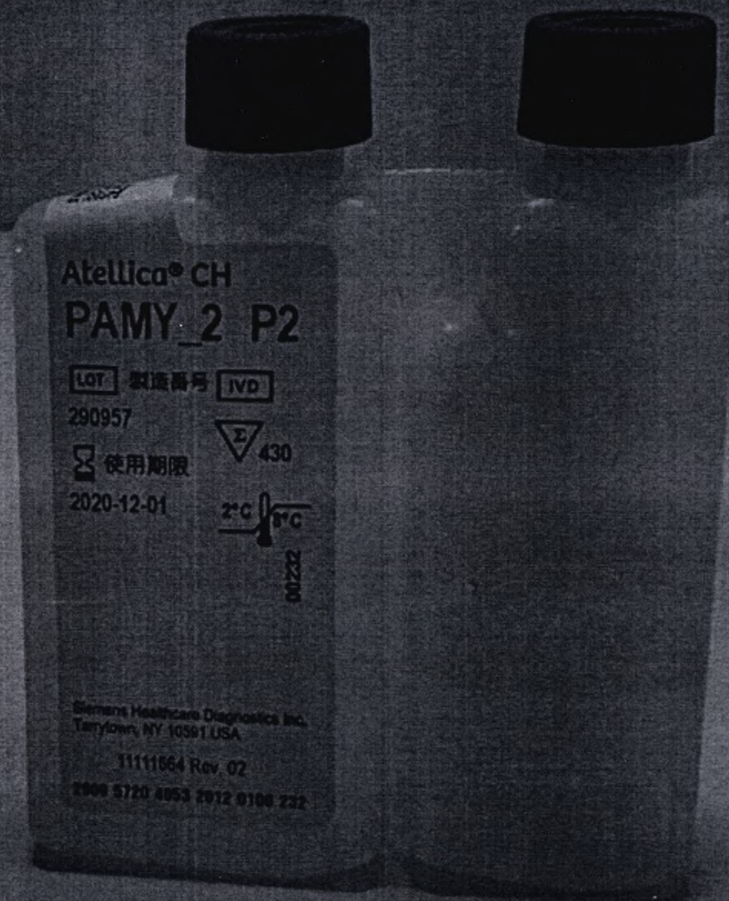

Всего прошито и  
пронумеровано 4 листа  
(ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

