



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Дназм»

Ишорикова О.В.

**Фотографическое изображение
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ с упаковкой и без**

Автоклав (стерилизатор паровой) медицинский, варианты исполнения SJ-AD60, SJ-AD80, SJ-AD100 (см. Приложение)

**Производитель:
SJ CLAVE Co., Ltd
Republic of Korea
(Эс-Джей КЛЭЙВ Ко., Лтд)
(Республика Корея)
10F, Room 19-20, The Sky Vally Bldg., 416, Hwagok-ro, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea (Республика Корея)**

Автоклав (стерилизатор паровой) медицинский, варианты исполнения SJ-AD60, SJ-AD80, SJ-AD100:

- I. Автоклав (стерилизатор паровой) медицинский SJ-AD60 в составе:
 - 1. Автоклав медицинский SJ-AD60.
 - 2. Корзина загрузочная - 2 шт.
 - 3. Руководство по эксплуатации
 - 4. Крышка заливного отверстия
 - 5. Поддон металлический
 - 6. Бутыль пластиковая для выпуска пара с трубками
 - 7. Уплотнитель крышки

- II. Автоклав (стерилизатор паровой) медицинский SJ-AD80 в составе:
 - 1. Автоклав медицинский SJ-AD80.
 - 2. Корзина загрузочная – 2 шт.
 - 3. Розетка электрическая специализированная.
 - 4. Руководство по эксплуатации
 - 5. Крышка заливного отверстия
 - 6. Поддон металлический
 - 7. Бутыль пластиковая для выпуска пара с трубками
 - 8. Уплотнитель крышки

- III. Автоклав (стерилизатор паровой) медицинский SJ-AD100 в составе:
 - 1. Автоклав медицинский SJ-AD100.
 - 2. Корзина загрузочная большая.
 - 3. Корзина загрузочная малая.
 - 4. Розетка электрическая специализированная.
 - 5. Руководство по эксплуатации
 - 6. Крышка заливного отверстия
 - 7. Поддон металлический
 - 8. Бутыль пластиковая для выпуска пара с трубками
 - 9. Уплотнитель крышки



Автомат (стерилизатор паровой) лабораторный, фирменный SJ-AD 60

Аппарат измерения скорости ветра 57-АД 80





Автомат /стерилизатор/паровой негусачный SY-AD100



Dia-M, LLC
Aurora-2 accessories
Gross Weight: 33 KG
Net Weight: 5 KG
Carton Size: 0.68 x 0.64 x 0.33M
Carton No.: A/1

Dia-M, LLC
Aurora-2
Gross Weight: 33 KG
Net Weight: 5 KG
Carton Size: 0.68 x 0.64 x 0.33M
Carton No.: A/1

Thermo
SCIENTIFIC

thermo
scientific applied
biosystems

 **SJ CLAVE**
Made in KOREA



Автоклав биологический

Art. Nr.
8042 589-00

max. 1000 kg


Attention
max 54 cm
max 21,2


hier aufreißen
LIEBHERR
LKPv 6523-4

Корзина гарпозная для мытья: ST-AD60
и ST-AD80



Копирующее устройство для СЧ-АВ-500

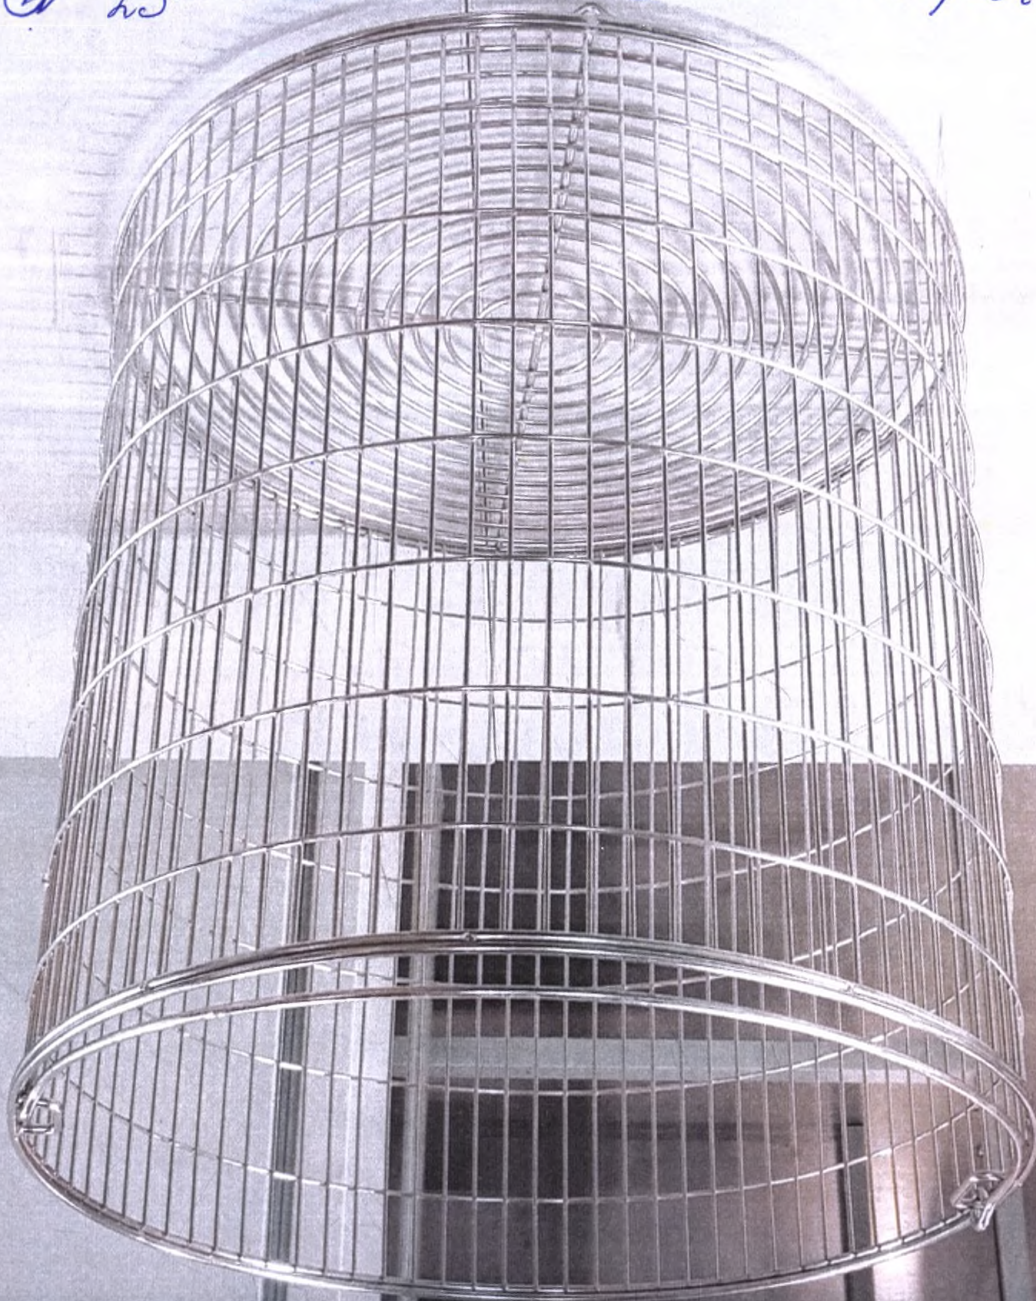

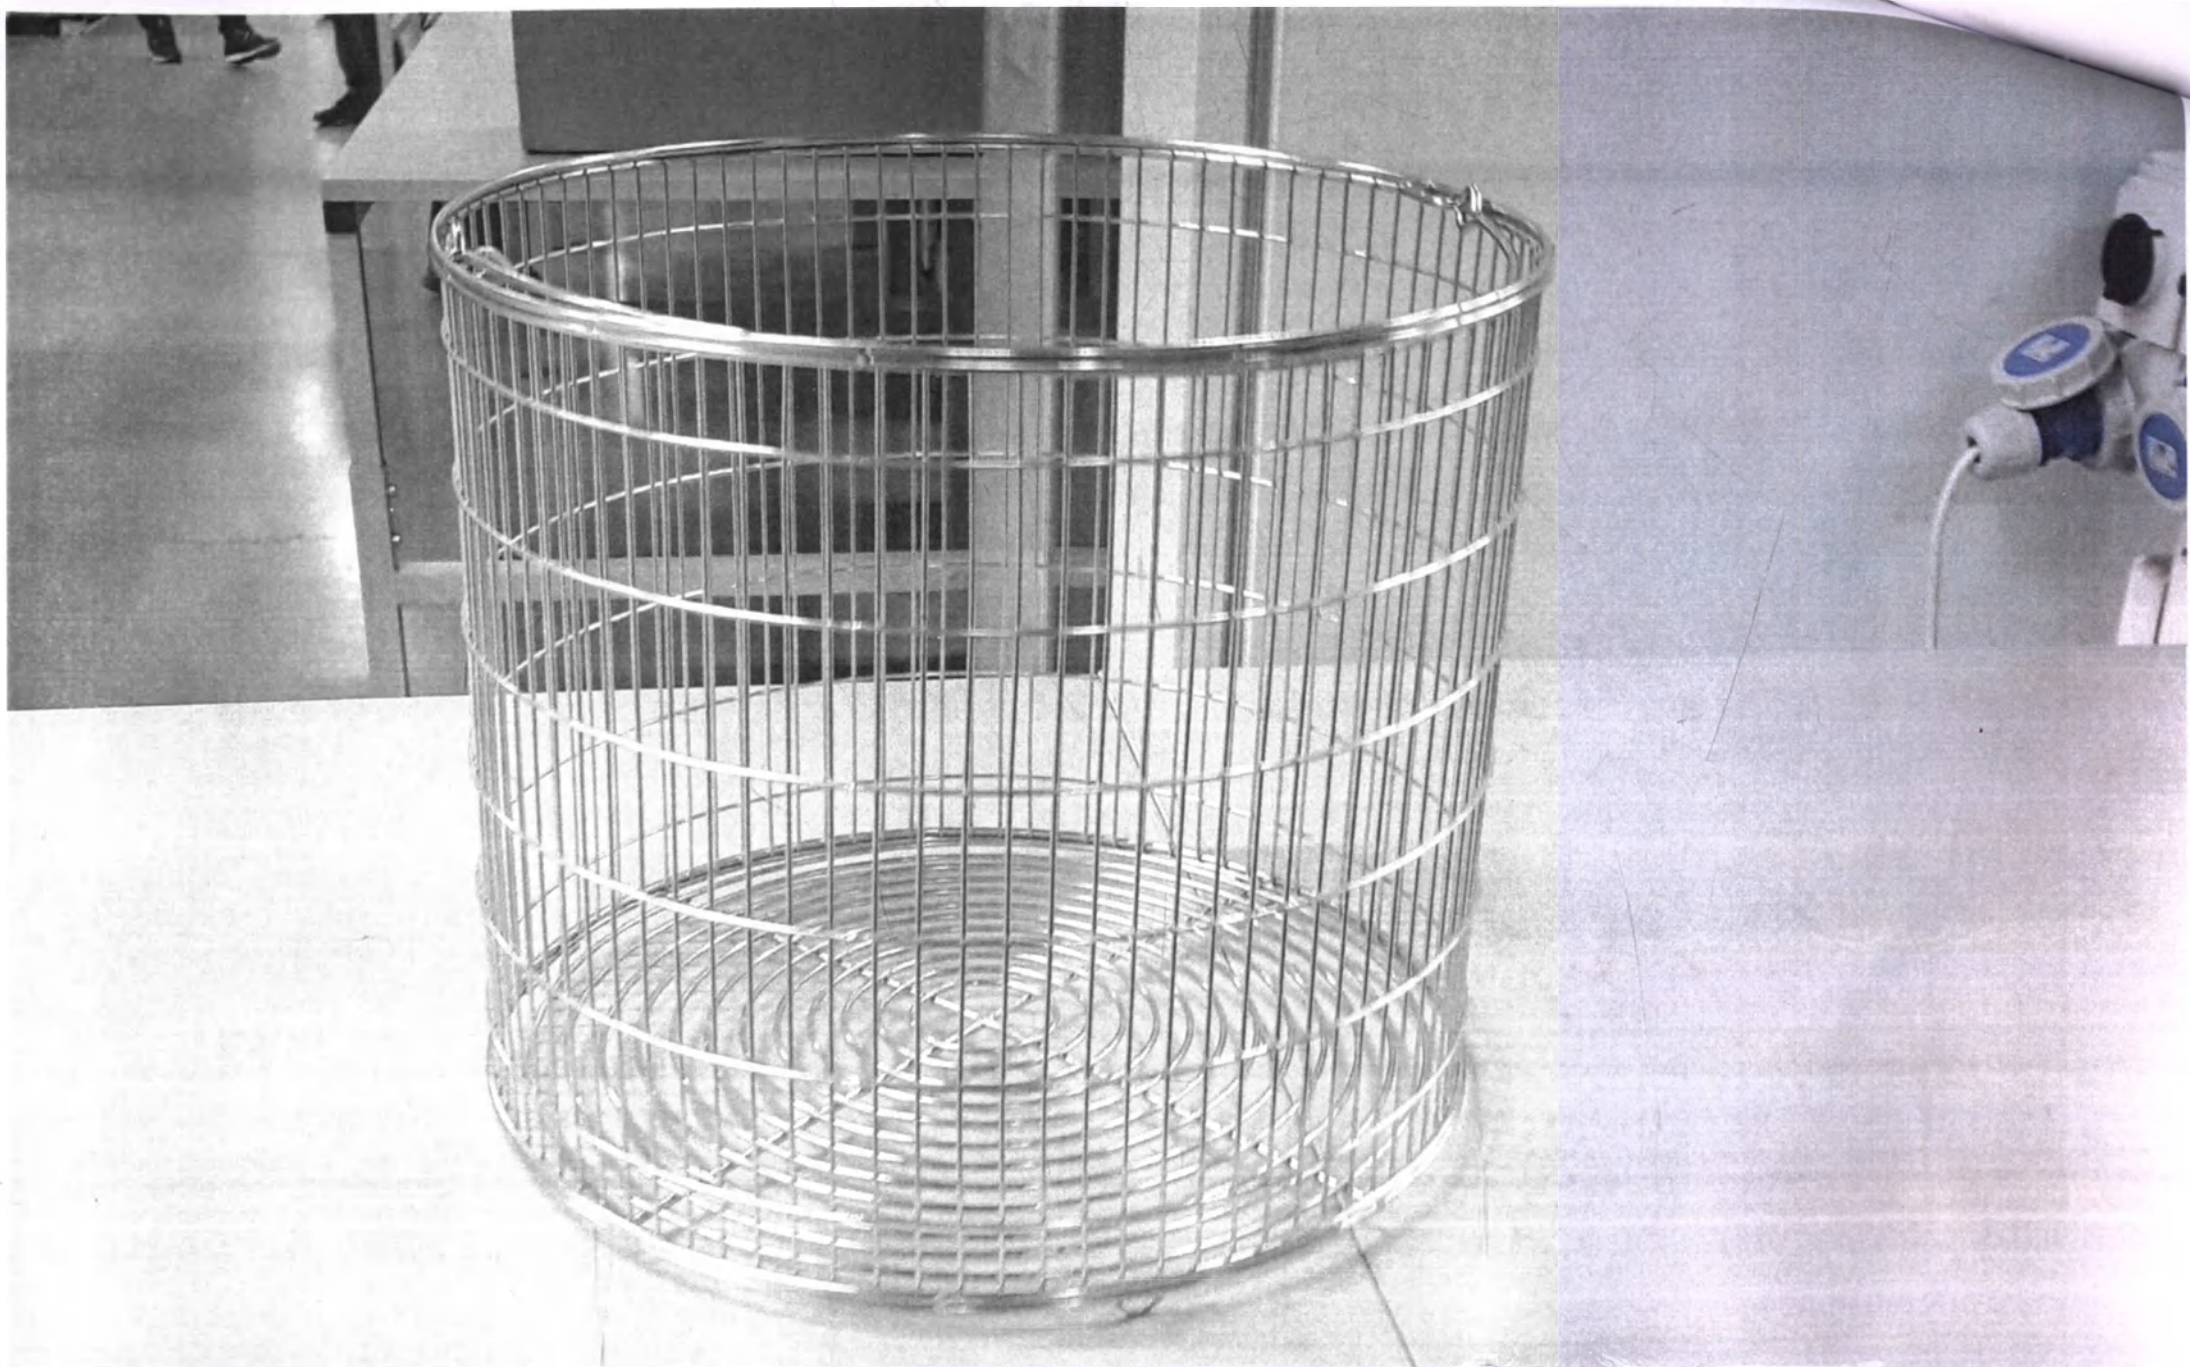

Корзина загрузочная малая для SJ-AD100 SJ-AD100



Контроль за уровнем содержания по объектам:
SY-ADCO, SY-ADSD и SY-AD100

thermo fisher
SCIENTIFIC

thermo
scientific

applied
biosystem

AUTO CLAVE




Поддон металлический для
моделей ST-AD60, ST-AD80 и ST-AD100

Крышка заливного отбора



Розмере аексплуатацне чыгунагу/пазнак
для абмэркае: ST-AD80, ST-AD100

Регистр электросчетчика

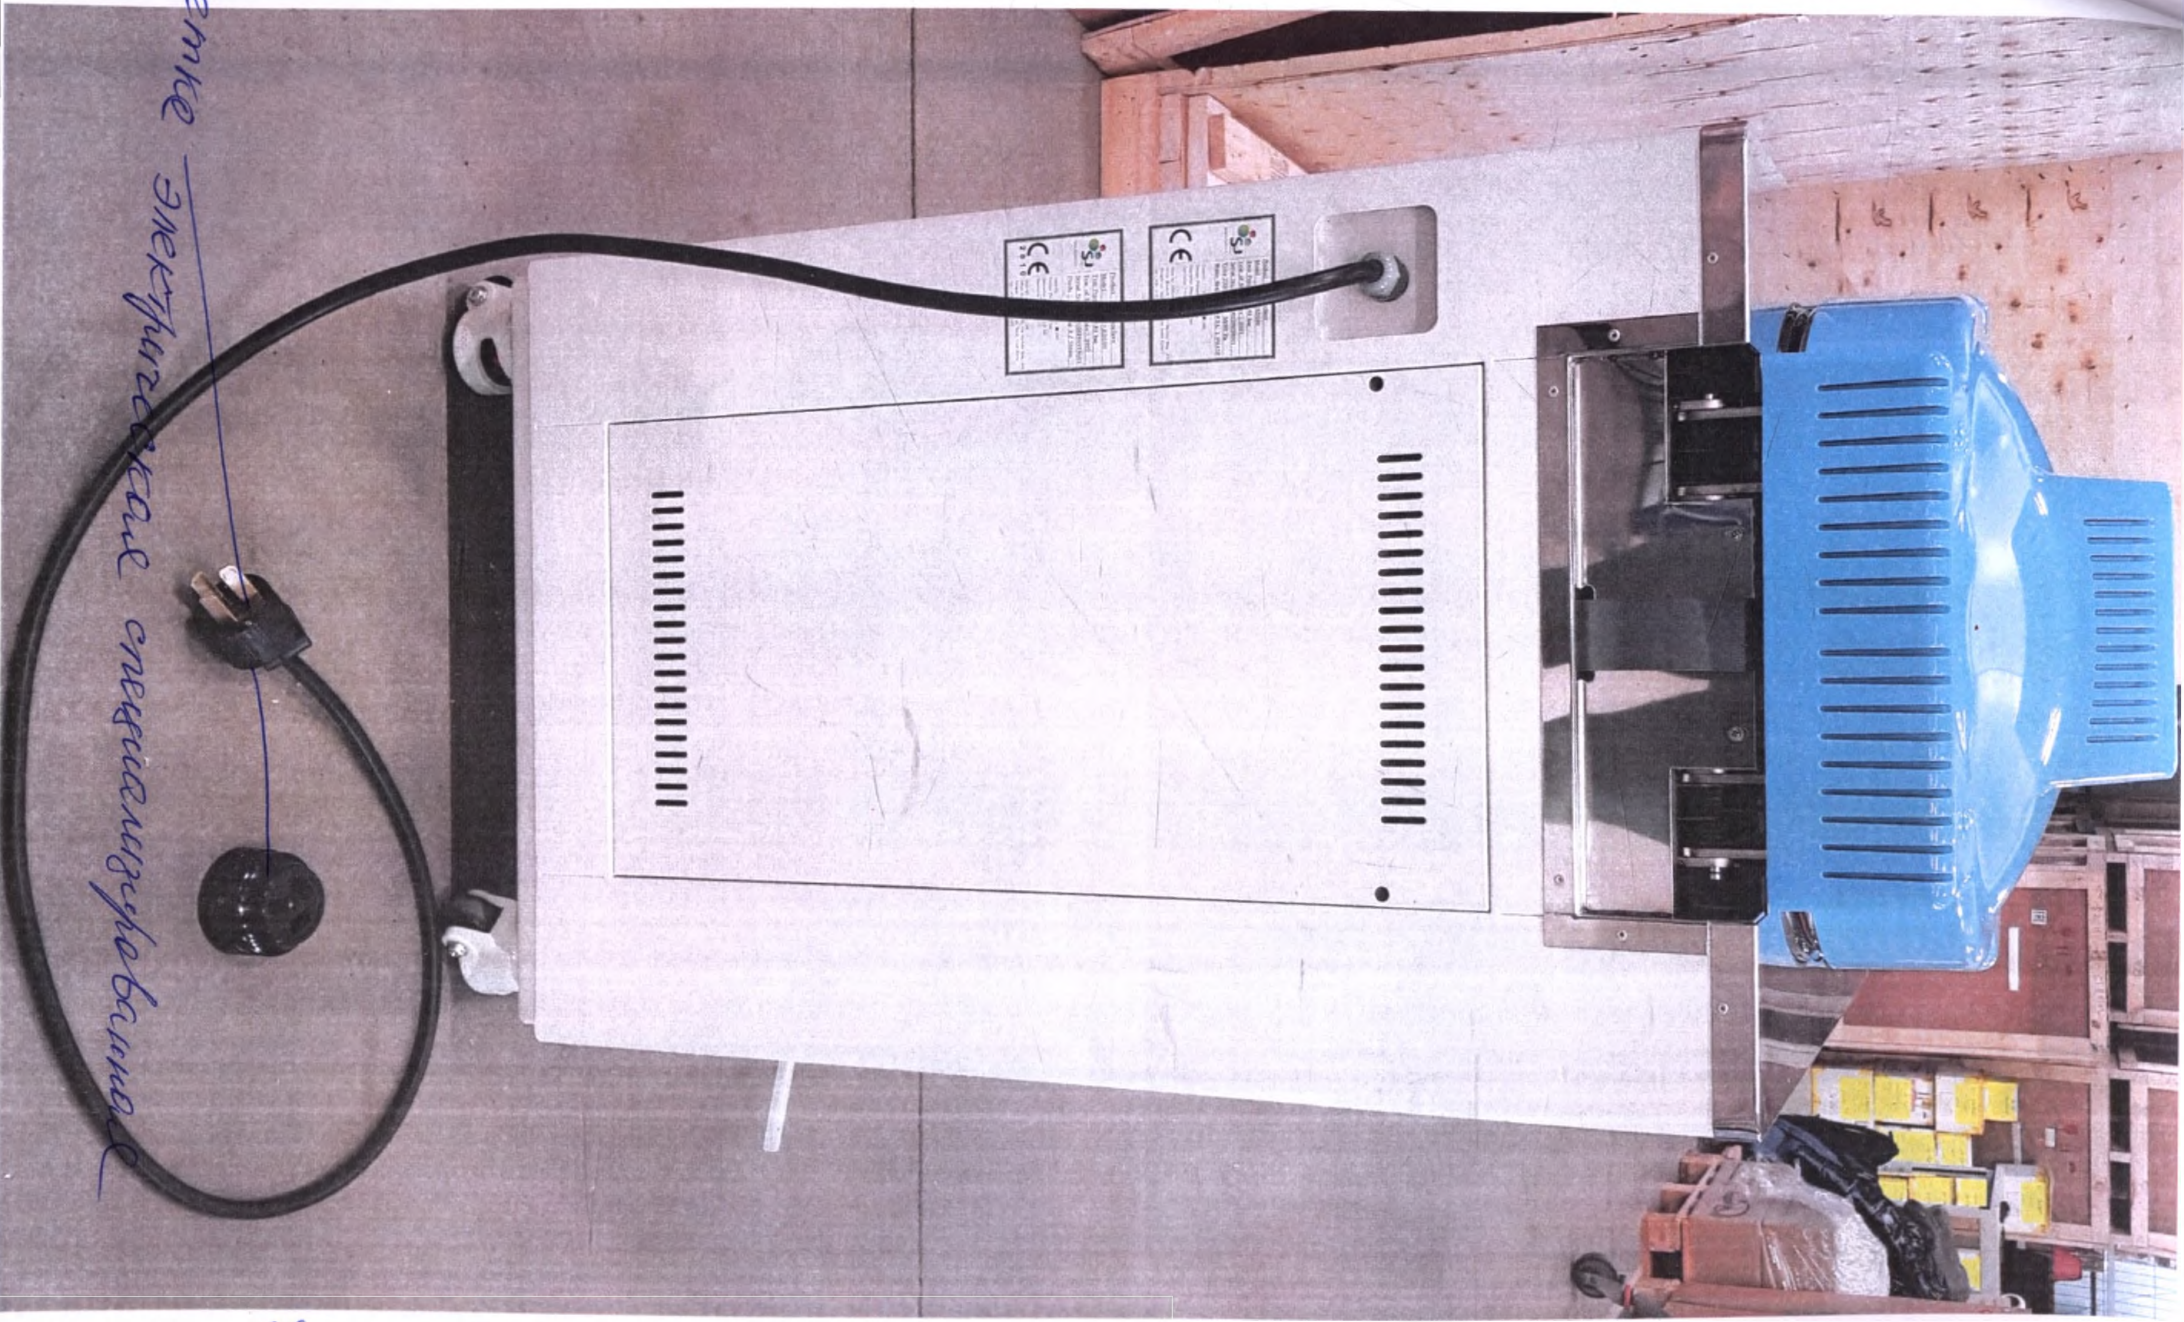


Штукатурка СТ-АД100 без запаха.

Выявлено нарушение при
с гидравлическим давлением: 57-4060,
57-4080, 57-40700

Дымаві напружваліся па банянае нава і з'яўляўся



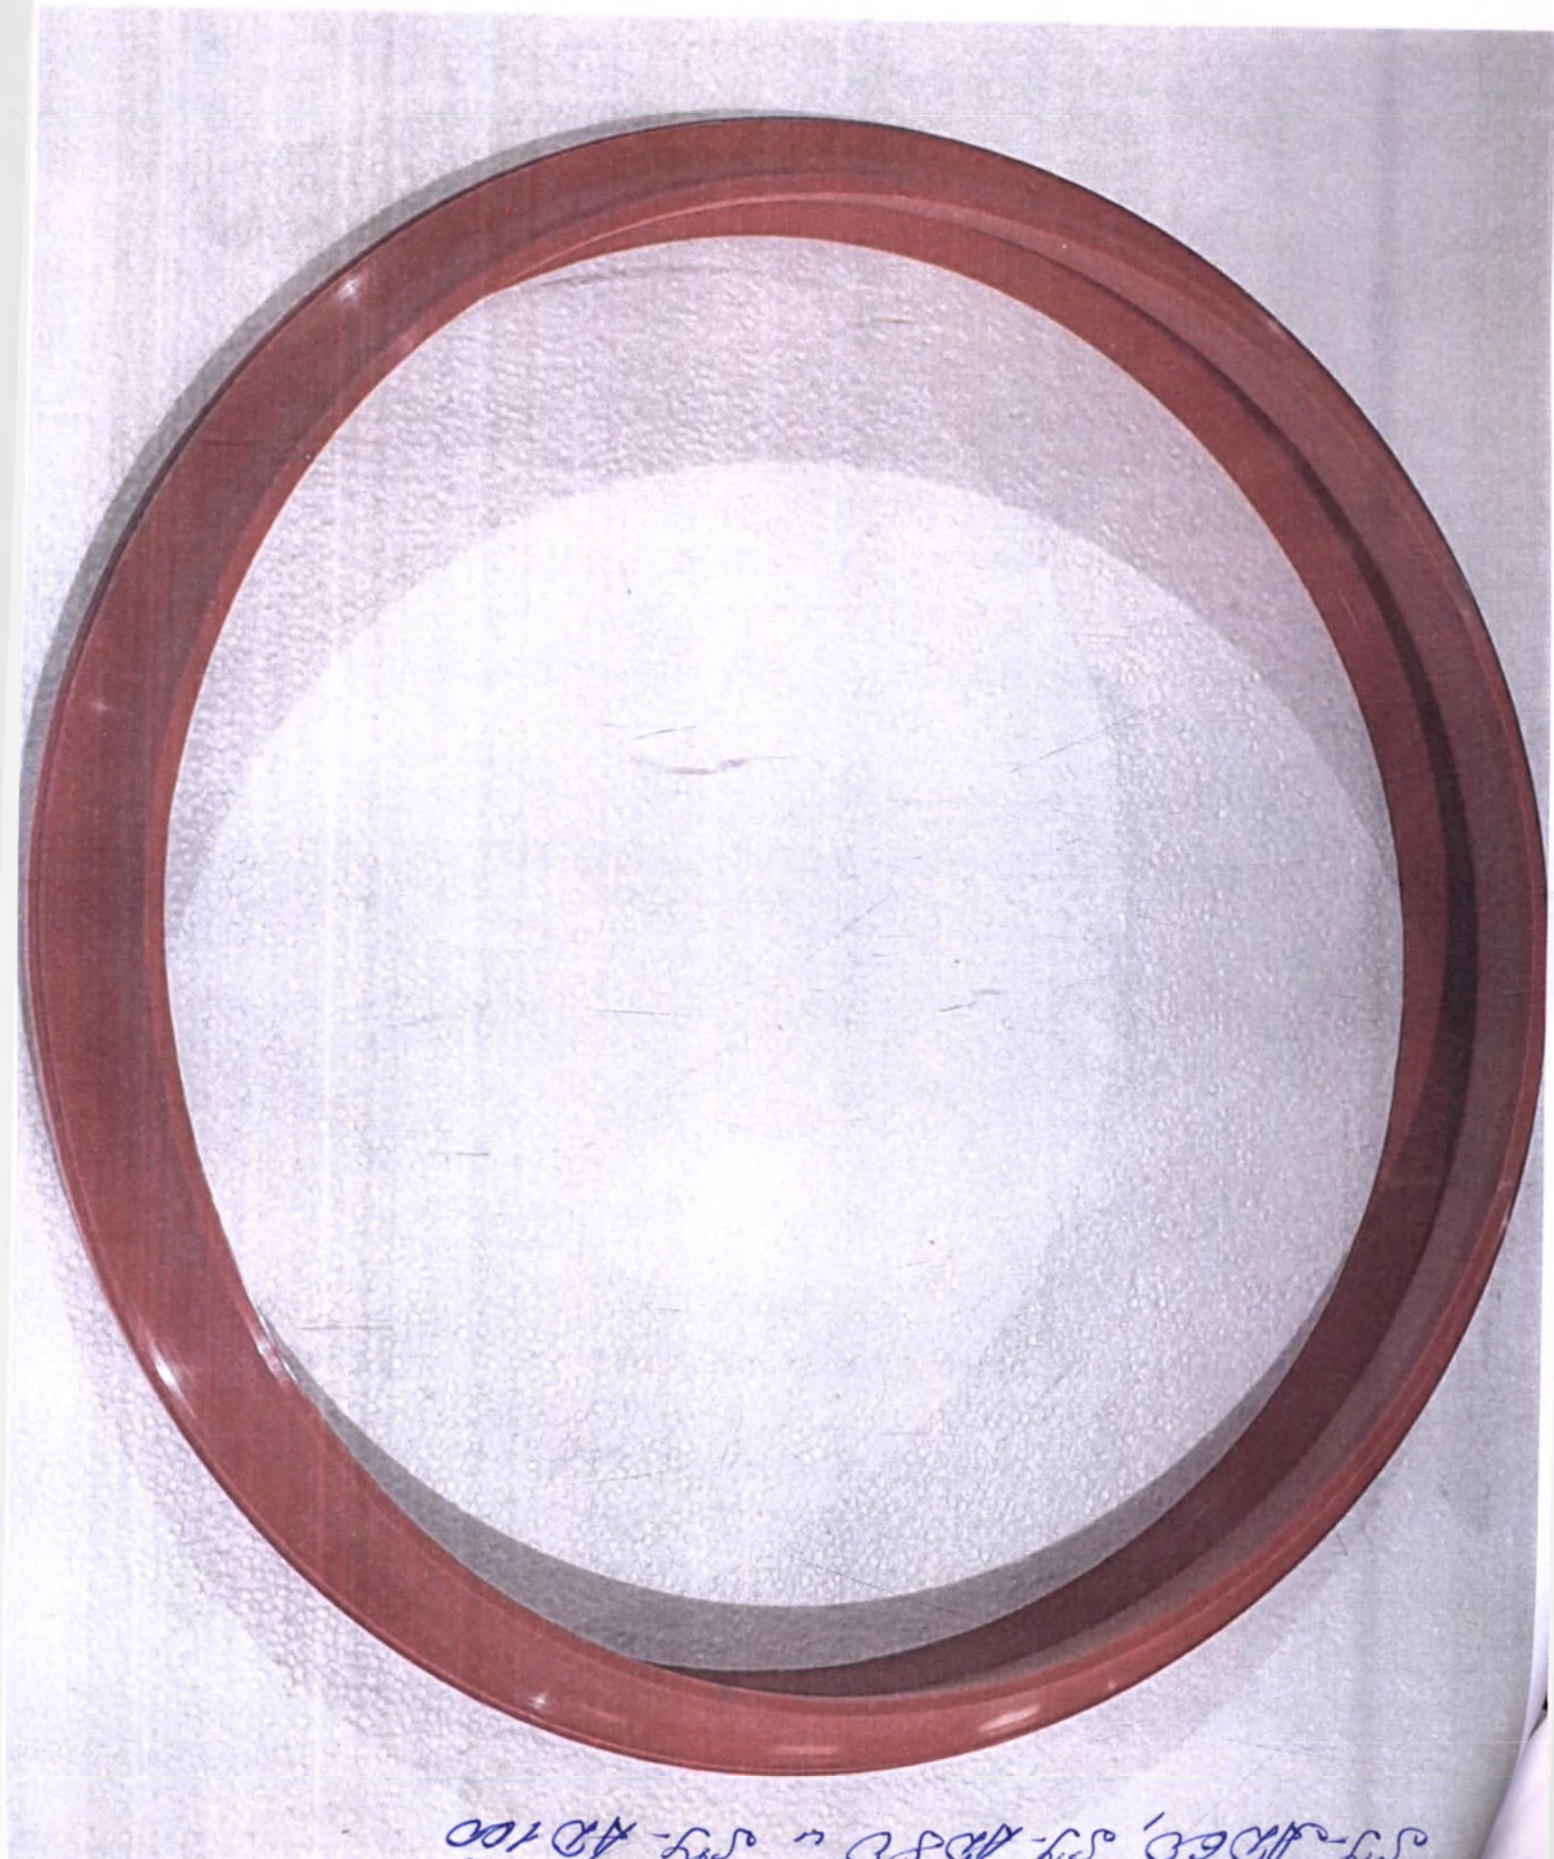

Информация для заказа:
СЗ-АД60, СЗ-АД80 и СЗ-АД100

Маркировка газобезопасности

 www.sjclave.com	Product	Autoclave
	Model	SJ-AD100
	Test Pressure :	2.81 bar
	Year of Manufacture :	2022
	Serial No.	SJAD100220928001
	Volts	220/230 Vac 50/60 Hz
	Watts	4kw AMPS 18.2A, 1 PHASE
	Capacity :	☐ 62L ☐ 81L ☒ 106L
	Design Pressure :	1.2 bar
	Operation Pressure :	1.2 bar
	Operation Temp :	121°C
	Made by.	SJCLAVE Co., Ltd.
	Office:	Room19-20, 10F, The SkyVally Bldg., 416, Hwagok-ro, Gangseo-gu, Seoul, South Korea
	Tel :	+82-2-2131-2992

 www.sjclave.com	Product	Autoclave
	Model	SJ-AD100
	Test Pressure :	2.81 bar
	Year of Manufacture :	2022
	Serial No.	SJAD100220928001
 2 8 1 0	Fluids :	Group 2 / Steam
	Capacity :	☐ 62L ☐ 81L ☒ 106L
	Design Pressure :	1.2 bar
	Operation Pressure :	1.2 bar
	Operation Temp :	121°C
 2 8 1 0	Made by.	SJCLAVE Co., Ltd.
	Office:	Room19-20, 10F, The SkyVally Bldg., 416, Hwagok-ro, Gangseo-gu, Seoul, South Korea
	Tel :	+82-2-2131-2992

Klammern unterhalb dieser Linie!
Clamp below this line!

**WICHTIG**

Einzel- und Einwegtaschen
als Transportbehälter für
verflüssigte Gase.
Ausserhalb der Norm sind
Spezialtaschen aus einer
dickwandigen Folie aus
Kunststoff.

5322115
2-1111

879
SUKC1103270829001

CASE NO. JF 50 CAL NO. 000000000000
 PERM. D. 00000 000000000000

57-201097
HT
ENC-604
57-201097

2-11-40-47
-101357
R.T.
1940-41

HT 20070701

LIBRARY
UNIVERSITY OF MICHIGAN

[illegible]

1970-1971	
1970	1971
1970-1971	1971-1972
1972-1973	

Прошито и скреплено

печатью



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Диаэм»

Шорикова О.В.



Макеты маркировки на медицинское изделие:

**Автоклав (стерилизатор паровой) медицинский, для вариантов исполнения
SJ-AD60, SJ-AD80, SJ-AD100**

Производитель:

SJ CLAVE Co., Ltd

Republic of Korea

(Эс-Джей КЛЭЙВ Ко., Лтд)

(Республика Корея)

10F, Room19-20, The Sky Vally Bldg., 416, Hwagok-ro, Gangseo-gu, Seoul,

Republic of Korea (Республика Корея)

1. Дополнительная этикетка на автоклаве (необходимо наклеить на автоклав в дополнение к имеющейся этикетке)

Автоклав (стерилизатор паровой) медицинский SJ-AD100

Дата выпуска: 2022-09

Серийный №: SJAD100220928001

~220/230 В, 50/60 Гц, 4 кВт, 18,2 А

Объем камеры: 106 л (106 дм³)

Испытательное давление: 2,81 бар

Рабочее давление: 1,2 бар

Рабочая температура: 121 °C

Производитель: «SJ CLAVE Co., Ltd», Республика Корея


РУ № ____ от ____

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Диаэм»

129345, Российская Федерация, г. Москва ул. Магаданская, д. 7, корпус

3, эт. 2, офис 210

+7(495) 745-05-08



IP2X

2. Этот знак наклеивается на внешнюю сторону крышки камеры стерилизационной (сверху автоклава на крышку)



3. Маркировка на транспортную упаковку



**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Диаэм»

129345, Российская
Федерация, г. Москва
ул. Магаданская, д. 7,
корпус 3, эт. 2, офис
210

+7(495) 745-05-08



-25°C



+45°C

**Автоклав (стерилизатор паровой)
медицинский SJ-AD100**

Дата выпуска: 2022-09

Серийный №: SJAD100220928001

~220/230 В, 50/60 Гц, 4 кВт, 18,2 А

Объем камеры: 106 л (106 дм³)

Испытательное давление: 2,81 бар

Рабочее давление: 1,2 бар

Рабочая температура: 121 °C

Производитель: «SJ CLAVE Co.,
Ltd», Республика Корея
10F, Room19-20, The Sky Vally Bldg.,
416, Hwagok-ro, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

+82 2-2131-2992

РУ № ____ от ____

Прошито и скреплено

печатью  листов

