



УТВЕРЖДАЮ
Финансовый директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»
В.Г. Гуляева

Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения содержания С-
реактивного белка в сыворотке крови человека (CRP)

ETI11241300-2

CRP HumaStar

Σ 100

LOT

REF 11241300


LOT 22002

BUF / R1 1 x 100 Σ 0016

AS / R2 1 x 100 Σ 0016

⌚ 2023-09-30

⌚ 2...8°C



Warning
H319

IVD ⓘ CE



(01)04033145191957

(10)22002(93)0(17)230930

Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 65205 Wiesbaden Germany

Human


Diagnostics Worldwide


Набор реагентов для количественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови человека (CRP)
 Вариант исполнения 1, в составе:
 - Раствор буферный (R1), 1 флакон 100 тестов;
 - Раствор антикальворитин (R2), 1 флакон 100 тестов;
 - Инструкция по применению, 1 шт.
 Промышленность:
 HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
 Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
 Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____ г.
 Температура хранения и транспортирования от +2 °C до +8 °C
 Медицинское изделие для диагностики in vitro
 Для профессионального применения
 Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА"
 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2.2, корп. 1.
 Ссылочный, применяемые в маркировке изделия, приведены на
 оригинальной упаковке
 Кат. № 11241300
 LOT № 22002
 Годен до 30.09.2023



Human
 Diagnostics Worldwide

Фотографическое изображение 2 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «CRP» с русскоязычным стикером, Вариант исполнения 1

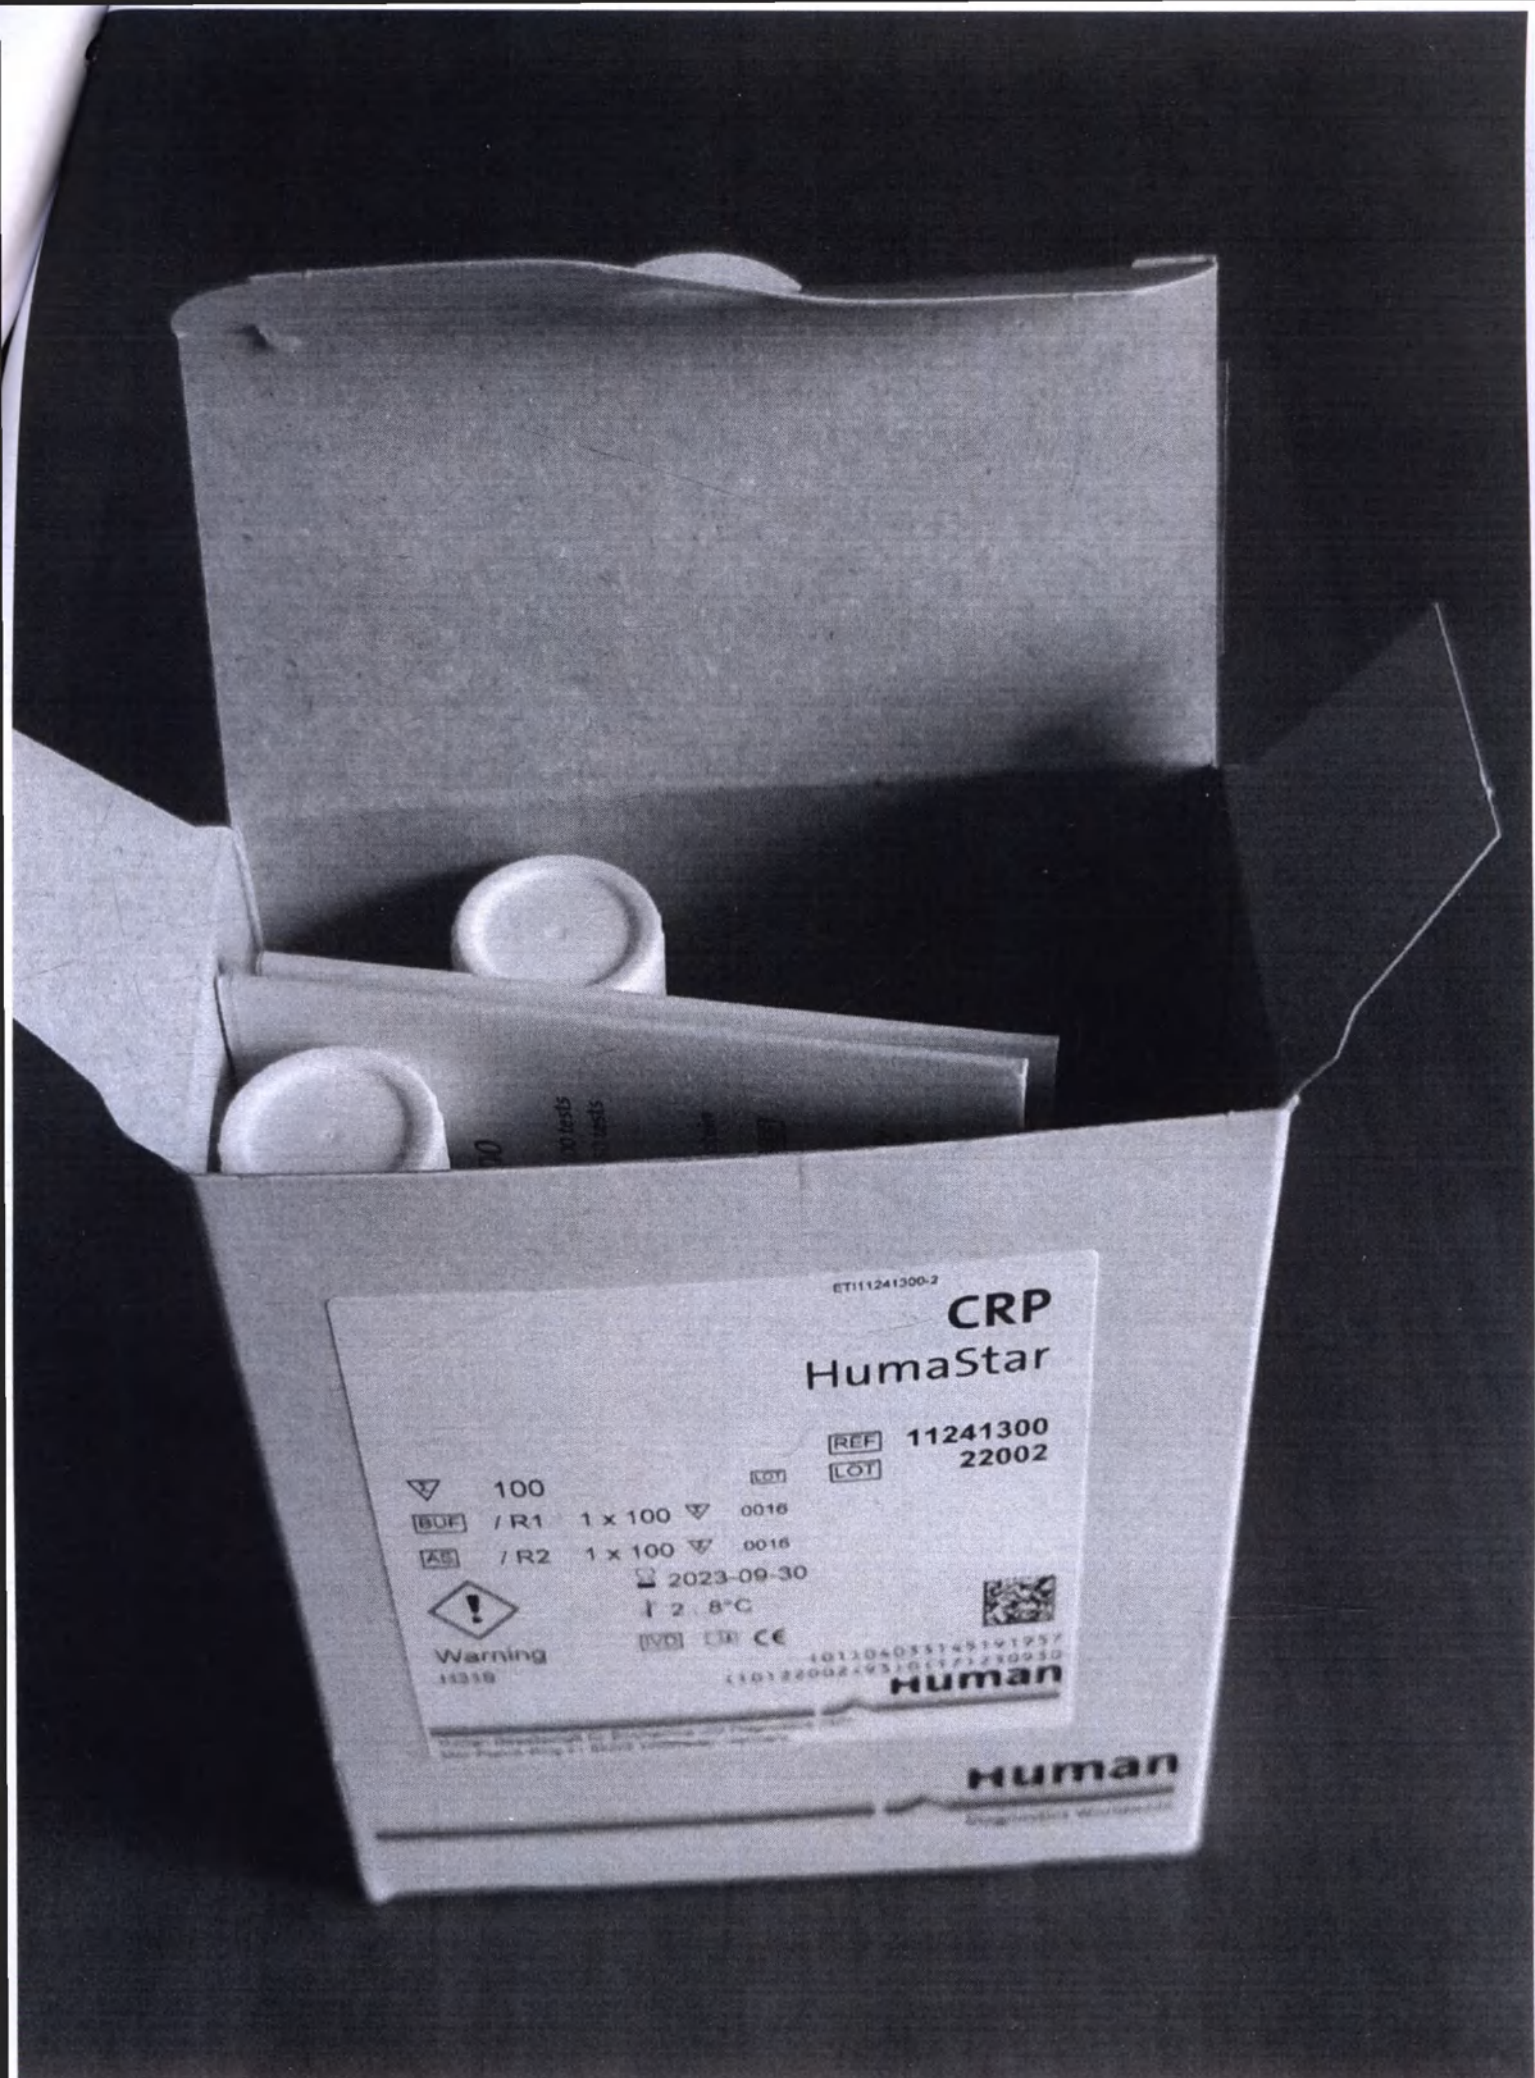

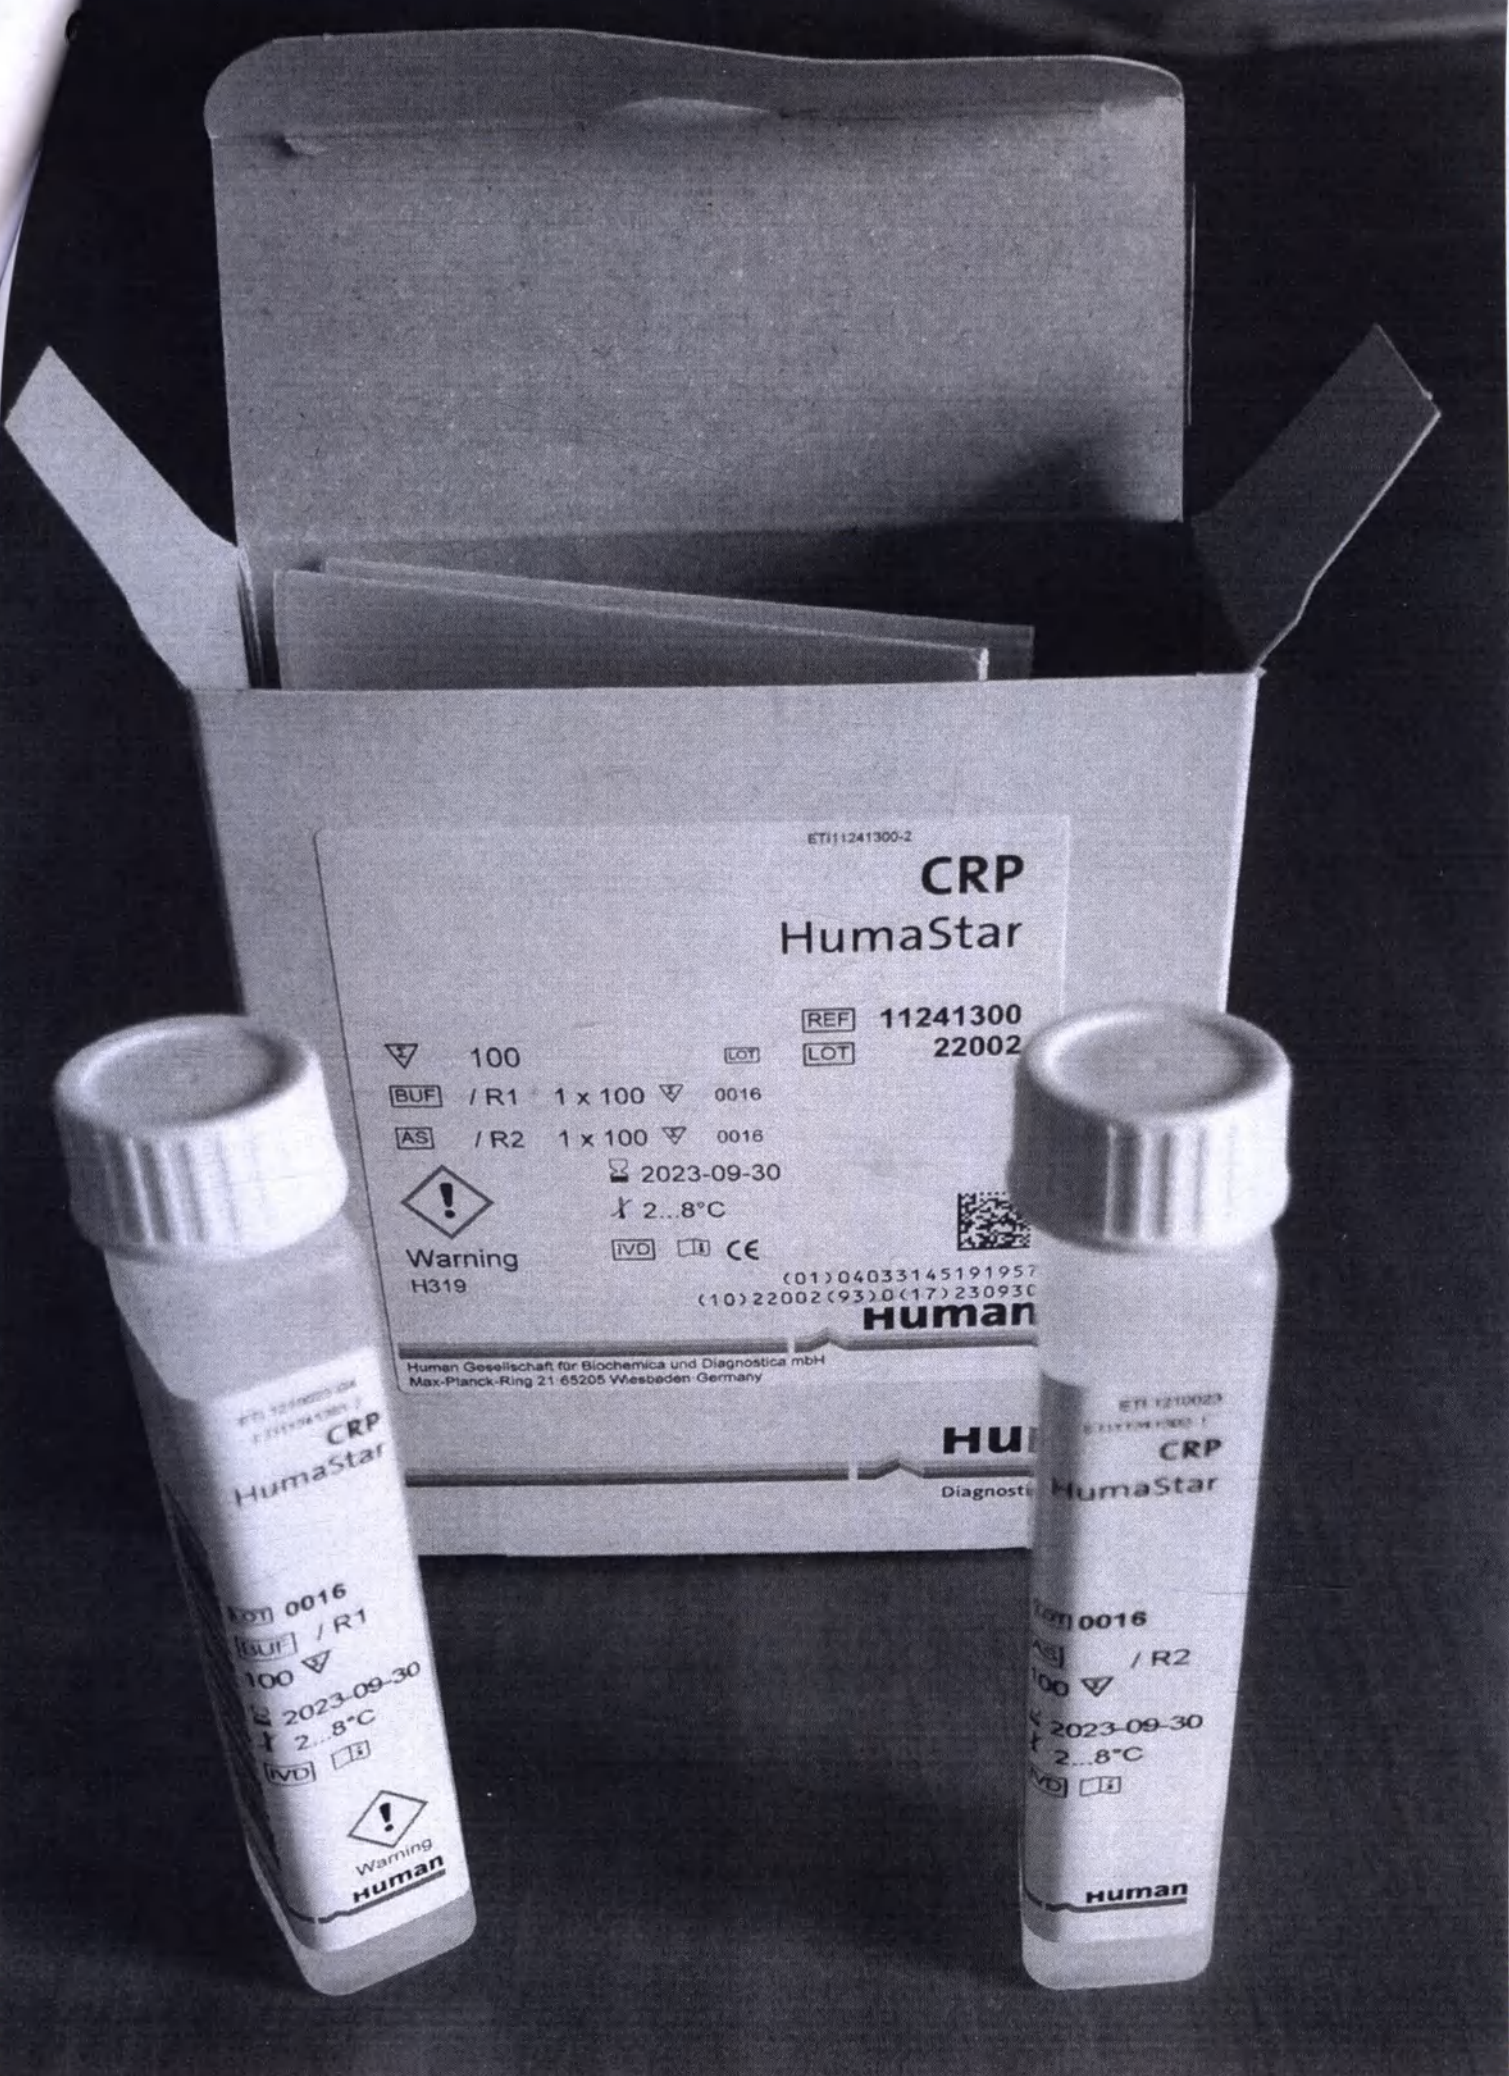

ETI11241300-2

CRP HumaStar

REF 11241300
LOT 22002

▽ 100
BUF / R1 1 x 100 ▽ 0016
AS / R2 1 x 100 ▽ 0016

2023-09-30

2...8°C



Warning
H319

IVD CE



(01)04033145191957
(10)22002(93)0(17)230930

human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 65205 Wiesbaden Germany

HU

Diagnosti

CRP
HumaStar

ETI 11241300-2
CRP
HumaStar


Lot 0016
BUF / R1
100 ▽
2023-09-30
2...8°C
IVD




Warning
human

ETI 11241300-2
CRP
HumaStar
Lot 0016
AS / R2
100 ▽
2023-09-30
2...8°C
IVD

human

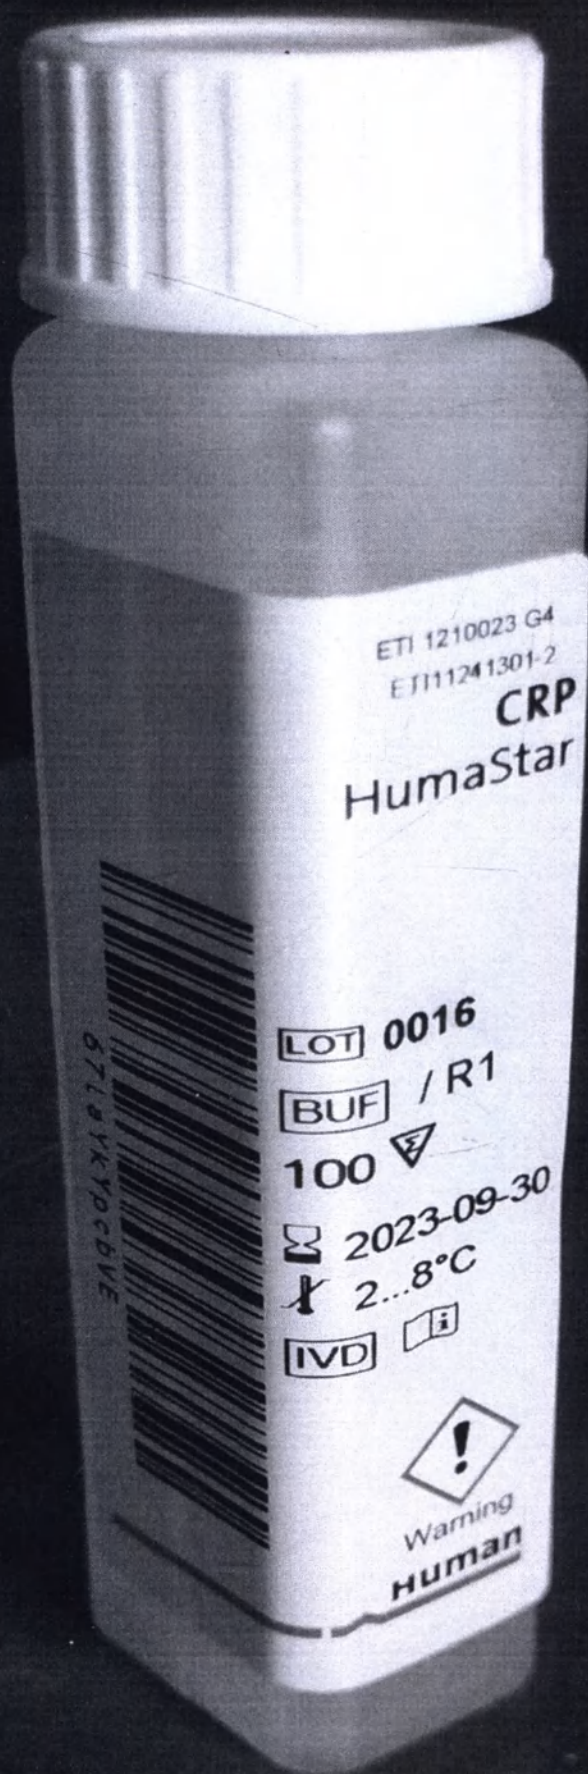

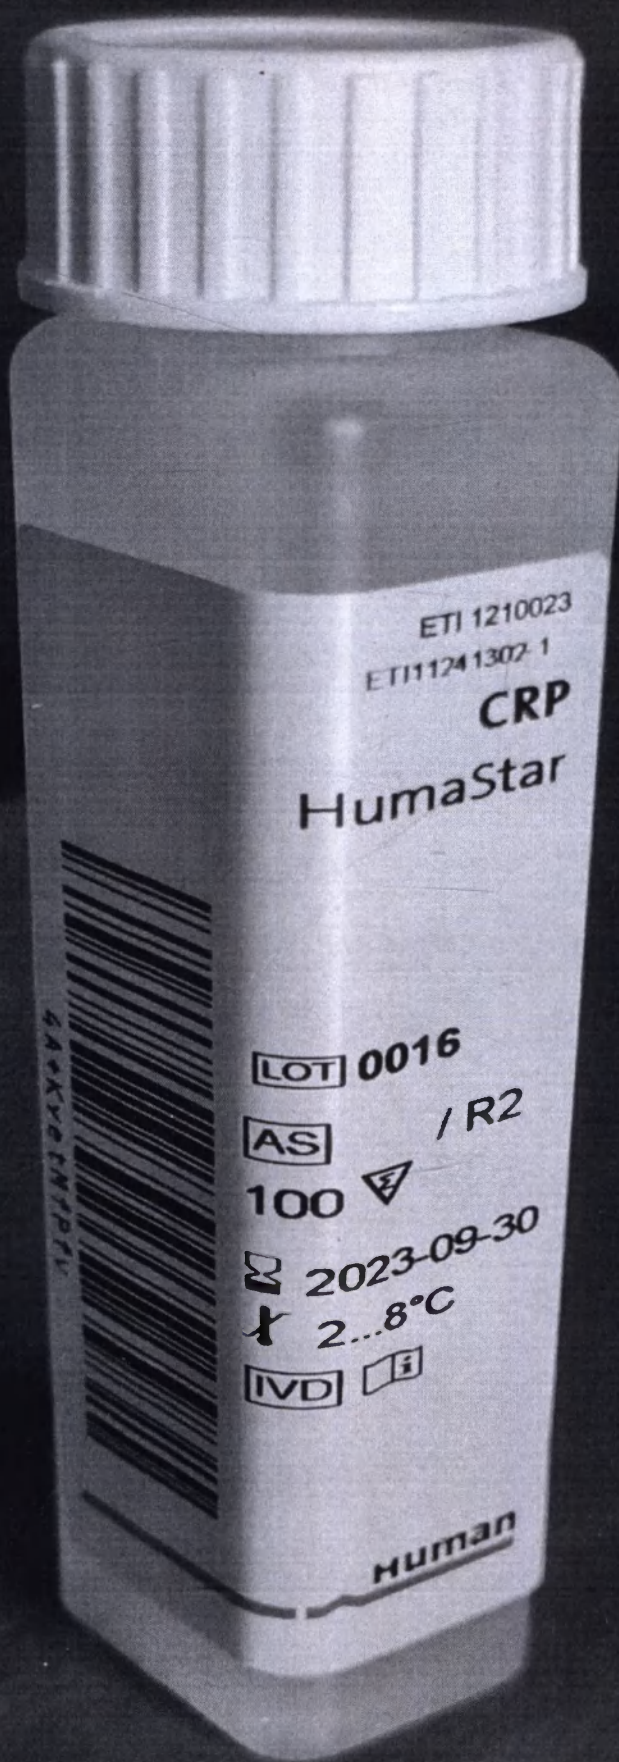

ETI11241600-6

CRP

HumaStar

REF 11241600

LOT 22002

Σ 250

LOT

BUF / R1 250

Σ 0106

AS / R2 250

Σ 0106

2023-09-30

2...8°C



Warning

H319

IVD



CE

(01)04033145121466

(10)22002(93)0(17)230930

Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 65205 Wiesbaden Germany

Human

Diagnostics Worldwide

Набор реагентов для количественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови человека (CRP)

Вариант исполнения 2, в составе:

- Раствор буферный (R1), 1 флакон 250 тестов;
- Раствор антисыворотки (R2), 1 флакон 250 тестов;
- Инструкция по применению, 1 шт.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Температура хранения и транспортирования от +2 °C до +8 °C

Регистрационное Удостоверение №: РЗН _____ от _____ г.

Медицинское изделие для диагностики in vitro

Для профессионального применения.


Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1.

Символы, применяемые в маркировке изделий, приведены на оригинальной упаковке.

Kat. №: 11241600

ЛОТ №: 22002


Годен до: 30.09.2023




human

Diagnostics Worldwide

Фотографическое изображение 8 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «CRP» с русскоязычным стикером, Вариант исполнения 2

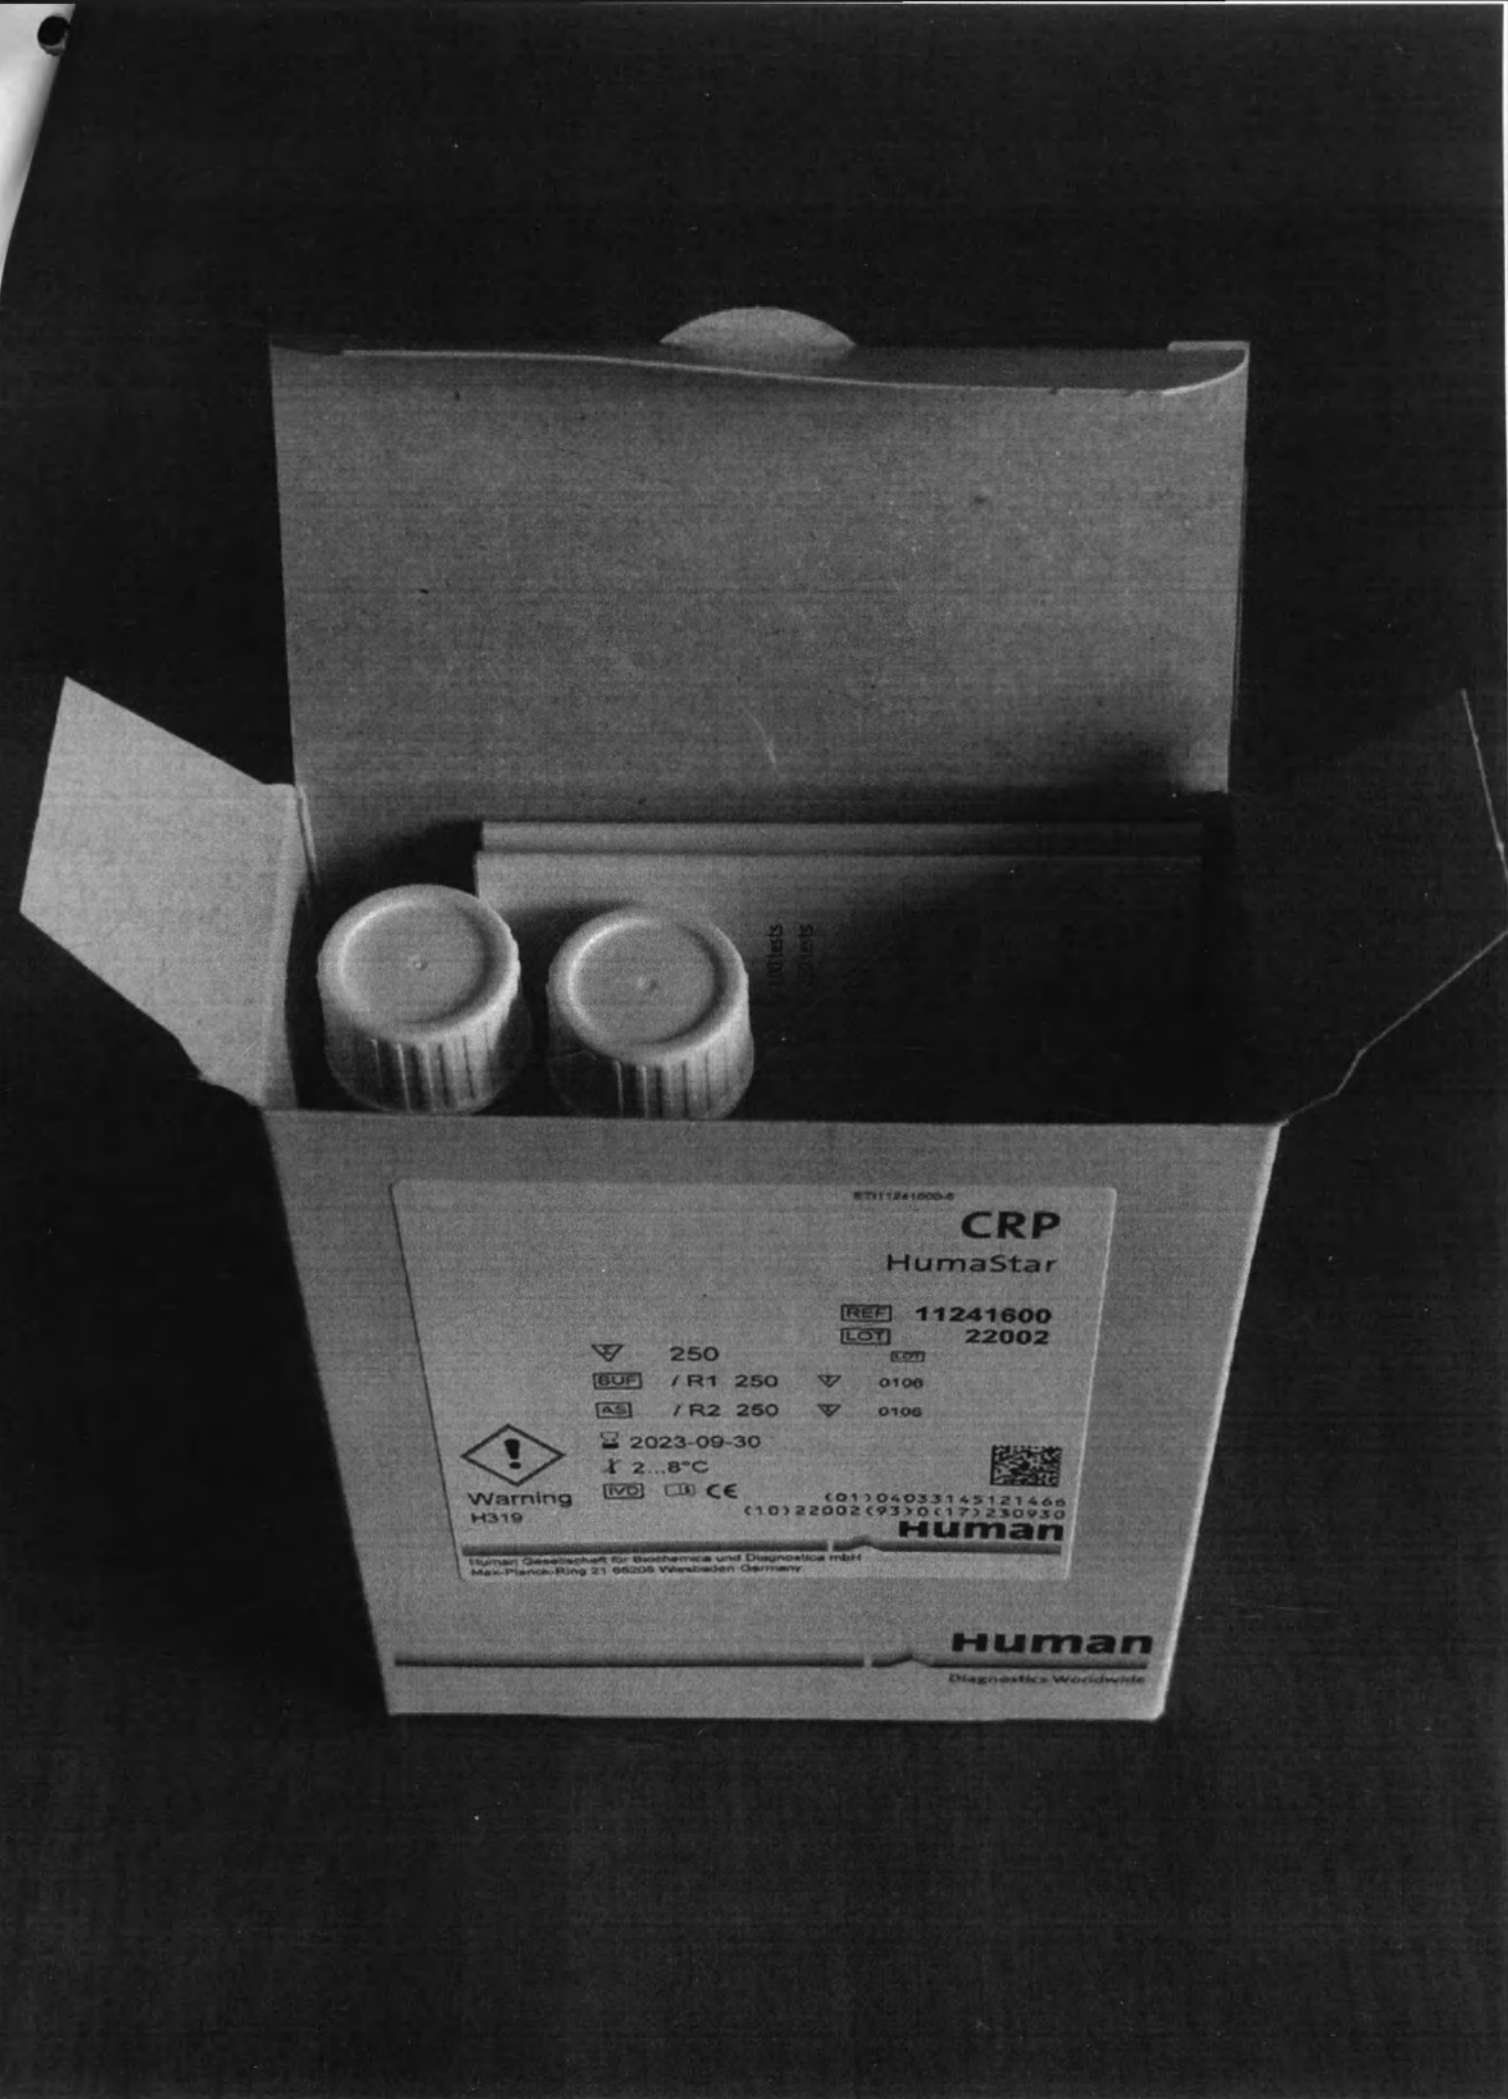

Фотографическое изображение 9 – Внешний вид потребительской упаковки Набора реагентов «CRP», Вариант исполнения 2

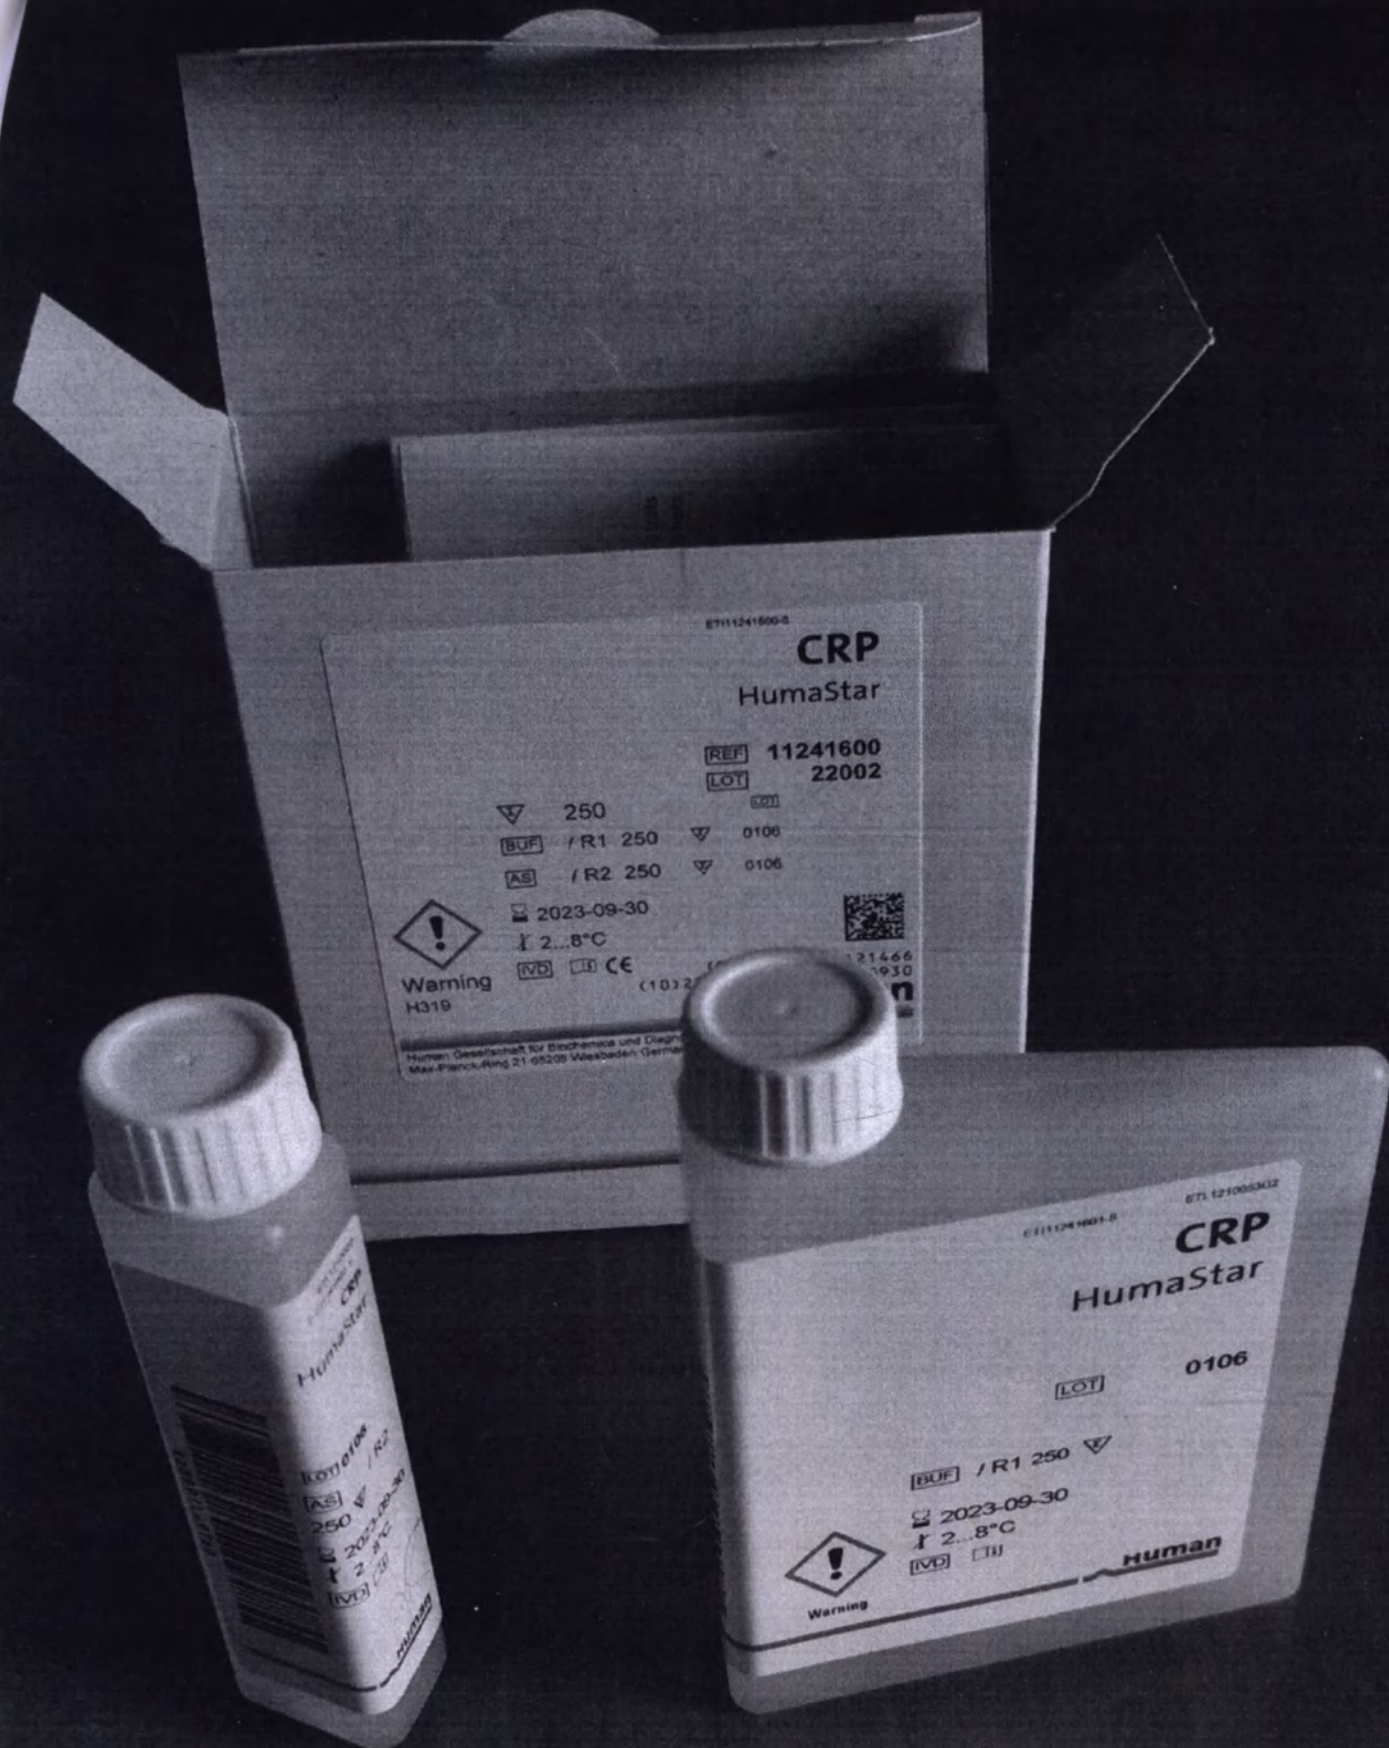

ETI11241601-6

ETI 1210053G2

CRP

HumaStar

LOT

0106

BUF / R1 250 Σ

🕒 2023-09-30


🌡 2...8°C

IVD ⓘ



Warning

human

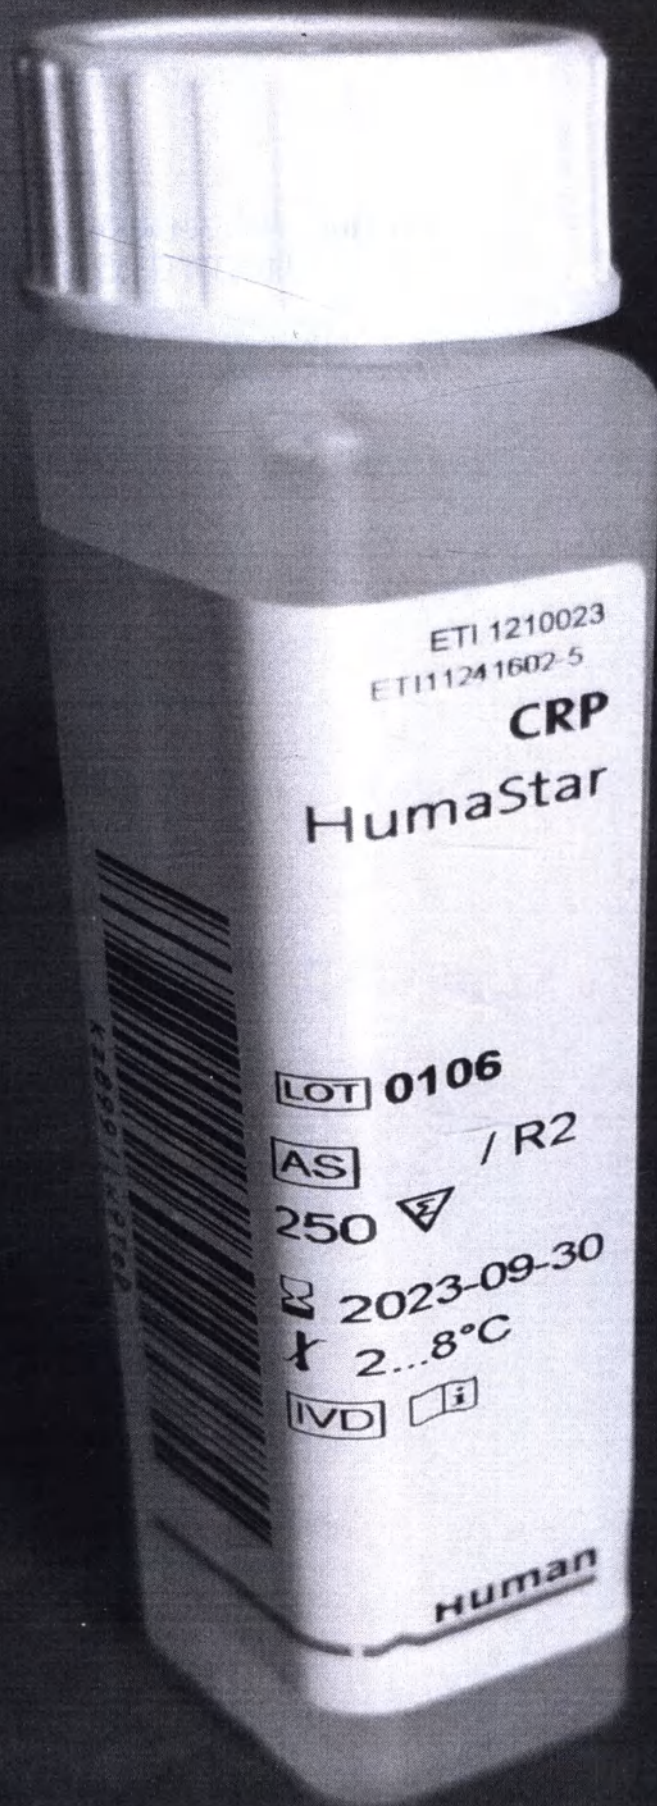

ETI 1210023
ETI11241602-5

CRP
HumaStar

LOT 0106

AS / R2

250

2023-09-30

2...8°C

IVD

human

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 13 листов.

Финансовый директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»

 Гуляева В.Г.

