

УТВЕРЖДАЮ
Представитель
ООО «РИТМАНН»



 Захаров Д.Г.
 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:
Ларингоскоп интубационный многоразового использования
с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Simplight, размер 3



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Т-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Oxford, вариант исполнения Simplight, размер 1



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1



Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5



Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4



Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4



Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight ①

Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight ②

Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight ③



Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight ①

Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight ②

Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight ③



Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight ①

Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight ②



Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight ①

Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight ②

Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight ③



Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight ①

Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight ②



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную лампу 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4) вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller, вариант исполнения Simplight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Simplight, размер 3 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Simplight, размер 3 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Simplight, размер 3 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Т-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Т-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Simplight, размер 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Foregger, вариант исполнения Simplight, размер 0, 1, 2, 3, 4 – 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с тонкой рукоятью, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Oxford, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, тонкая, под лампу вакуумную лампу 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный с короткой рукоятью, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Oxford, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, короткая, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Simplight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Oxford, вариант исполнения Simplight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа лампочного, средняя, под лампу вакуумную 2,5 В, вариант исполнения Simplight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 2L, 3, 4, 5 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоятка ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight- 1 шт.



**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Fibrolight, размер 00, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Polio, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Polio, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1 шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (3), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Fibrolight, размер 3 - 1шт;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Т-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Т-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Т-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Т-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight, 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Т-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Т-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоятка ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип T-Pro зубосберегающий, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип T-Pro зубосберегающий, вариант исполнения Fibrolight, размер 2 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Firbrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Firbrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Firbrolight, размер 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Firbrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Firbrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоятка ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Fibrolight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Firbrolight, размер 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой LED 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой XENON 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения
Fibrolight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукояткой с лампой XENON 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:


1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.

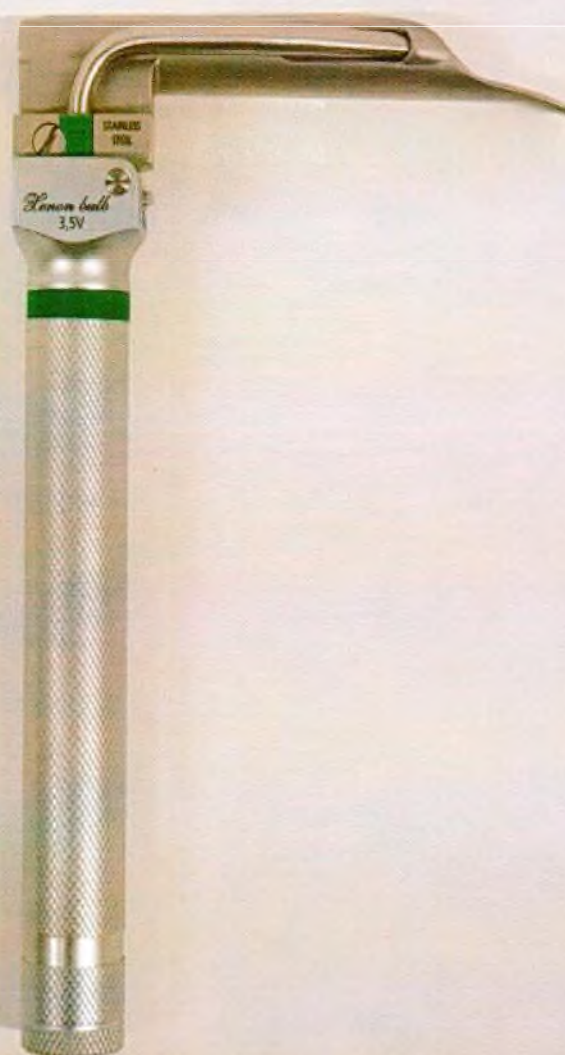

**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой XENON 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения
Fibrolight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;

2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Foregger, в размерах (0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Foregger, вариант исполнения Fibrolight, размер 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой XENON 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой XENON 2,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Oxford, в размерах (1), вариант исполнения Fibrolight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, сменный оптоканал, тип Oxford, вариант исполнения Fibrolight, размер 1 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, в размерах, тип Macintosh (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh, в размерах (0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh, вариант исполнения Maxlight, размер 0, 1, 2, 3, 3SC, 4, 5 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Miller, в размерах (00, 0, 1, 2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Miller, вариант исполнения Maxlight, размер 00, 0, 1, 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоятка ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой LED 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоятка ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой LED 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight
В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой LED 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой LED 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



**Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой руко-
ятью с лампой XENON 2,5 В, Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight**

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight – 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с короткой рукояткой с лампой XENON 2,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, короткая, с лампой XENON 2,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический с тонкой рукоятью с лампой XENON 3,5 В, Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, тонкая, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический со средней рукоятью с лампой XENON 3,5 В, тип Macintosh Flex, в размерах (2, 3, 4), вариант исполнения Maxlight

В сборе:

1. Клинок ларингоскопа фиброоптического, несменный оптоканал, тип Macintosh Flex, вариант исполнения Maxlight, размер 2, 3, 4 - 1 шт.;
2. Рукоять ларингоскопа фиброоптического, средняя, с лампой XENON 3,5 В, вариант исполнения Fibrolight - 1 шт.



Лампа вакуумная для клинков малая 2,5 В с линзой прозрачной для клинков – 1 шт. ①


Лампа вакуумная для клинков большая 2,5 В с линзой прозрачной для клинков – 1 шт. ②

Лампа вакуумная для клинков малая 2,5 В с линзой матовой для клинков – 1 шт. ③

Лампа вакуумная для клинков большая 2,5 В с линзой матовой для клинков – 1 шт. ④




- | | |
|--|---|
| Лампа малая галогеновая XENON 2,5 В для рукоятей | ① |
| Лампа большая галогеновая XENON 3,5 В для рукоятей | ② |
| Лампа малая LED 2,5 В для рукоятей | ③ |
| Лампа большая LED 3,5 В для рукоятей | ④ |

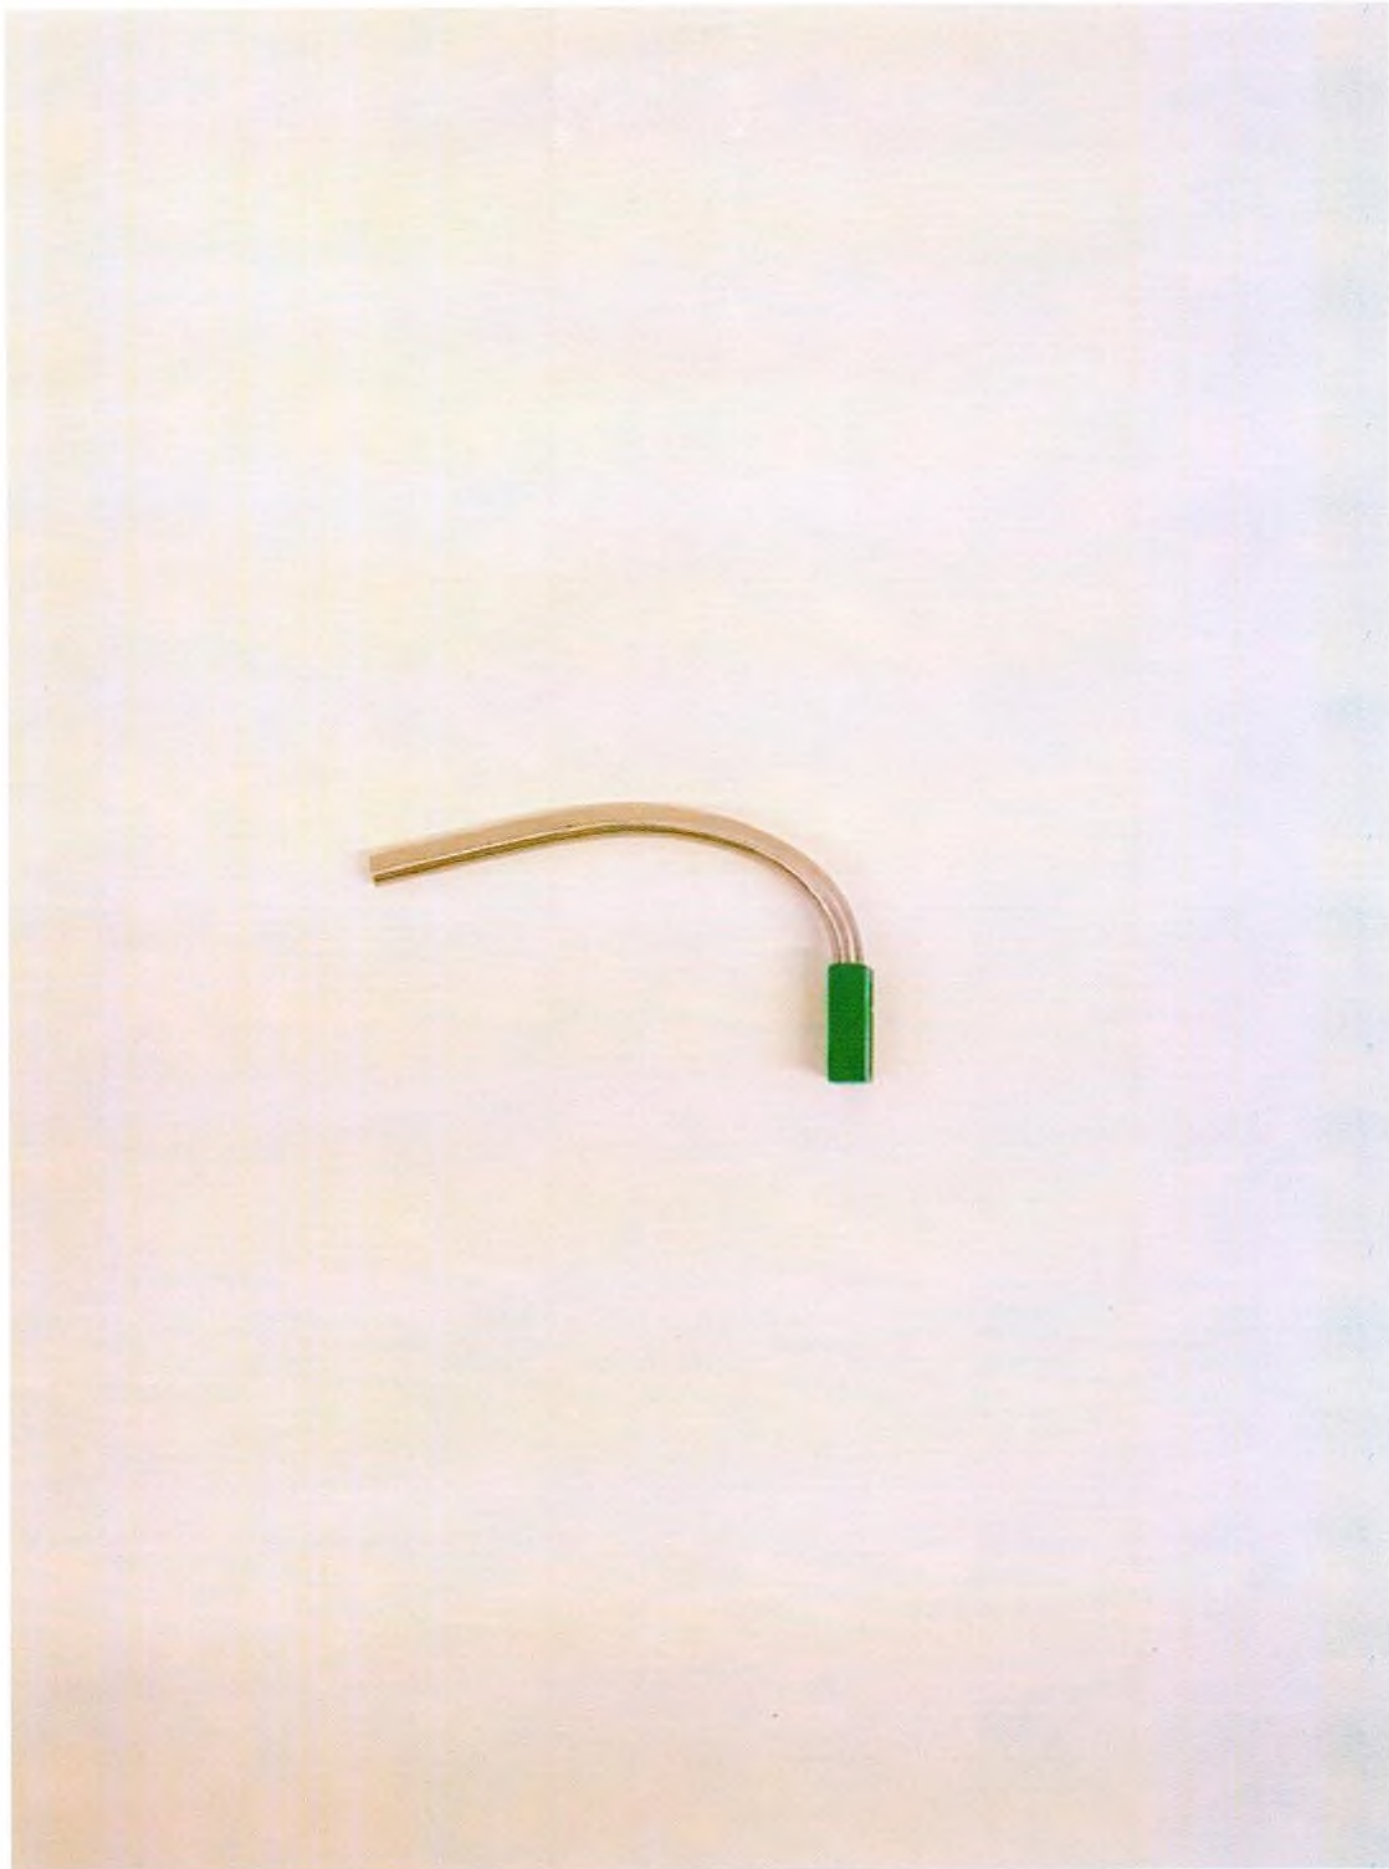


Внешний вид сменного оптоканала для клинка на примере изделия

Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh Overview с улучшенным обзором, вариант исполнения Firbrolight, размер 3 – 1шт.

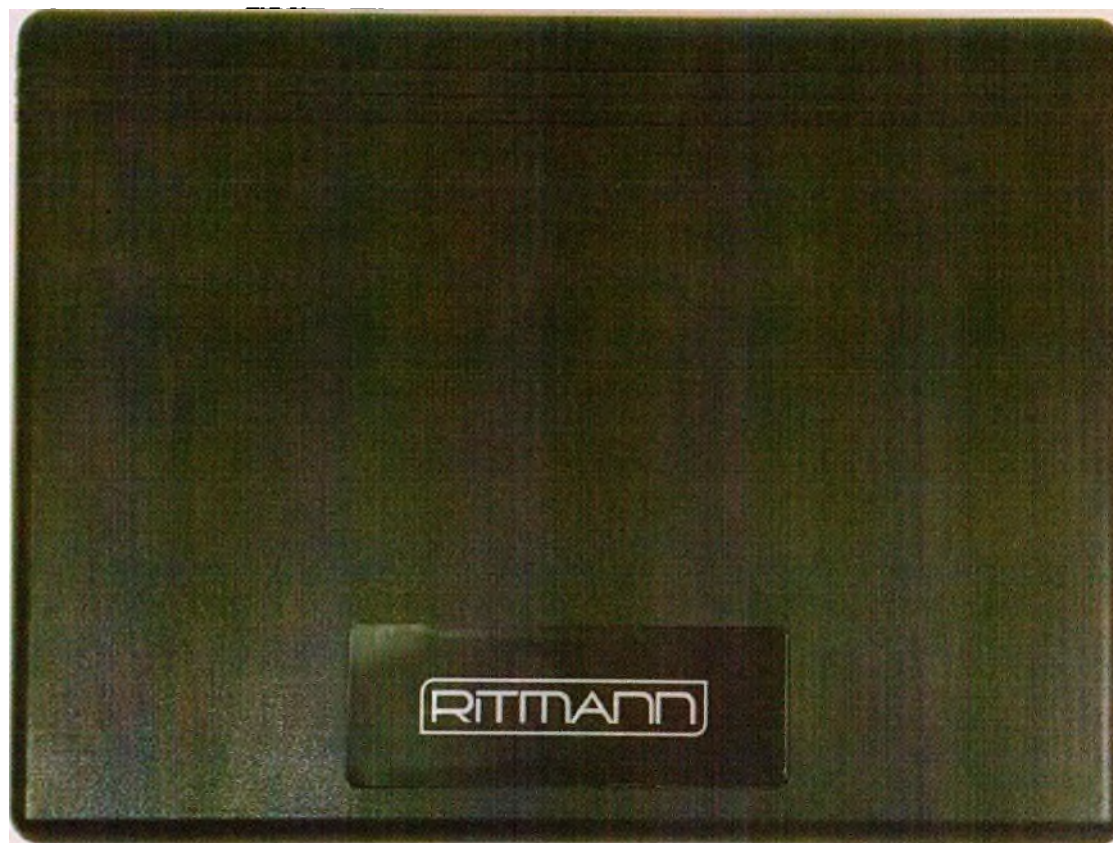


Кейс малый пластиковый - 1 шт.

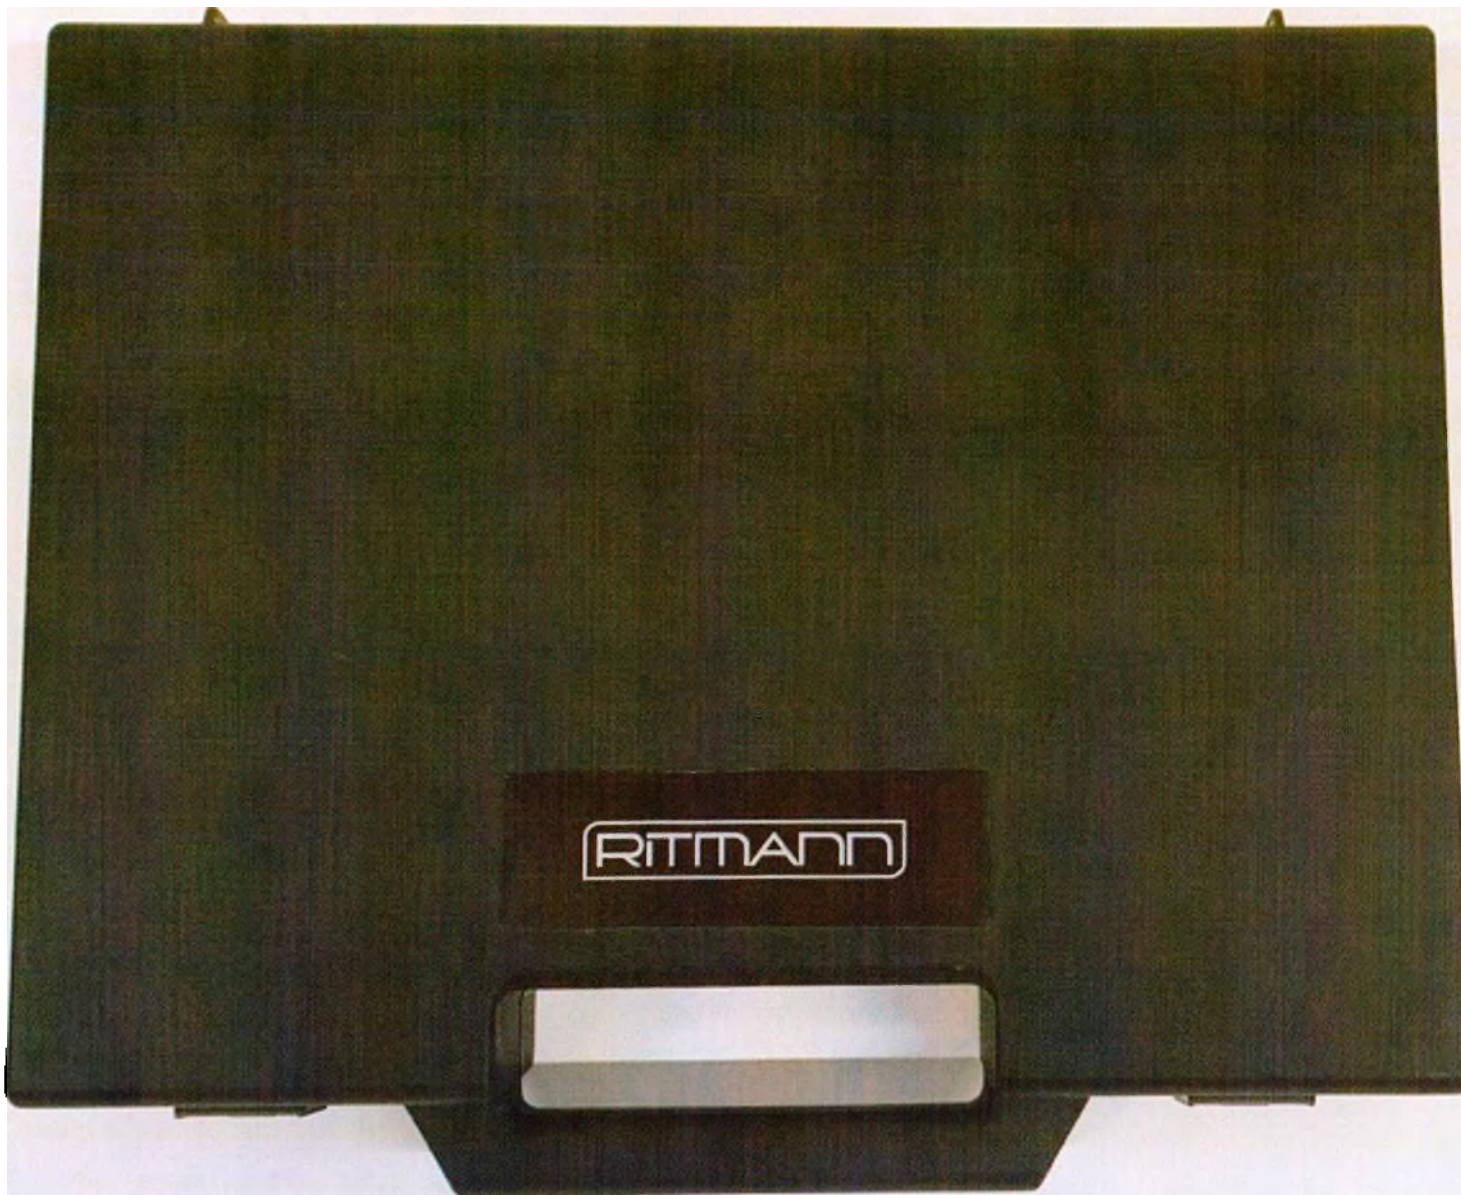

Кейс стандартный пластиковый - 1 шт.




Сетевое зарядное устройство Fedder - 1 шт.

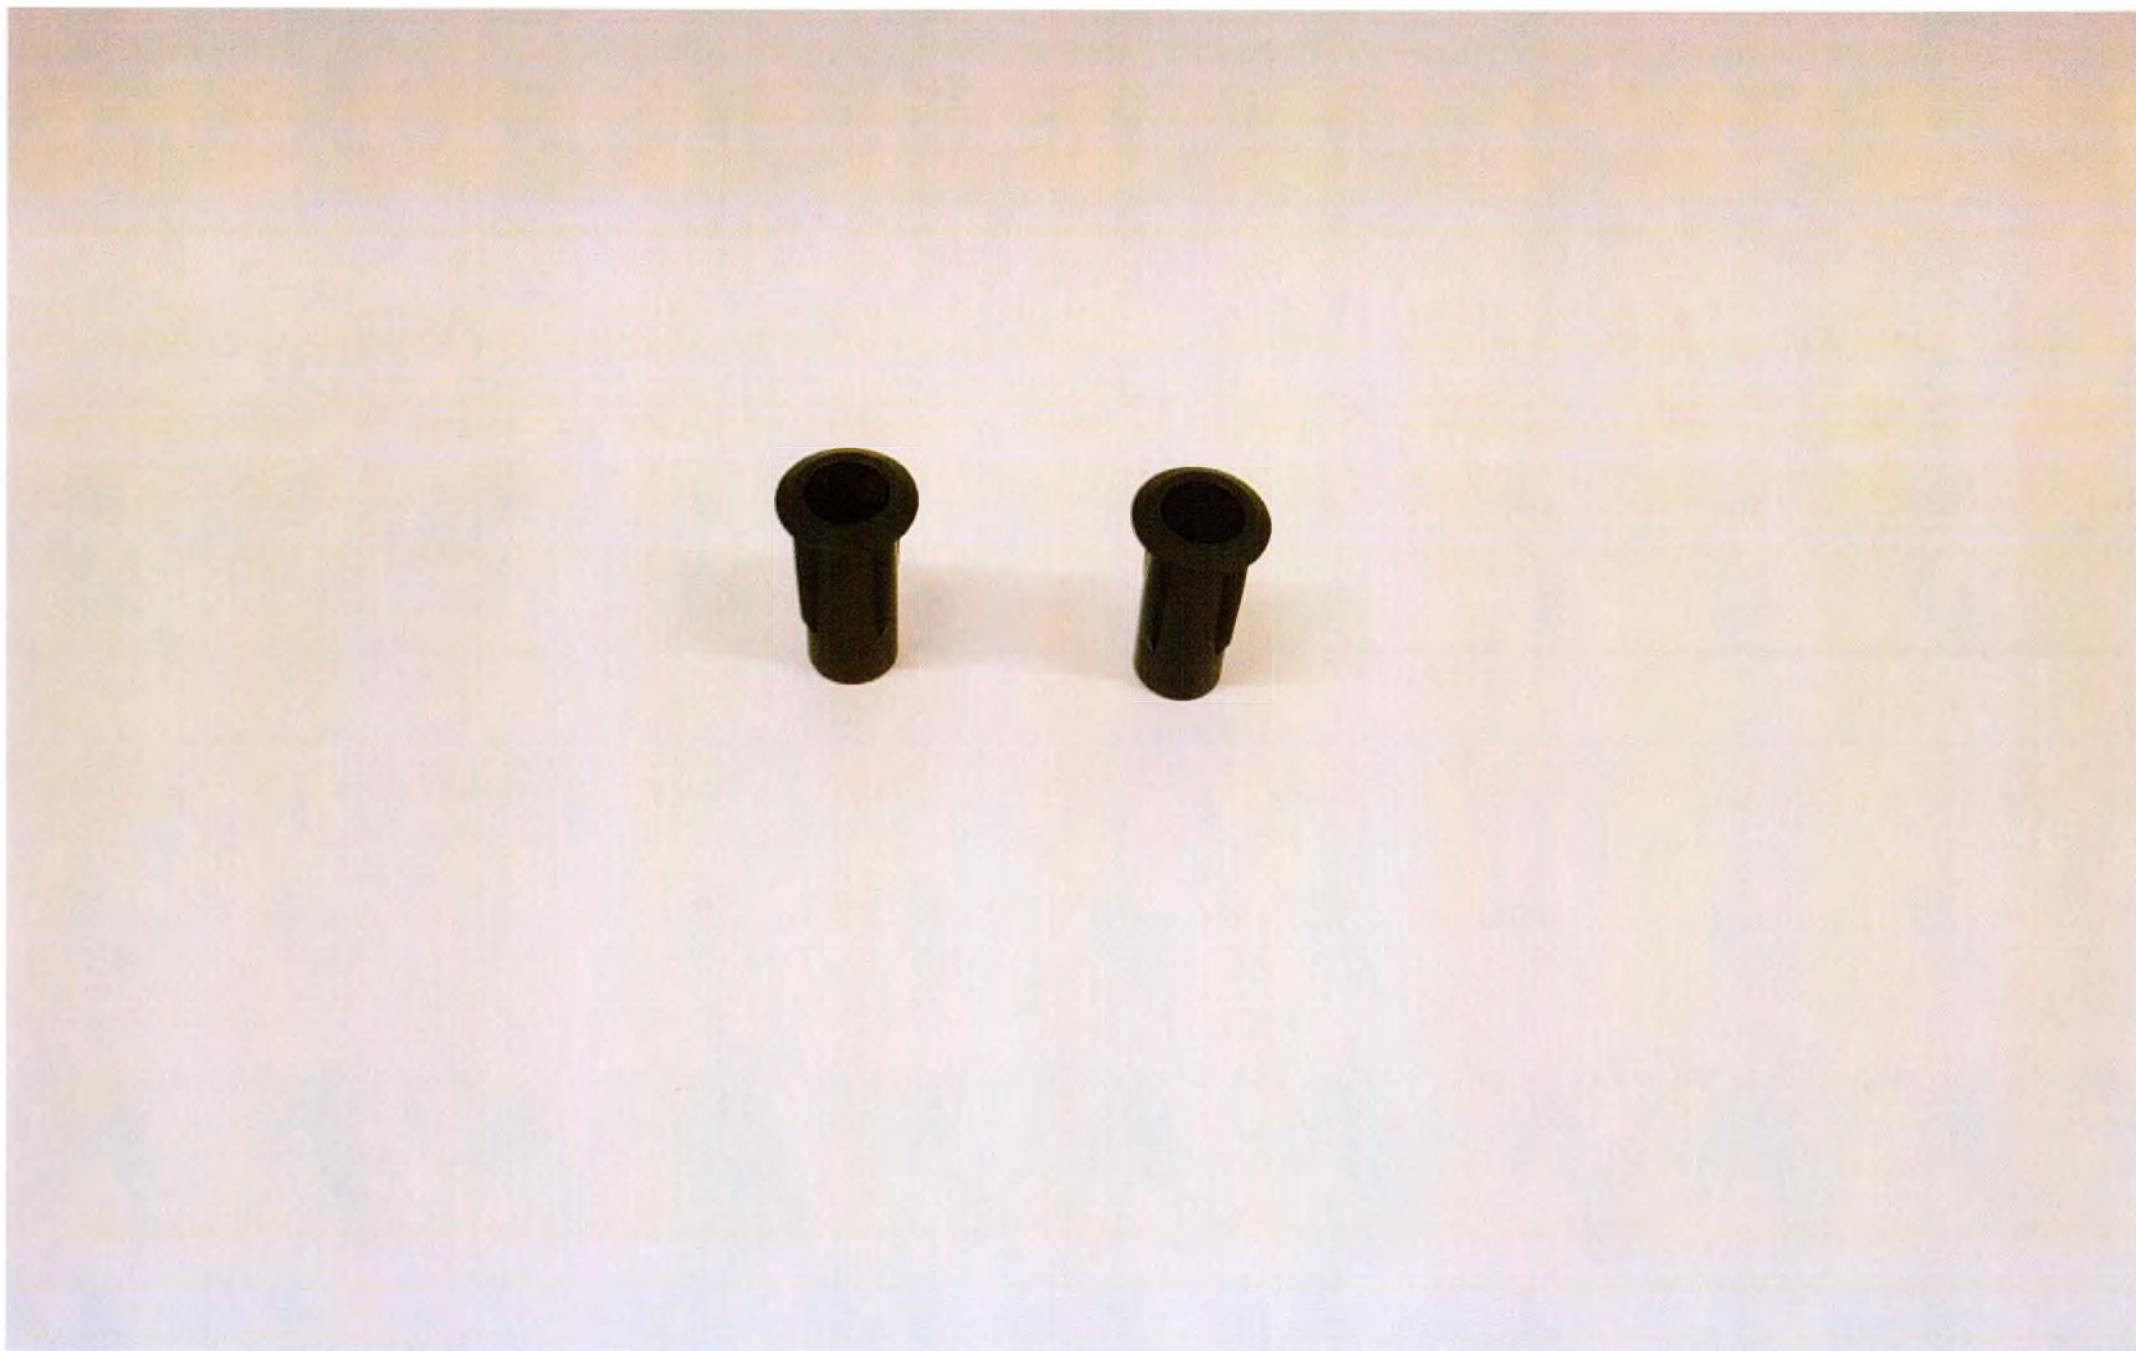


Переходник - 2 шт.



Кабель питания - 1 шт.

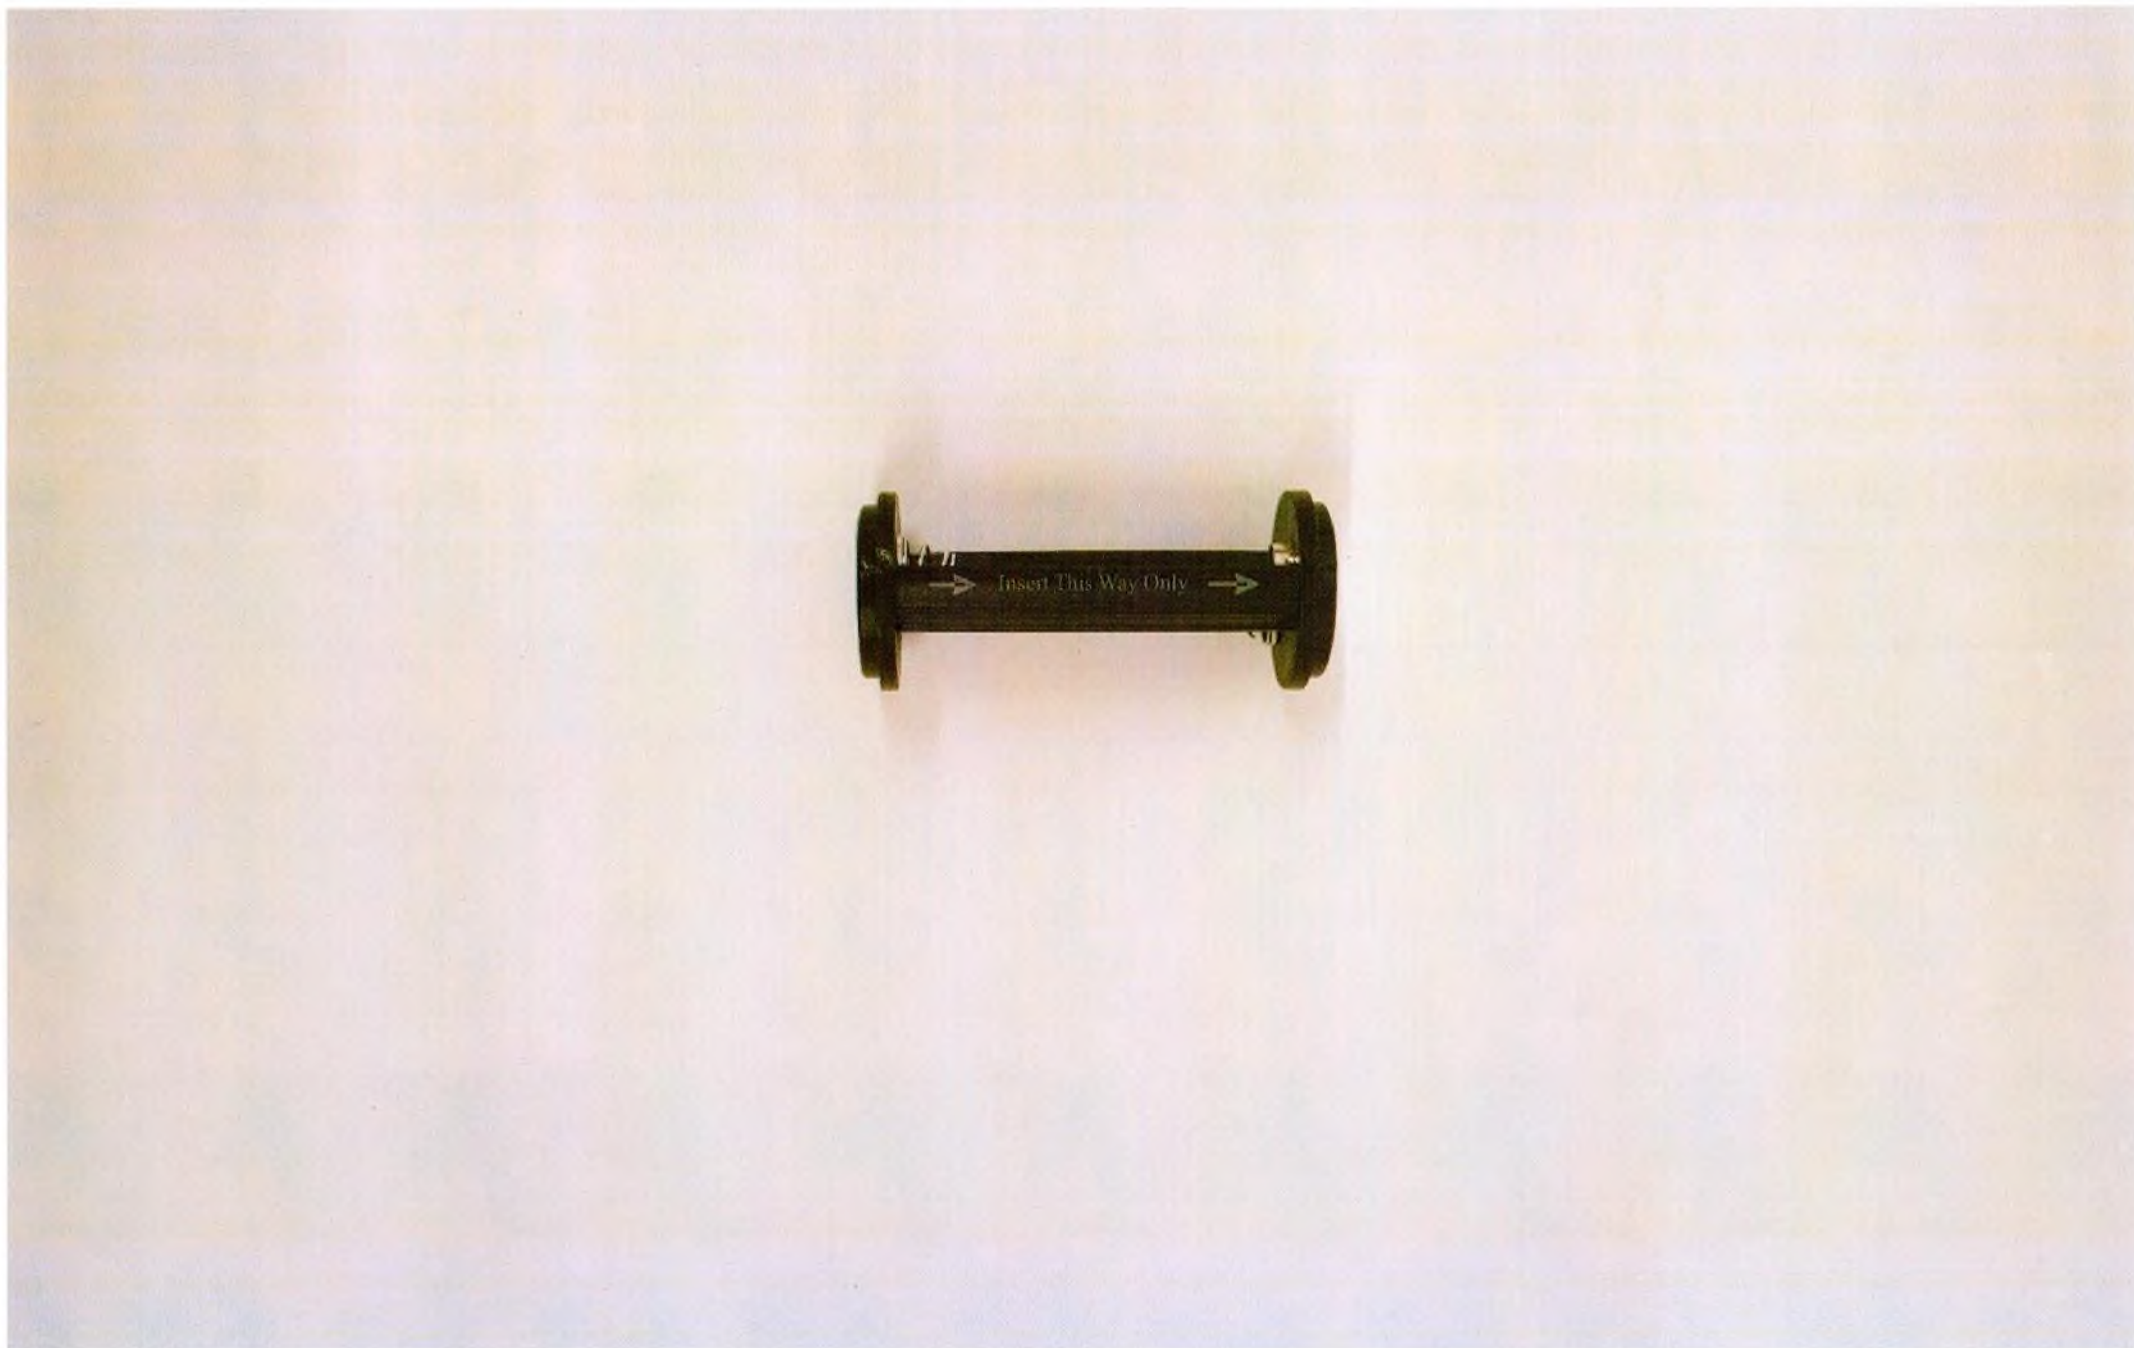

Батарейный отсек – 1 шт.

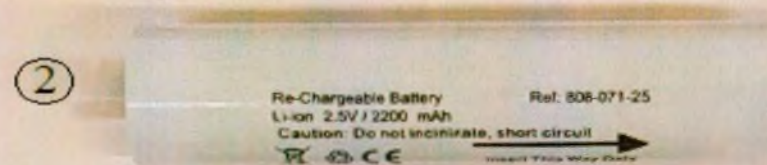

Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В (RIT808-069-25) ①;
Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В (RIT808-063-35), ③

Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В (RIT808-071-25) ②
Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В (RIT808-065-35), ④

Всего проинито
и проинтерновано
169 (сто шесть-
десять девять)
листов



УТВЕРЖДАЮ

Представитель



ООО «РИТМАНН»

Захаров Д.Г.

2023 г.

Образцы маркировки, наносимой на медицинское изделие:

«Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021»

2023 г.

Для потребительской и групповой упаковок клинков и рукоятей (рис.1):



Рис.1 Образец этикетки, наносимой на потребительскую / групповую упаковку на примере изделия
"Клинок ларингоскопа лампочного, лампа вакуумная 2,5 В, тип Miller,
вариант исполнения Simplight, размер 1"

2. Для ларингоскопа в кейсе (рис.2):



Рис.2 Образец этикетки, наносимой на потребительскую упаковку на примере изделия
"Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип
Macintosh, размер 0, вариант исполнения Simplight"

3. Для потребительской упаковки аккумуляторных батарей (рис. 3):



Рис.3 Образец этикетки, наносимой на потребительскую упаковку на примере изделия
"Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В "

4. Для потребительской и групповой упаковок лампы для рукояти/клинка (рис.4):



Рис.4 Образец этикетки, наносимой на потребительскую / групповую упаковку на примере изделия "Лампа вакуумная малая 2,5 В для клинков с линзой матовой"

5. Для потребительской и групповой упаковок сменного оптоканала (рис.5):



Рис. 5 Образец этикетки, наносимой на потребительскую / групповую упаковку на примере изделия "Сменный оптоканал для клинка, тип Macintosh, вариант исполнения Fibrolight, размер 0"

6. Для сетевого зарядного устройства Fedder, наносимая на оборотную сторону и на потребительскую упаковку (рис.6):

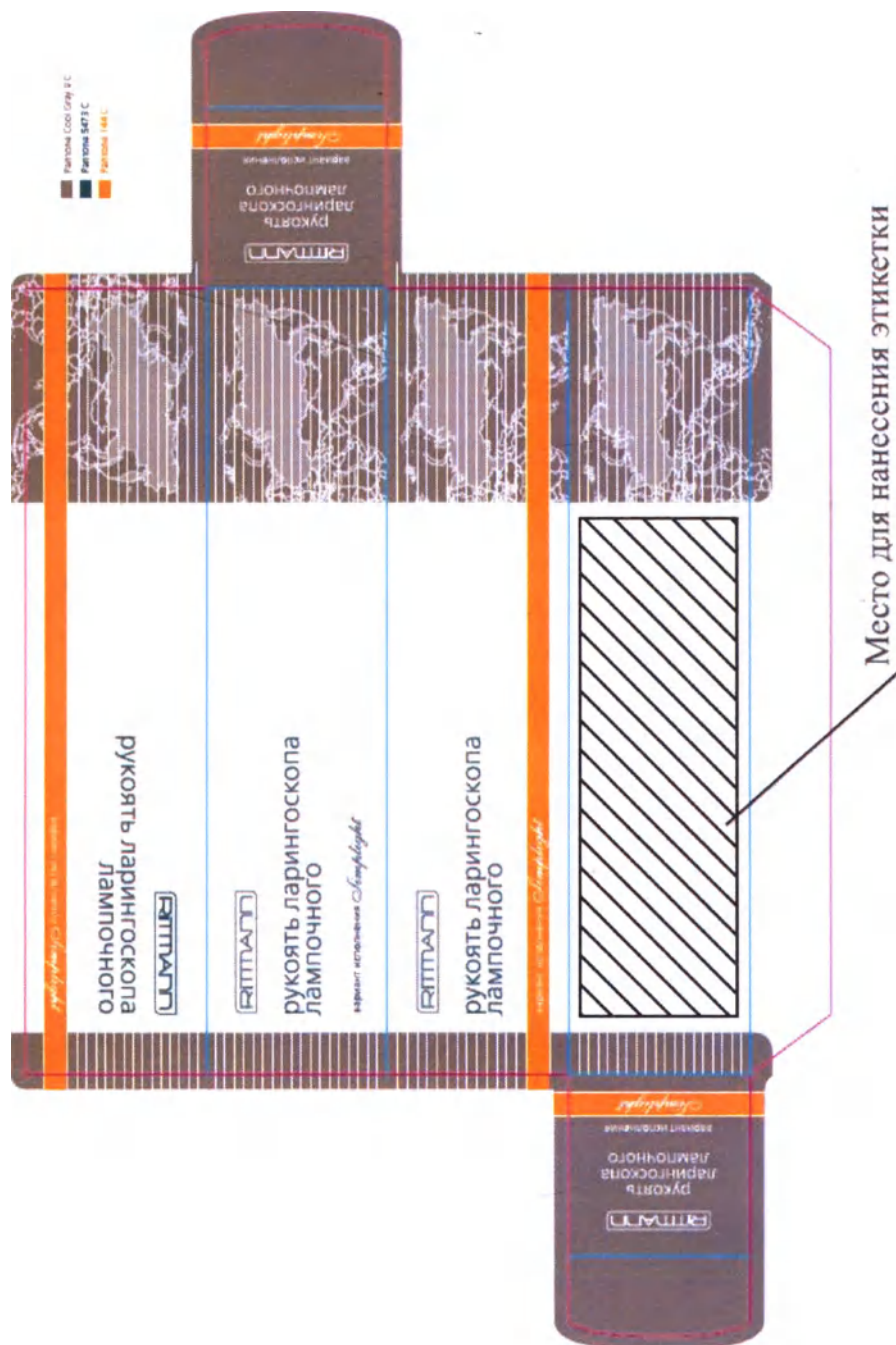


Рис.6 Образец этикетки, наносимой на потребительскую упаковку «Сетевого зарядного устройства Fedder»

7. На каждую транспортную тару должны быть нанесены (рис. 7):

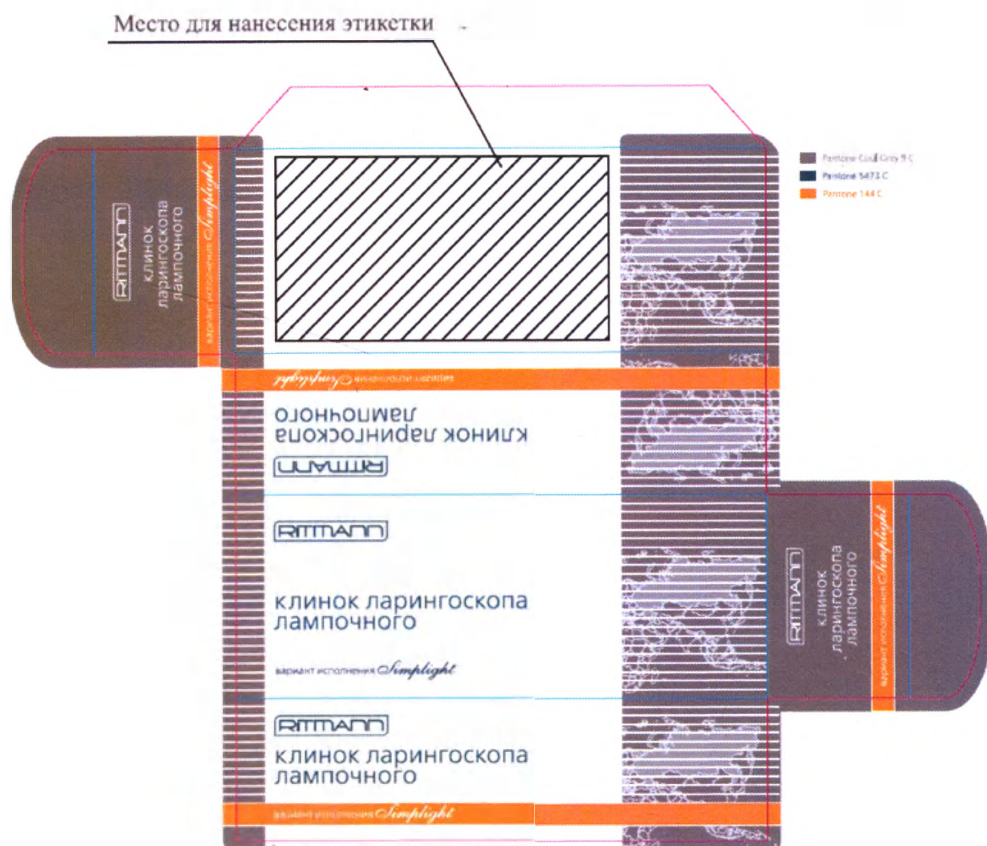


Рис.7 Образец этикетки, наносимой на транспортную упаковку на примере изделия «Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный со средней рукоятью, тип Macintosh, размер 0, вариант исполнения Simplight»




*Пример полноцветного макета потребительской упаковки медицинского изделия
«Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021»*

**1. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный, вариант
исполнения Simplight.**




Пример полноцветного макета потребительской упаковки медицинского изделия
«Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021»

I. Ларингоскоп интубационный многоразового использования лампочный, вариант исполнения Simplight.

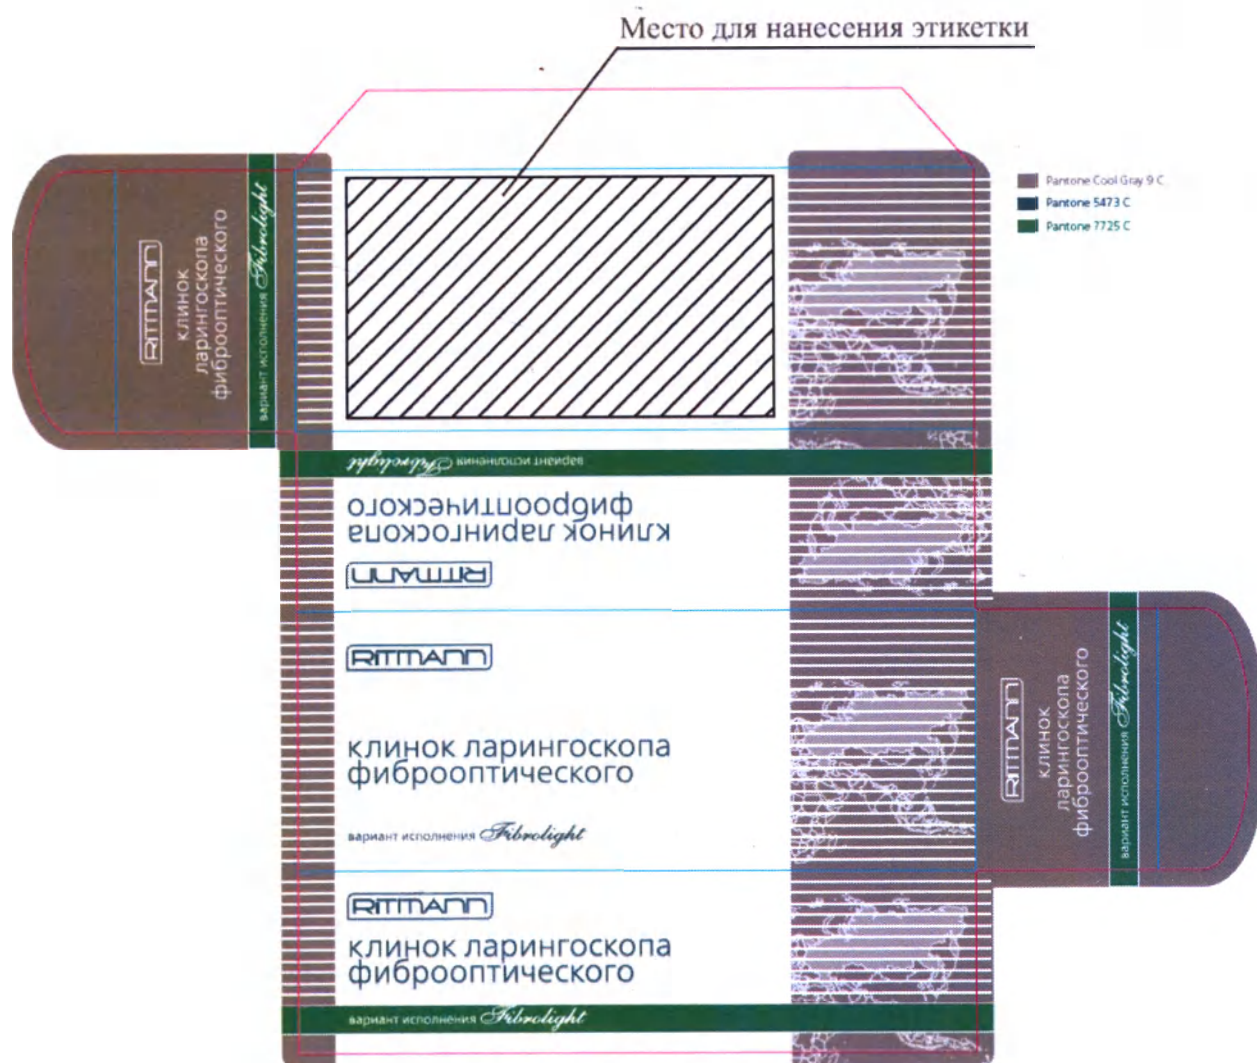


Пример полноцветного макета потребительской упаковки медицинского изделия
«Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021»

II. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический, вариант исполнения Fibrolight

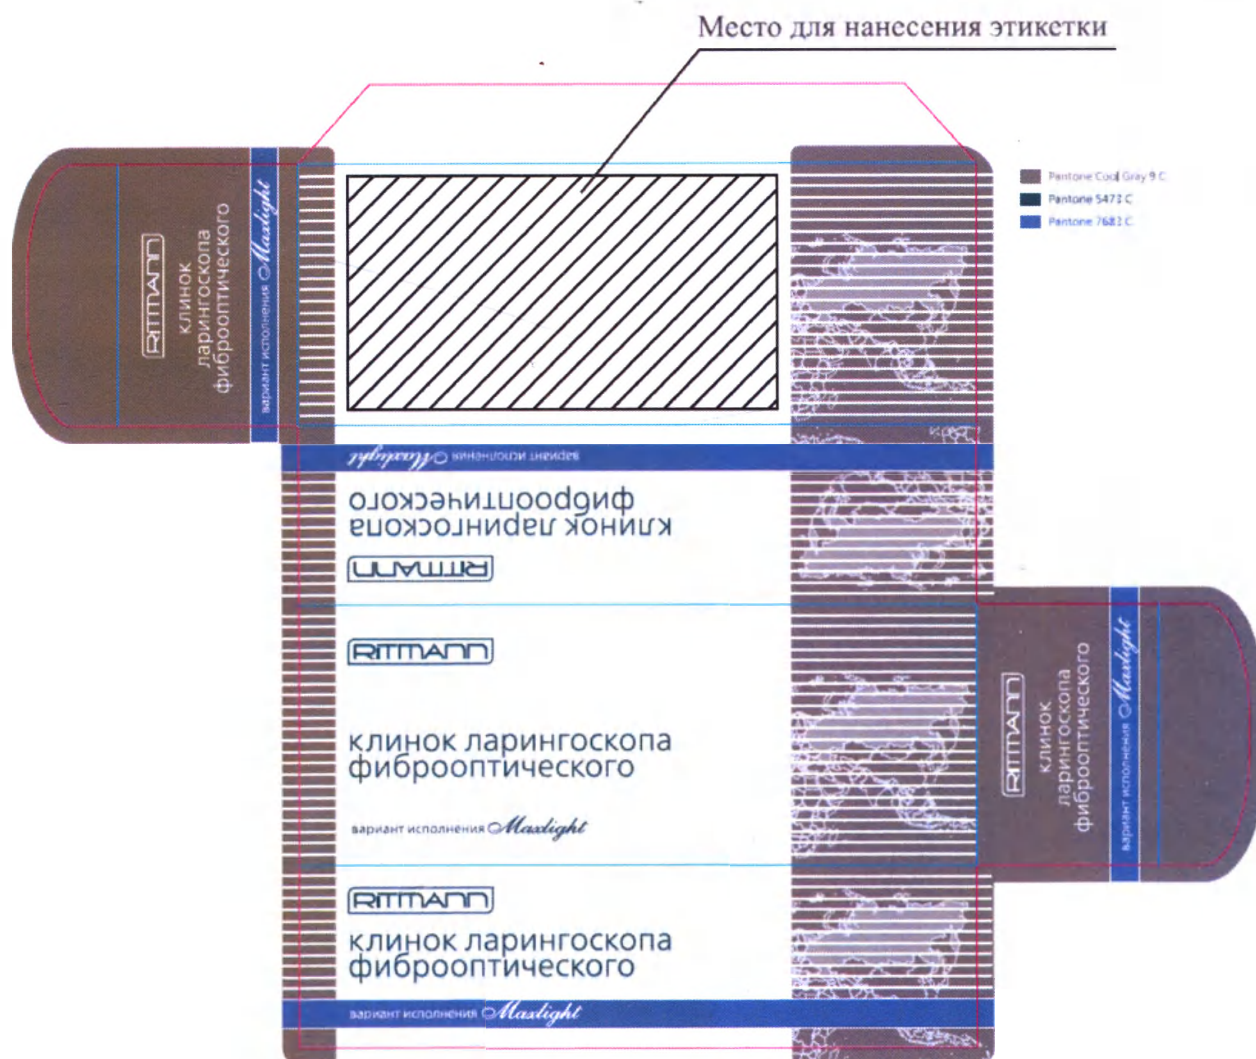

Пример полноцветного макета потребительской упаковки медицинского изделия
«Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021»

III. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический, вариант исполнения Maxlight

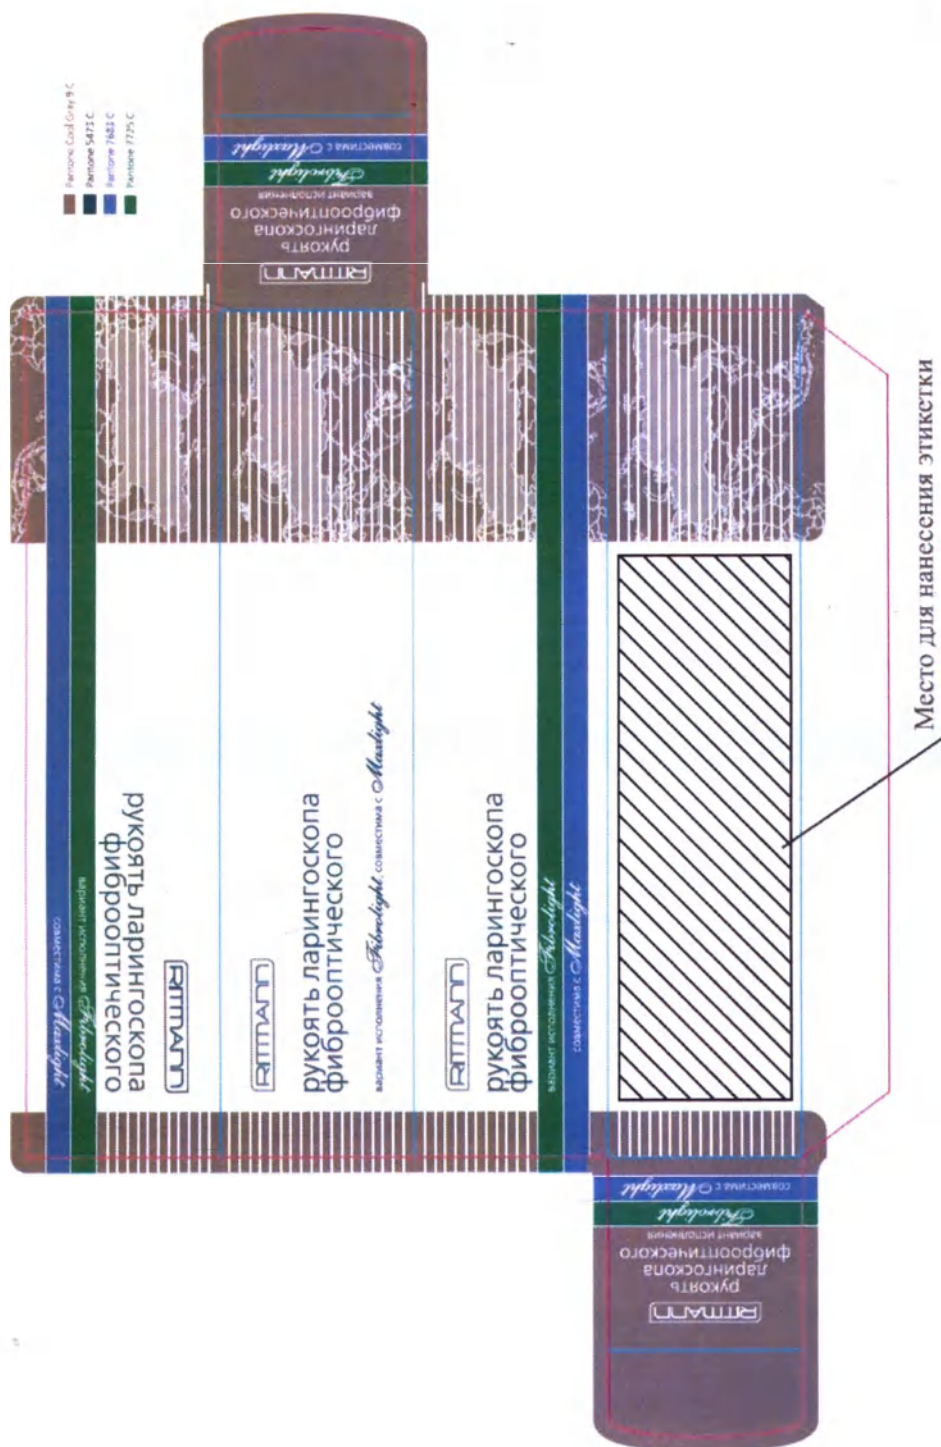


Пример полноцветного макета потребительской упаковки медицинского изделия
«Ларингоскоп интубационный многоразового использования с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021»

II. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический, вариант исполнения Fibrolight / III. Ларингоскоп интубационный многоразового использования фиброоптический, вариант исполнения Maxlight



 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

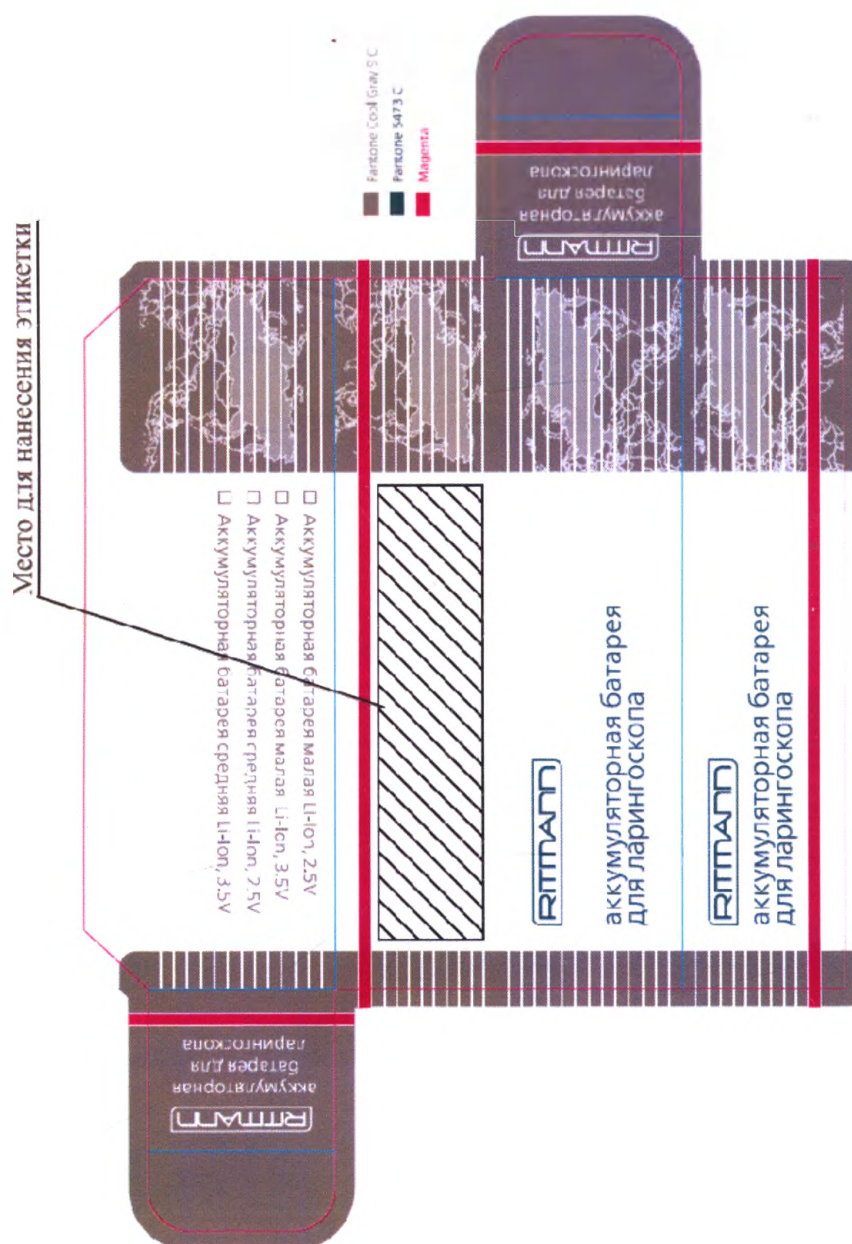

Пример полноцветного макета потребительской упаковки принадлежностей
Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 2,5 В, Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 2,5 В,
Аккумуляторная батарея малая Li-Ion, 3,5 В, Аккумуляторная батарея средняя Li-Ion, 3,5 В



*Пример потребительской упаковки медицинского изделия «Ларингоскоп
интубационный многоразового использования с принадлежностями по ТУ 26.60.12-
001-92072059-2021»*

Сверху вниз: Кейс стандартный пластиковый, Кейс малый пластиковый



*Пример полноцветного макета транспортной упаковки медицинского изделия
«Ларингоскоп интубационный многократного использования с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-92072059-2021»*



Рассеянное
и поглощенное
13 (тринадцать)
лучей