




УТВЕРЖДАЮ

Финансовый директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»

 Гуляева В.Г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Реагент для количественного определения содержания альбумина в
сыворотке и плазме крови человека (Albumin liquicolor)

ETH10560300-1

ALBUMIN liquicolor

HumaStar

Σ 240

LOT

REF 10560300

LOT 22003

RGT / R1 4 x 60 Σ

0012

🕒 2024-10-31

🌡 2...25°C

IVD ⓘ CE




(01)04033145192022(10)22003(93)0(17)241031

Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 65205 Wiesbaden Germany

Human

Diagnostics Worldwide

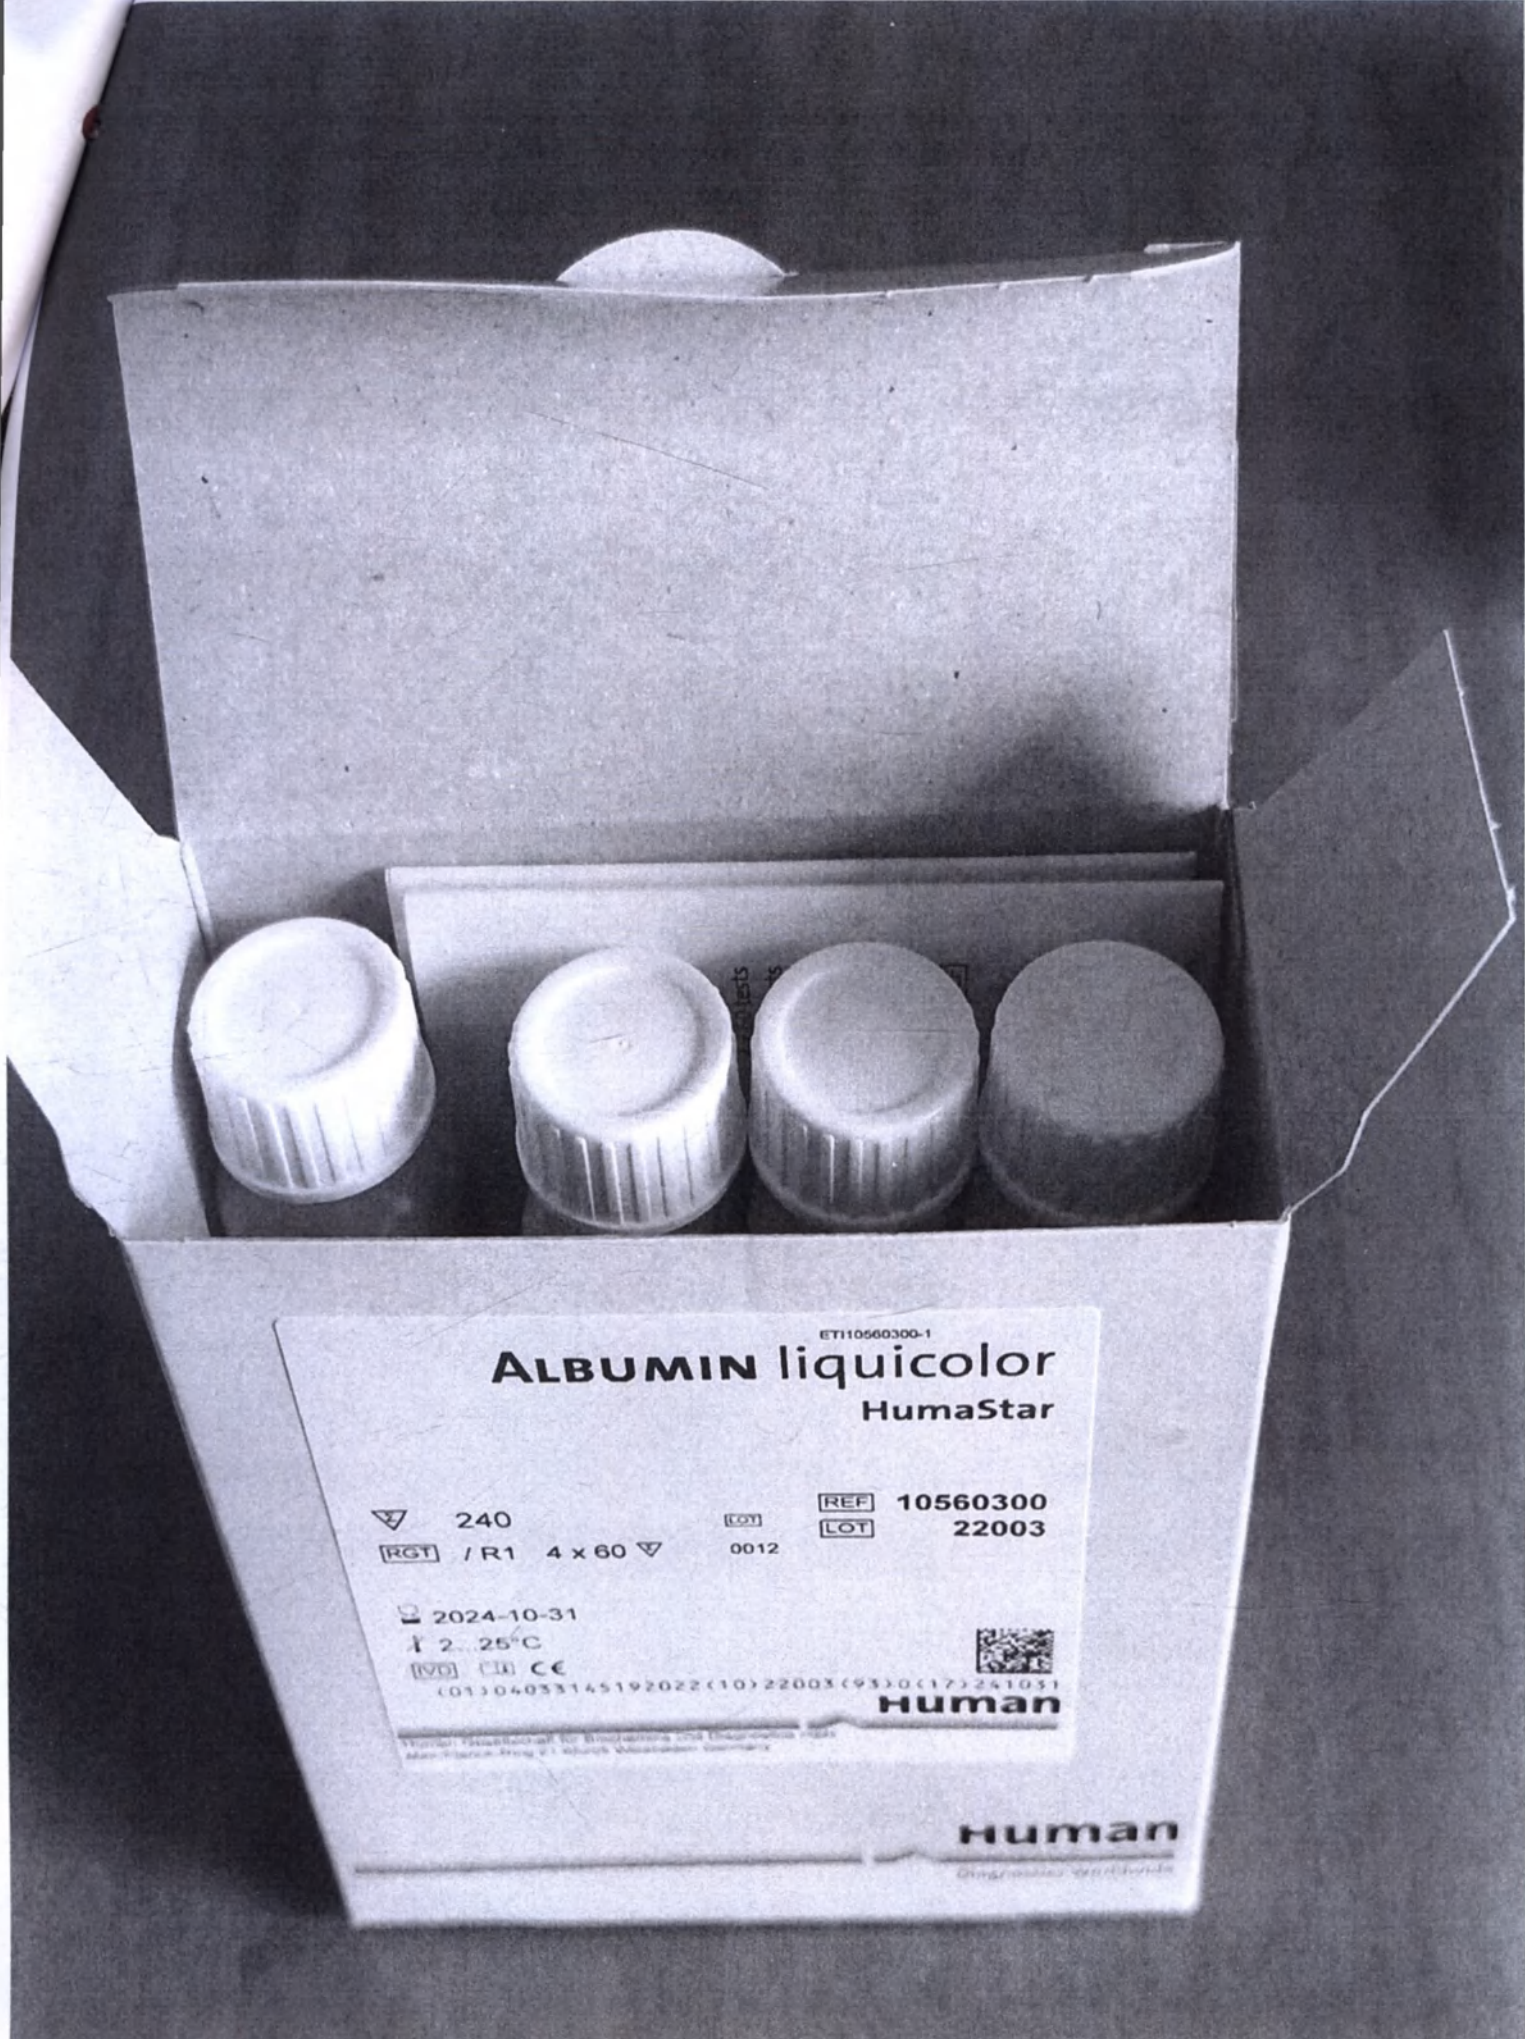

ET110560300-1
ALBUMIN liquicolor
HumaStar

▽ 240

RG1 / R1 4 x 60 ▽

LOT

0012

REF

10560300

LOT

22003

2024-10-31

2...25°C

IVD CE

(01)04033145192022(10)22003(93)0(17)241031

human

Human Standard for Biochemistry and Diagnostic tests
Main Service-Point in Russia: Moscow, Germany

human


Diagnostic reagents

Фотографическое изображение 2 – Внешний вид потребительской упаковки Реагента «Albumin liquicolor», Вариант исполнения 1


Реагент для количественного определения содержания альбумина в сыворотке
и плазме крови человека (Albumin Iquicolor)
- Реагент для определения I, в составе:
- Набор реактивов по применению, 1 шт.
Применение:
HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия
Температура хранения и транспортирования от +2 °C до +25 °C
Регистрационное Удостоверение № РЗН _____ от _____ г.
Для профессионального применения.
Медицинское изделие для диагностики *in vitro*
Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корпус 1
Символы, применяемые в маркировке изделия, приведены на
Кат. № 10560300
LOT № 22003
Годен до: 31.10.2024




Human
Diagnostics Worldwide

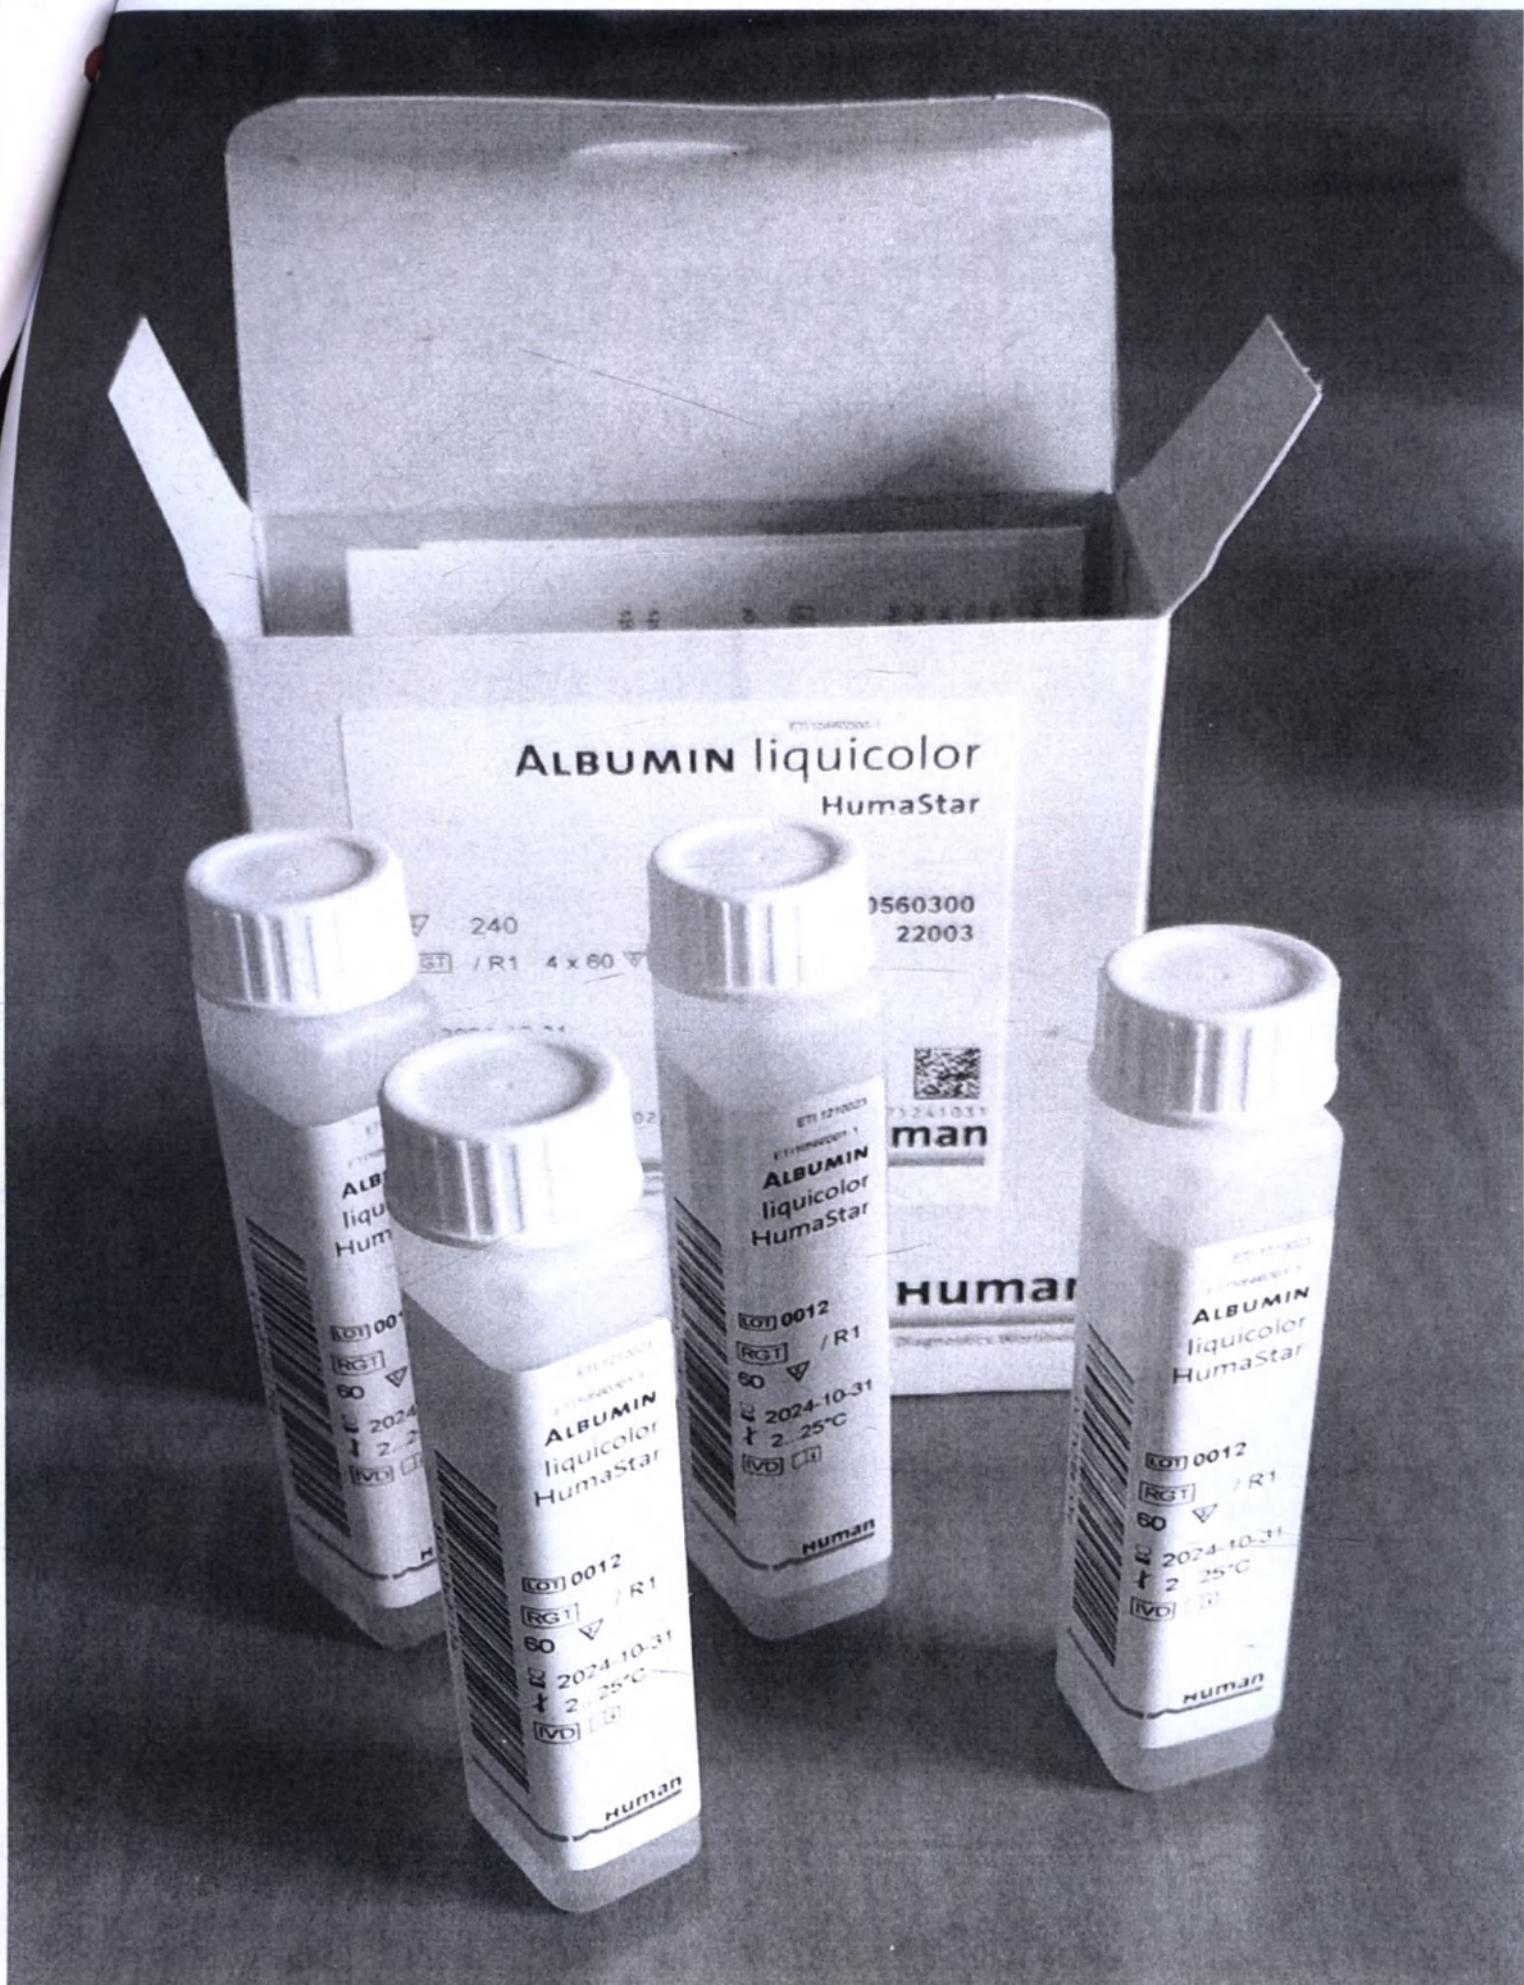


Фотографическое изображение 4 – Содержимое потребительской упаковки Реагента «Albumin liquicolor», Вариант исполнения I

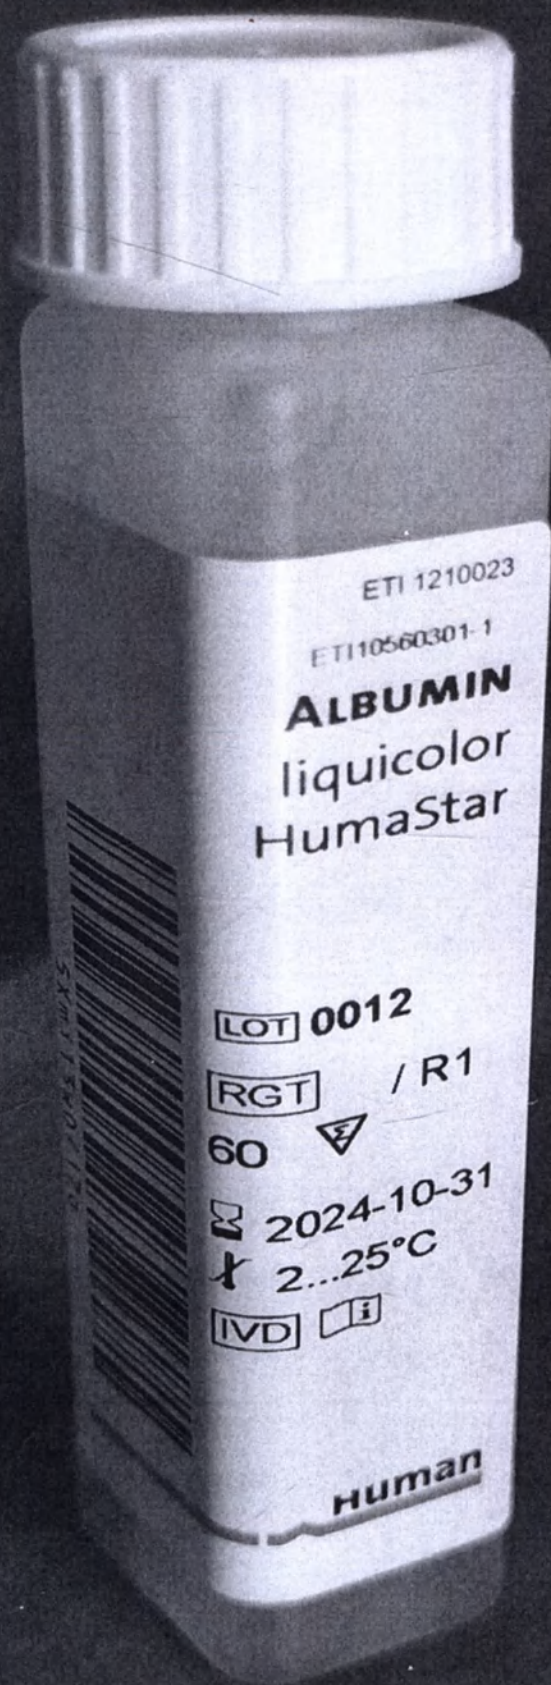


Фотографическое изображение 5 – Внешний вид «Реагент окрашивающий (R1)» Реагента «Albumin liquicolor», Вариант исполнения 1

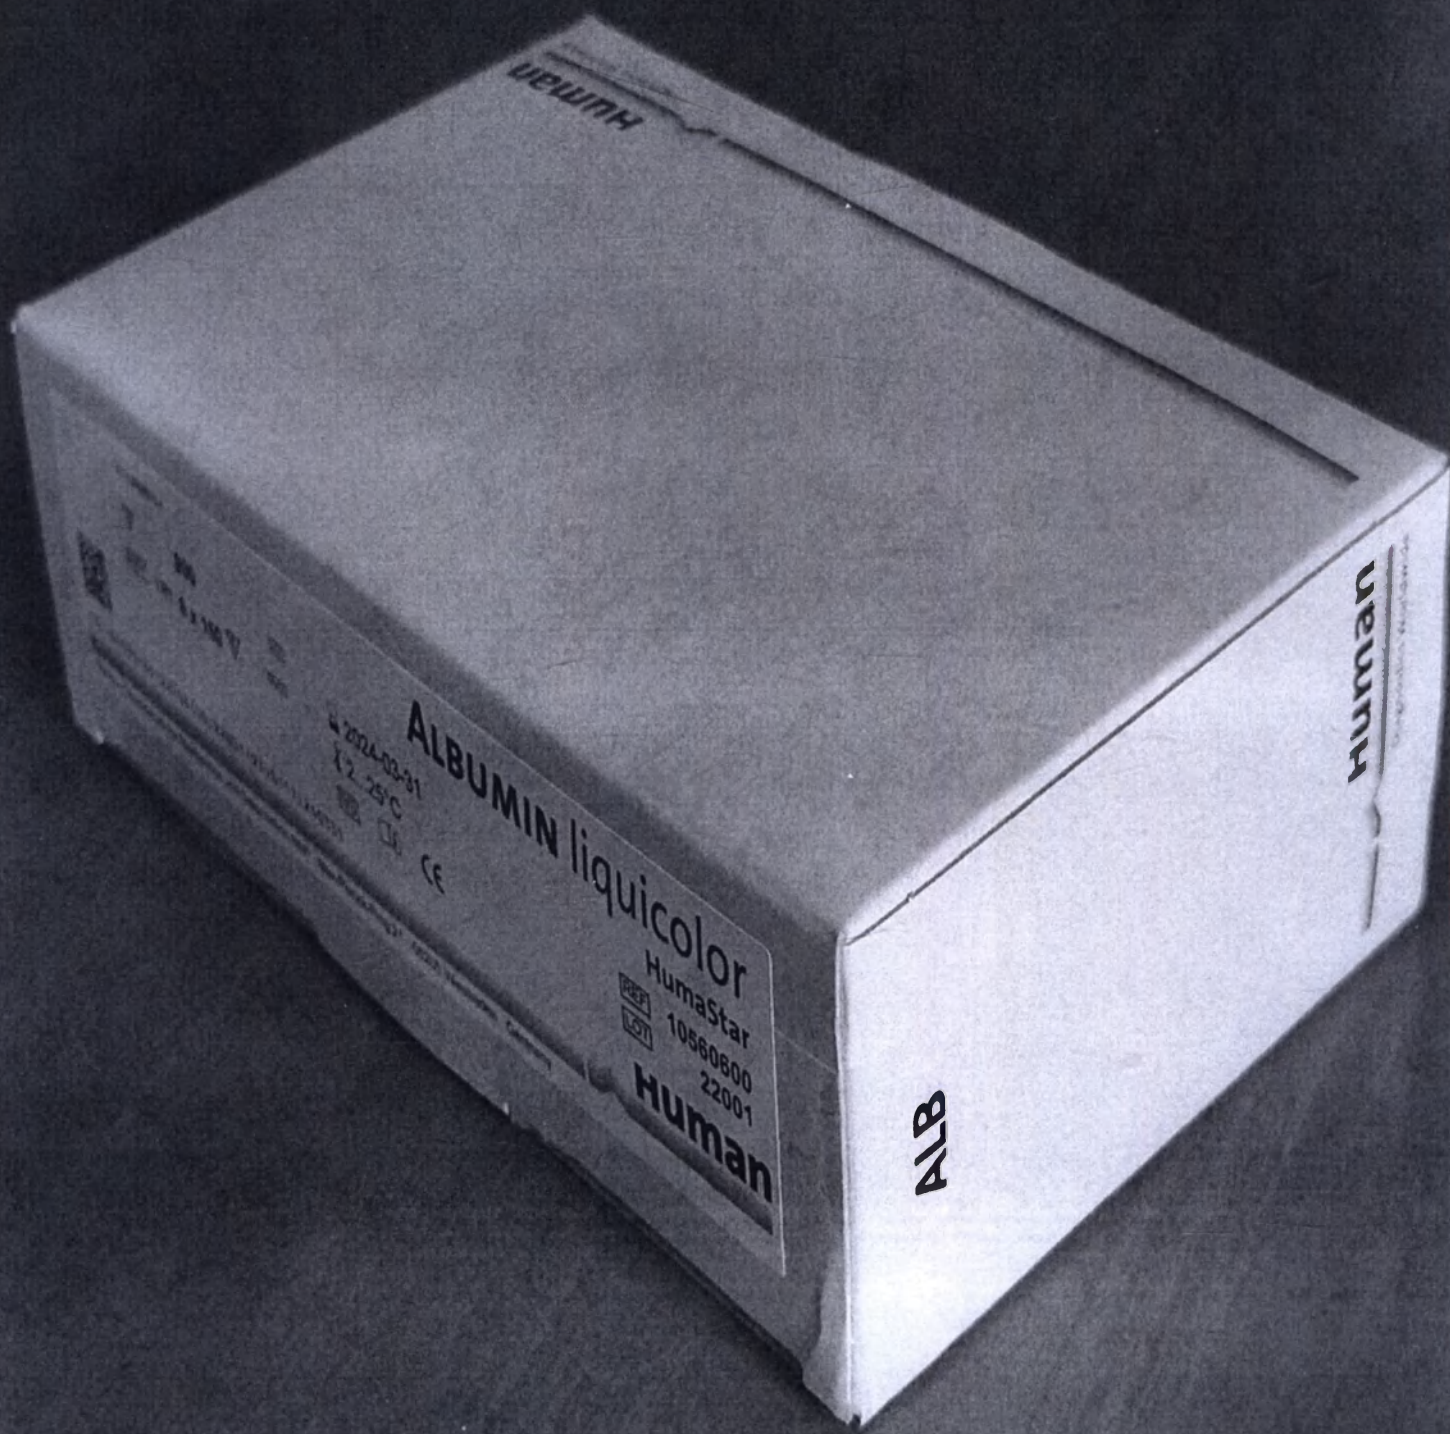

Фотографическое изображение 6 – Внешний вид потребительской упаковки Реагента «Albumin liquicolor», Вариант исполнения 2

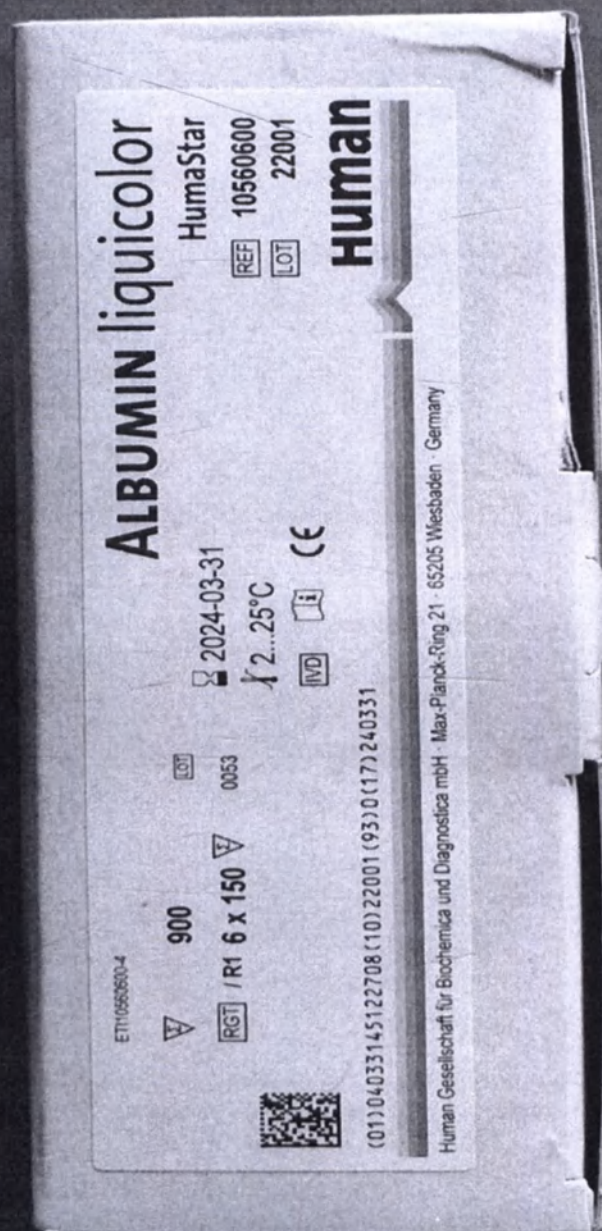


Фотографическое изображение 7 – Внешний вид потребительской упаковки Реагента «Albumin liquicolor», Вариант исполнения 2

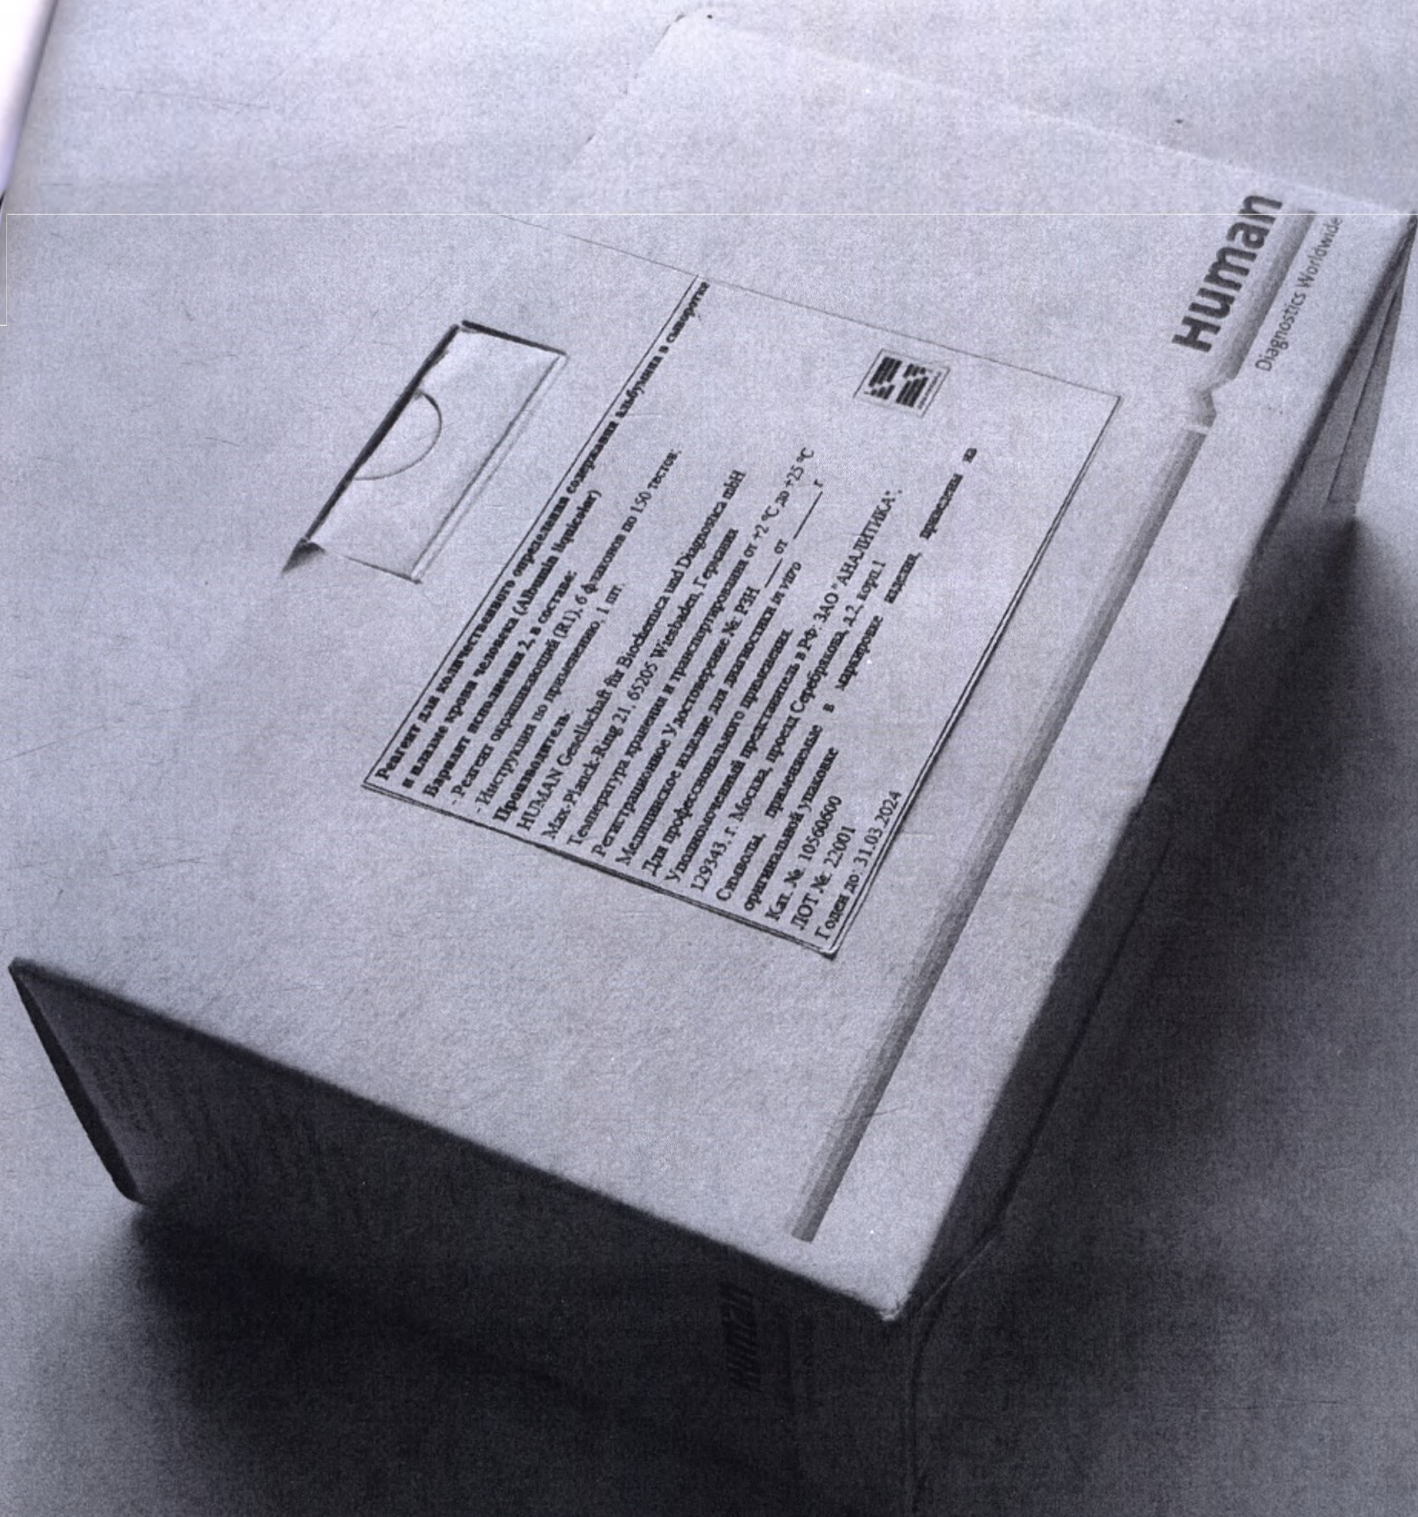


Реагент для количественного определения содержания альбумина в сыворотке
и плазме крови человека (Albumin liquidcolor)
Вариант исполнения 2, в комплекте:
- Реагент окрашивающий (RL), 6 флаконов по 150 тестов;
- Инструкция по применению, 1 шт.
HUMAN Gesellschaft für Biochemie und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Germany
Температура хранения в транспортировке от +2 °C до +25 °C
Рекомендуемое место для диагностики в лаборатории
Материальное удостоверение № РЗН
129343, г. Москва, проезд Саввакина 42, корп. 1
Специализированная организация
Кат. № 10560600
ЛОТ № 23001
Годен до 31.03.2024

human
Diagnostics Worldwide

Фотографическое изображение 8 – Внешний вид потребительской упаковки Реагента «Albumin liquidcolor» с русскоязычным стикером, Вариант исполнения 2

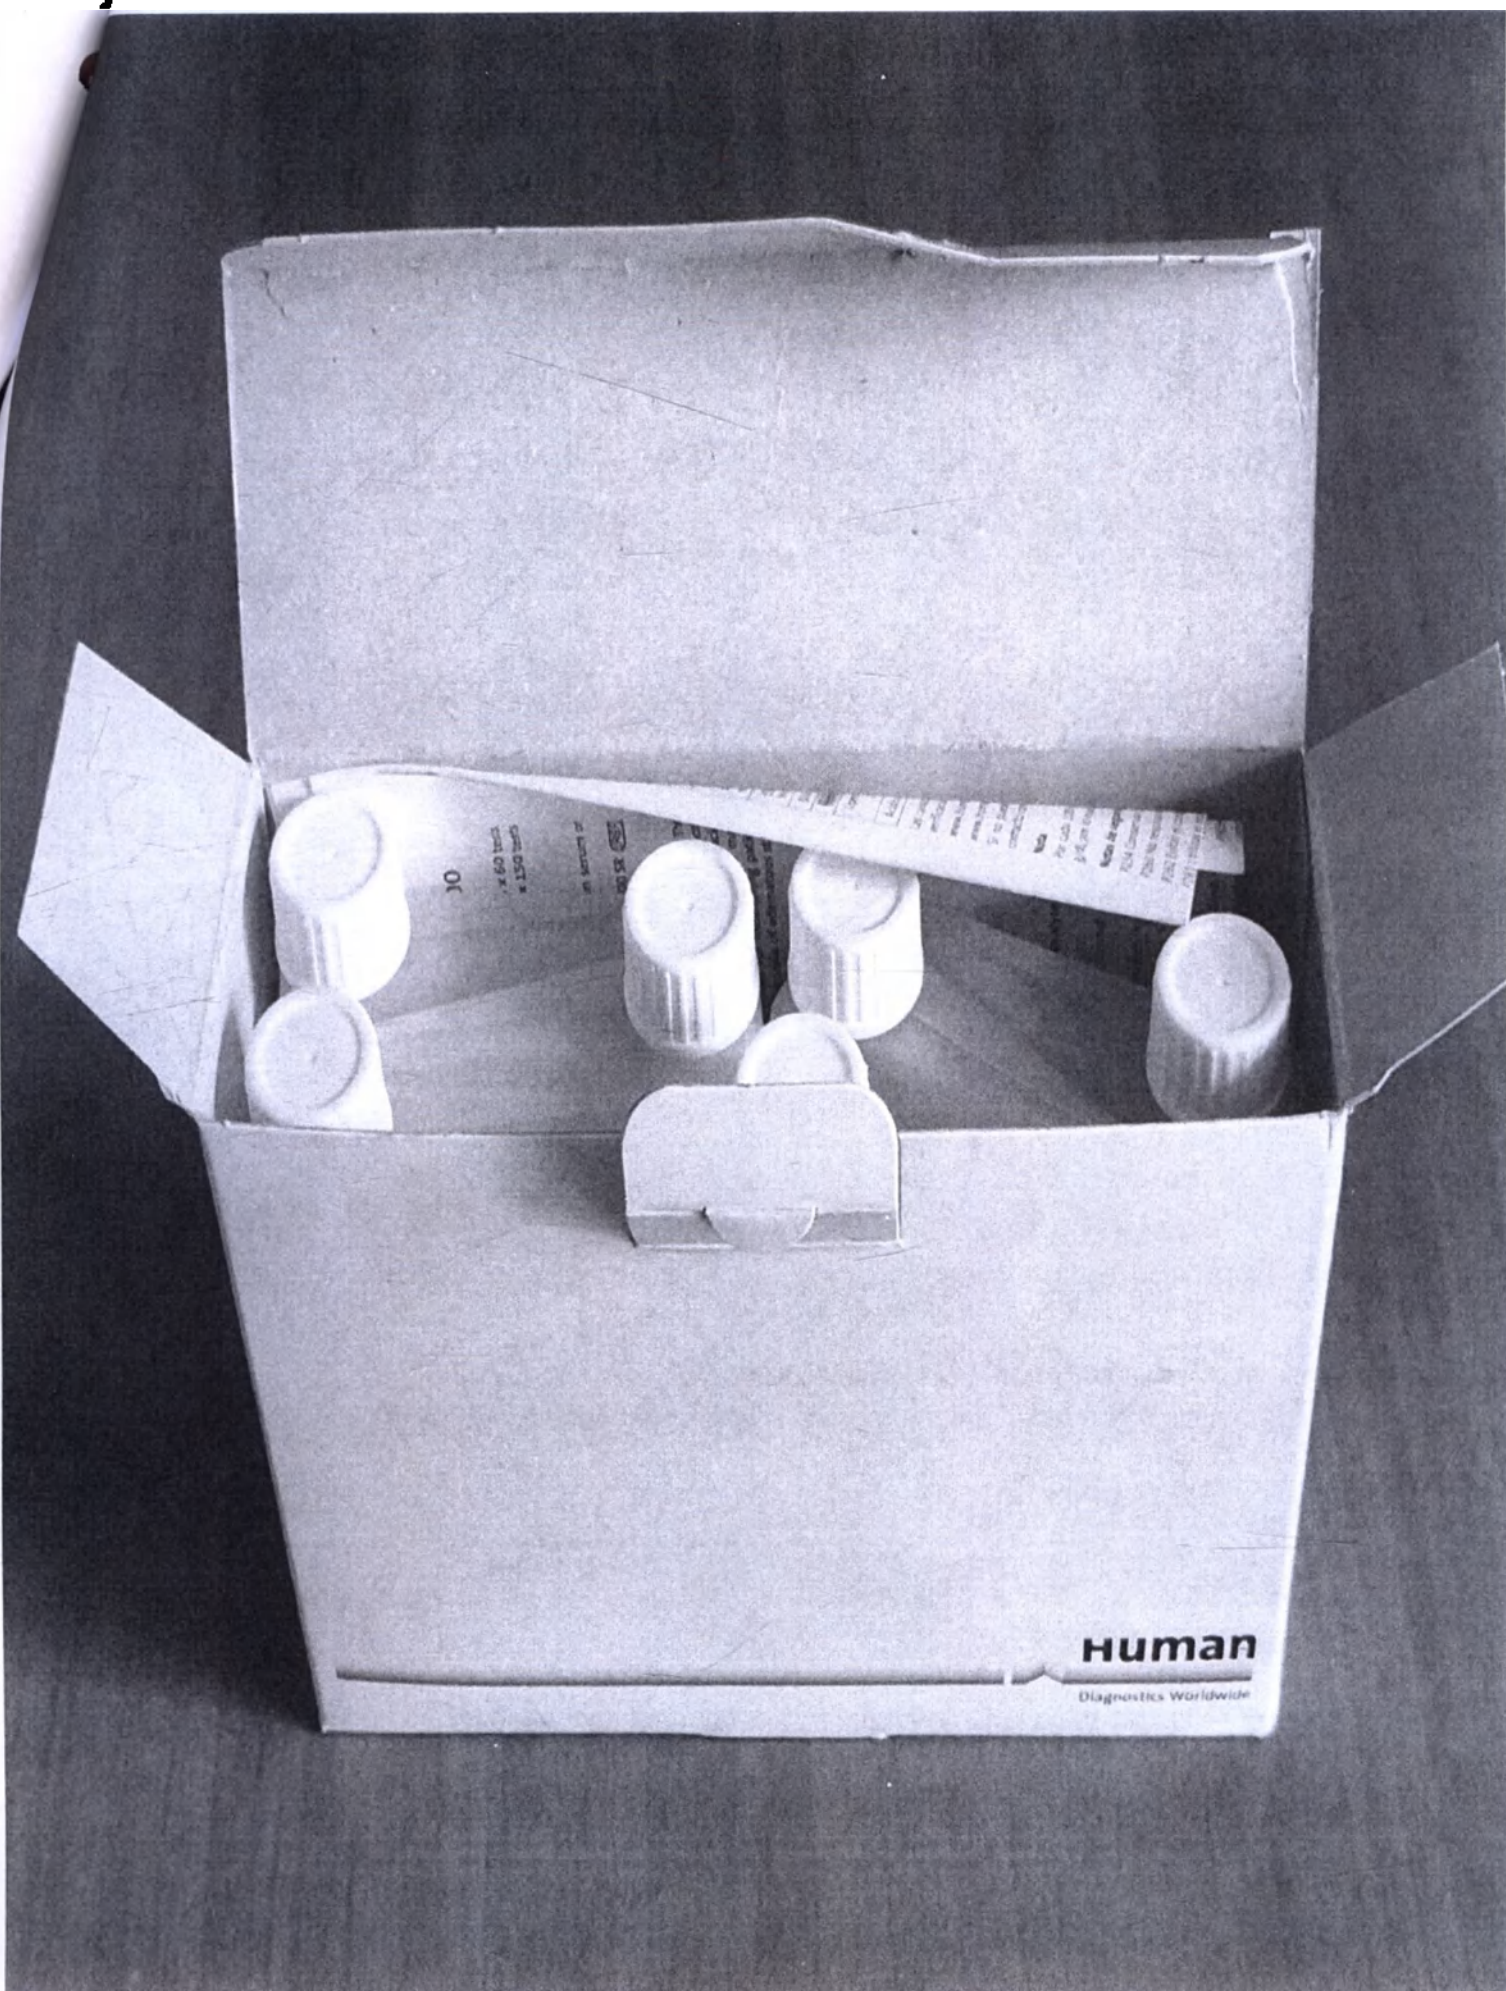

Фотографическое изображение 9 – Внешний вид потребительской упаковки Реагента «Albumin liquidcolor», Вариант исполнения 2

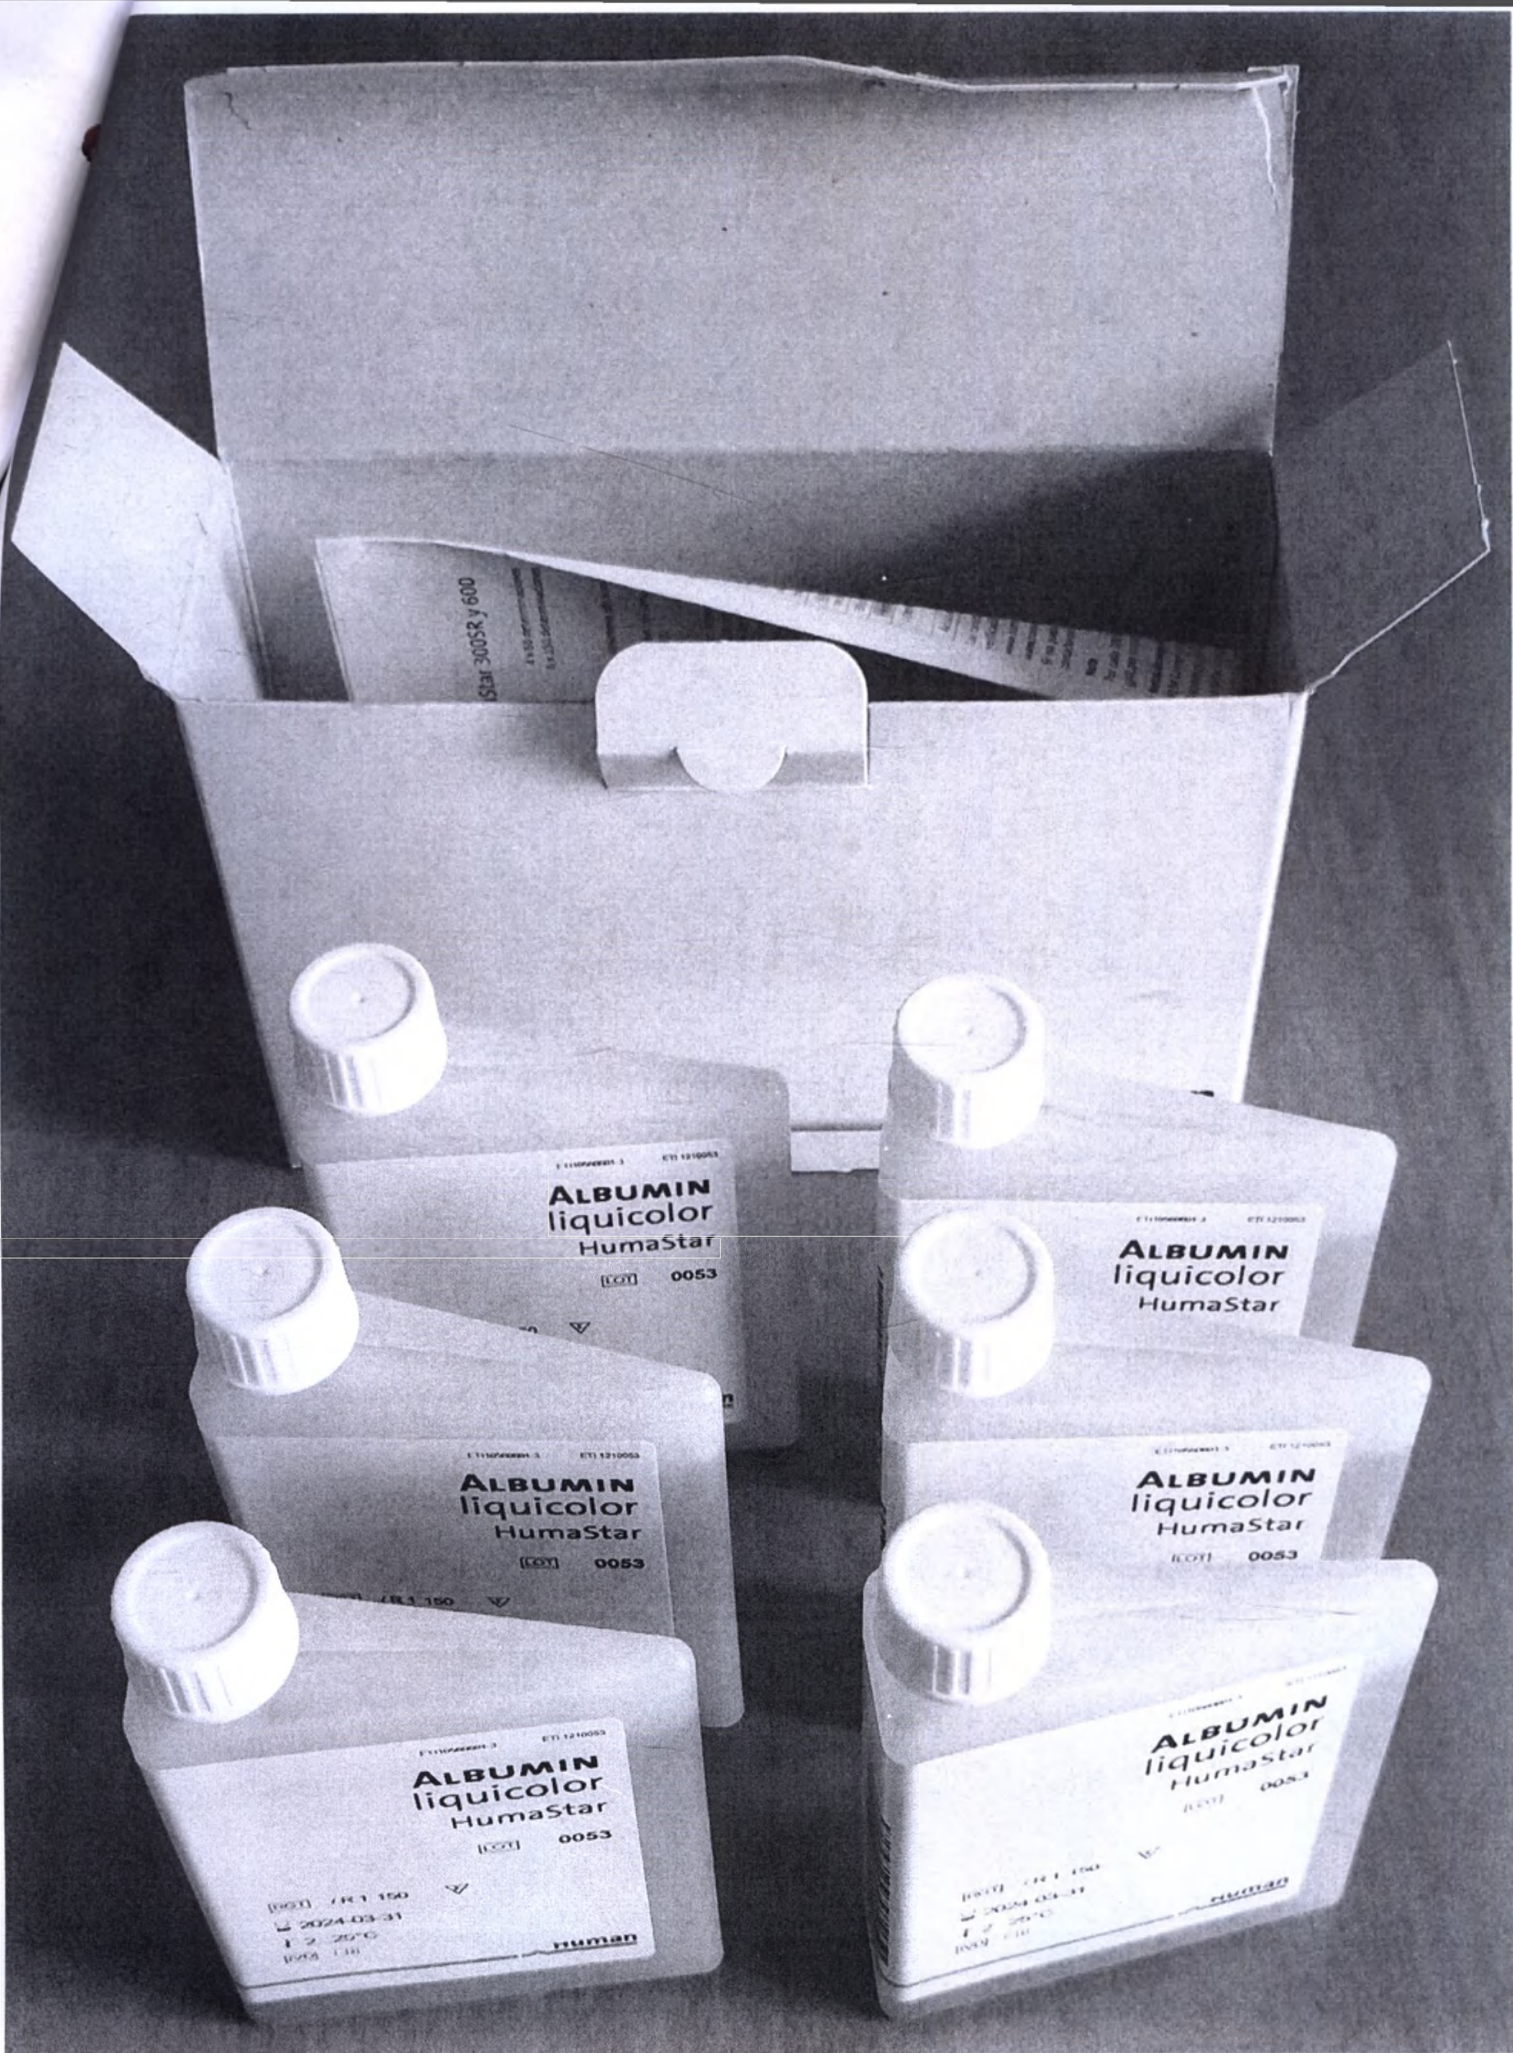

Фотографическое изображение 10 – Содержимое потребительской упаковки Реагента «Albumin liquicolor», Вариант исполнения 2

ETI10560601-3

ETI 1210053

ALBUMIN liquicolor HumaStar

LOT

0053

RGT / R 1 150



2024-03-31

2...25°C

IVD



human

Фотографическое изображение 11 – Внешний вид «Реагент окрашивающий (R1)» Реагента «Albumin liquicolor»,
Вариант исполнения 2

Всего прикручено,
проверено и исправлено
печатью 12 шт. гос.



Финансовый директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»

 Гуляева В.Г.