








IIAP

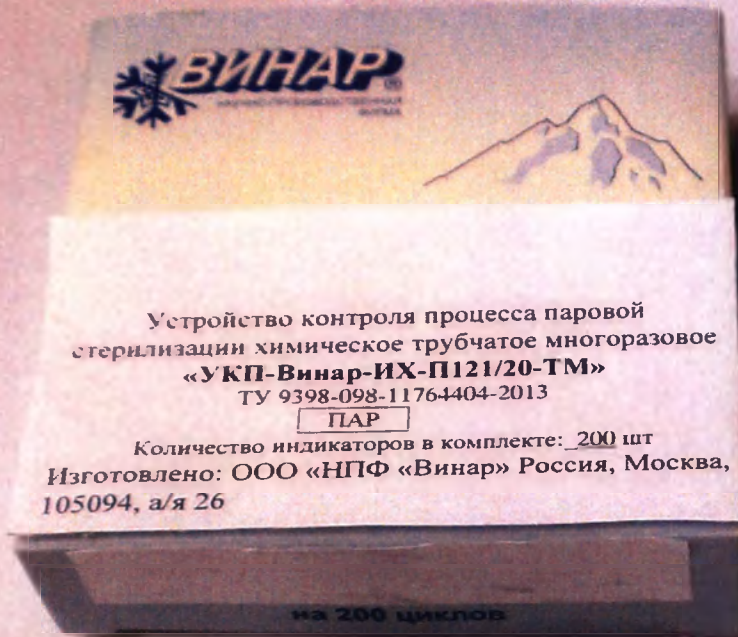

Используемая индикаторная полоска пр-
вой стороне которого нанесены индикаторные
метки. На тыльной стороне



Устройство контроля процесса паровой стерилизации биологическое трубчатое многоразовое «УКП-Винар-ИБ-ПА-ТМ»

Устройство контроля процесса паровой
стерилизации биологическое трубчатое многоразовое
«УКП-Винар-ИБ-ПА-ТМ»
ТУ 9398-098-11764404-2013

Количество индикаторов в комплекте: 18 шт

Изготовлено: ООО «НПФ «Винар» Россия, Москва,
105094, а/я 26

Дата изготовления ФЕВ 2013 ОТК 2 партия 01

Применяется в каждом цикле стерилизации трубчатых и
полых изделий в паровых стерилизаторах циклическим
принудительным удалением воздуха в циклах стерилизации с
параметрами выдержки: «121⁺³ °C, 20⁺² мин», «134⁺³ °C, 5⁺¹
мин», «134⁺³ °C, 7⁺¹ мин». Закладывать в камеру стерилизатора
на нижнюю полку у загрузочной и разгрузочной двери.

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от +5 °C до
+40 °C и относительной влажности не выше 85%, в
защищенном от солнечного света месте. Беречь от влаги.
Гарантийный ресурс Устройства – 200 циклов стерилизации.
Гарантийный срок хранения 16 месяцев.

ВИНАР
Биотест-П-ВИНАР

Индикатор автономный биологический одноразовый
для контроля всех режимов паровой стерилизации
медицинских изделий, разрешенных в РФ.
Высушенные споры микроорганизмов *Geobacillus*
stearothermophilus штамм БКМ Б-718 в кол-ве 10⁶

ТУ 9398-098-11764404-2011

РЕЖИМЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ

И. то,	Вид микроорганизма	Количество спор	Параметры
Биотест-П2-Винар			

ДОК ПРО
Перед исп

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

6 (шесть)

лист 06

Генеральный директор
ООО «НПФ «Винар»

Андреев В.С.

