

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИФА»

Е. В. Варлыгин



«22» мая 2023 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия

**«Тест-полоски колориметрические, серии URS, для анализа мочи на Станции анализа мочи, автоматической, серии BW-3000 + BW-901, в вариантах исполнения»**, производства Bioway Biological Technology Co., Ltd. (Биовэй Биолоджикал Технолоджи Ко Лтд.), Китай

Рисунок 1. Тест-полоски колориметрические, серии URS, для анализа мочи на Станции анализа мочи, автоматической, серии BW-3000 + BW-901, в вариантах исполнения: 1.1 Тест-полоски URS-12F для анализа мочи по 12 параметрам

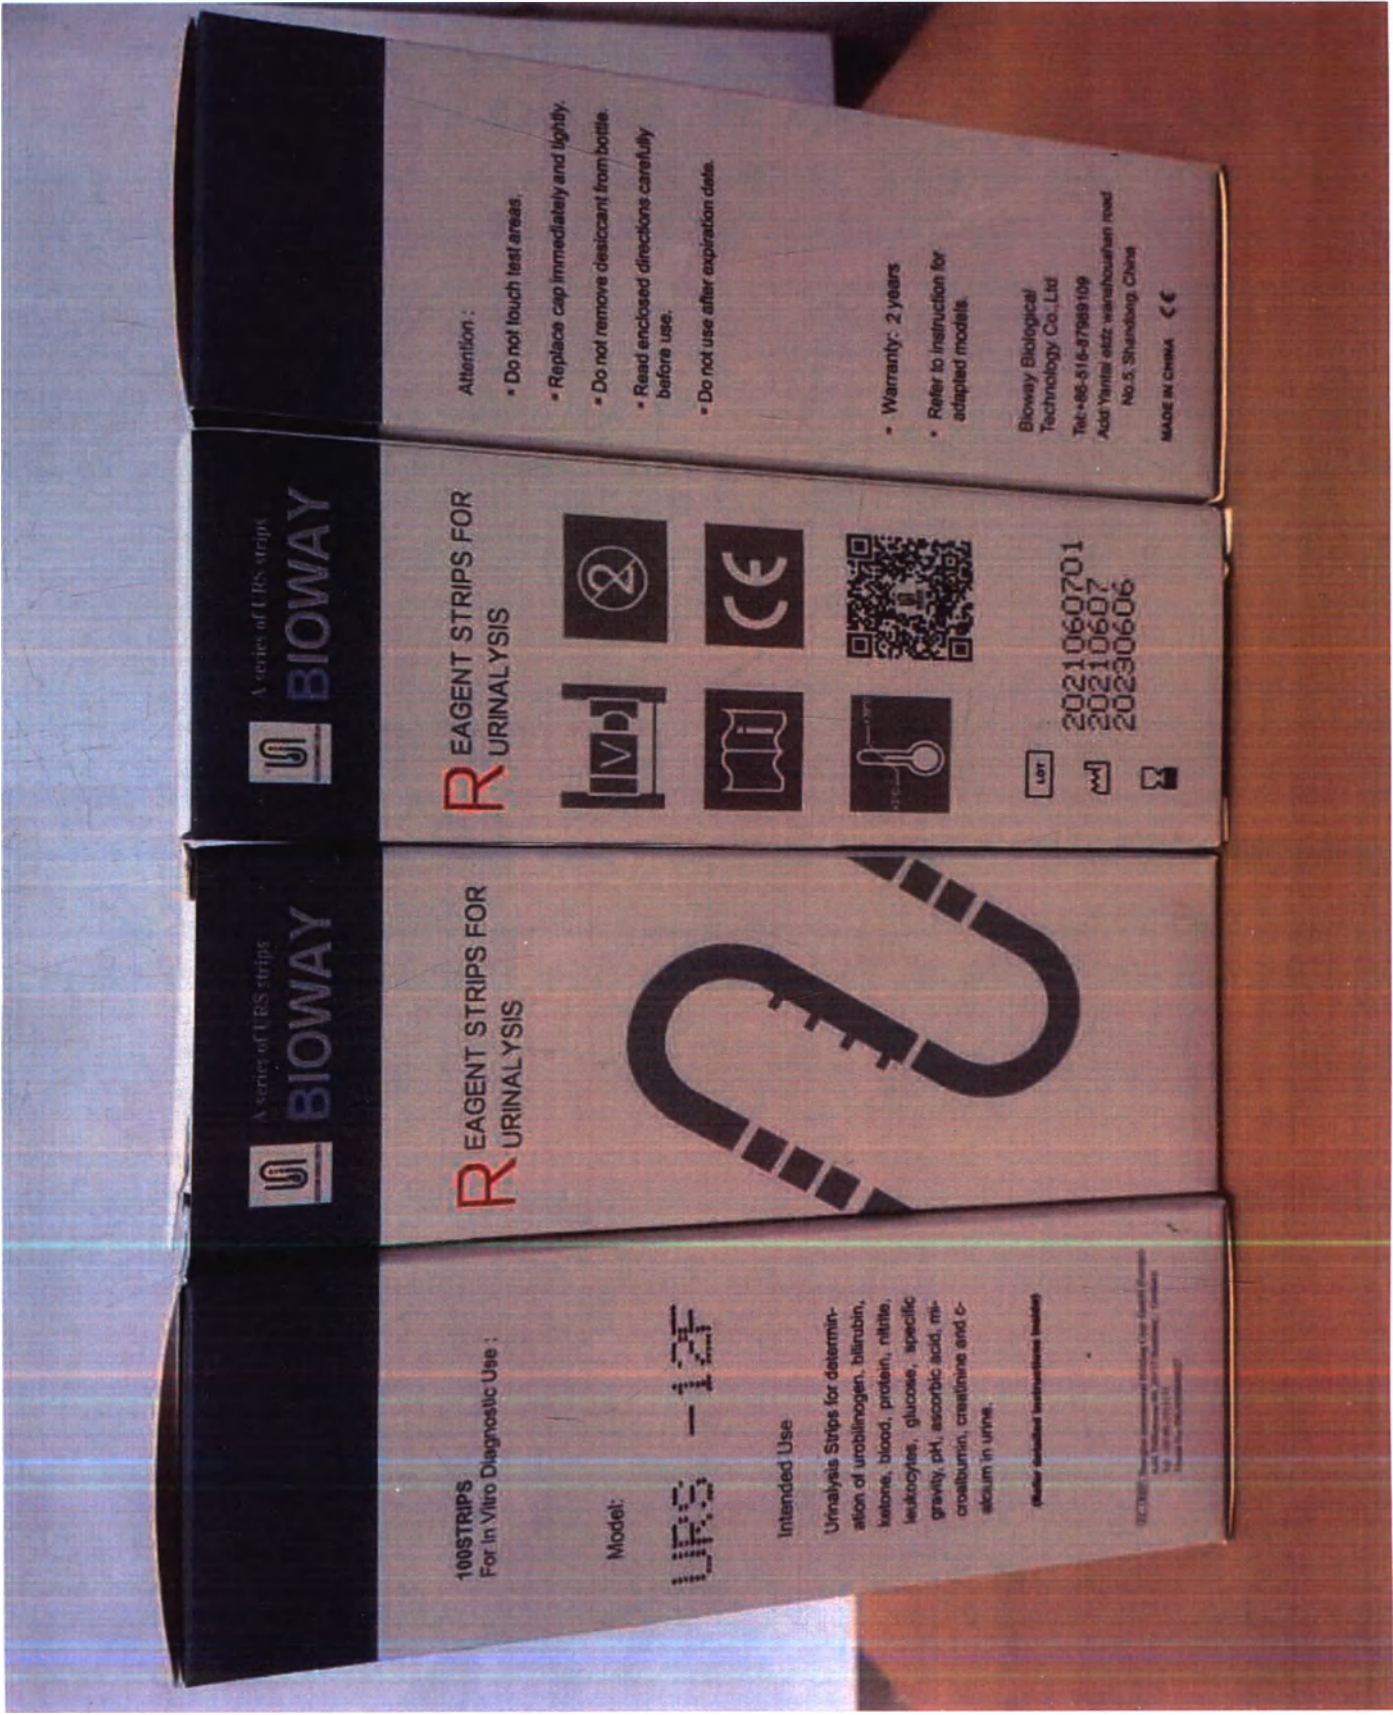




Рисунок 2. Тест-полоски колориметрические, серии URS, для анализа мочи на Станции анализа мочи, автоматической, серии BW-3000 + BW-901, в вариантах исполнения: 2.1 Тест-полоски URS-11F для анализа мочи по 11 параметрам

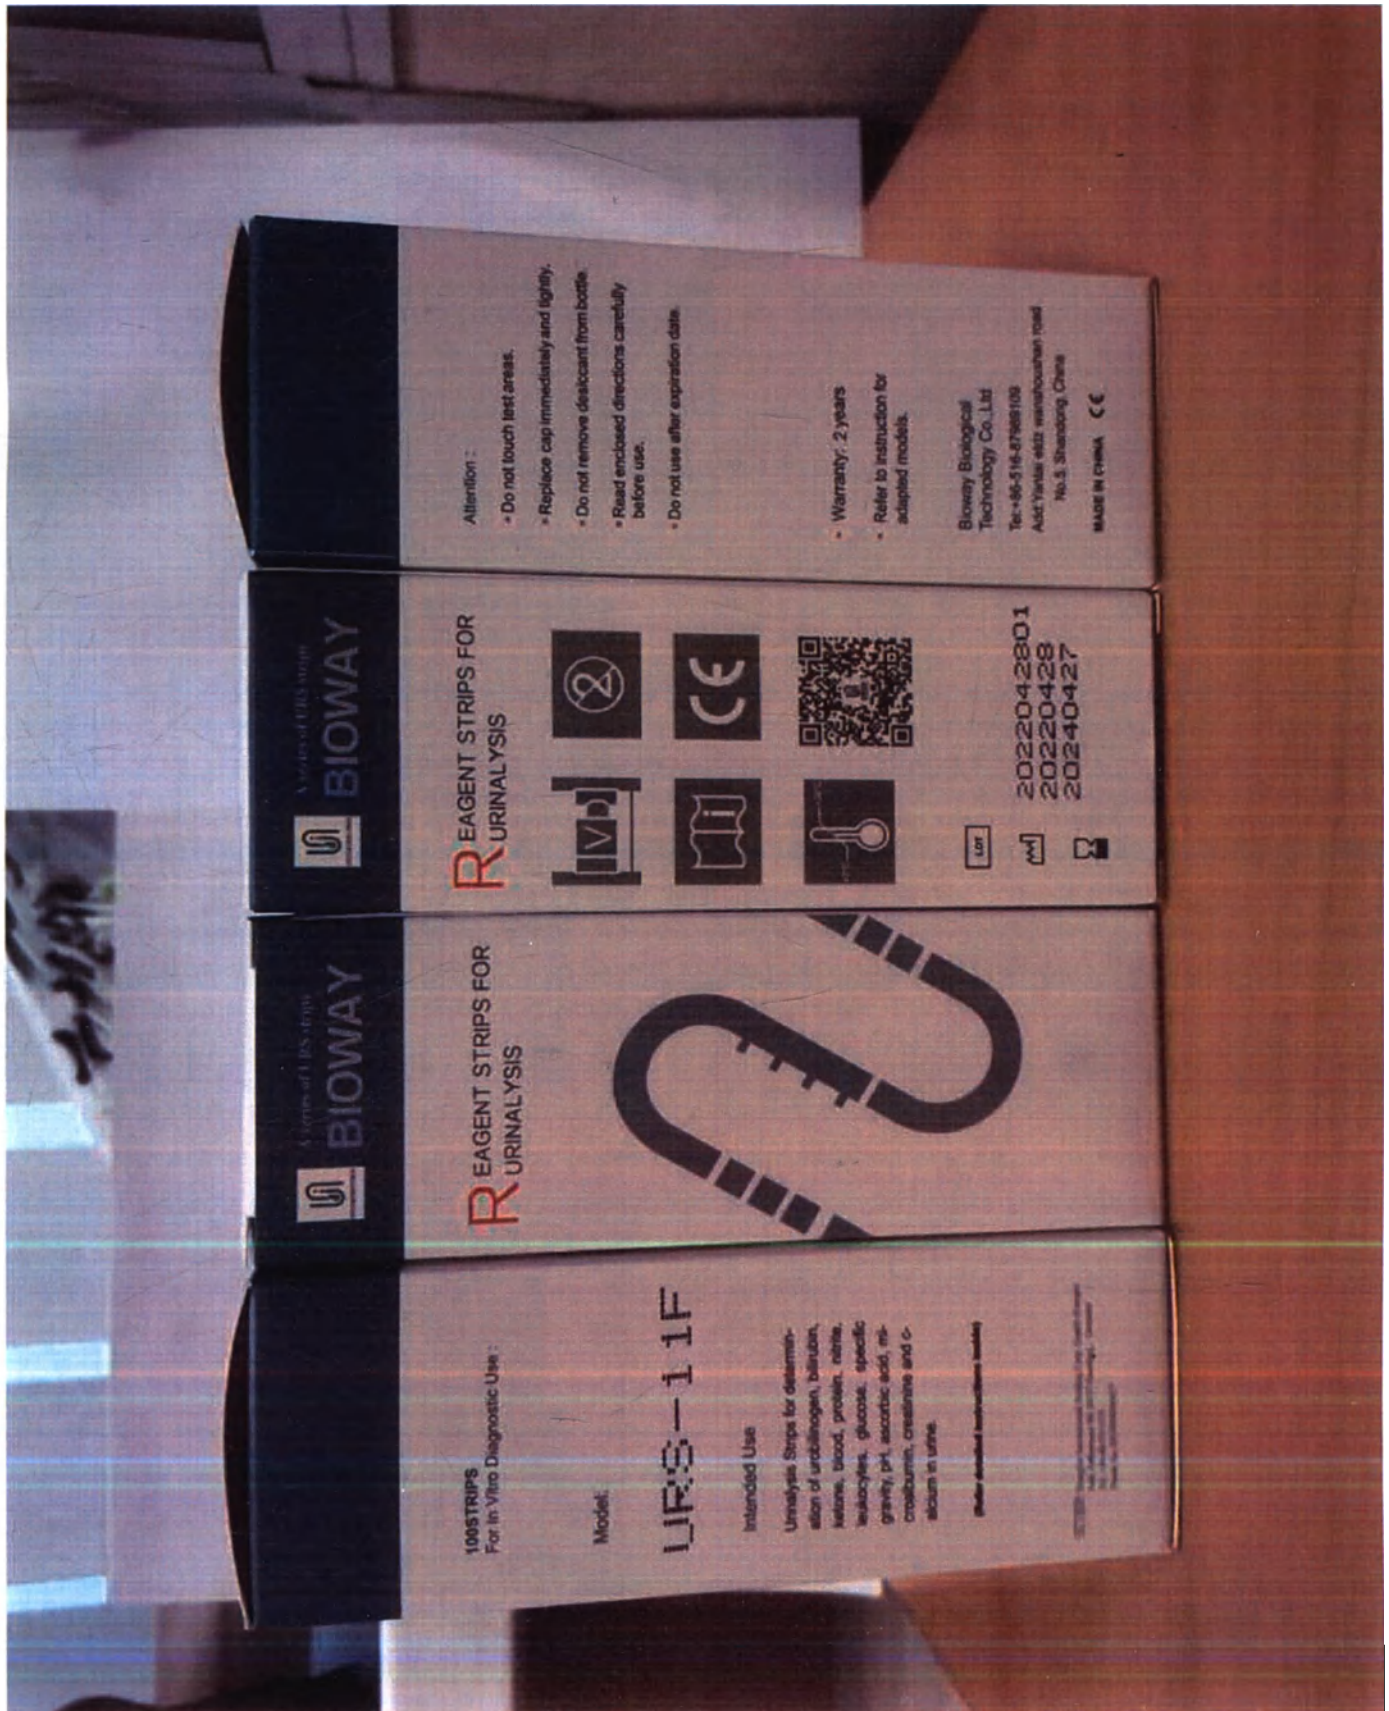




Рисунок 3. Тест-полоски колориметрические. серии URS. для анализа мочи на Станции анализа мочи, автоматической, серии BW-3000 + BW-901, в вариантах исполнения: 3.1 Тест-полоски URS-10F для анализа мочи по 10 параметрам



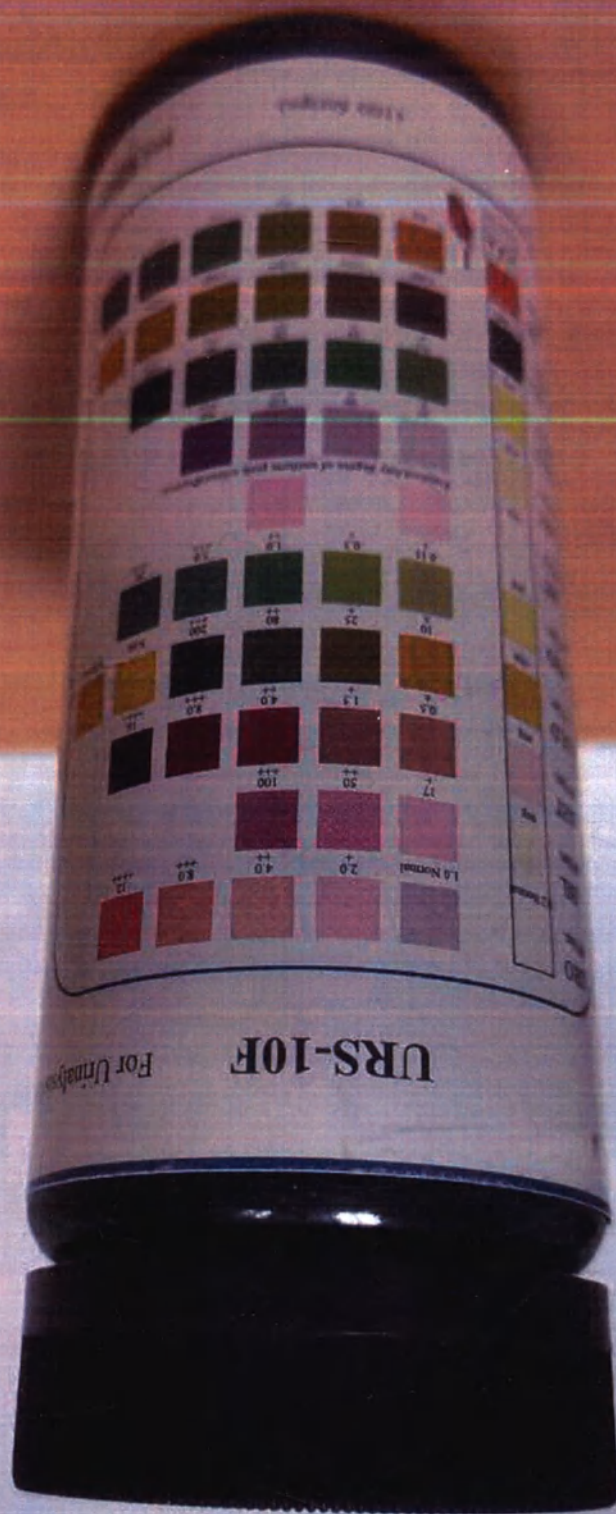


Рисунок 4. Инструкция по применению

ical technology Co.,Ltd

CE

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Market Director

(должность/position)

Justin Zhang

(Имя/Name)

(подпись/signature)

«30» May 2023 г.

«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)

M.H. / Stamp



Тест-полоски колориметрические, серии URS, для анализа мочи на Станции анализа мочи, автоматической, серии BW-3000 + BW-901, в вариантах исполнения

Инструкция по применению

扫描全能王 创建



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

9 (декабрь) 2011 г.

лист(-ов),

Ис. директор *М. Вартогян*  
СВ