
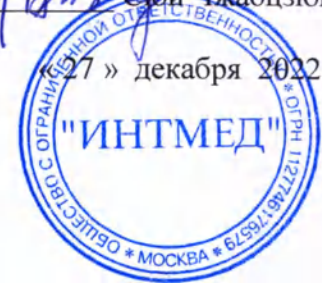


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИНТМЕД»


С. А. Чжаоцзюнь
«27» декабря 2022 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ЗОНД ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, СТЕРИЛЬНЫЙ

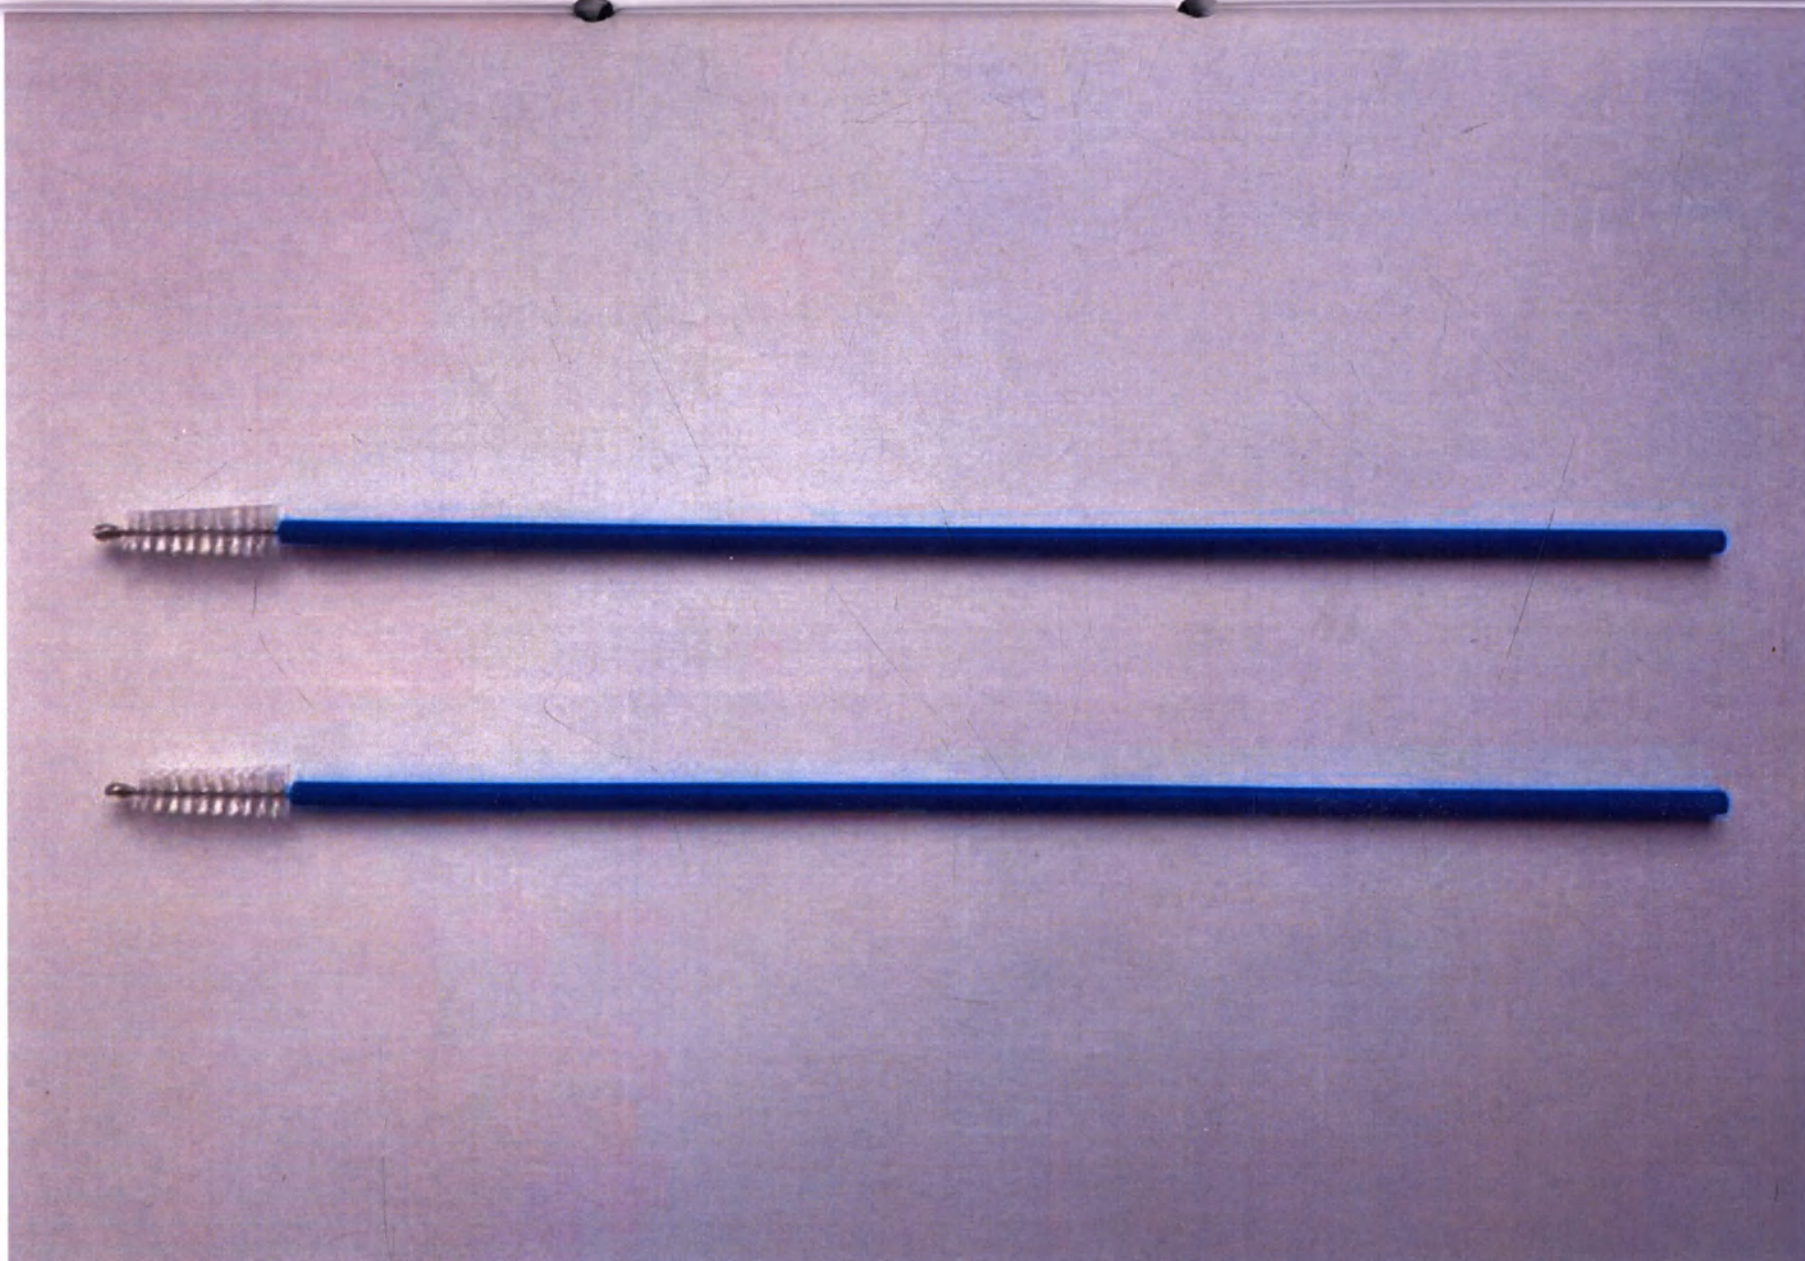


Фото 1 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-1, щеточка цервикальная – вид изделия

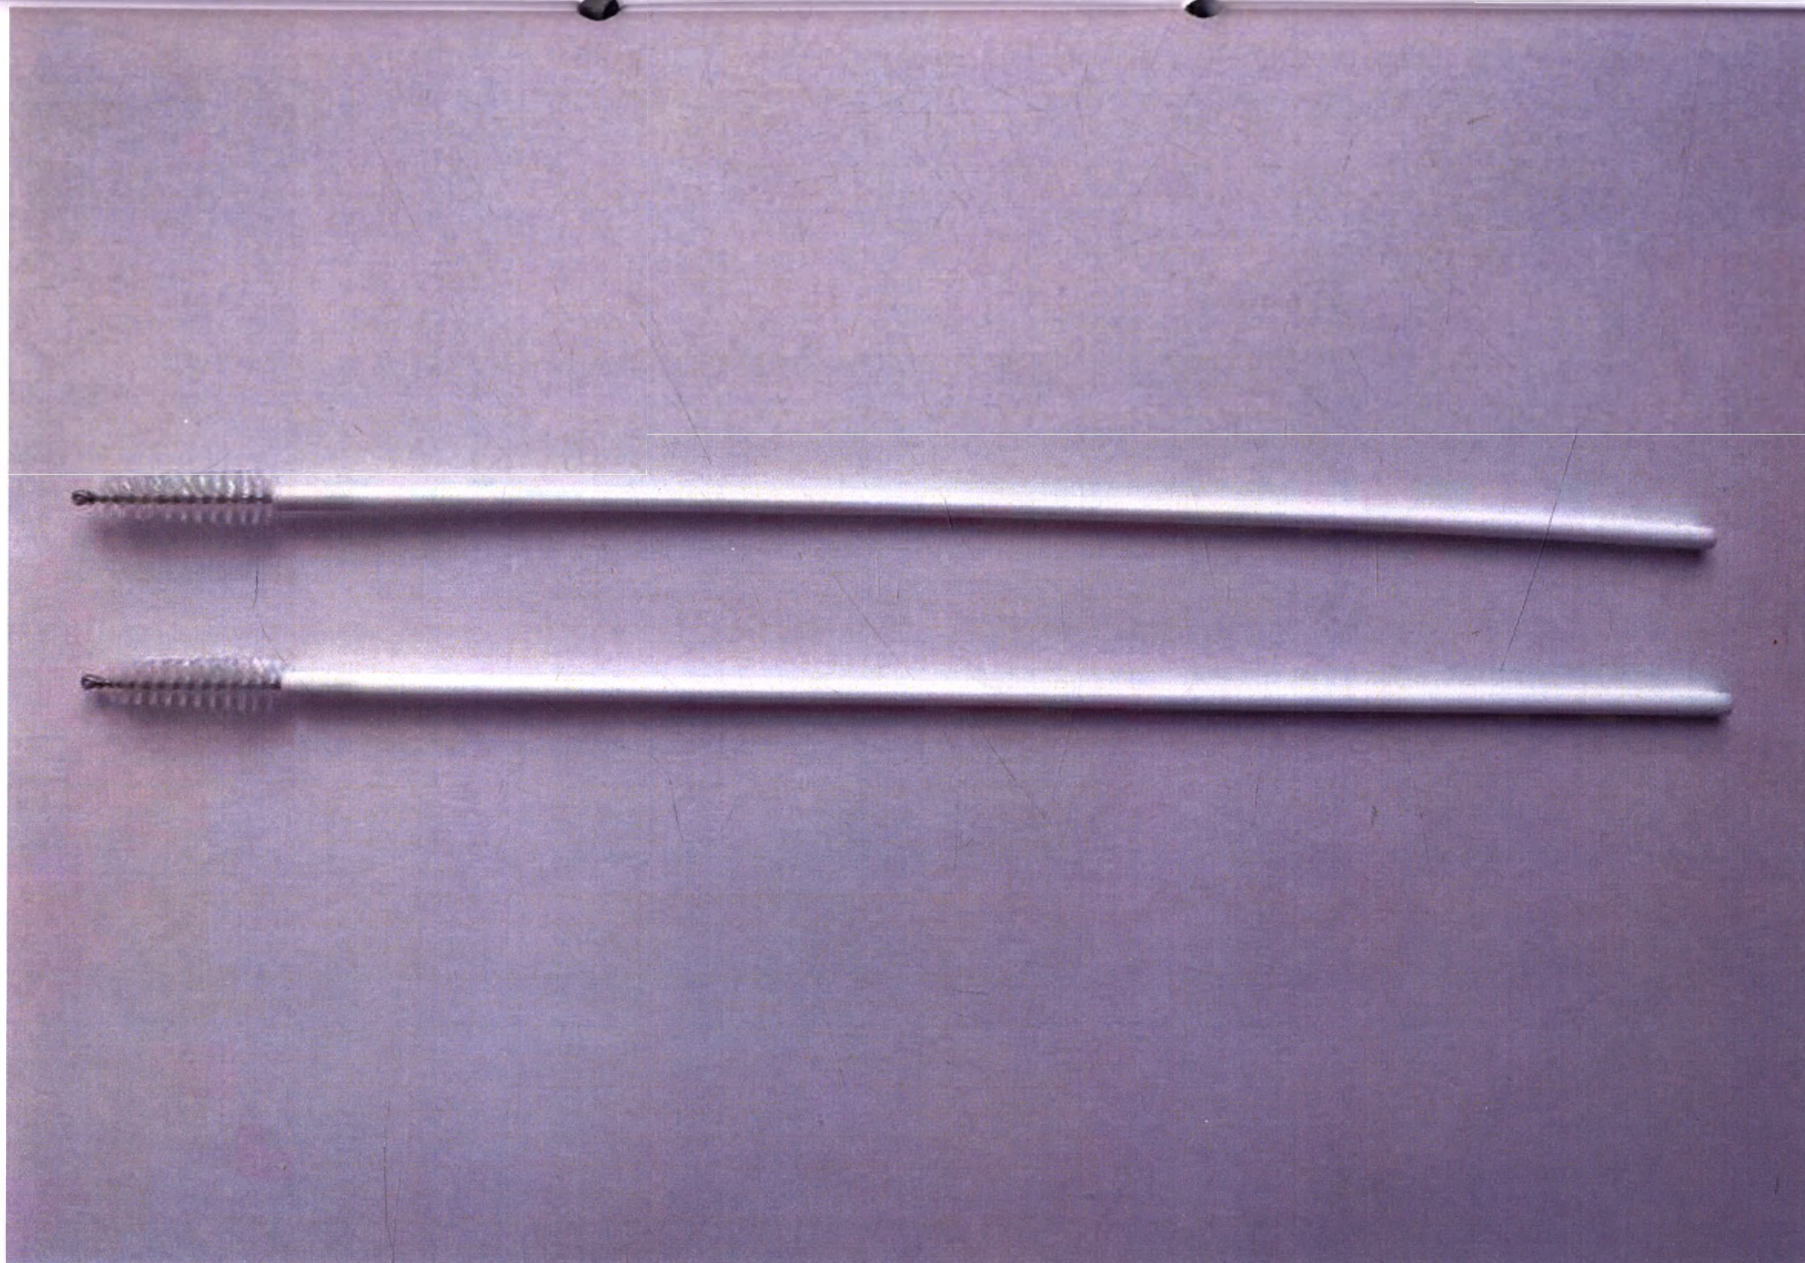


Фото 2 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-1, цитощетка цервикальная – вид изделия

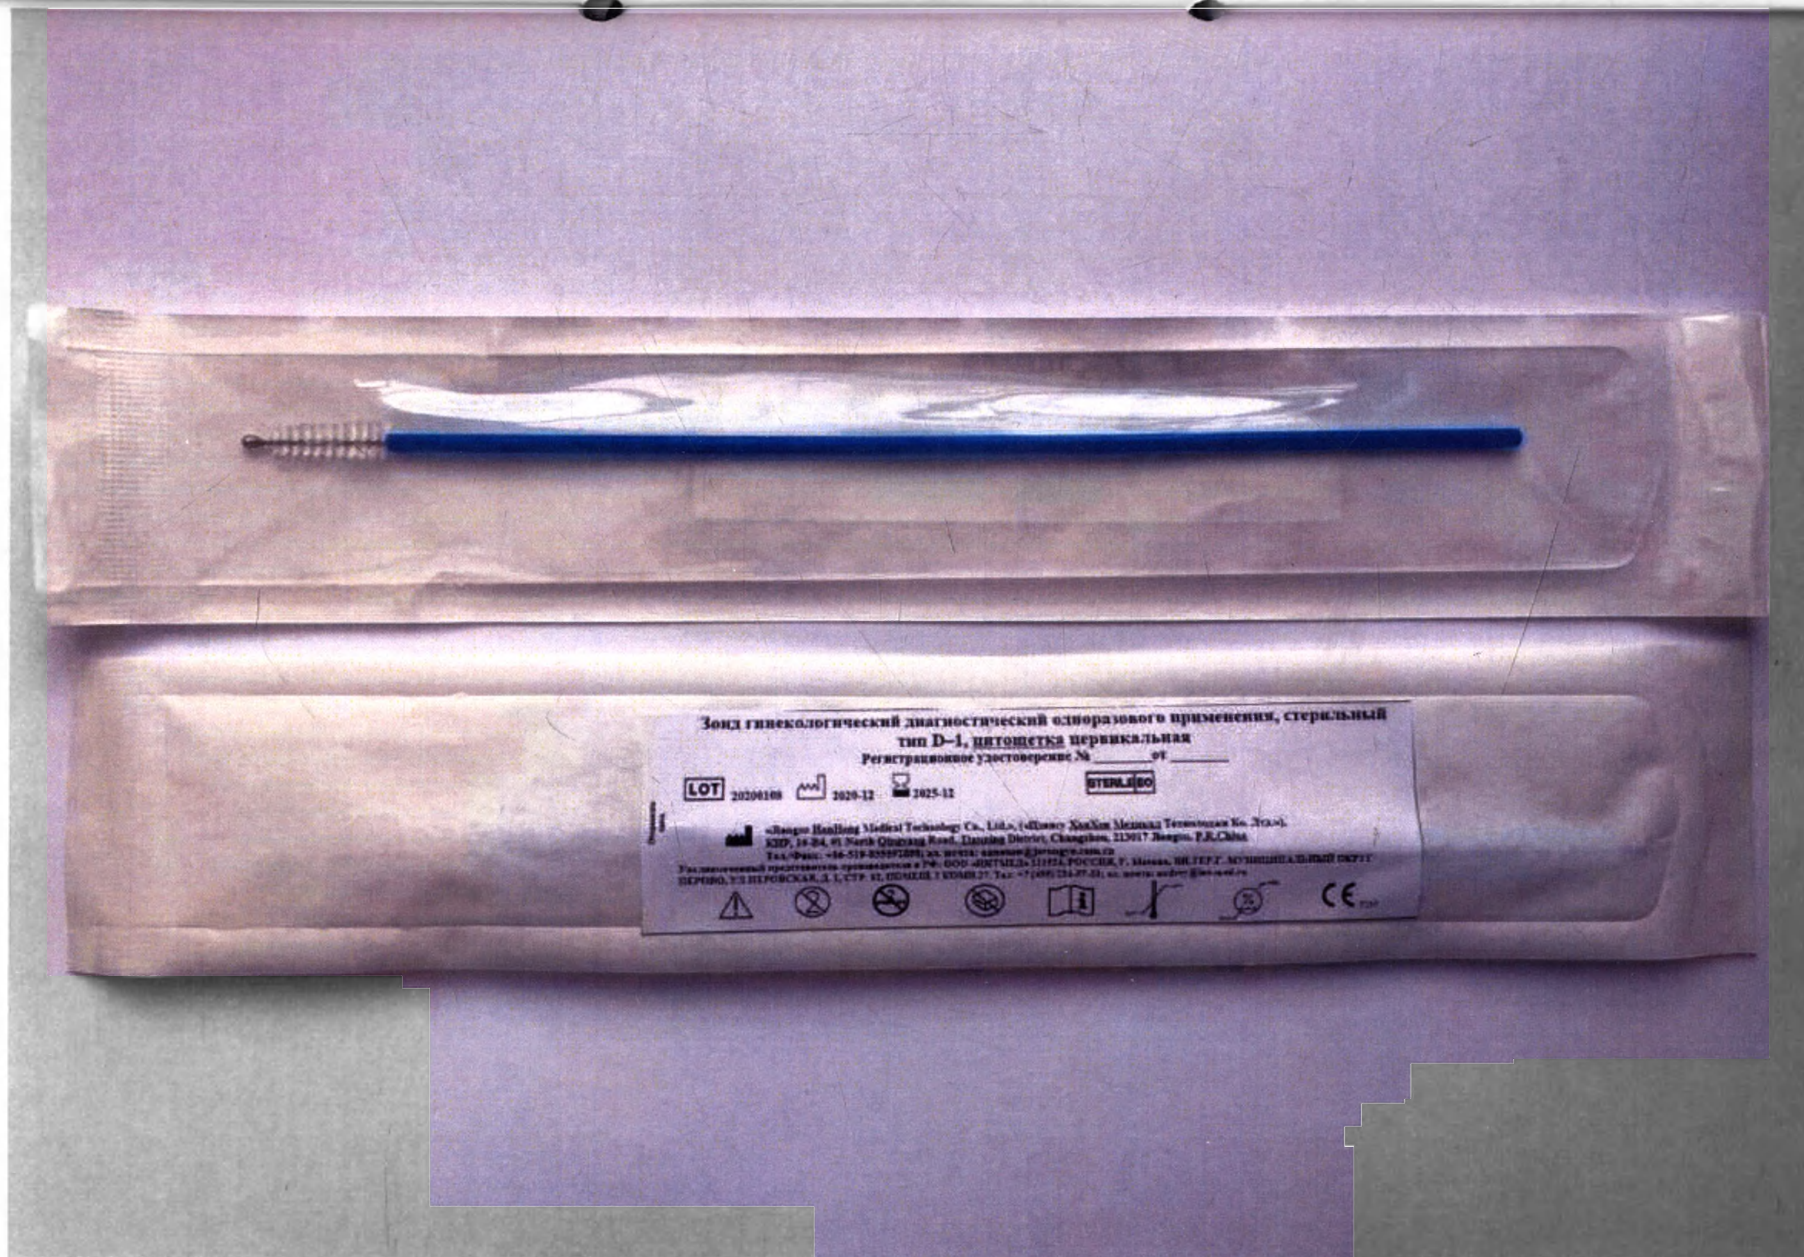


Фото 3 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-1, цитощетка цервикальная - индивидуальная упаковка

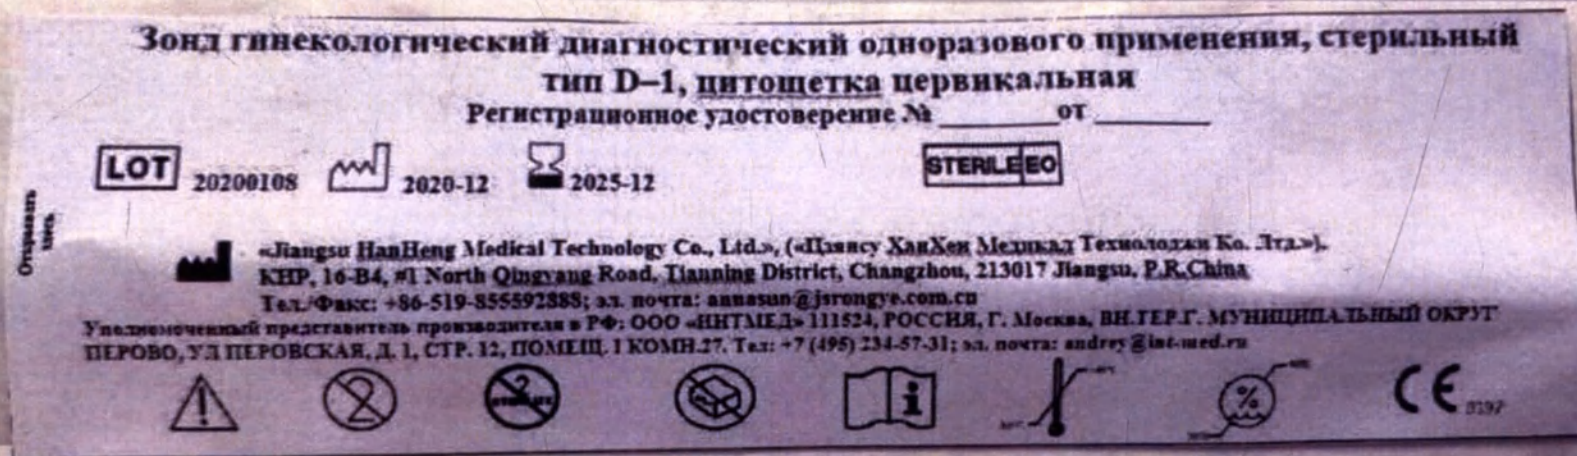



Фото 4 - Маркировка индивидуальной упаковки

Зонд гинекологический
диагностический одноразового
применения, стерильный тип D-1,
цитощетка цервикальная
100 шт/уп.

LOT 20200108

2020-12

2025-12



- Запрещено повторное применение.
- Запрещено применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- Запрещено применять после истечения срока годности.
- Запрещено применять при наличии повреждений.
- Перед использованием прочтите инструкцию по применению.

«Jiangsu HanHeng Medical
Technology Co., Ltd.» («Цзянсу ХанХен
Медикал Текнолоджи Ко. Лтд.»),
KHP, 16-B4, #1 North Qingyang Road,
Tianning District, Changzhou, 213017
Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-85559288

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО «ИНТМЕД»

111524, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР.
12, ПОМЕЩ. 1 КОМН.27,

Тел: +7 (495) 234-57-31 E-mail:

andrey@int-med.ru

ПУ № _____ от _____



Фото 5 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-1, цитощетка цервикальная - групповая упаковка

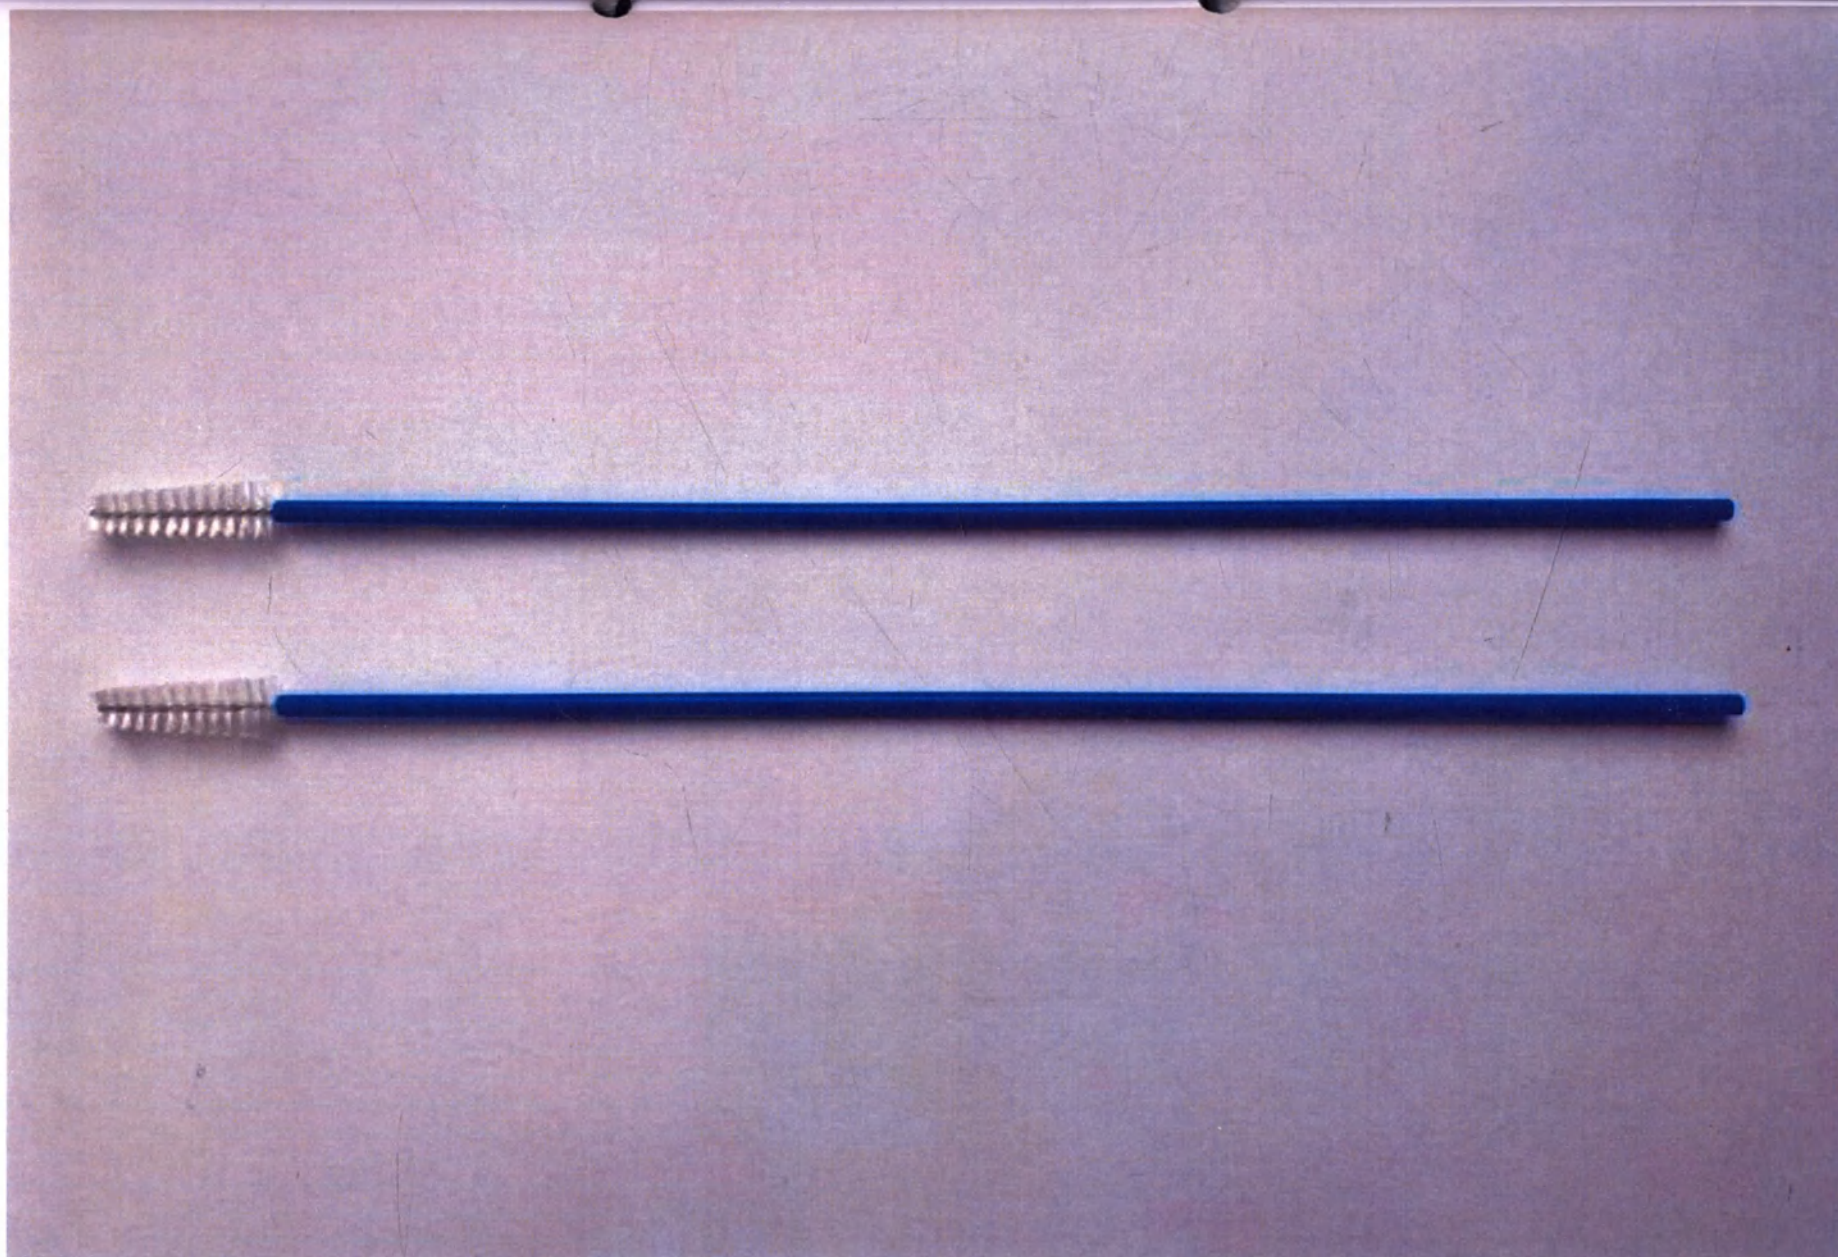


Фото 6 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-2, цитощетка цервикальная – вид изделия

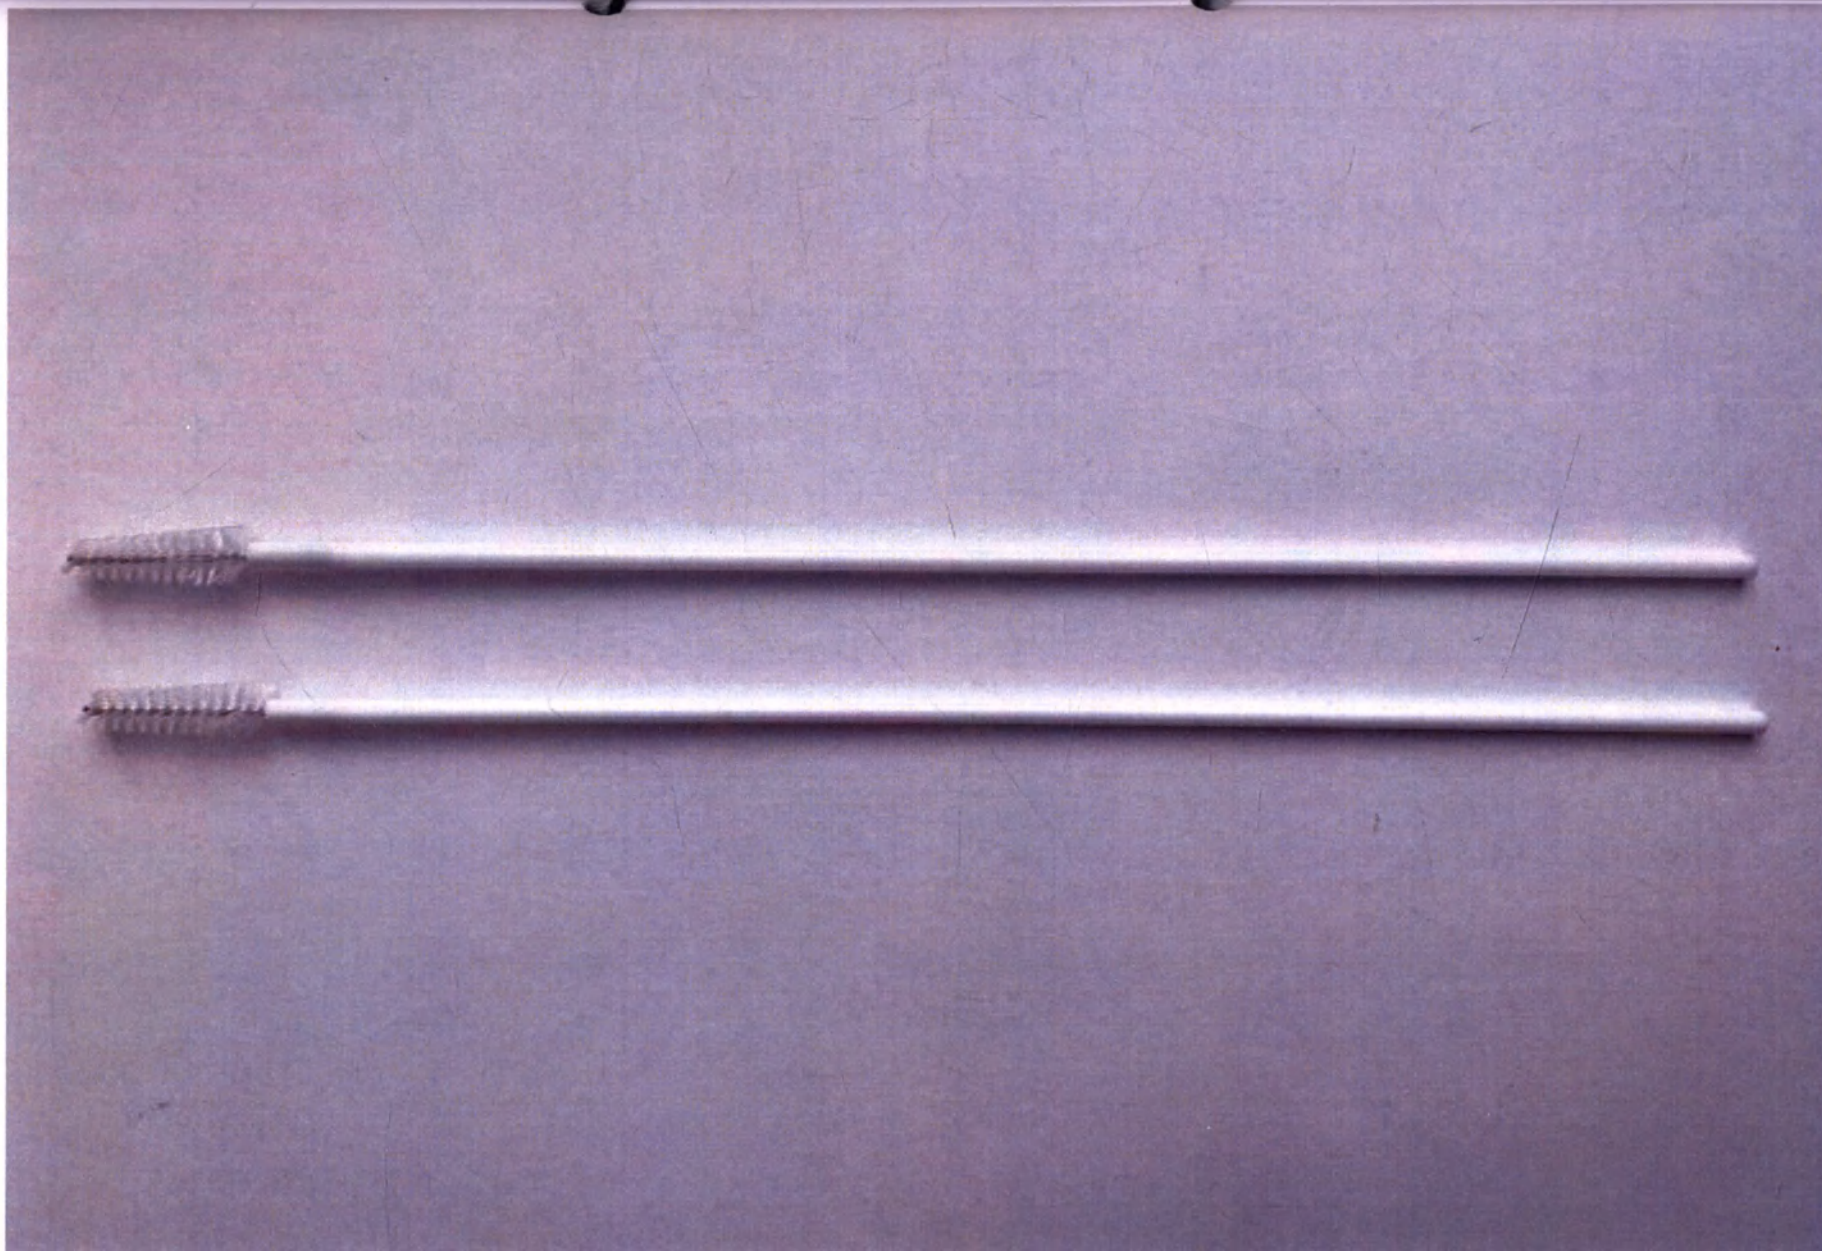


Фото 7 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-2, цитощетка цервикальная – вид изделия

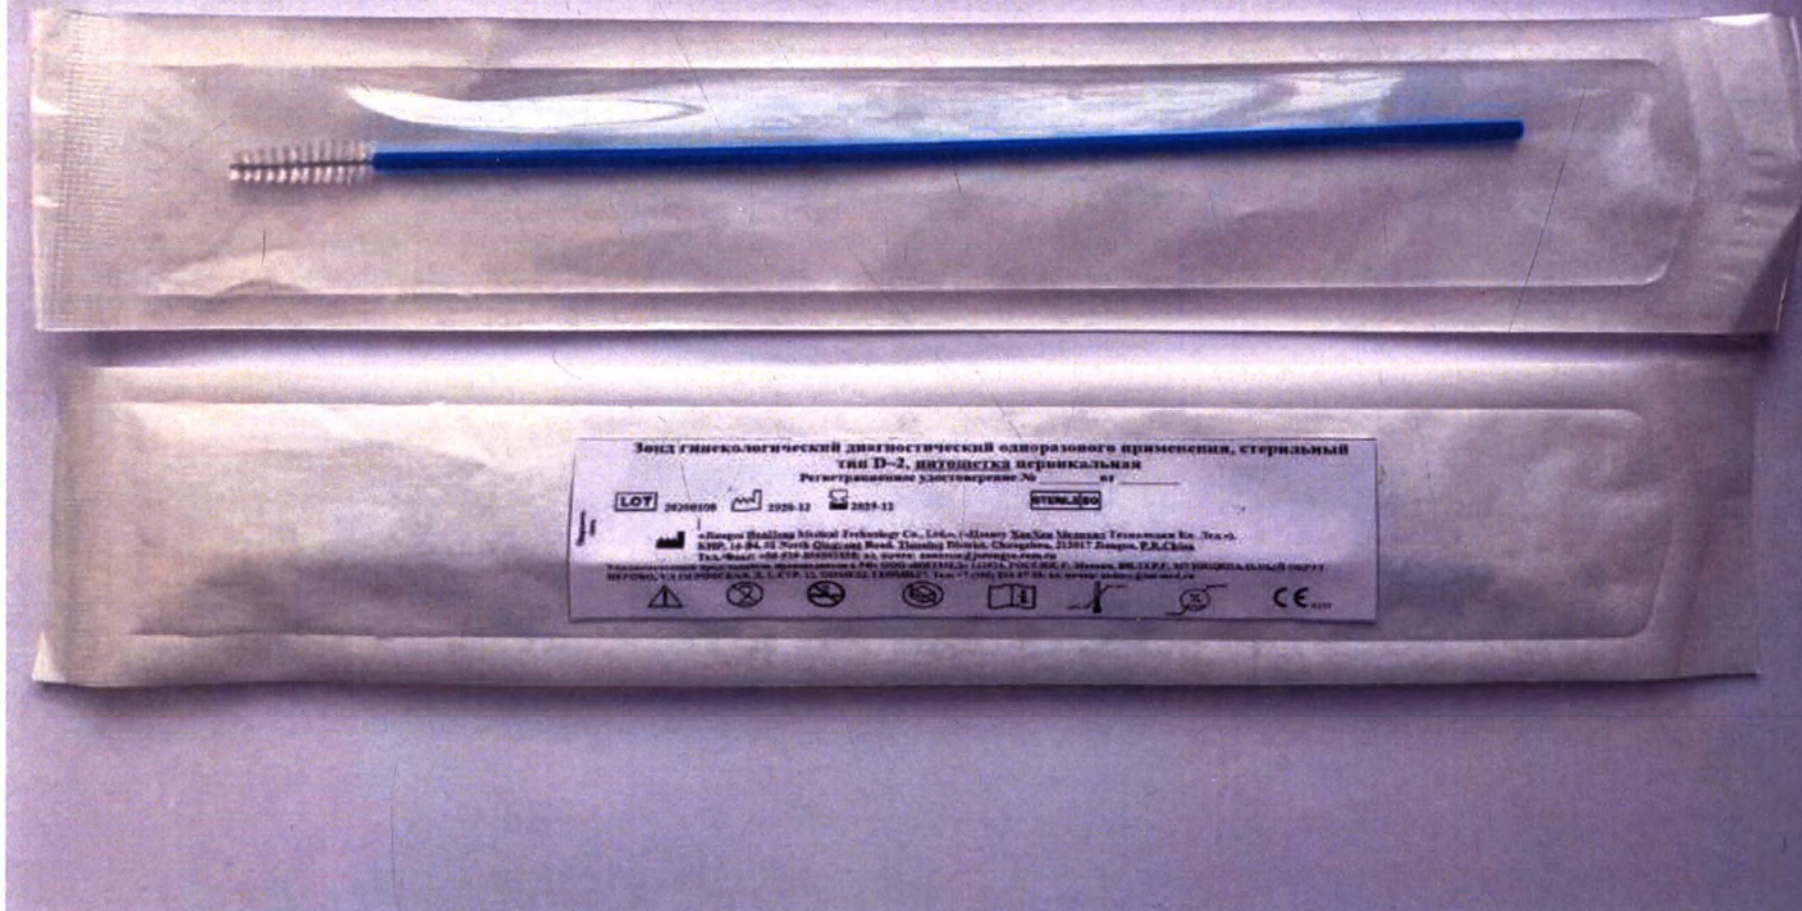


Фото 8 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-2, цитощетка цервикальная – индивидуальная упаковка

Зона глинисто-пеллический однофазового призмения, стериальный

тип Д-2, автометрия непрерывная

Перепечатанное удостоверение № 01

LOT

26200108

E

2020-12

M

2025-12

STENOLOGO

Copyright © 1994

1

10

*Tianjing Hualin Medical Technology Co., Ltd., (Tianjin Hualin Medical Technology Co., Ltd.)
No. 16-04, 41 North Qiyang Road, Tianjin District, Changzhou, 213015 Jiangsu, P.R.China
Tel: +86-518-85680158; fax: +86-518-85680158; e-mail: hualin@163.com

KIPP, J. F. 44, North Qindang Road, Tianjing District, Changzhou, 213017 Jiangsu, P.R.China
Tel./Fax: +86-519-84601530 or +86-519-84601531
E-mail: kippj@163.com

Phone: +86-21-5952 9910 Fax: +86-21-5952 9911
E-MAIL: ammsun@protonic.com.cn
TEL: Dalian: +86-415-8865015/801 FAX: +86-415-8865015

Phone: +86-678-8290000 Fax: +86-678-8290001
E-mail: info@china-chemical.com
Tel: +86-678-8290001 Fax: +86-678-8290002
E-mail: info@china-chemical.com

Yae) monodromy of the corresponding projective curves in $\mathbb{P}^3$: 000-281141-1, 11514, POCHEK, F. Mironov, B. TEP, M. TIRUGA. Ushakov, O. P. TERPONO, V. A. TERPONOVA, A. I. CIP, L. TONKIL, I. KOVCH, 27, Tel: +7 (195) 274-47-33; no. newsgroup: terp@net.msu.ru




Фото 9 - Маркировка индивидуальной упаковки

**Зонд гинекологический
диагностический одноразового
применения, стерильный тип D-2,
цитощетка цервикальная
100 шт/уп.**

LOT 20200108

2020-12

2025-12



- Запрещено повторное применение.
- Запрещено применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- Запрещено применять после истечения срока годности.
- Запрещено применять при наличии повреждений.
- Перед использованием прочтите инструкцию по применению.

«Jiangsu HanHeng Medical
Technology Co., Ltd.», («Цзянсу ХанХен
Медикал Технолоджи Ко. Лтд.»),
КНР, 16-B4, #1 North Qingyang Road,
Tianning District, Changzhou, 213017
Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-85559288

**Уполномоченный представитель
производителя в РФ:**

ООО «ИНТМЕД»
111524, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР.
12, ПОМЕЩ. 1 КОМН.27,
Тел: +7 (495) 234-57-31 E-mail:
andrey@int-med.ru

РУ № _____ от _____



Фото 10 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип D-2, цитощетка цервикальная – групповая упаковка

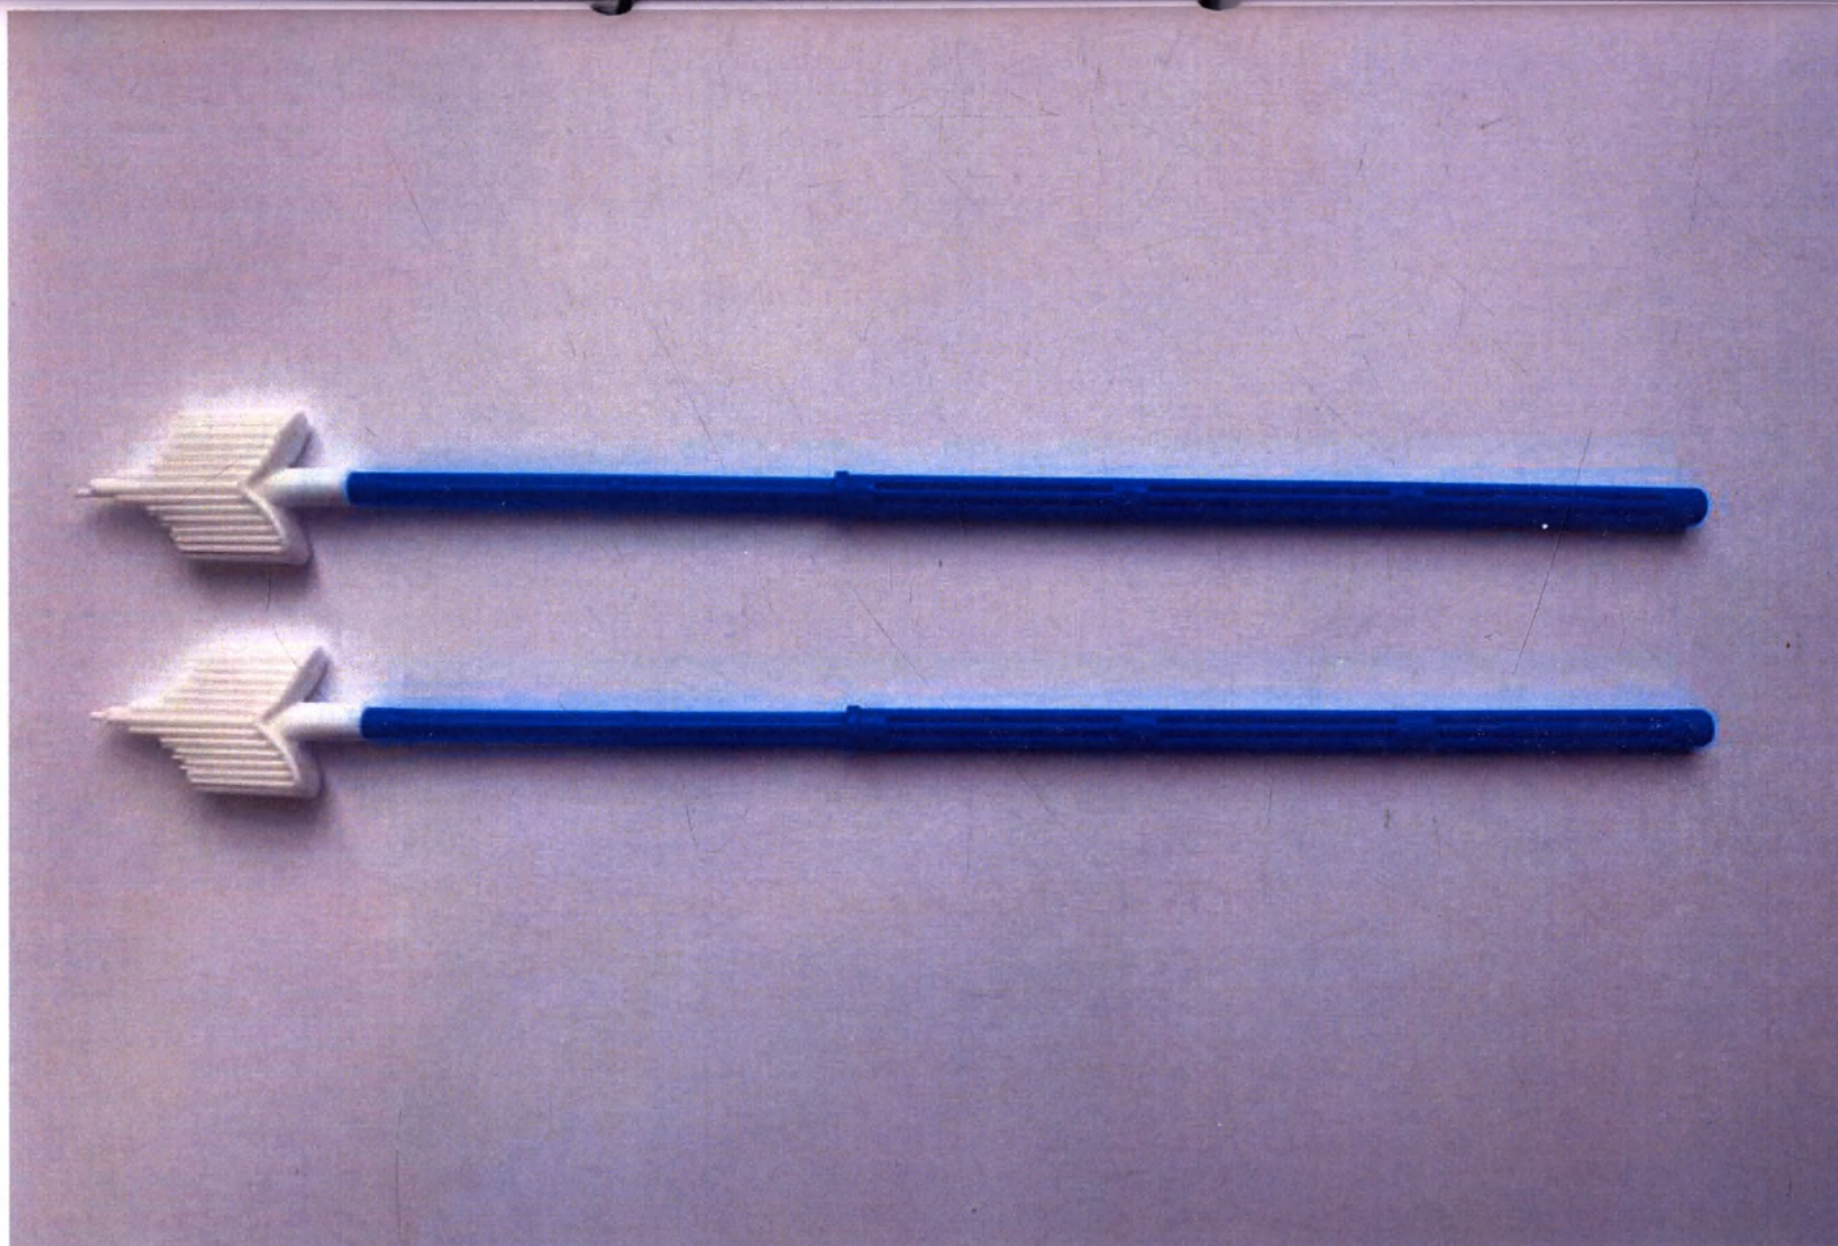


Фото 11- Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-1 (Цервикс Браш) – вид изделия

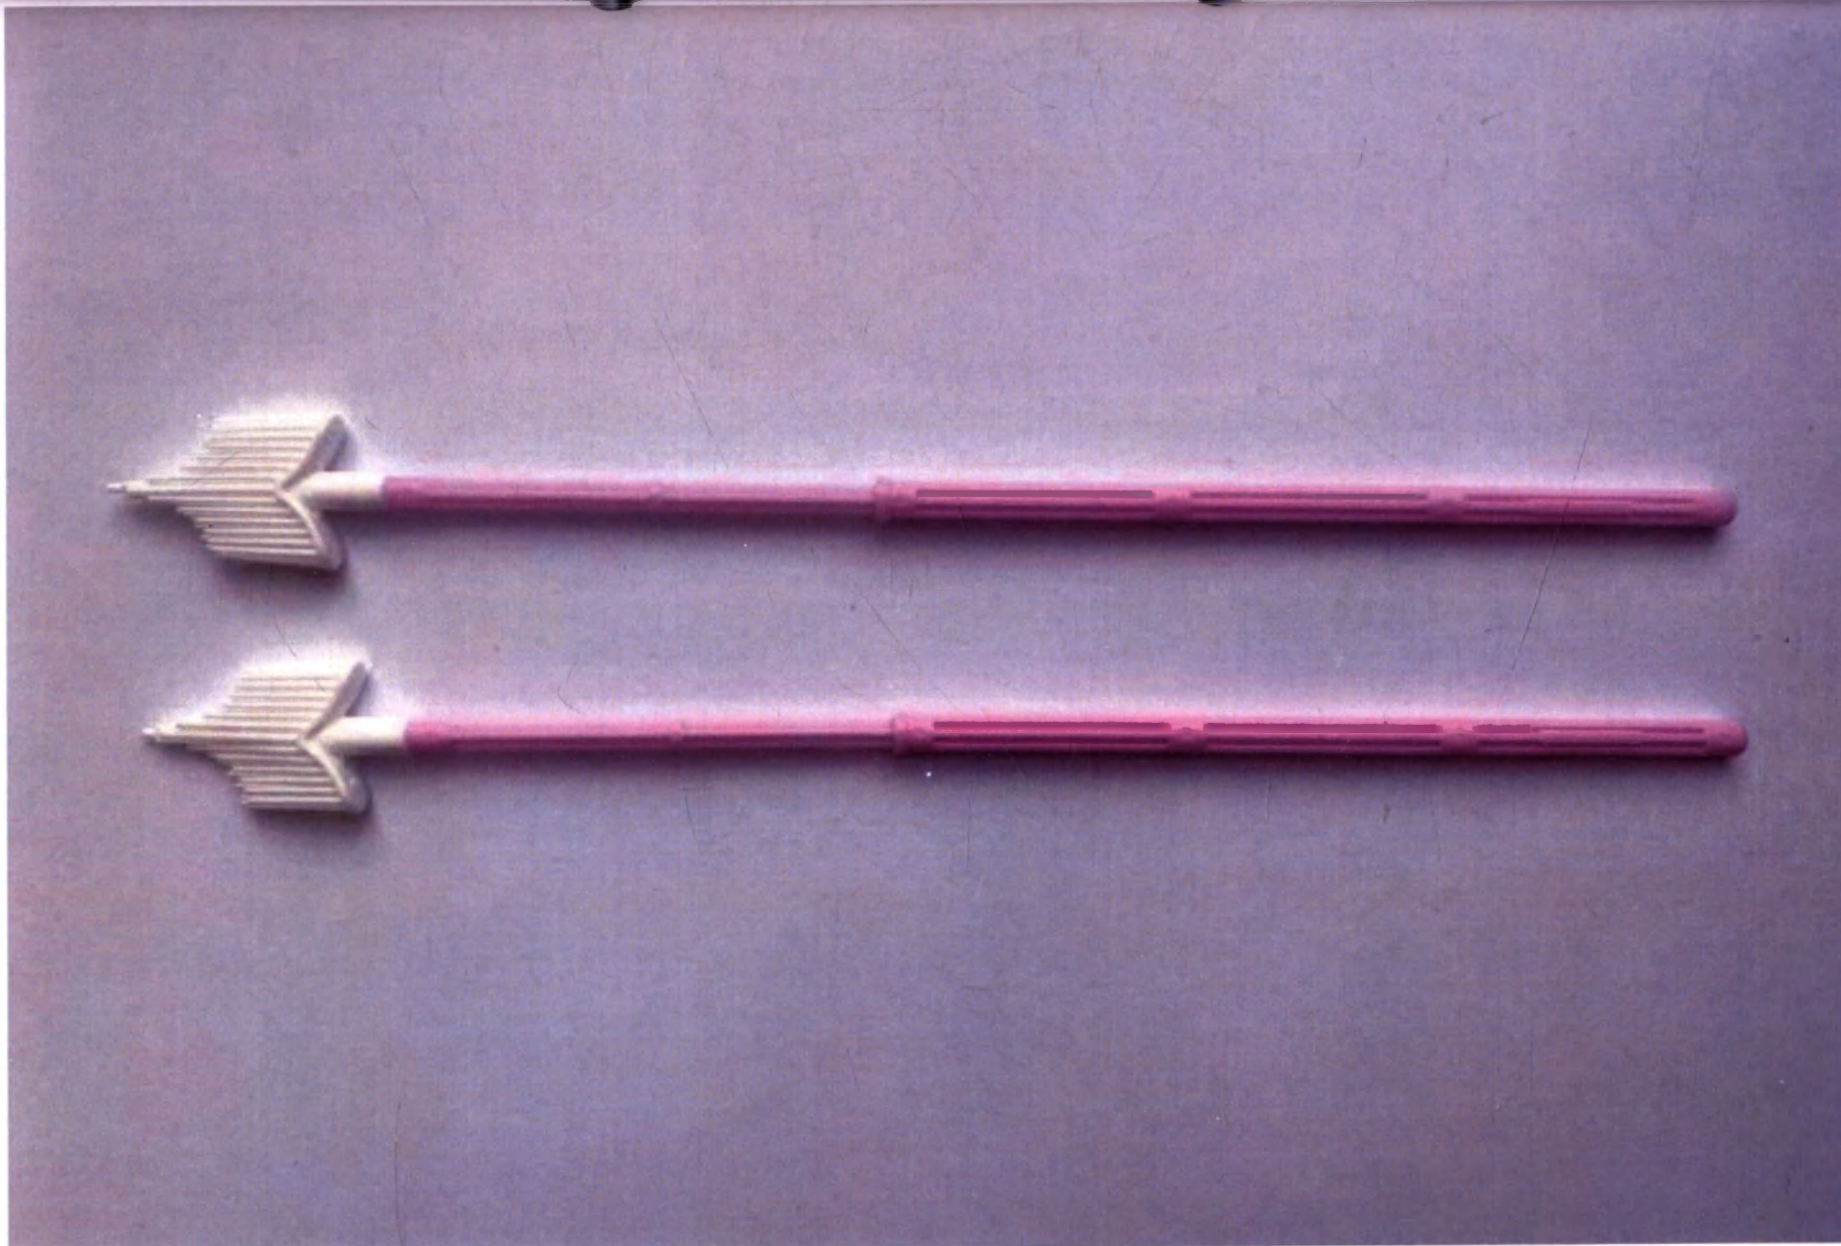


Фото 12- Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-1 (Цервикс Браш) – вид изделия

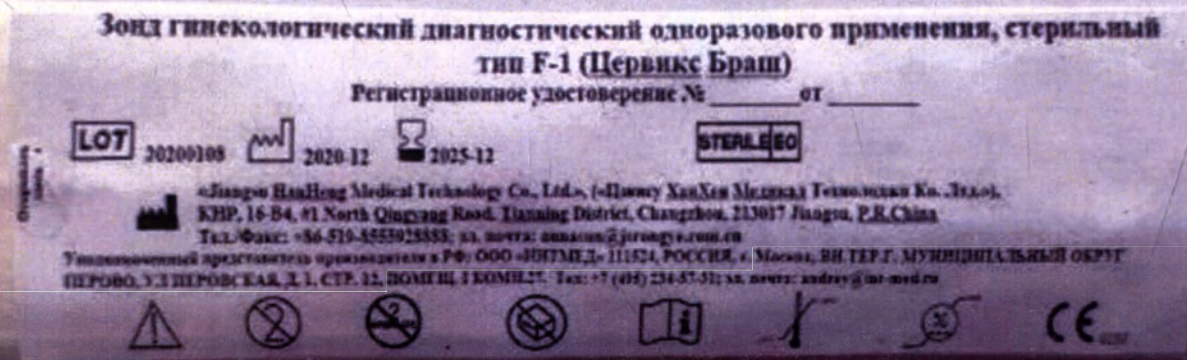


Фото 14 - Маркировка индивидуальной упаковки

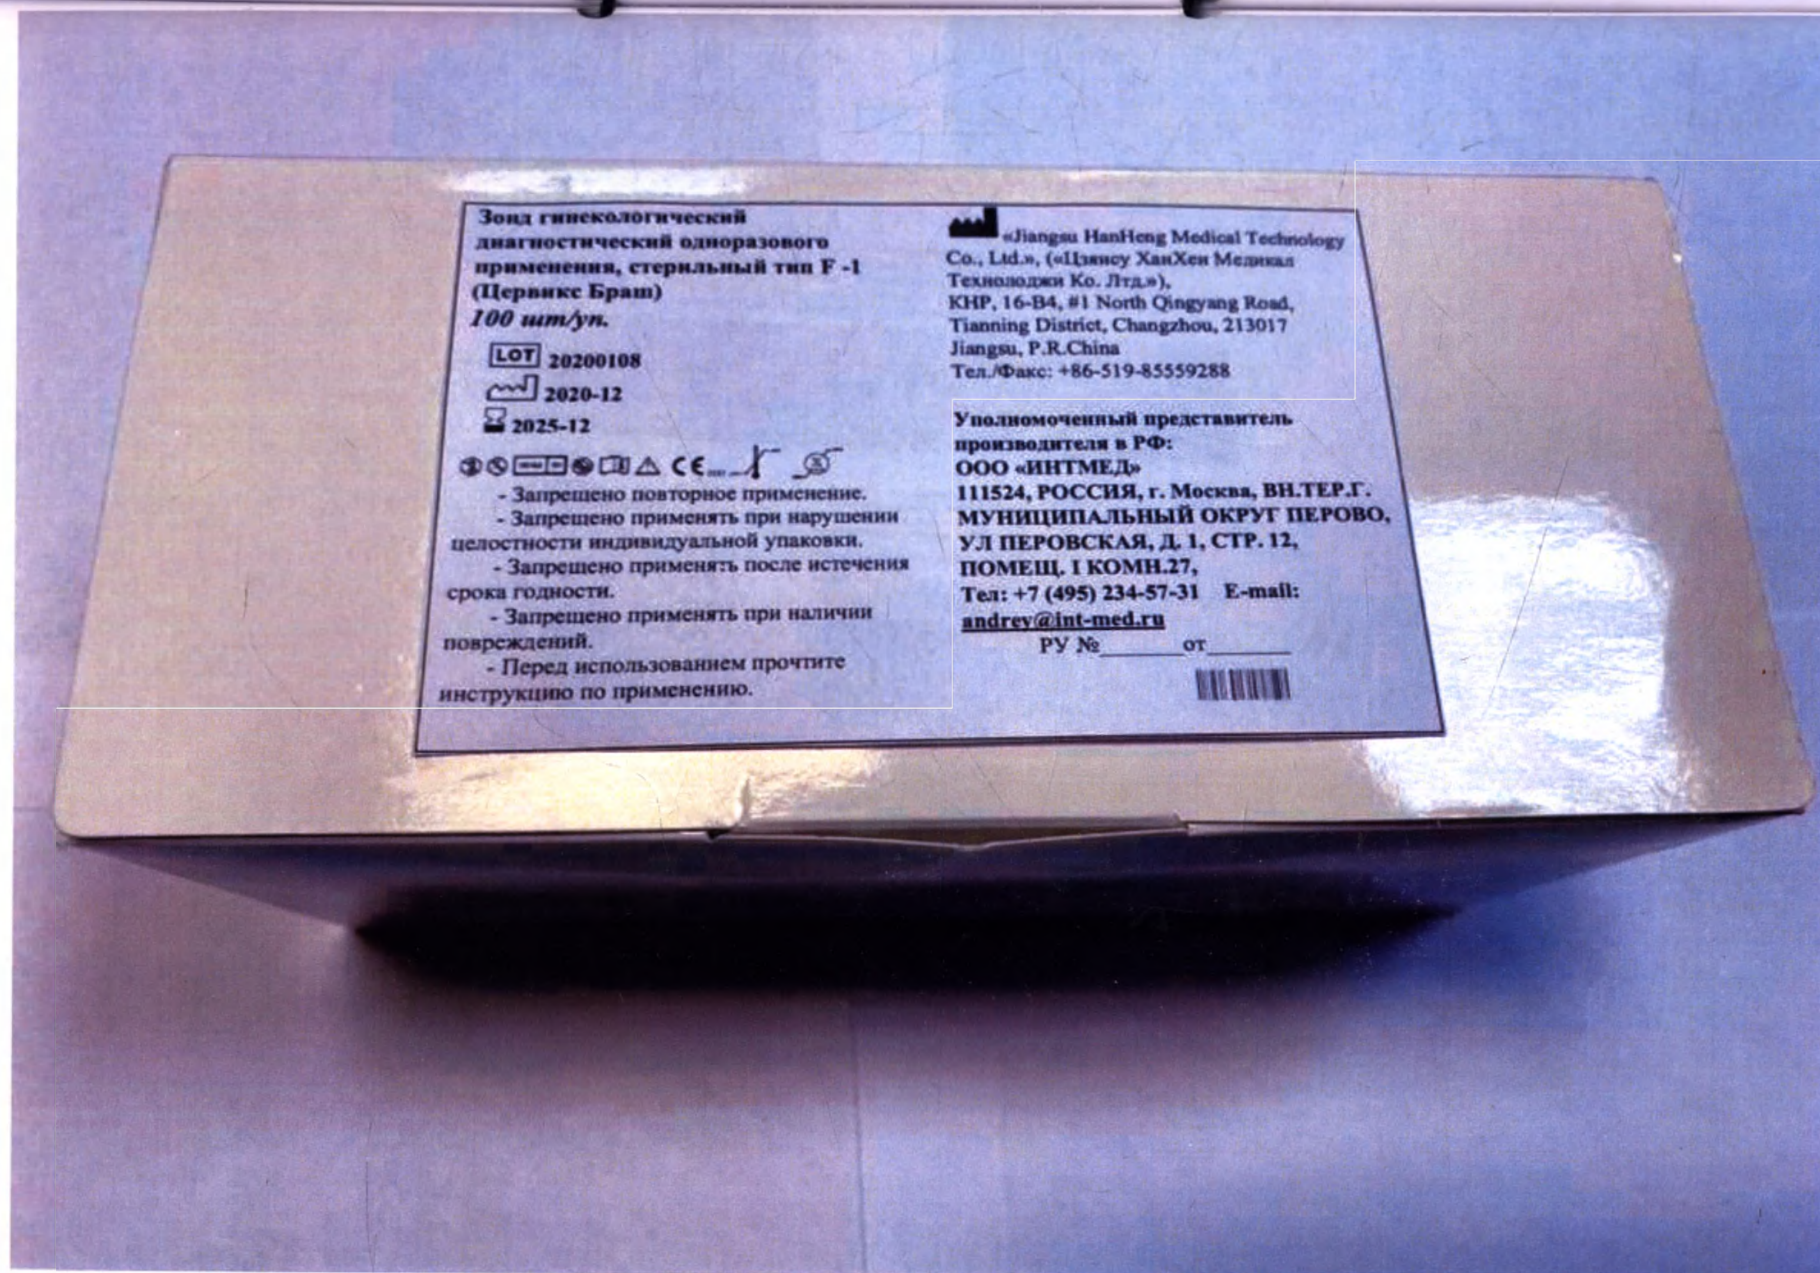


Фото 15- Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-1 (Цервикс Браш) – групповая упаковка

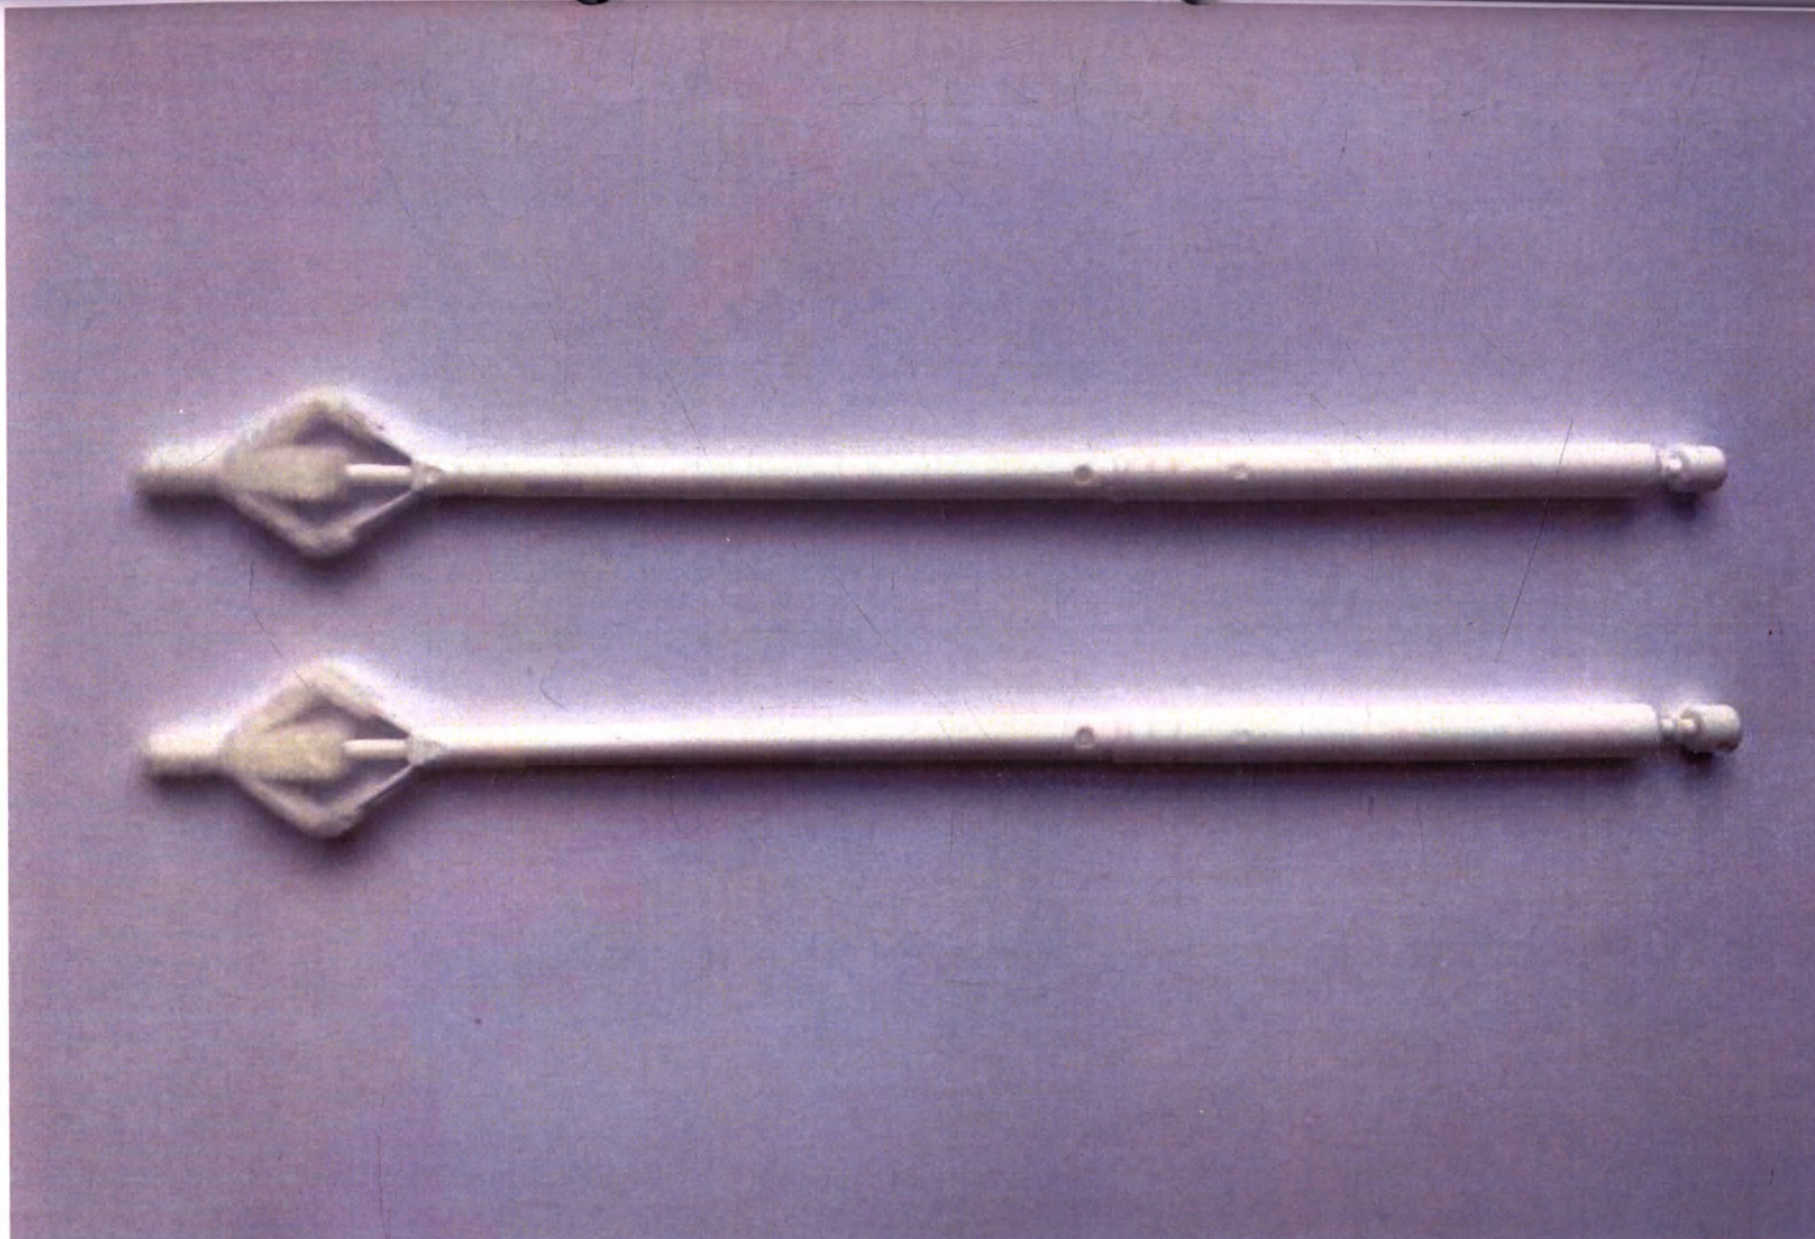


Фото 16 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-2S комбинированный (ромбовидный) - вид изделия

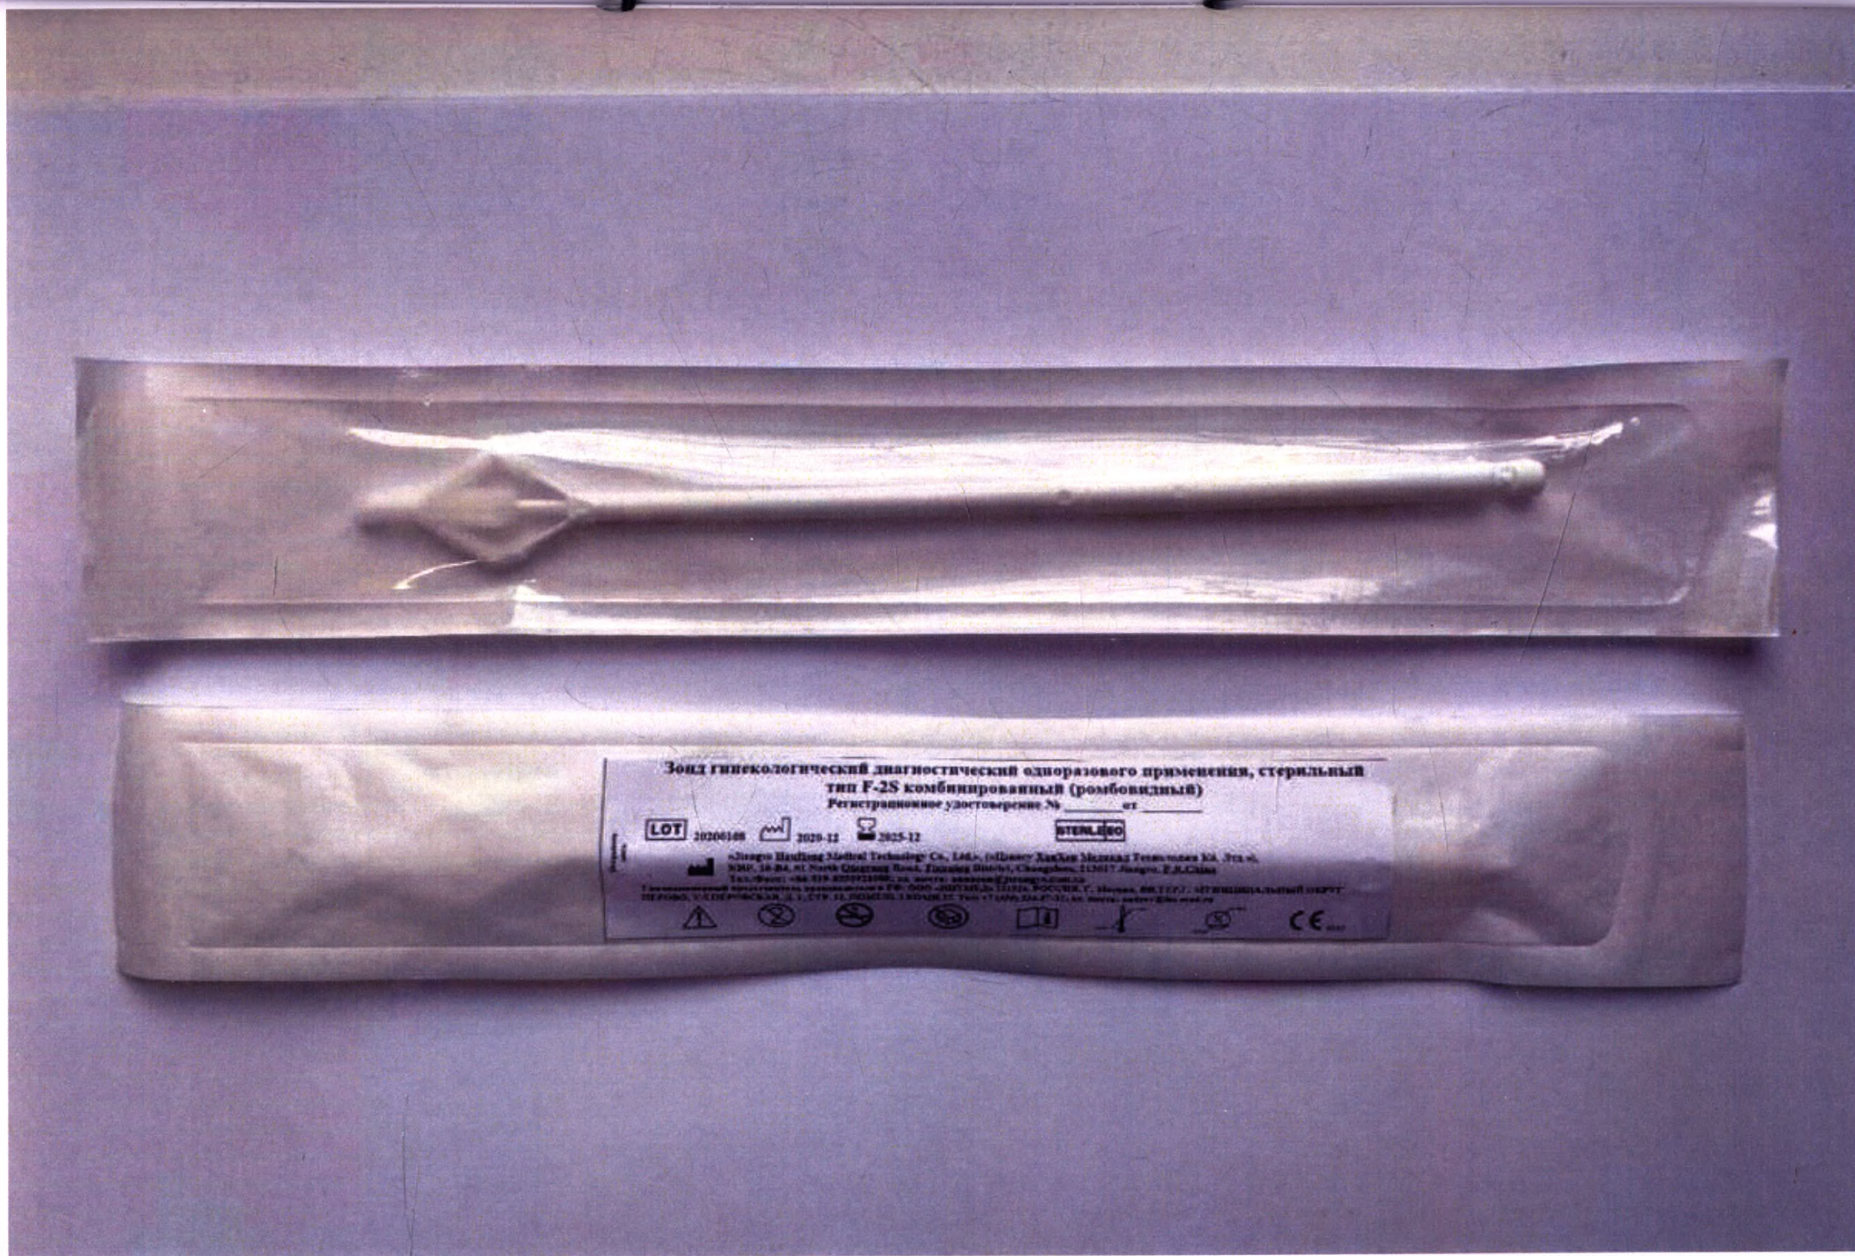


Фото 17 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-2SL комбинированный (ромбовидный) – индивидуальная упаковка

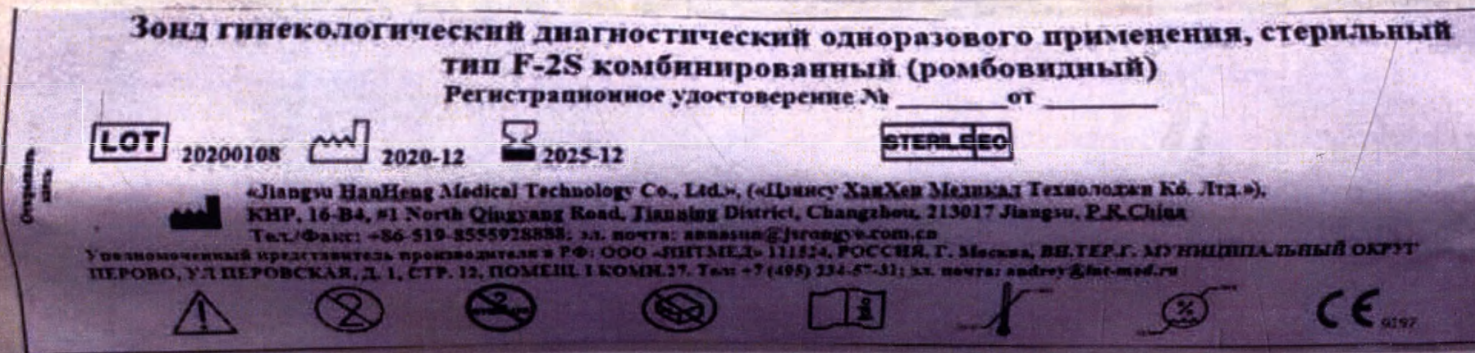



Фото 18 – Маркировка индивидуальной упаковки

Зонд гинекологический
диагностический одноразового
применения, стерильный тип F-2S
комбинированный (ромбовидный)
100 шт/уп.

LOT 20200108

2020-12

2025-12



- Запрещено повторное применение.
- Запрещено применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- Запрещено применять после истечения срока годности.
- Запрещено применять при наличии повреждений.
- Перед использованием прочтите инструкцию по применению.

«Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.», («Цзянсу ХанХен Медикал Текнолоджи Ко. Лтд.»),
KHP, 16-B4, #1 North Qingyang Road,
Tianning District, Changzhou, 213017
Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-85559288

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО «ИНТМЕД»

111524, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,
УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 12,
ПОМЕЩ. 1 КОМН.27,

Тел: +7 (495) 234-57-31 E-mail:

andrey@int-med.ru

РУ № _____ от _____




Фото 19 – Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный Тип F-2S комбинированный (ромбовидный) - групповая упаковка

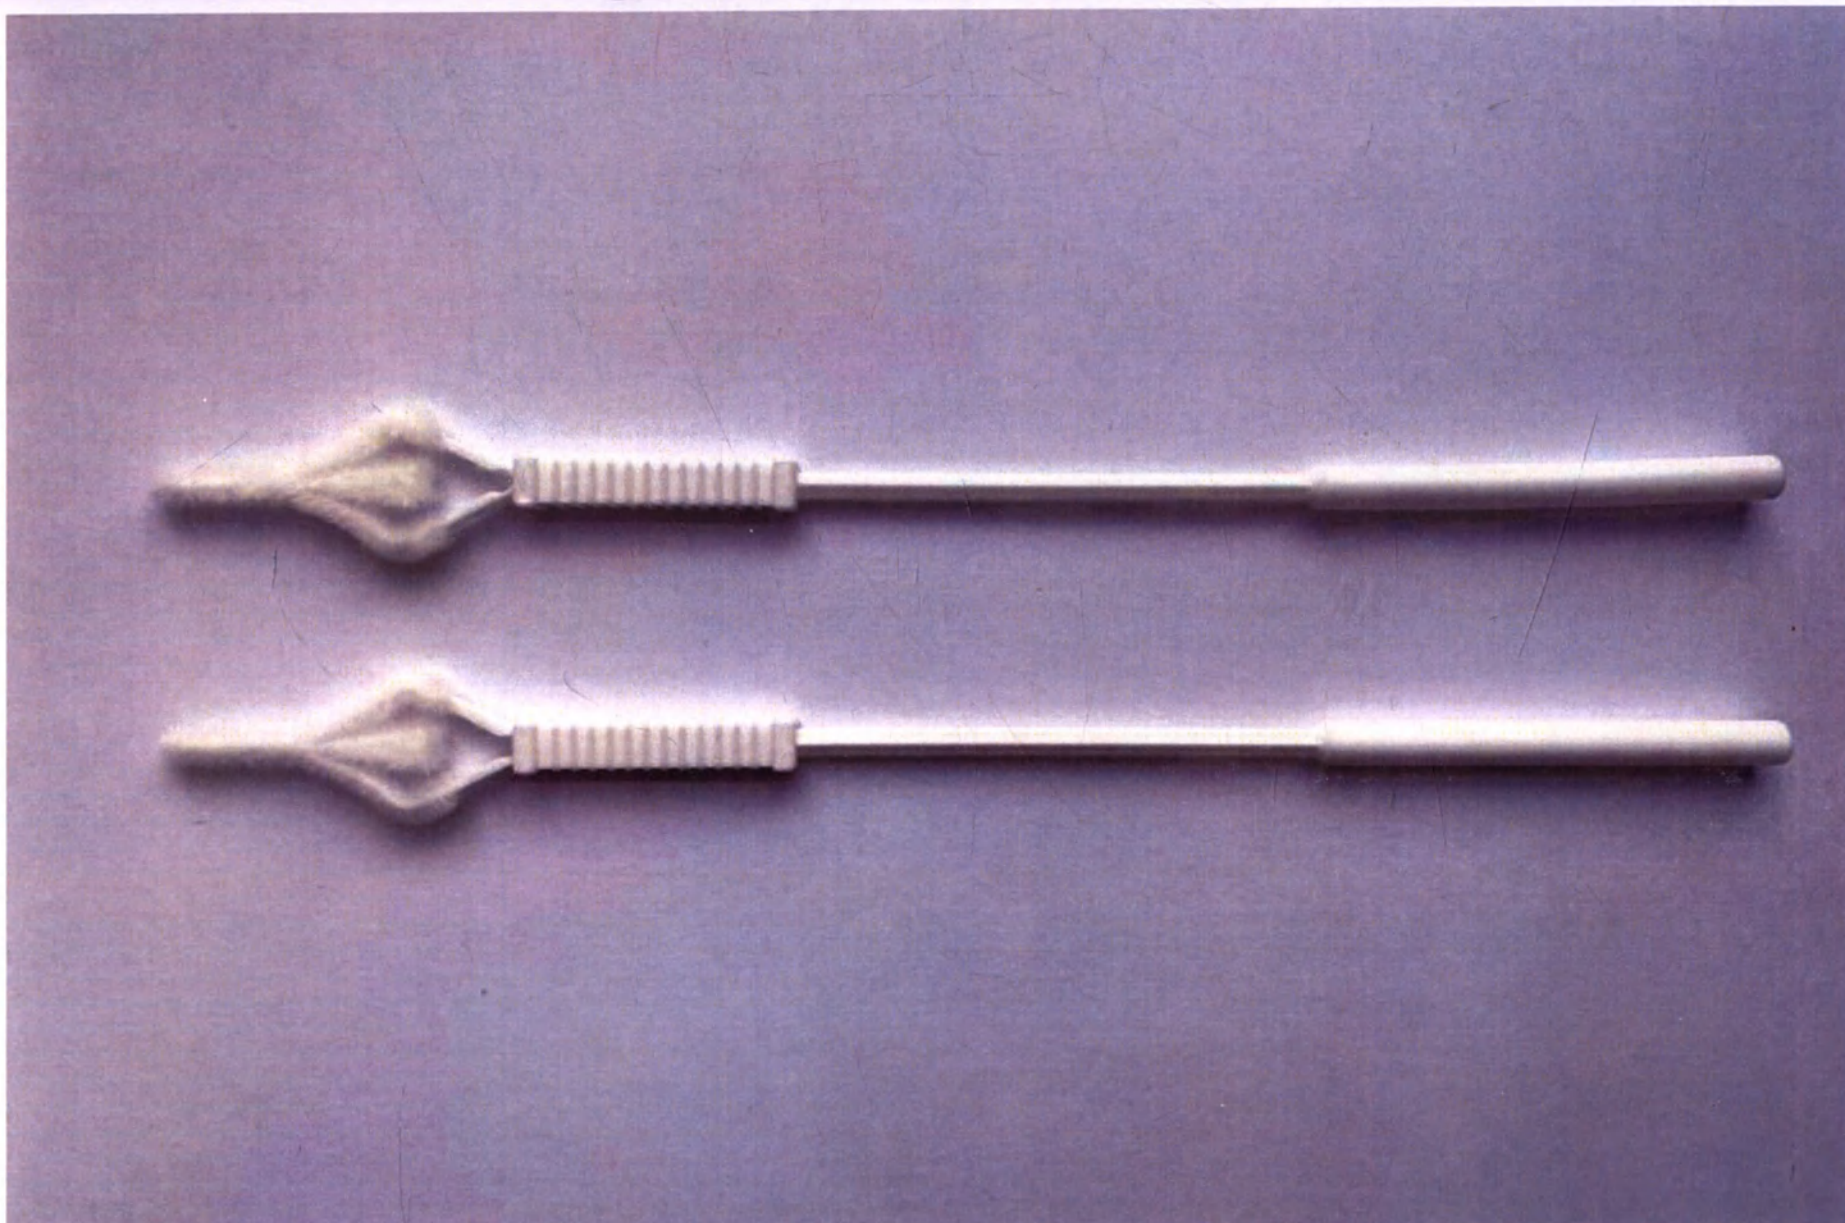


Фото 20 – Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный Тип F-2SL комбинированный (ромбовидный) - вид изделия

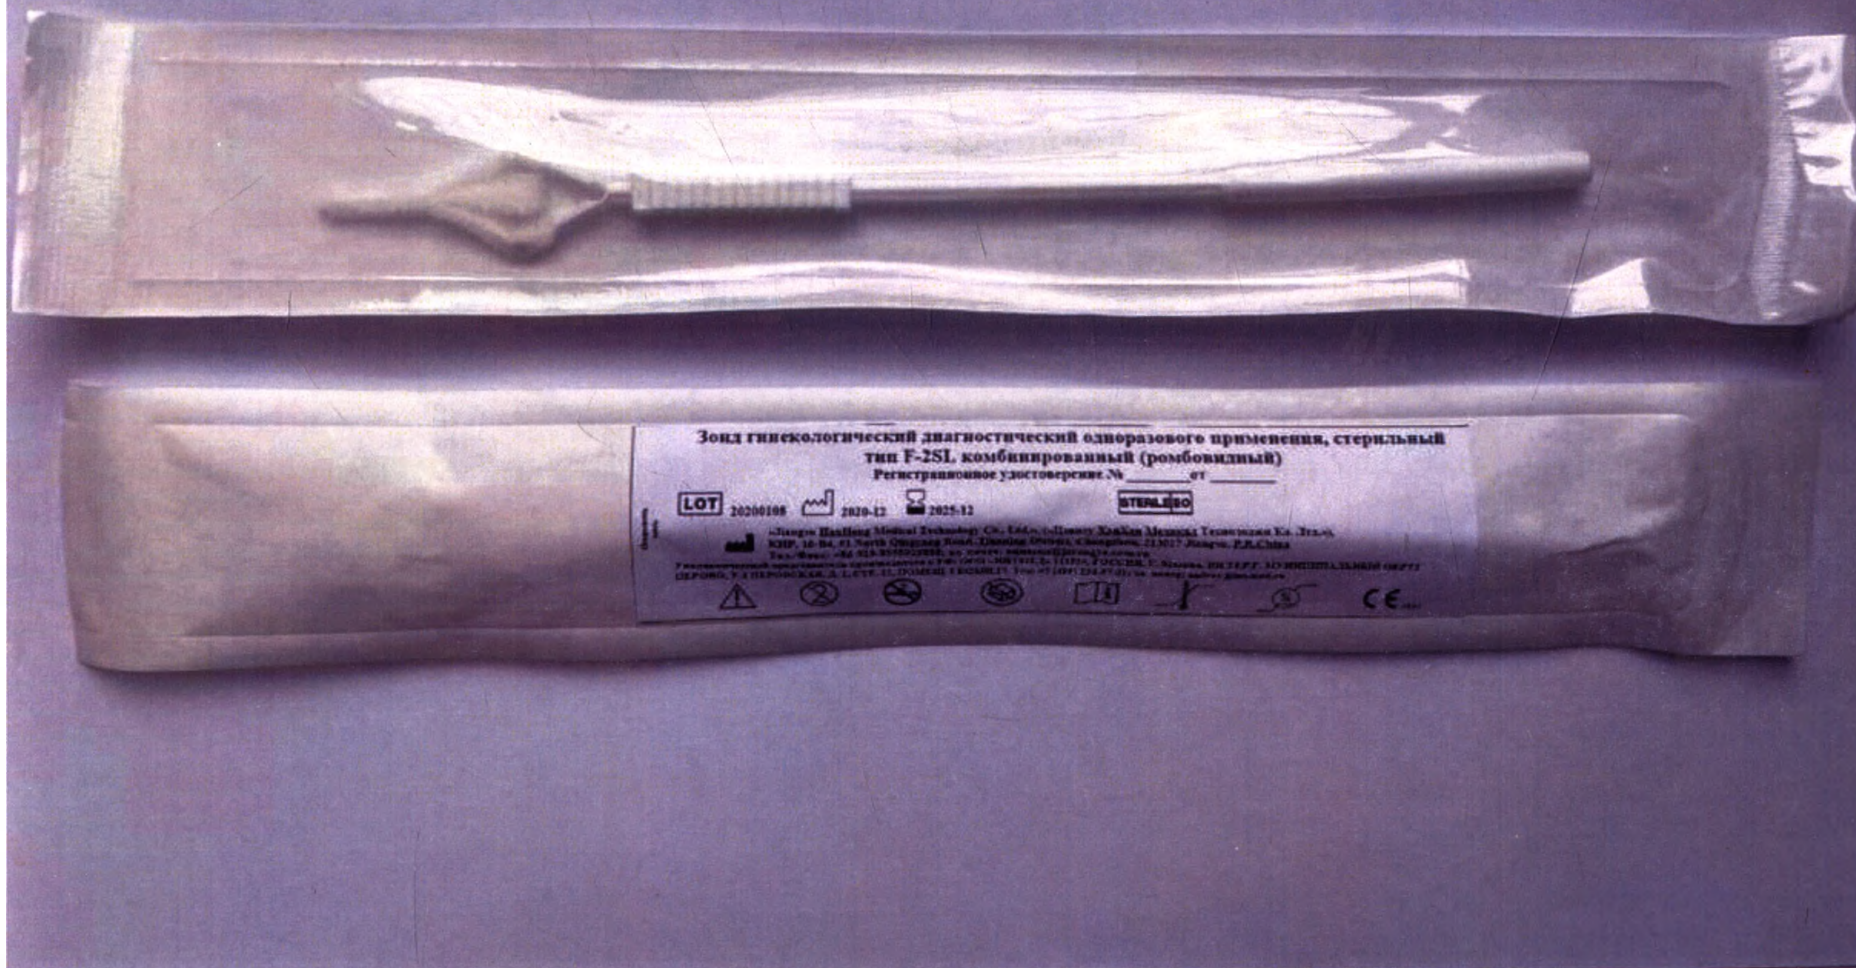


Фото 21 – Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный Тип F-2SL комбинированный (ромбовидный) – индивидуальная упаковка

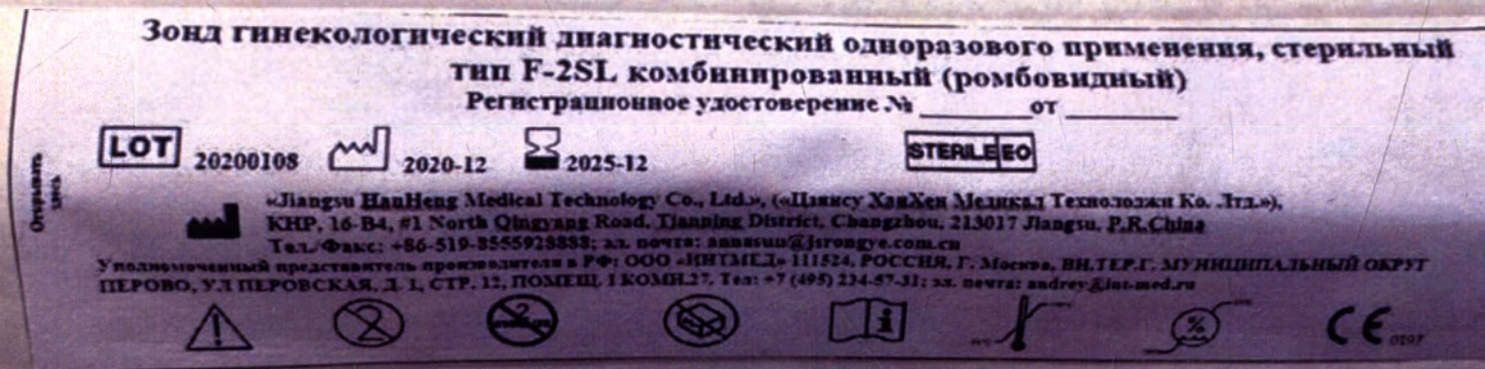



Фото 22 – Маркировка индивидуальной упаковки

Зонд гинекологический
диагностический одноразового
применения, стерильный тип F-2SL
комбинированный (ромбовидный)
100 шт/уп.

LOT 20200108

2020-12

2025-12



- Запрещено повторное применение.
- Запрещено применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- Запрещено применять после истечения срока годности.
- Запрещено применять при наличии повреждений.
- Перед использованием прочтите инструкцию по применению.

«Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.» («Цзянсу ХанХен Медикал Текнолоджи Ко. Лтд.»),
KHP, 16-B4, #1 North Qingyang Road,
Tianning District, Changzhou, 213017
Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-85559288

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО «ИНТМЕД»

111524, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО,
УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 12,
ПОМЕЩ. I КОМН.27,

Тел: +7 (495) 234-57-31 E-mail:

andrev@int-med.ru

РУ № _____ от _____



Фото 23 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный Тип F-2SL комбинированный (ромбовидный) – групповая упаковка

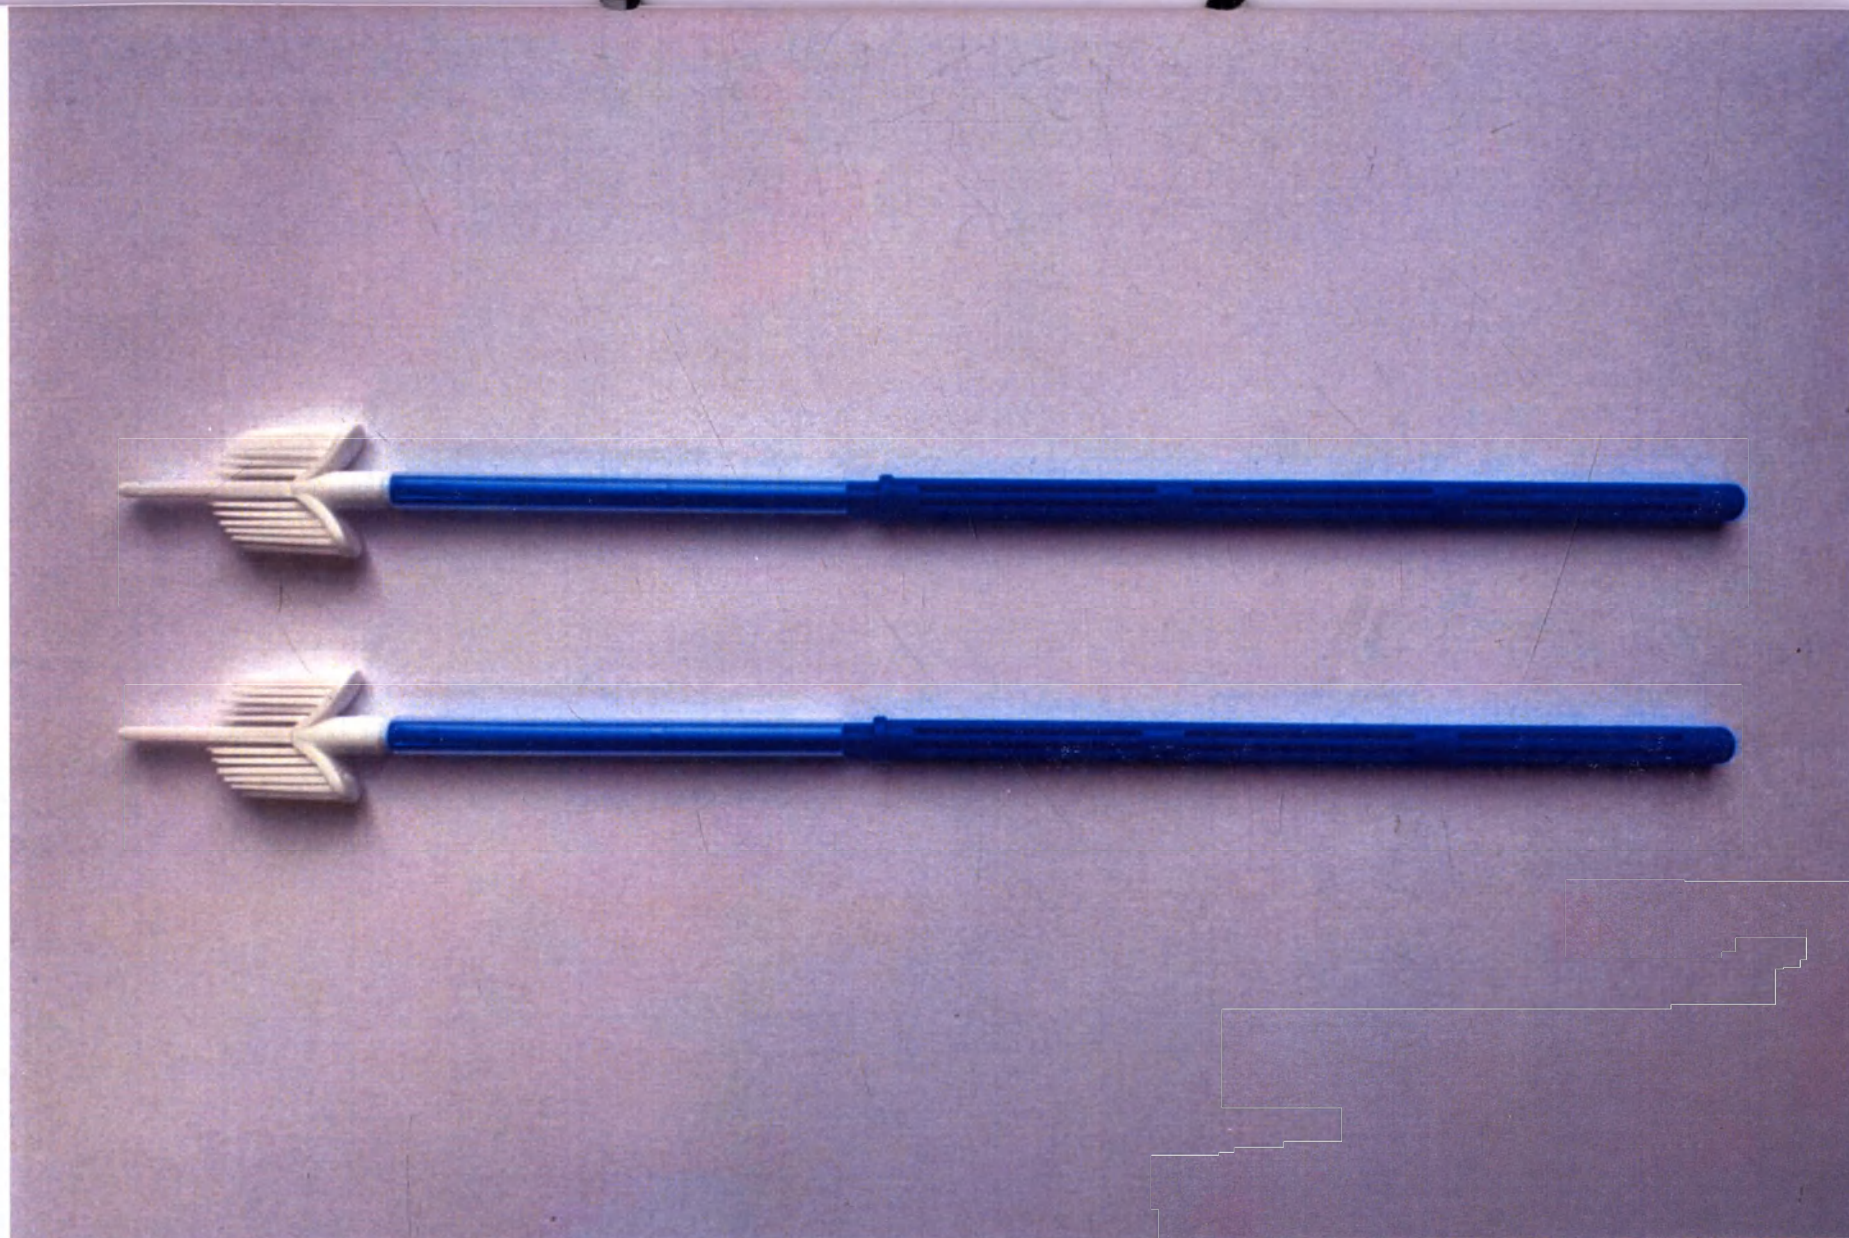


Фото 24 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-3 (Цервикс Браш) с удлиненным ершиком - вид изделия

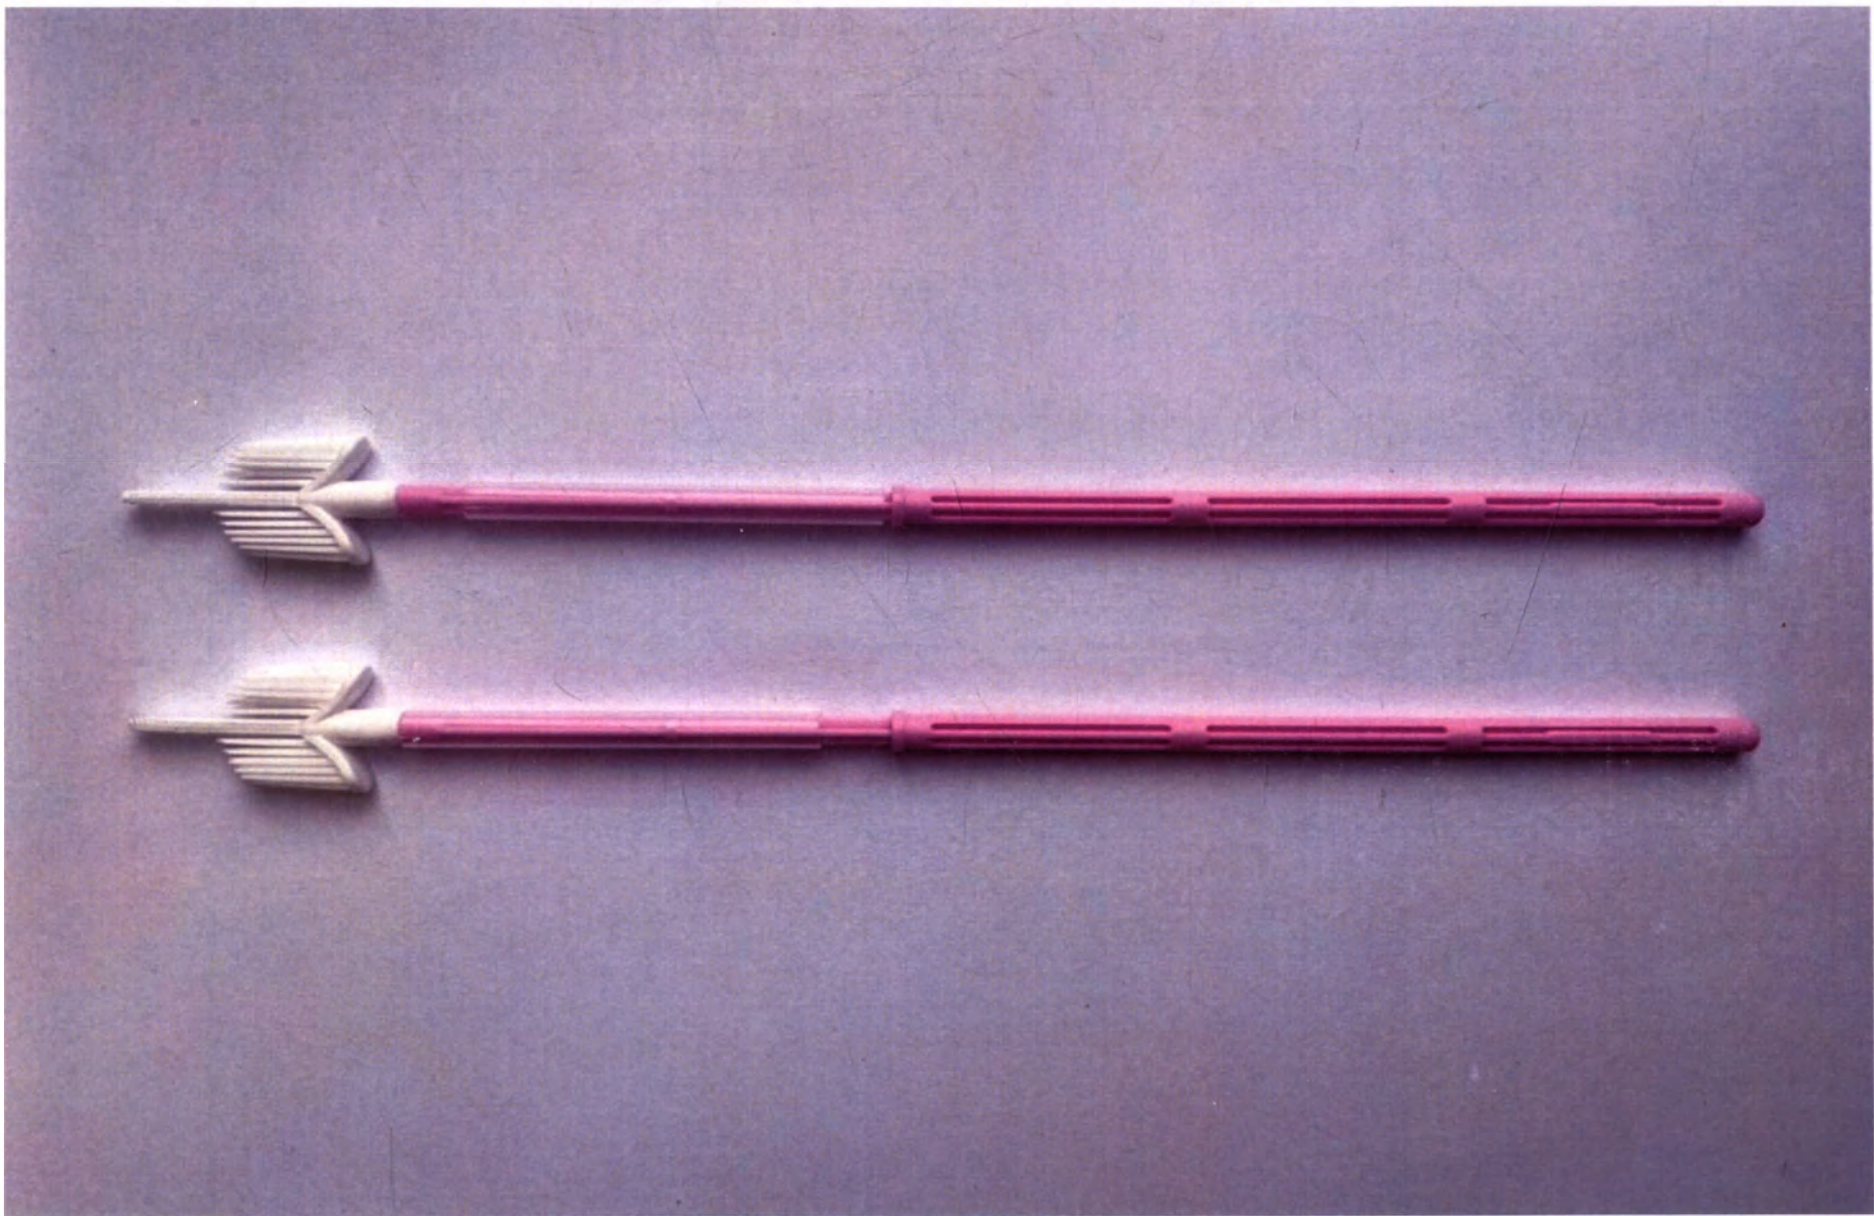


Фото 25 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-3 (Цервикс Браш) с удлиненным ершиком - вид изделия



Фото 26 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-3 (Цервикс Браш) с удлиненным ершиком – индивидуальная упаковка

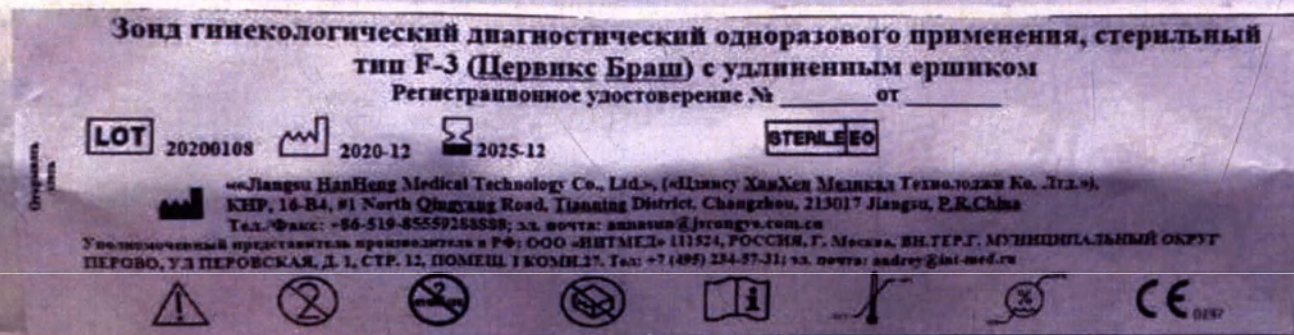


Фото 27 - Маркировка индивидуальной упаковки

Зонд гинекологический диагностический
одноразового применения, стерильный
тип F-3 (Цервикс Браш) с удлиненным
ершиком
100 шт/уп.

LOT 20200108

2020-12

2025-12



- Запрещено повторное применение.
- Запрещено применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- Запрещено применять после истечения срока годности.
- Запрещено применять при наличии повреждений.
- Перед использованием прочтите инструкцию по применению.

«Jiangsu HanHeng Medical Technology Co.,
Ltd.», («Цзянсу ХанХен Медикал Технолоджи Ко.
Лта.»),
KHP, 16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning
District, Changzhou, 213017 Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-85559288.

Уполномоченный представитель производителя в
РФ:

ООО «ИНТМЕД»
111524, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ.
ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. 1
КОМН.27,
Тел: +7 (495) 234-57-31 E-mail: andrey@int-med.ru
int-med.ru

РУ № _____ от _____



Фото 28 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-3 (Цервикс Браш) с удлиненным ершиком – групповая упаковка

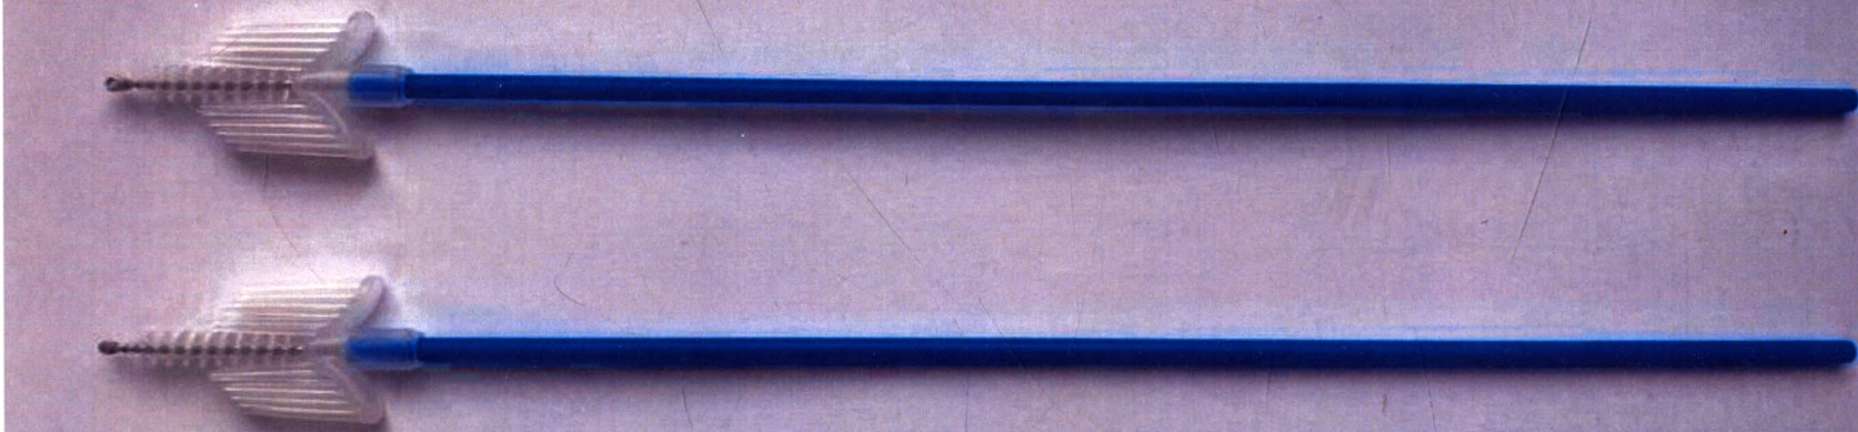


Фото 29 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-4 (Цервикс Браш) с цитощеткой, снабженной полимерным шариком – вид изделия

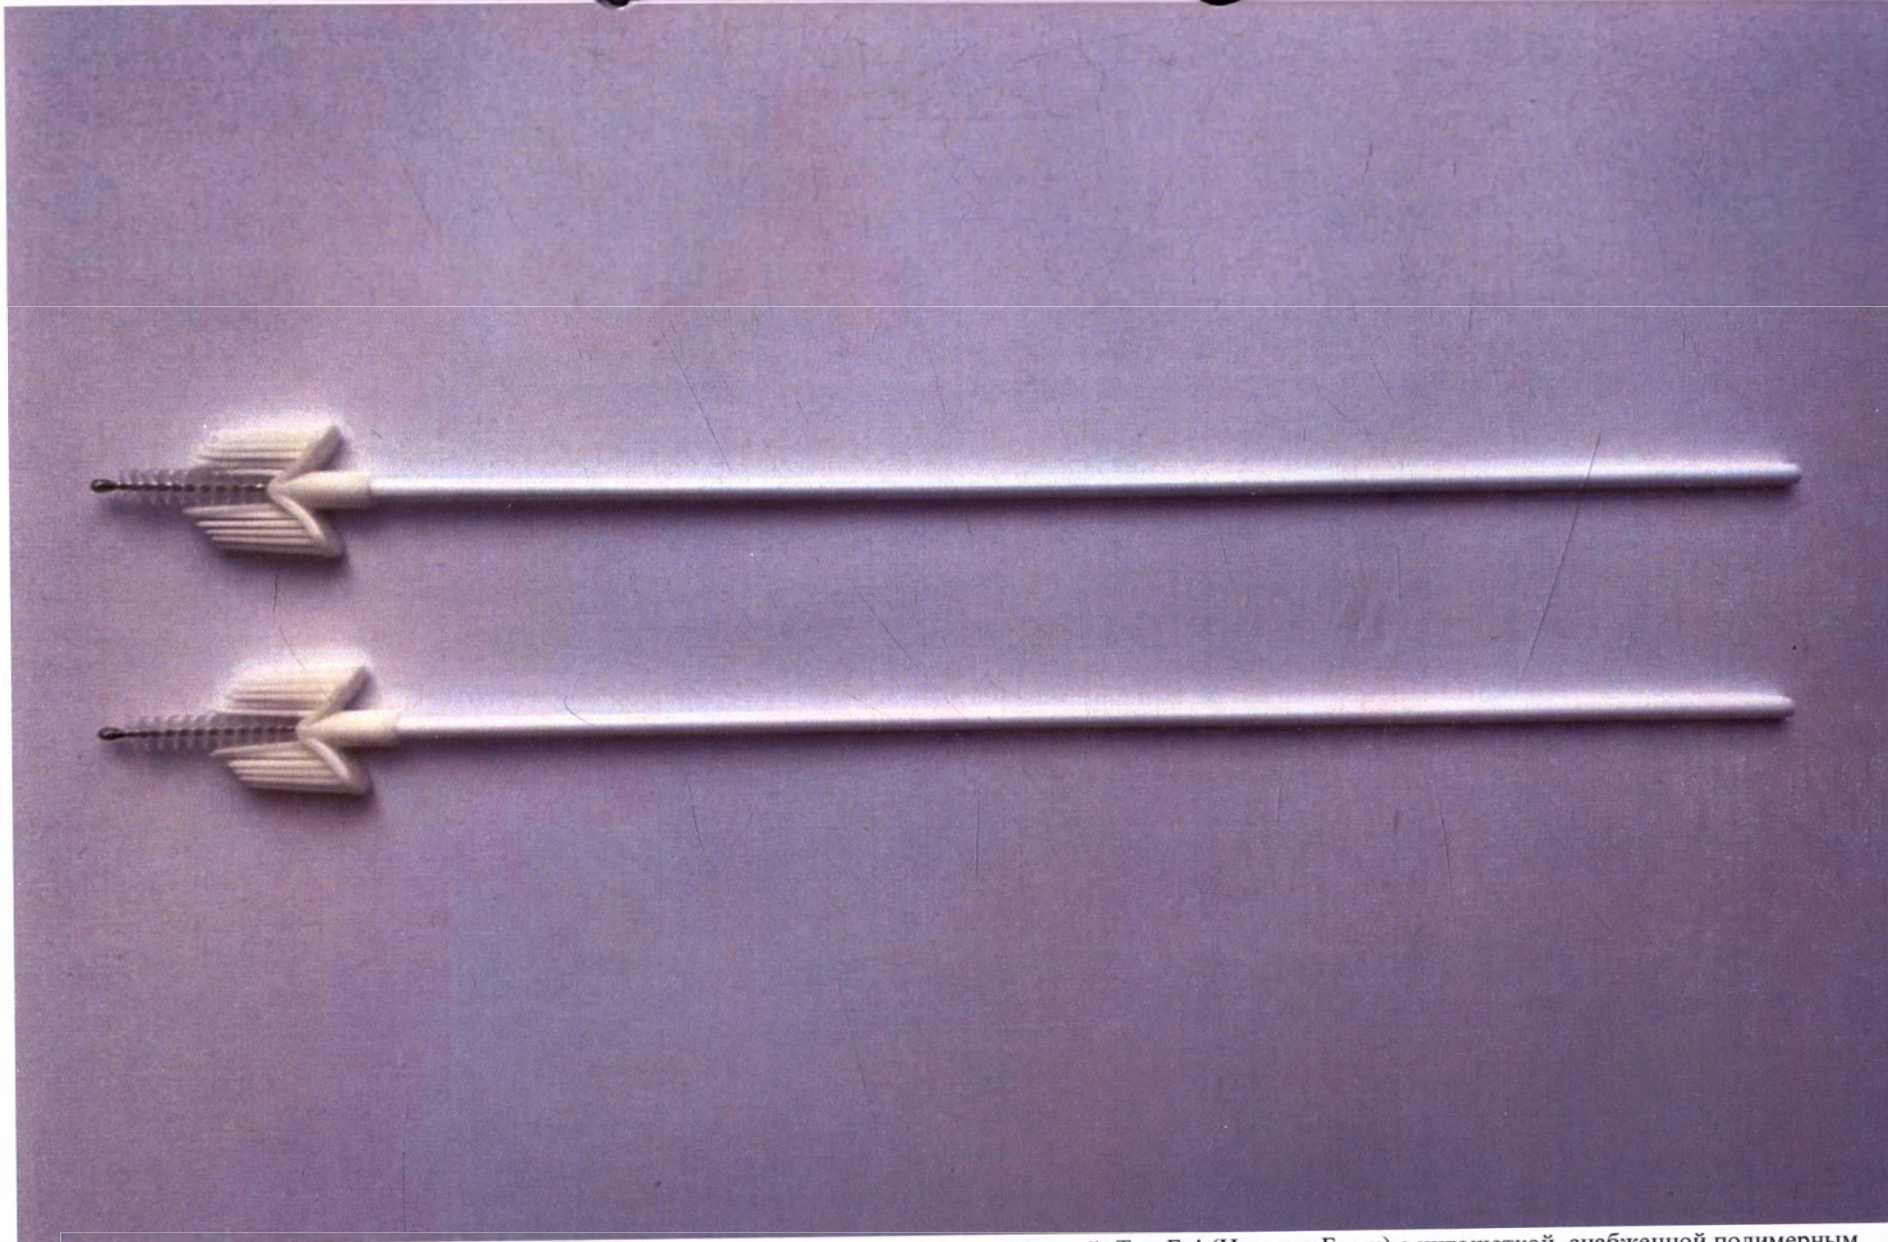


Фото 30 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-4 (Цервикс Браш) с цитощеткой, снабженной полимерным шариком – вид изделия

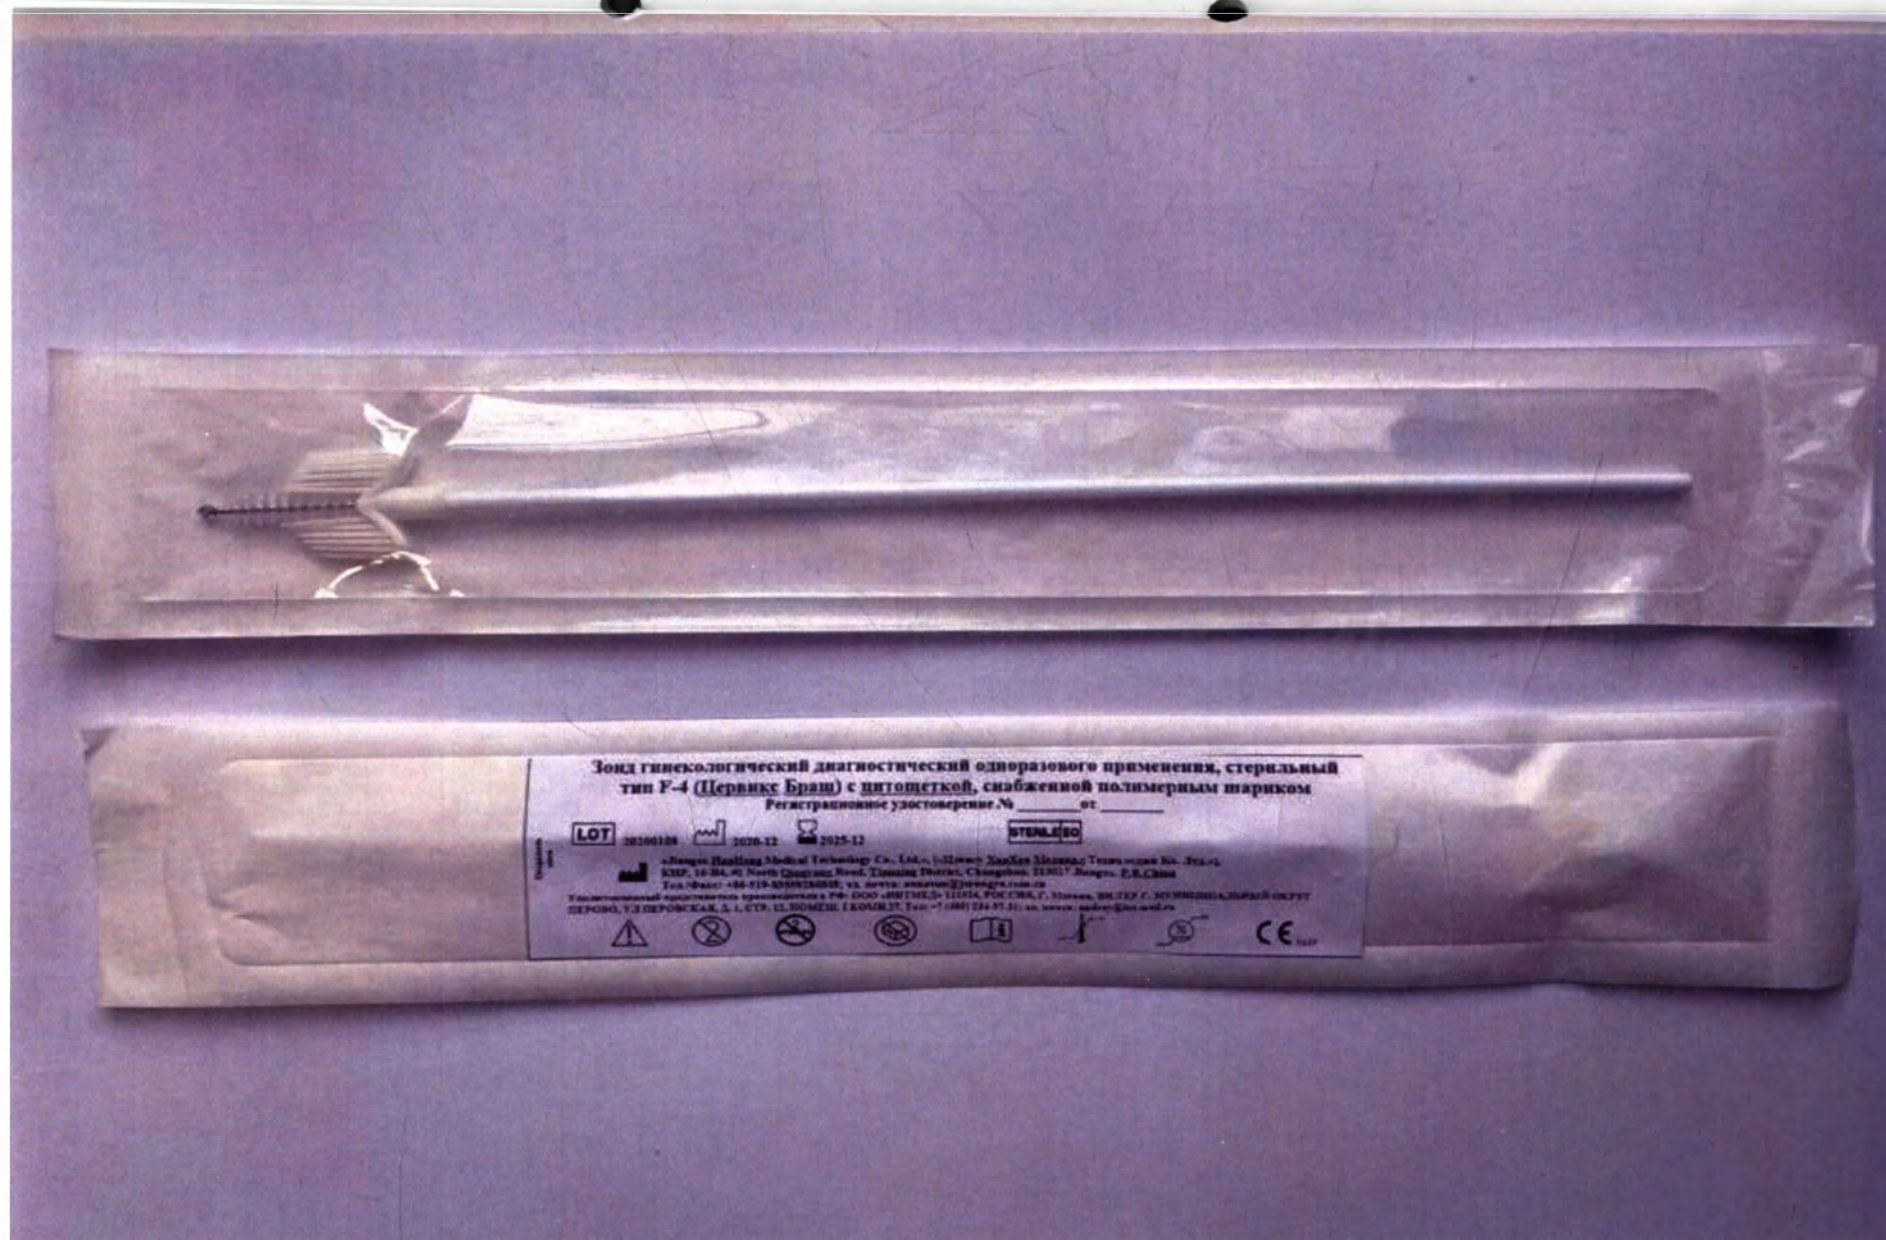


Фото 31 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-4 (Цервикс Браш) с цитощеткой, снабженной полимерным шариком – индивидуальная упаковка


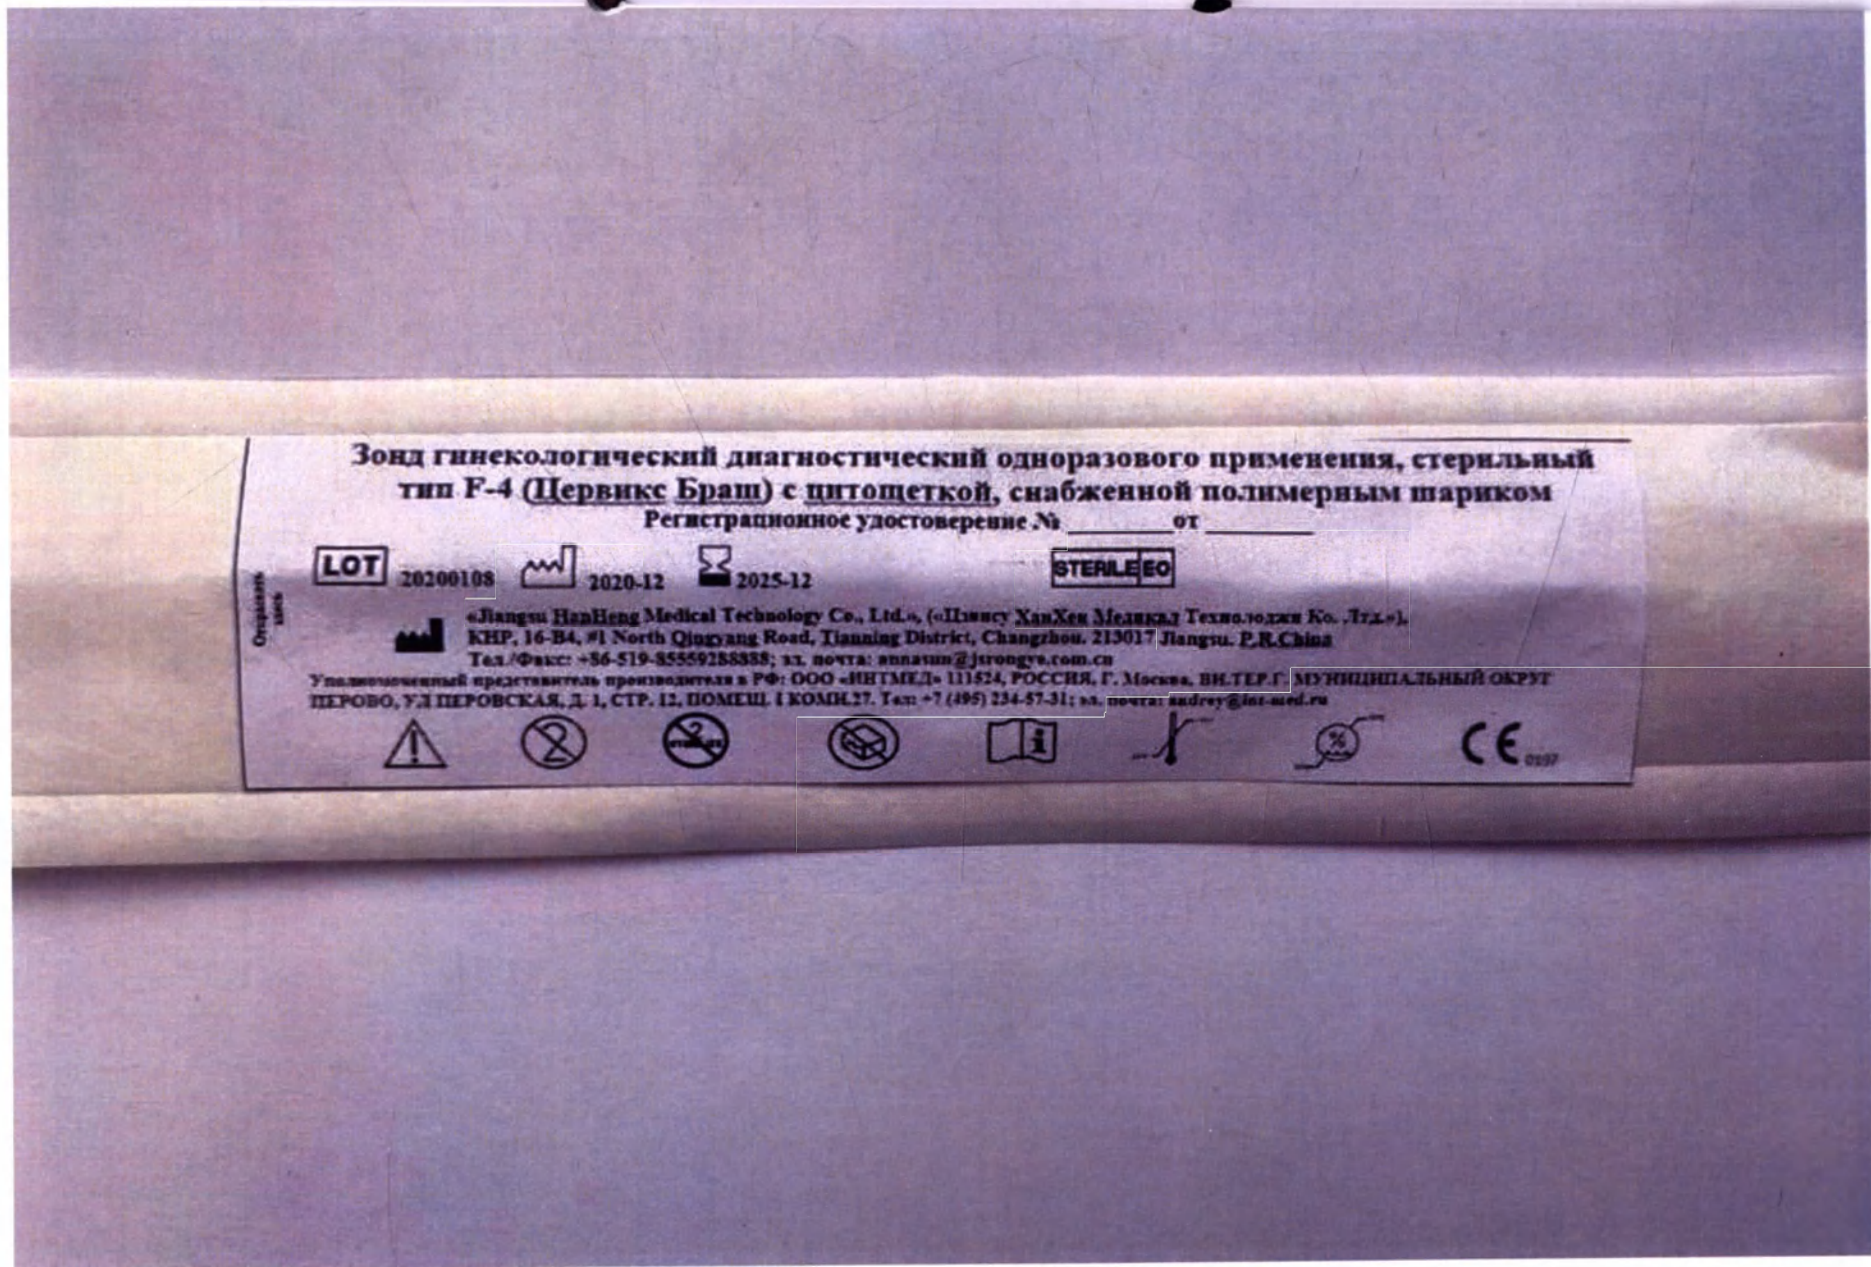


Фото 32 – Маркировка индивидуальной упаковки

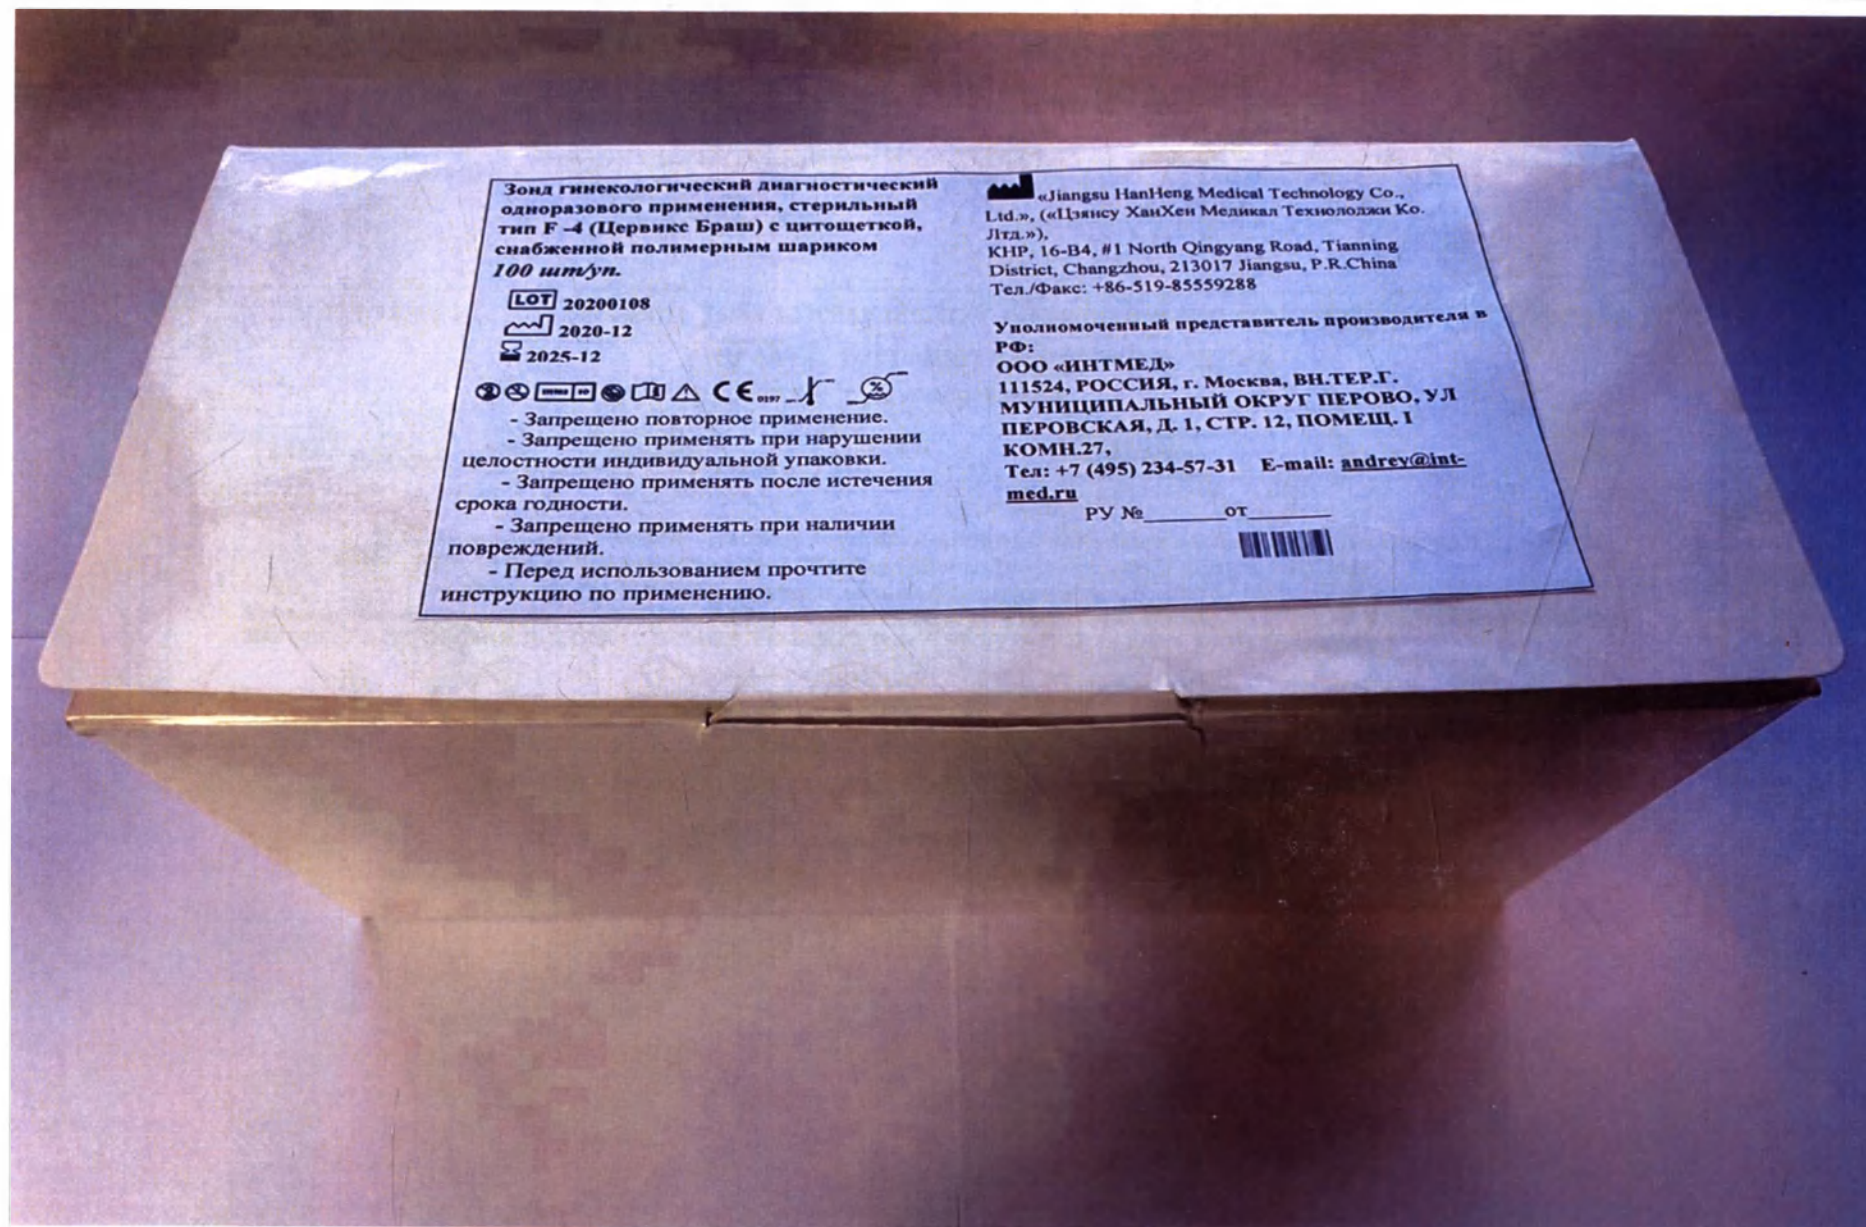

Зонд гинекологический диагностический
одноразового применения, стерильный
тип F-4 (Цервикс Браш) с цитощеткой,
снабженной полимерным шариком
100 шт/уп.

LOT 20200108

2020-12

2025-12



- Запрещено повторное применение.
- Запрещено применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- Запрещено применять после истечения срока годности.
- Запрещено применять при наличии повреждений.
- Перед использованием прочтите инструкцию по применению.

«Jiangsu HanHeng Medical Technology Co.,
Ltd.», («Цзянсу ХанХен Медикал Технолоджи Ко.
Лтд.»),
KHP, 16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning
District, Changzhou, 213017 Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-85559288

Уполномоченный представитель производителя в
РФ:

ООО «ИНТМЕД»
111524, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. 1
КОМН.27,
Тел: +7 (495) 234-57-31 E-mail: [andrey@int-](mailto:andrey@int-med.ru)
[med.ru](mailto:andrey@int-med.ru)

РУ № _____ от _____




Фото 33 - Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный: Тип F-4 (Цервикс Браш) с цитощеткой, снабженной полимерным шариком – групповая упаковка

**Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный
тип D-2, цитощетка цервикальная**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

LOT 20200108

2020-12

2025-12

STERILE

Открыть
здесь

«Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.», («Цзянсу ХанХен Медикал Технолоджи Ко. Лтд.»),
KHP, 16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District, Changzhou, 213017 Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-855592888; эл. почта: annasun@jsrongye.com.cn
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «ИНТМЕД» 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. 1 КОМП. 27. Тел: +7 (495) 234-57-31; эл. почта: andrey@int-med.ru










Фото 34 - Макет русскоязычной этикетки индивидуальной упаковки

Зонд гинекологический диагностический одноразового применения, стерильный тип D – 2, цитощетка цервикальная
100 мм. ум.

LOT 20200108

2020-12

2025-12



- Запрещено повторное применение.
- Запрещено применять при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- Запрещено применять после истечения срока годности.
- Запрещено применять при наличии повреждений.
- Перед использованием прочтите инструкцию по применению.

«Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.», («Цзянсу ХанХен Медикал Технолоджи Ко. Лтд.»),
КНР, 16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District, Changzhou,
213017 Jiangsu, P.R.China
Тел./Факс: +86-519-85559288

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «ИНТМЕД»

111524, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 12, ПОМЕЩ. I КОМН.27.

Тел: +7 (495) 234-57-31 E-mail: andrey@int-med.ru

РУ № _____ от _____



Фото 35 - Макет русскоязычной этикетки групповой упаковки

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 38 листа(ов).

Должность, ФИО _____

Генеральный директор

Ирина Владимировна

(подпись)

Место печати

«20» декабря 2022 года

