


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подразделения молекулярной диагностики
ООО «Эбботт Лэбораториз» в России и странах СНГ


«28» декабря 2022 года
 Коничева Е.Р.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**


Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit» для дифференциального выявления РНК вируса гриппа А (flu A), вируса гриппа В (flu B), респираторно-синцитиального вируса (RSV) и SARS-CoV-2 методом мультиплексной ОТ-ПЦР в мазке из носоглотки человека на анализаторе Alinity m, производства Abbott Molecular Inc. (Эбботт Молекуляр Инк.), США.



Фотографическое изображение 1. Внешний вид потребительской упаковки медицинского изделия Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit» (вид спереди)

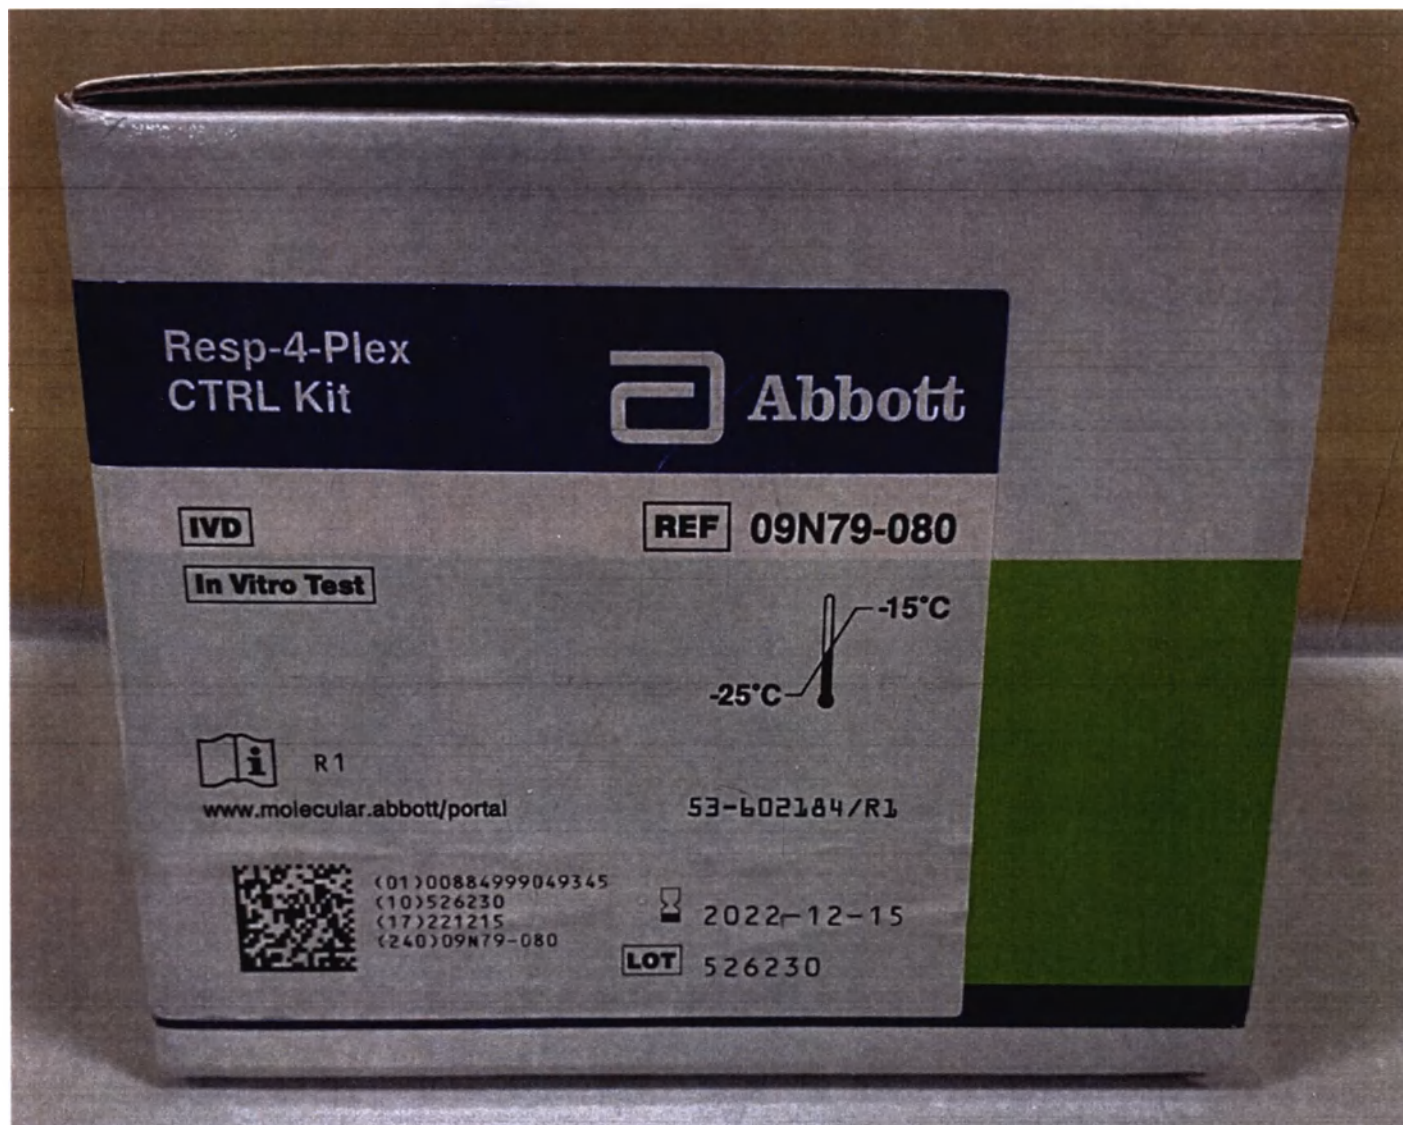

Фотографическое изображение 2. Внешний вид потребительской упаковки медицинского изделия Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit» (вид сбоку)

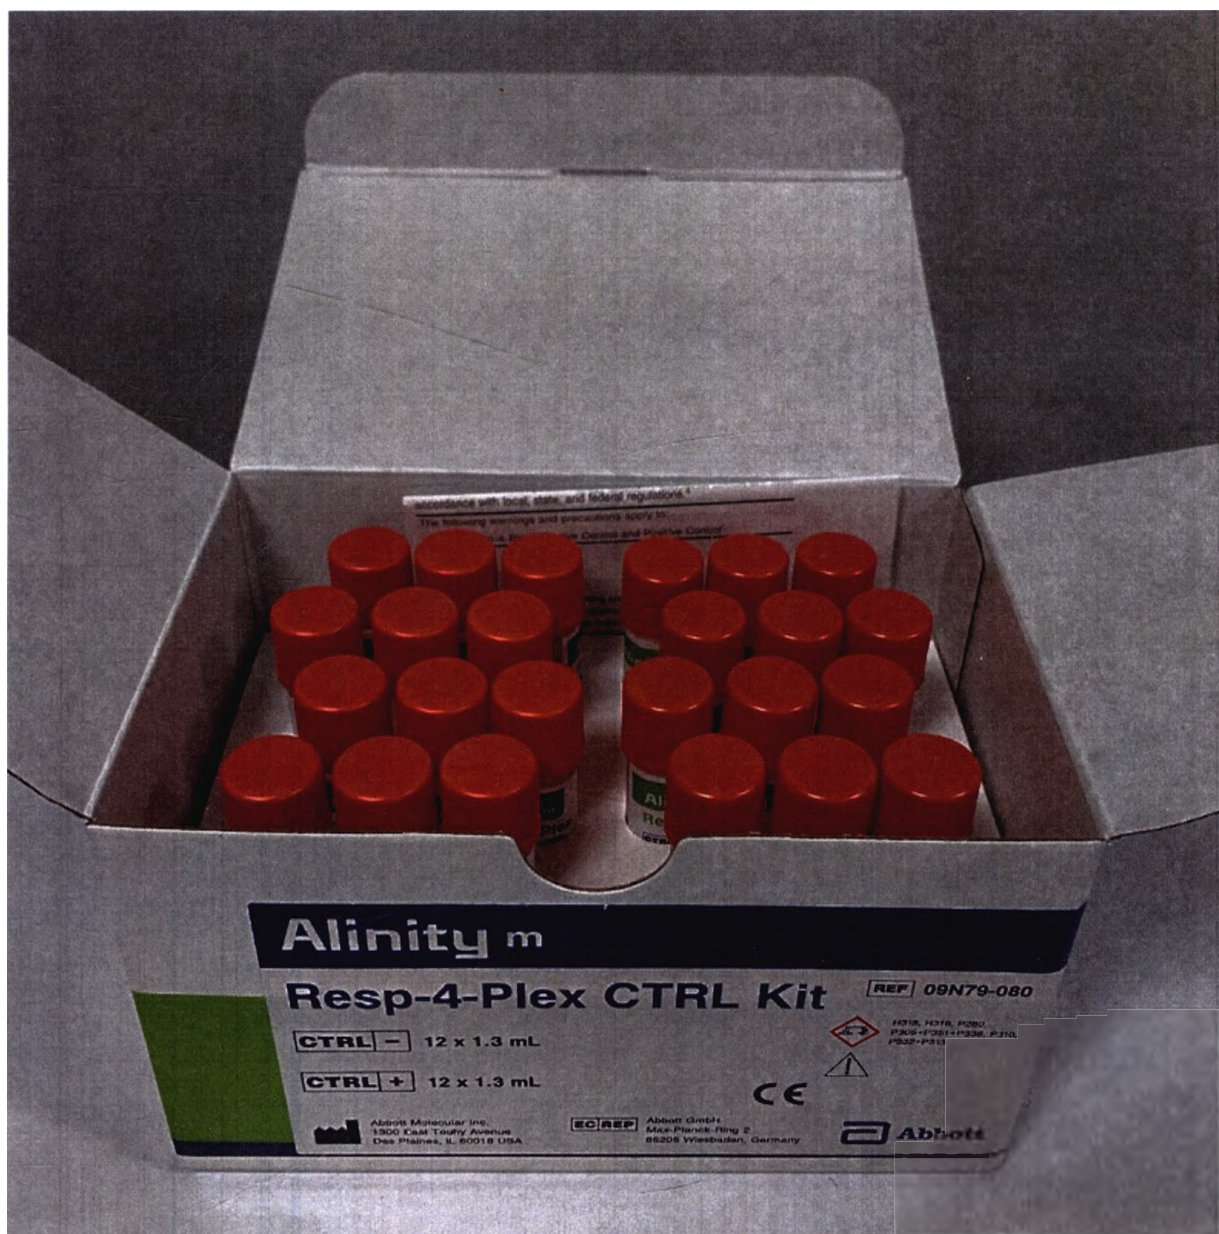

Фотографическое изображение 3. Содержимое потребительской упаковки медицинского изделия Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit»



Фотографическое изображение 4. Внешний вид компонента медицинского изделия Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit»: Отрицательный контроль Alinity m Resp-4-Plex - 12 флаконов по 1,3 мл;



Фотографическое изображение 5. Внешний вид компонента медицинского изделия Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit»: флаконы с отрицательным контролем Alinity m Resp-4-Plex



Фотографическое изображение 6. Внешний вид компонента медицинского изделия Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit»:
Положительный контроль Alinity m Resp-4-Plex - 12 флаконов по 1,3 мл;



Фотографическое изображение 7. Внешний вид компонента медицинского изделия Набор контролей «Alinity m Resp-4-Plex CTRL Kit»: флаконы с Положительным контролем Alinity m Resp-4-Plex

Прошито, пронумеровано

количество листов 8

[Signature] / Коничева Е.Р. /

Подпись

ФИО