

## **Фотографические изображения**


**Мониторы основных показаний  
жизнедеятельности, в вариантах исполнения:  
NC3, NC3A, NC3B, NC5, NC5A**

Базовый блок:





Маркировка на мониторах  
NC3:

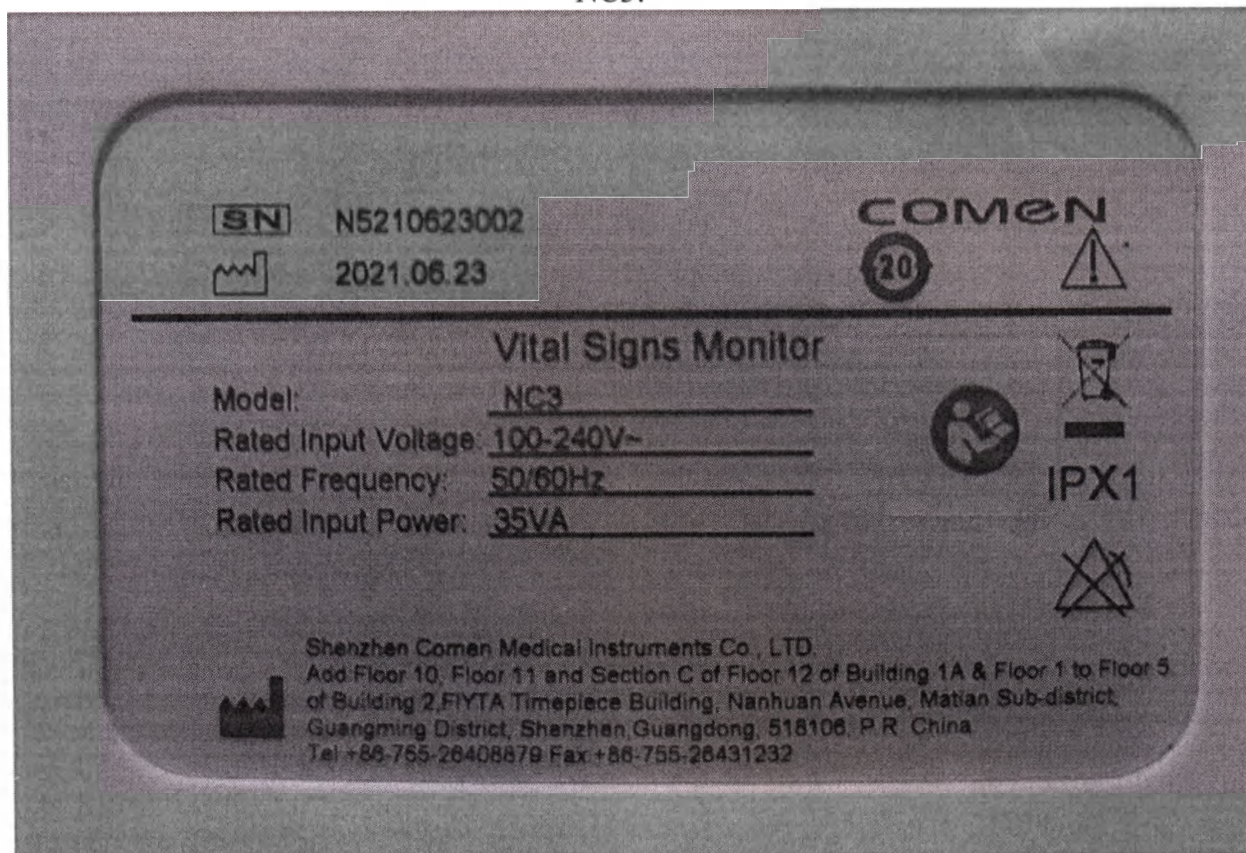

NC5:

**SN** N4210512001

 2021.05.12

COMeN

---

### Vital Signs Monitor

Model: NC5

Rated Input Voltage: 100-240V~

Rated Frequency: 50/60Hz

Rated Input Power: 0.5-0.3A



  
  
**IPX2**



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., LTD  
 Add: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China  
 Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232

**SN** N4210512001

 2021.05.12

COMeN

---

### Монитор основных показаний жизнедеятельности

Модель: NC5

Номинальное входное напряжение: 100-240В~

Номинальная частота: 50/60Гц

Номинальная входная мощность: 0.5-0.3А



  
  
**IPX1**




Shenzhen Comen Medical Instruments Co., LTD  
 Add: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China  
 Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232

УПП: ООО «Медстратегия», 195299, Г. Санкт-Петербург, муниципальный округ № 21, ул. Киришская, д.2  
 литера А, офис часть помещ. 6Н с ном. 39.49  
 Тел: 8(800) 300-82-79, +7 (812) 600-42-80

Кабель заземления:




Кабель питания:

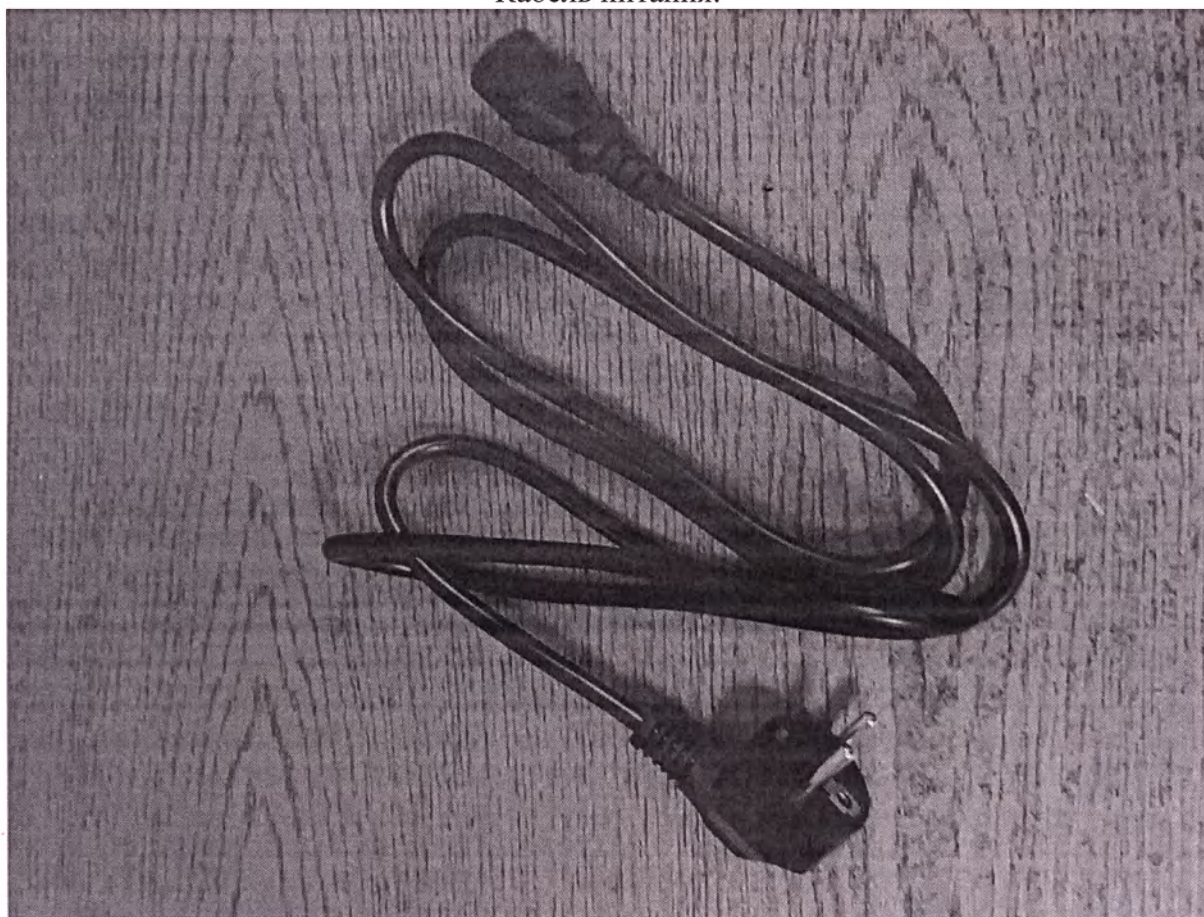

-Ушной термометр:



# Маркировка ушного термометра:

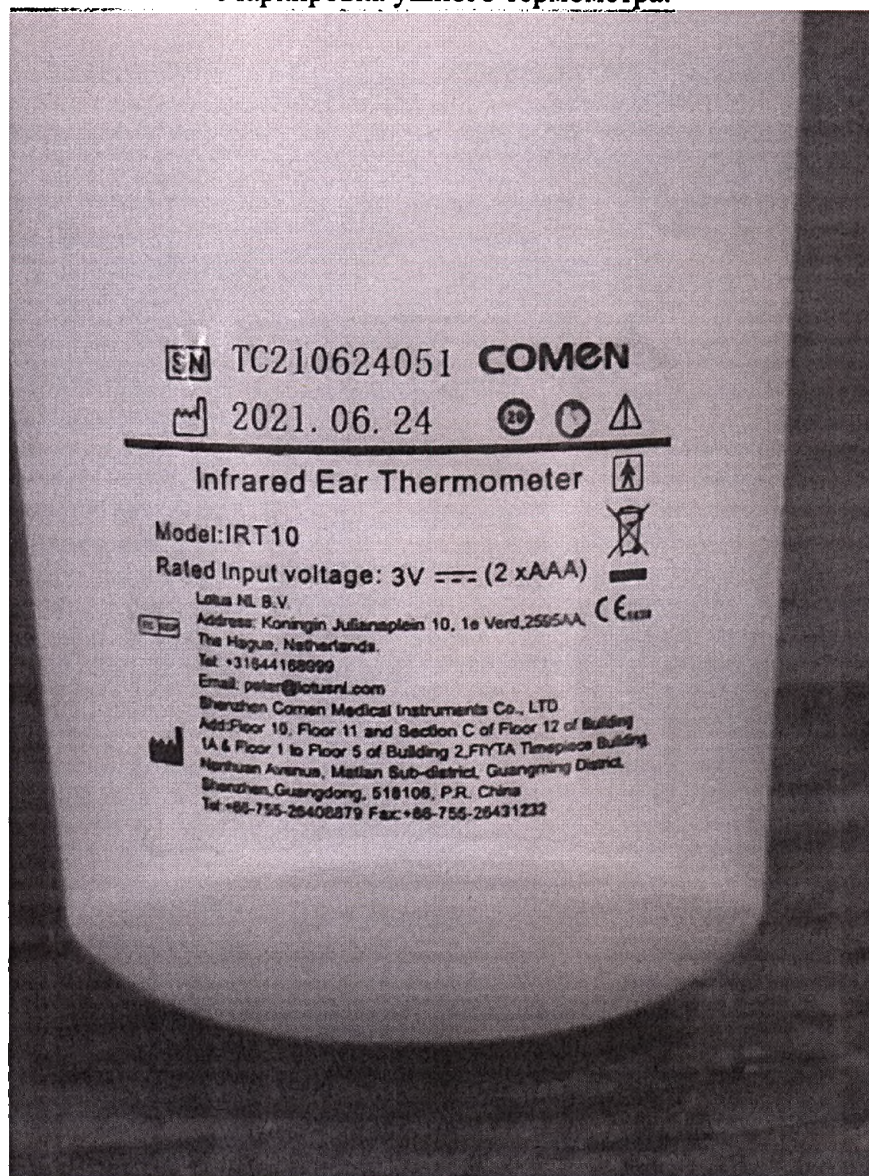

SN TC210624051 COMEN

2021.06.24



Инфракрасный ушной термометр

Модель: IRT10


Номинальное входное напряжение: 3В (2хААА)

Lotus NL B.V.  
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,  
The Hague, Netherlands.  
Tel: +31644168999  
Email: peter@lotusnl.com  
Shenzhen Comen Medical Instruments Co., LTD  
Add: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building  
1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece  
Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district,  
Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R.  
China  
Tel: +86-755-26408879 Fax: +86-755-26431232


-Крышка зонда ушного термометра:

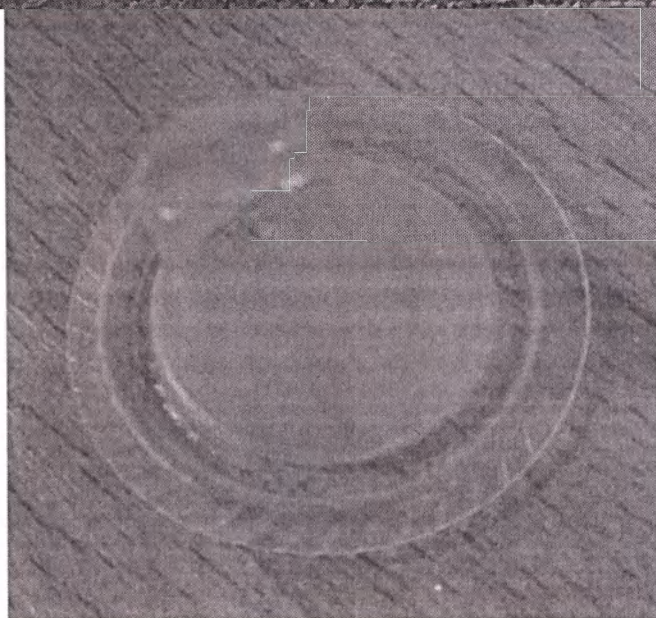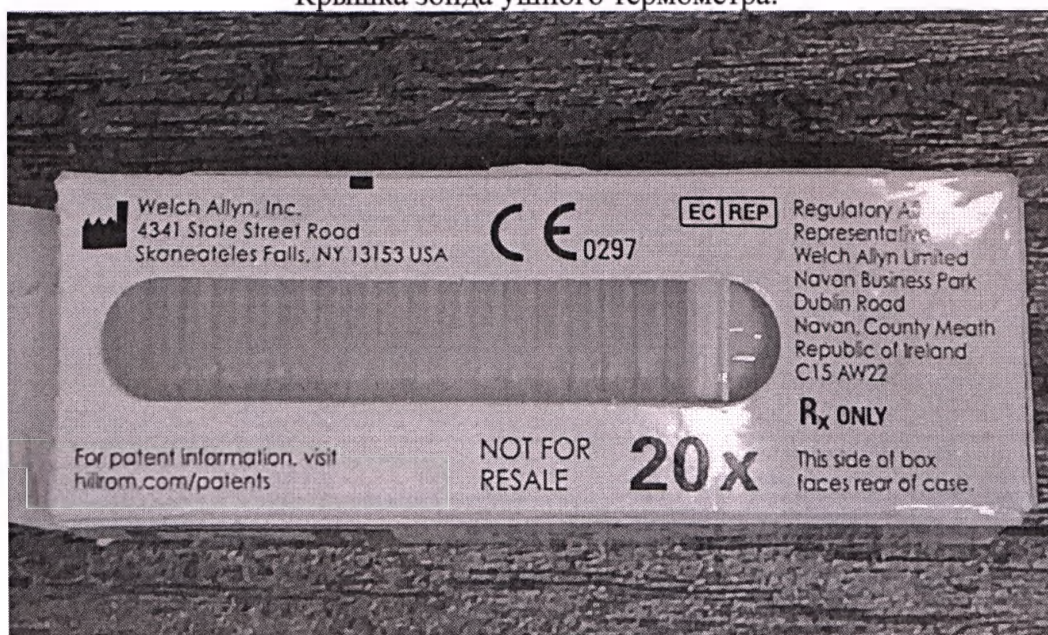

-Щелочная батарея типа AAA:

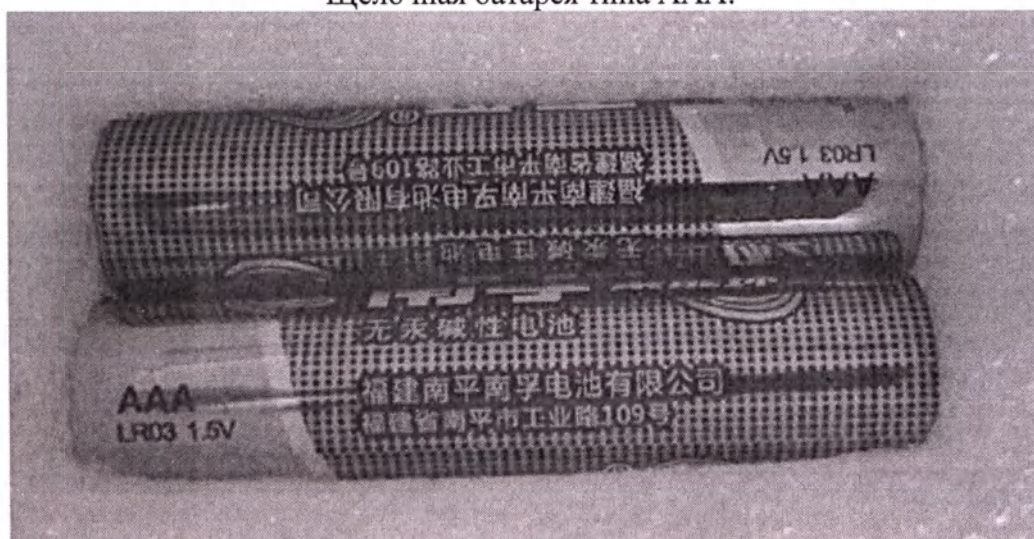

Аккумулятор вспомогательный:

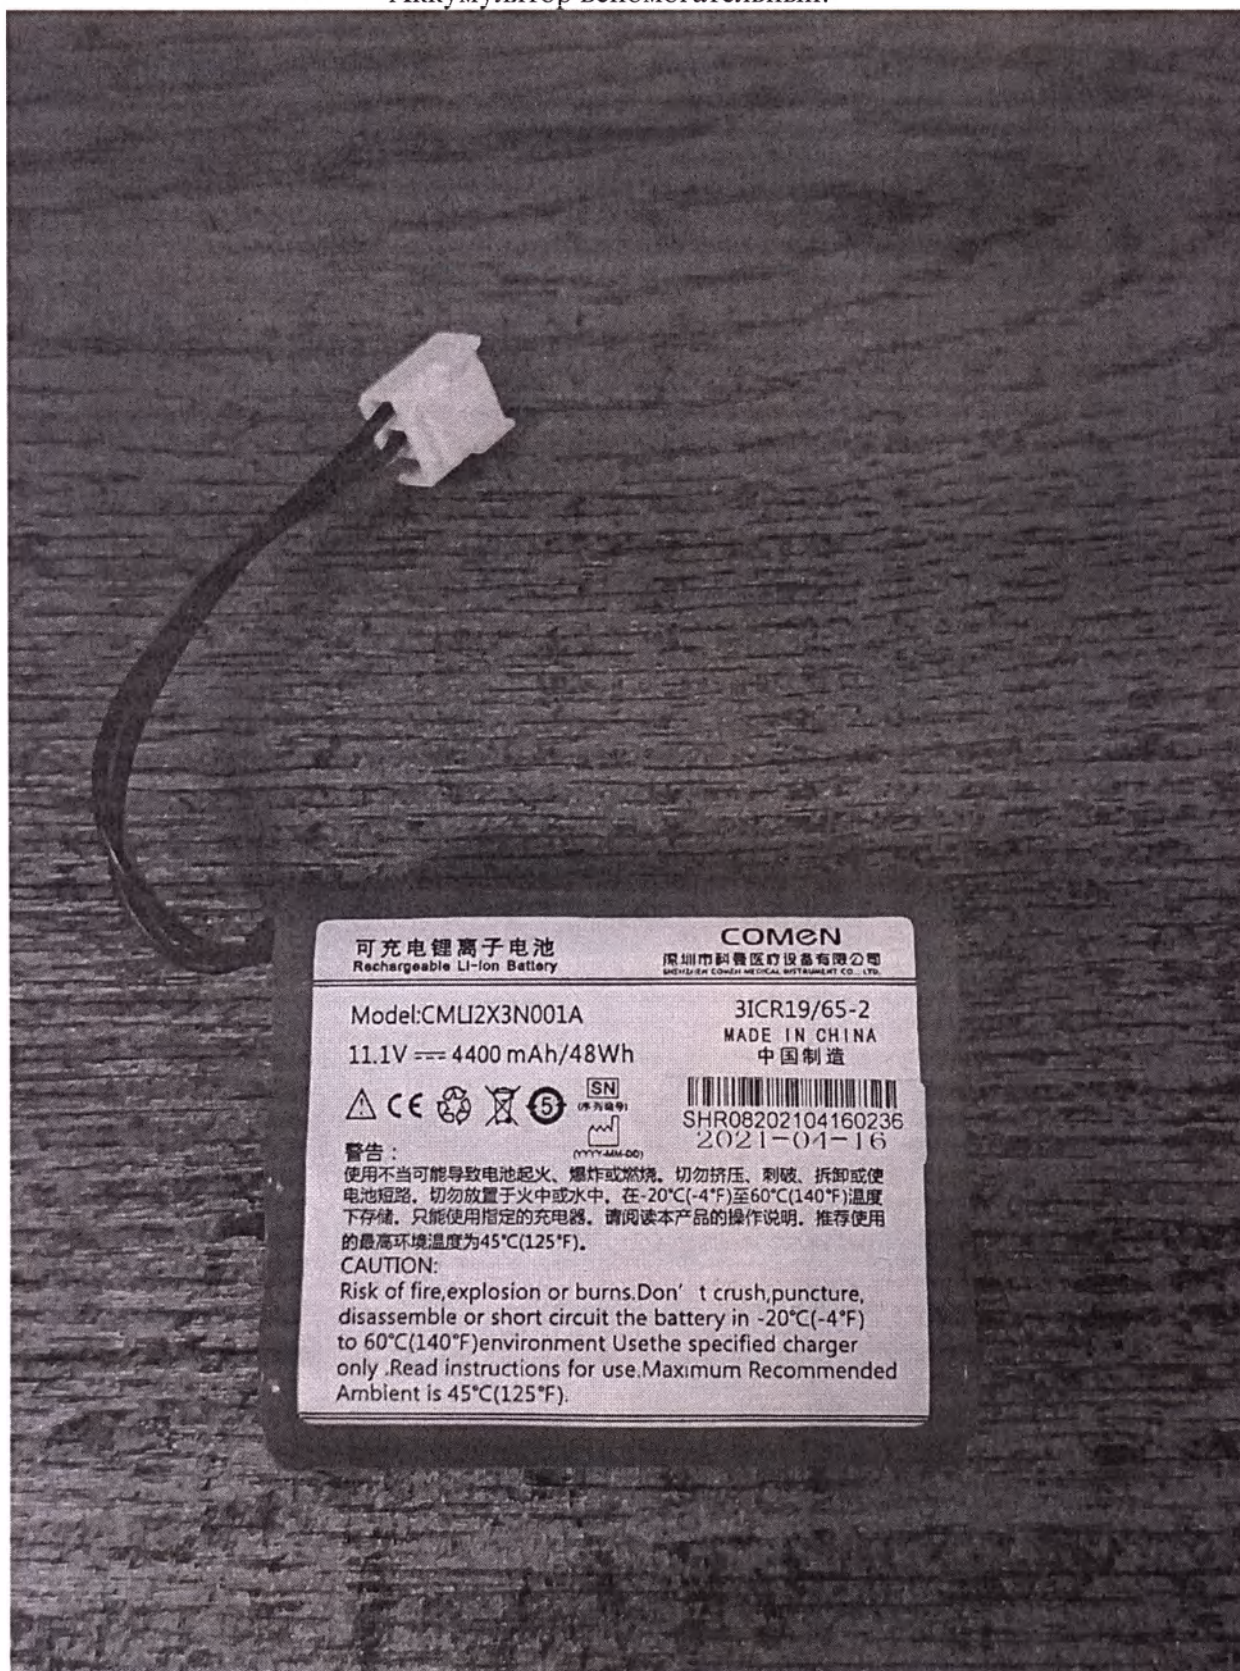

可充电锂离子电池  
Rechargeable Li-ion Battery

COMEN

深圳市科曼医疗设备有限公司  
SHENZHEN KOMAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Model: CMLI2X3N001A

3ICR19/65-2

11.1V === 4400 mAh/48Wh

MADE IN CHINA  
中国制造



SN

(序列号)



SHR08202104160236  
2021-04-16

警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。切勿挤压、刺破、拆卸或使电池短路。切勿放置于火中或水中。在 -20°C(-4°F)至60°C(140°F)温度下存储。只能使用指定的充电器。请阅读本产品的操作说明。推荐使用的最高环境温度为45°C(125°F)。

CAUTION:

Risk of fire, explosion or burns. Don't crush, puncture, disassemble or short circuit the battery in -20°C(-4°F) to 60°C(140°F) environment. Use the specified charger only. Read instructions for use. Maximum Recommended Ambient is 45°C(125°F).


Датчик SpO<sub>2</sub> для взрослых с кабелем:



Датчик SpO2 для взрослых:



Датчик SpO2 для детей/новорожденных:

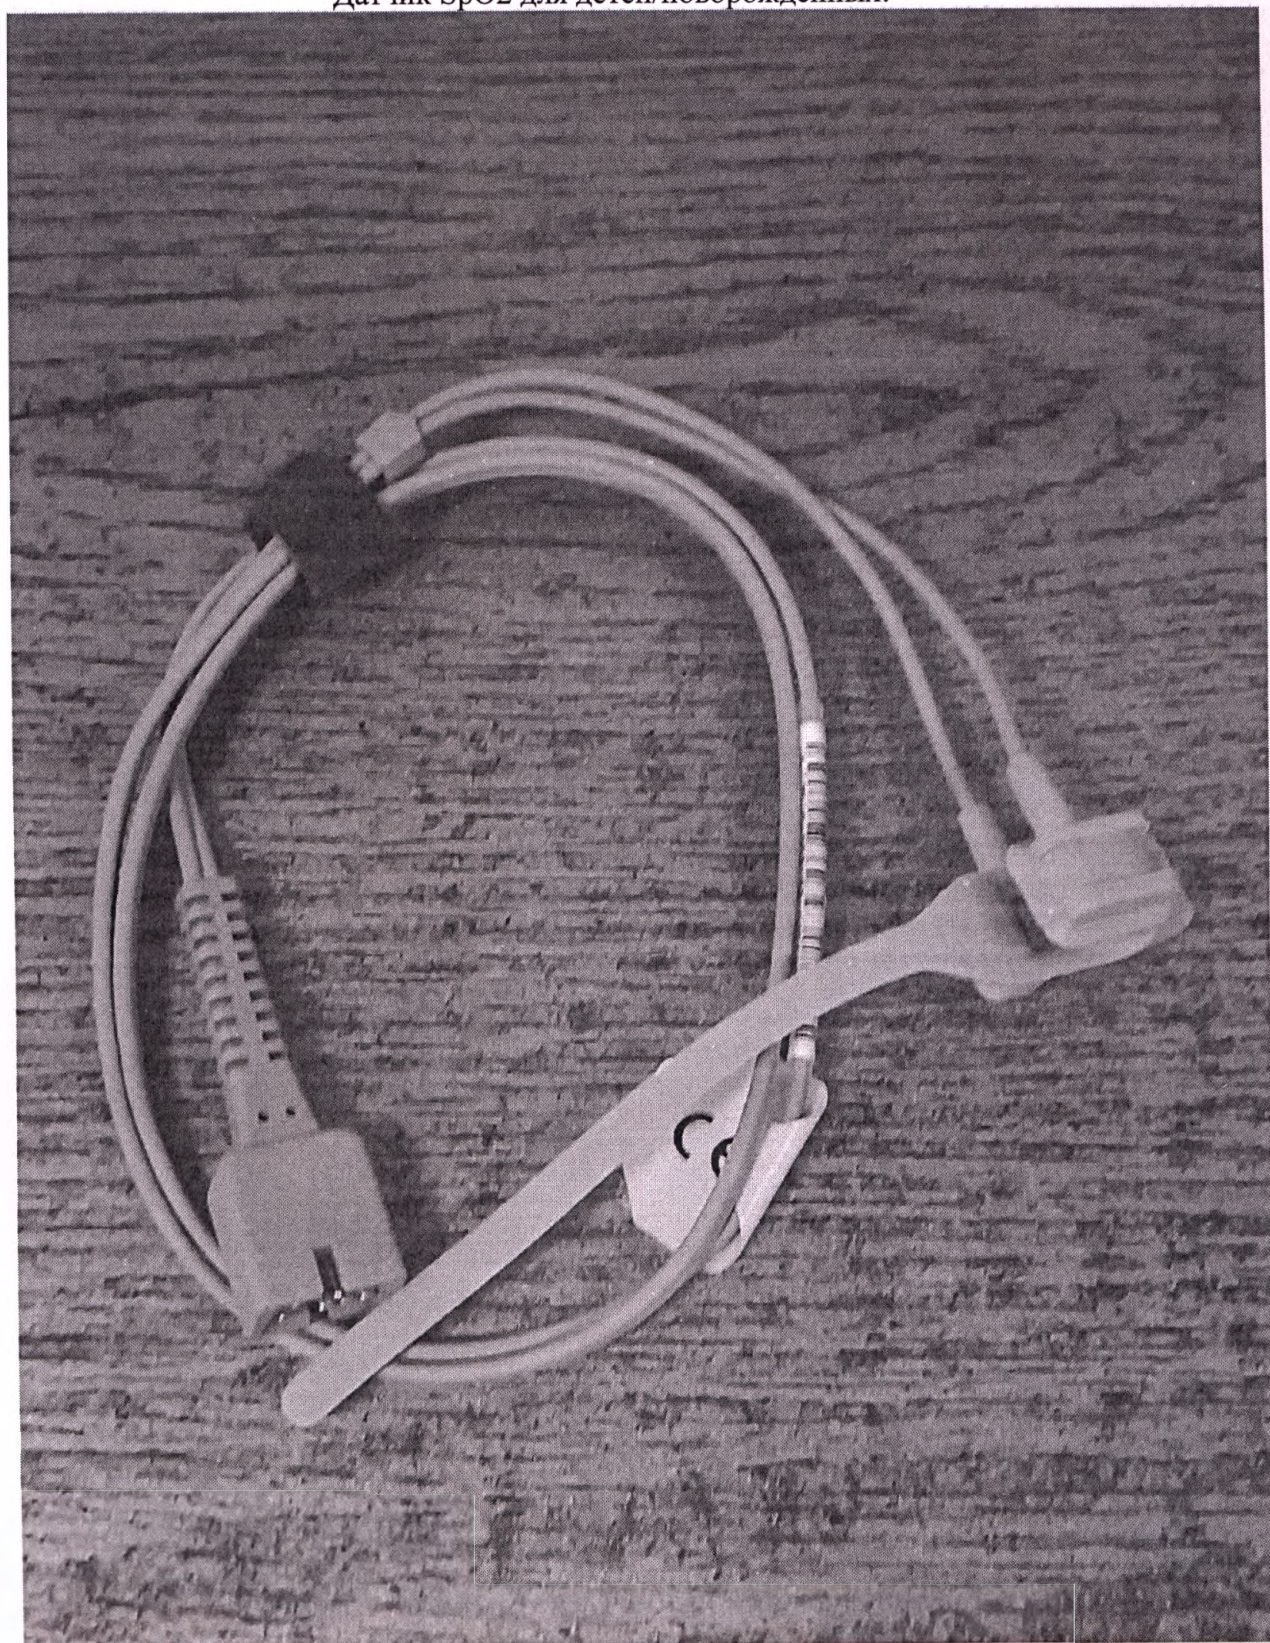


Удлинитель кабеля SpO2:




Кабель ЭКГ на 3 отведения, зажимной разъем, цельный:



Кабель ЭКГ на 3 отведения, зажимной разъем, отдельный:

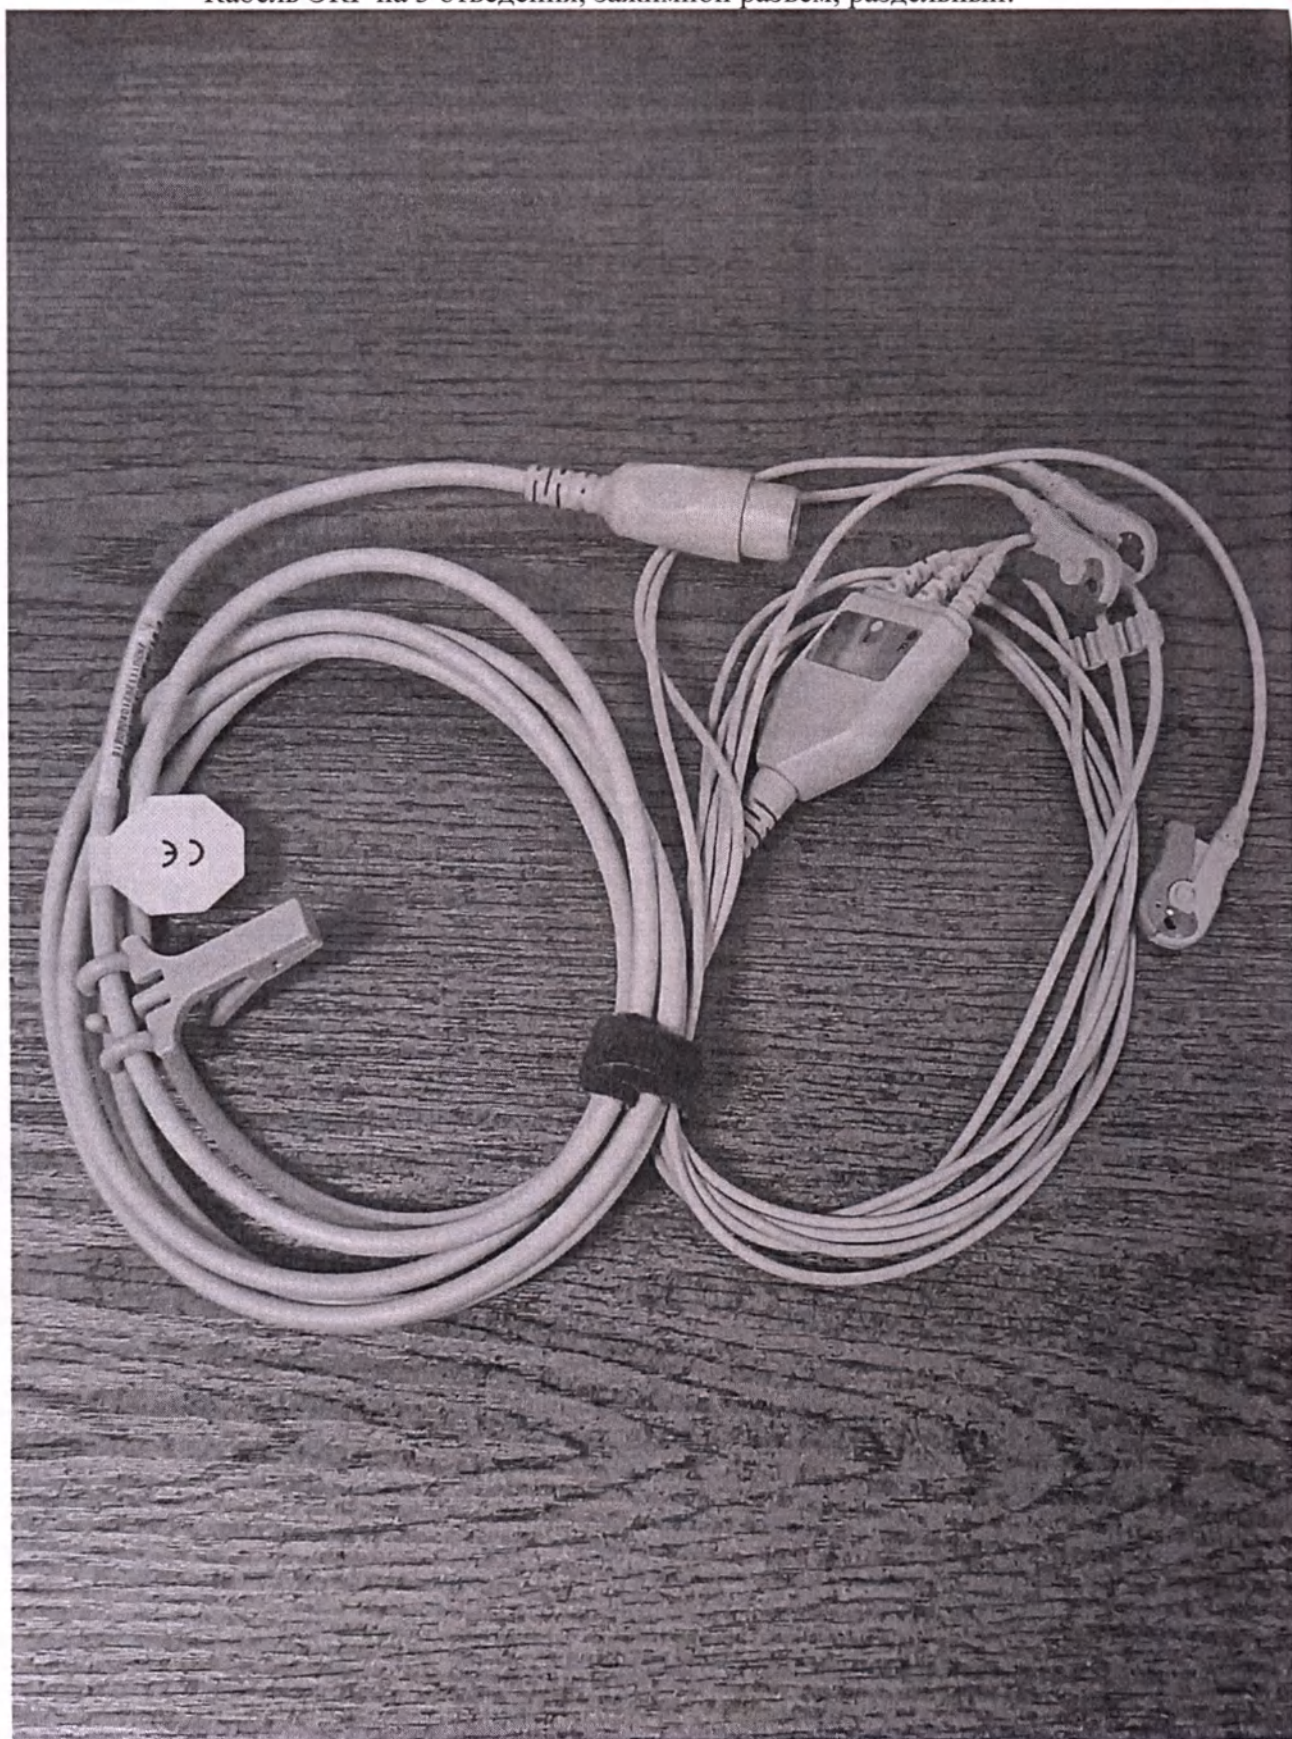


Основной кабель ЭКГ на 3 отведения для детей и новорожденных:

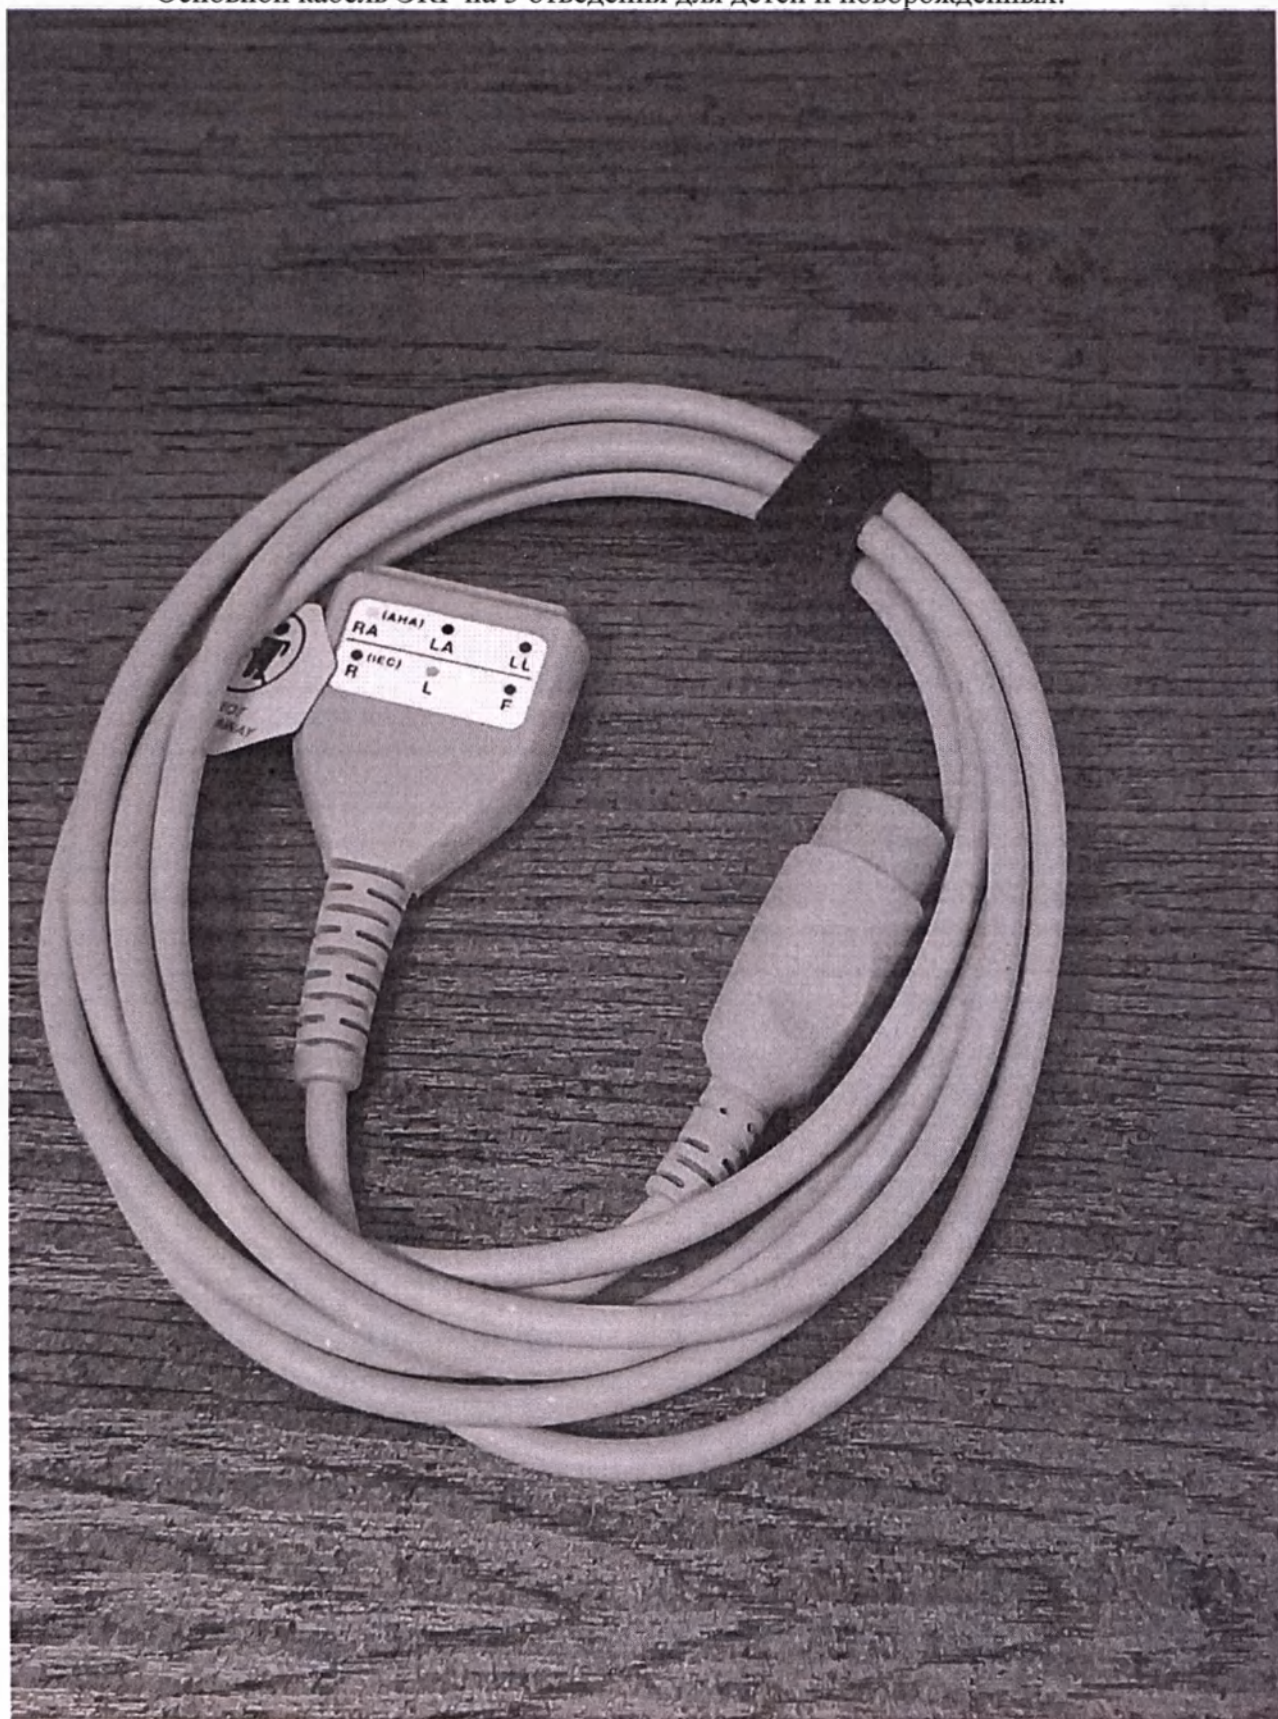


Разделенный кабель ЭКГ на 3 отведения для детей и новорожденных:



Одноразовый Электрод ЭКГ:

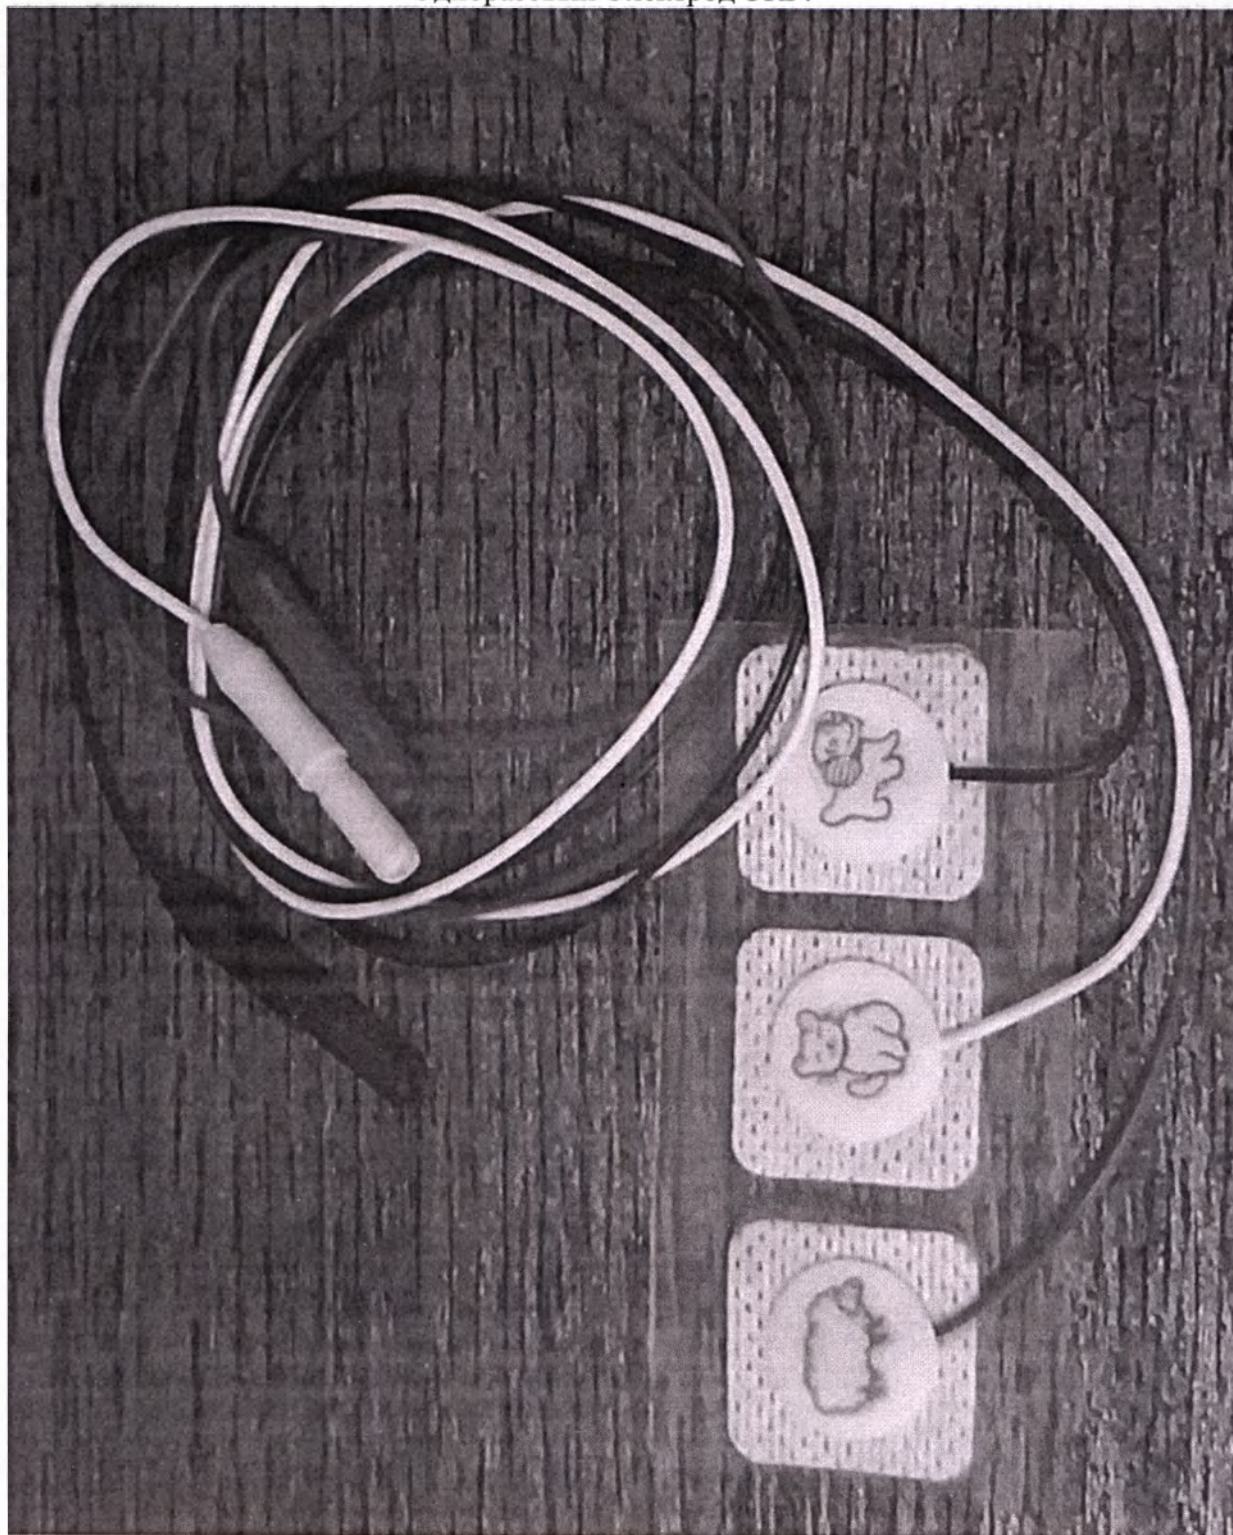


Электроды на конечности:

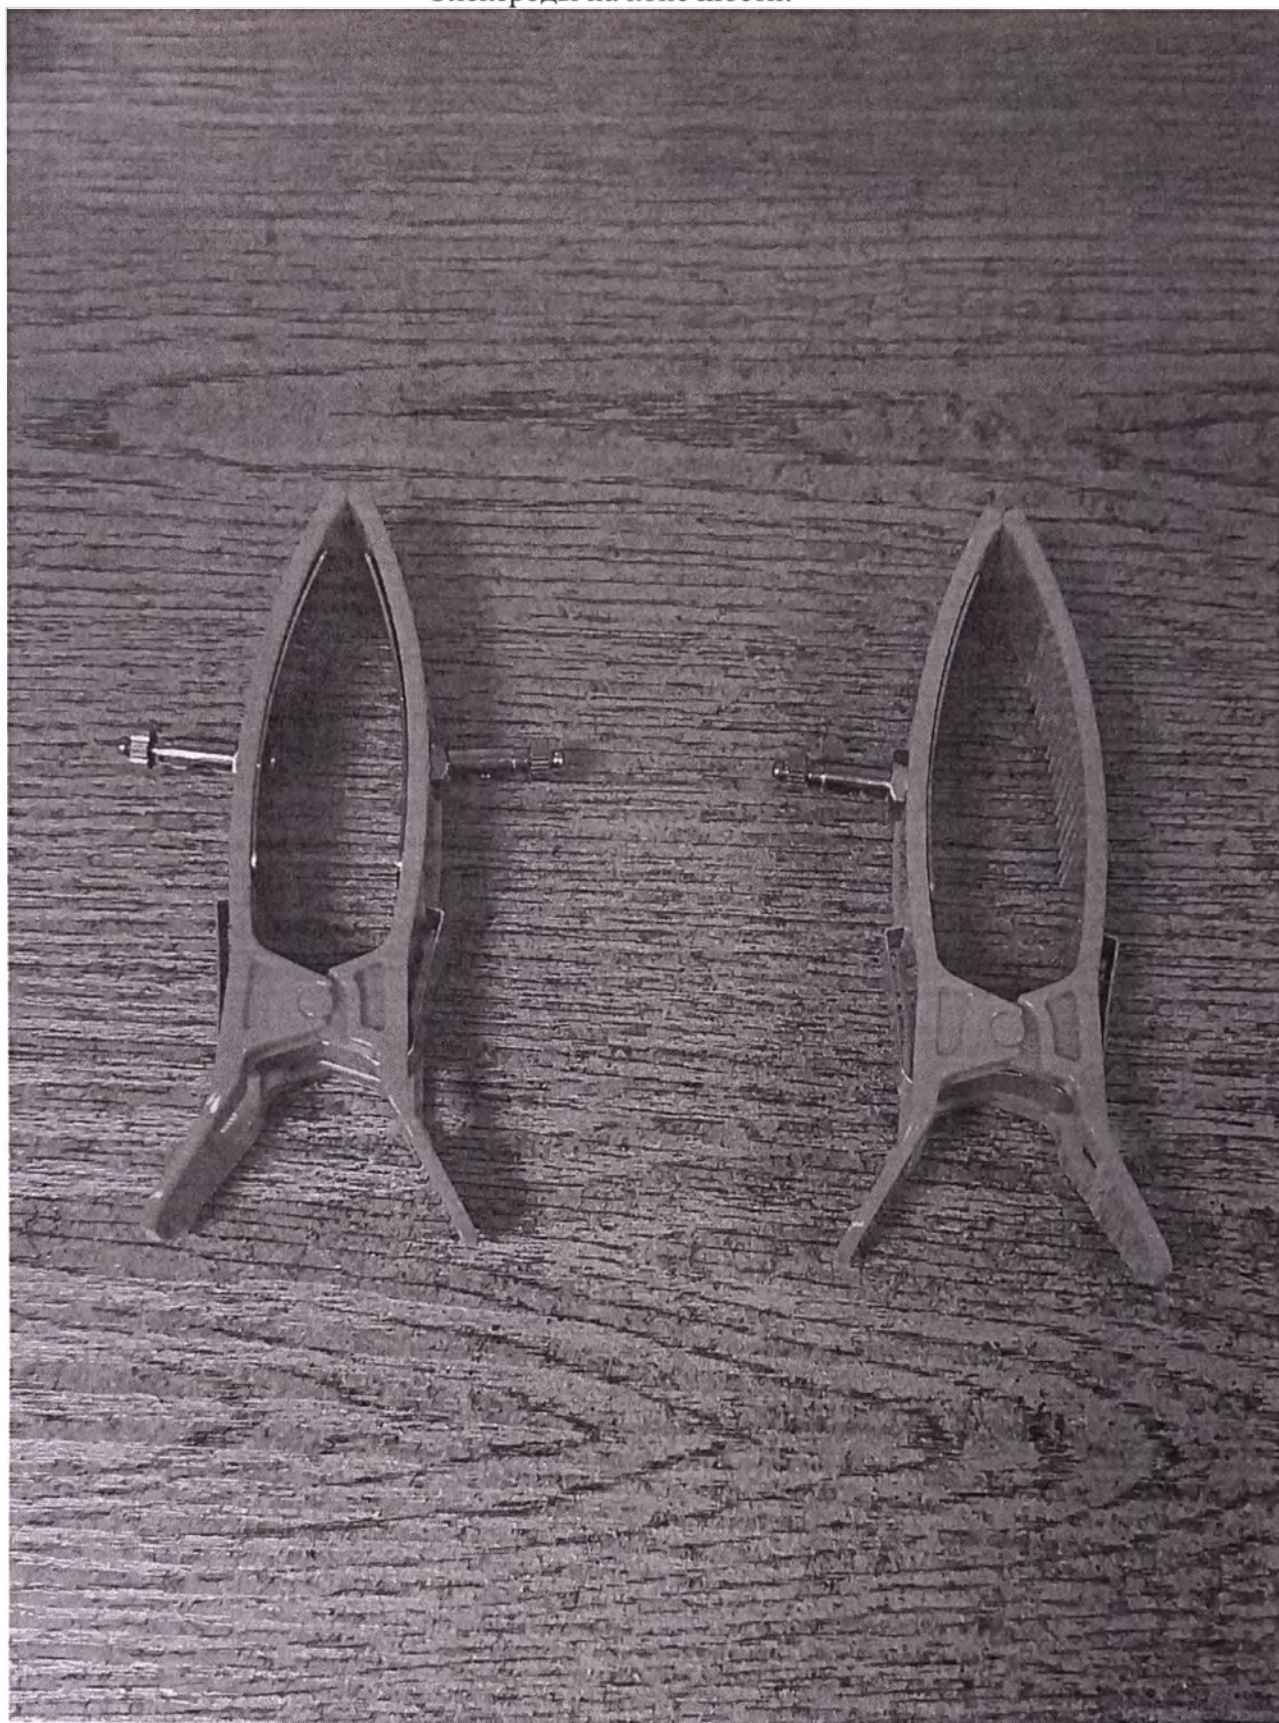


Бумага для печати:



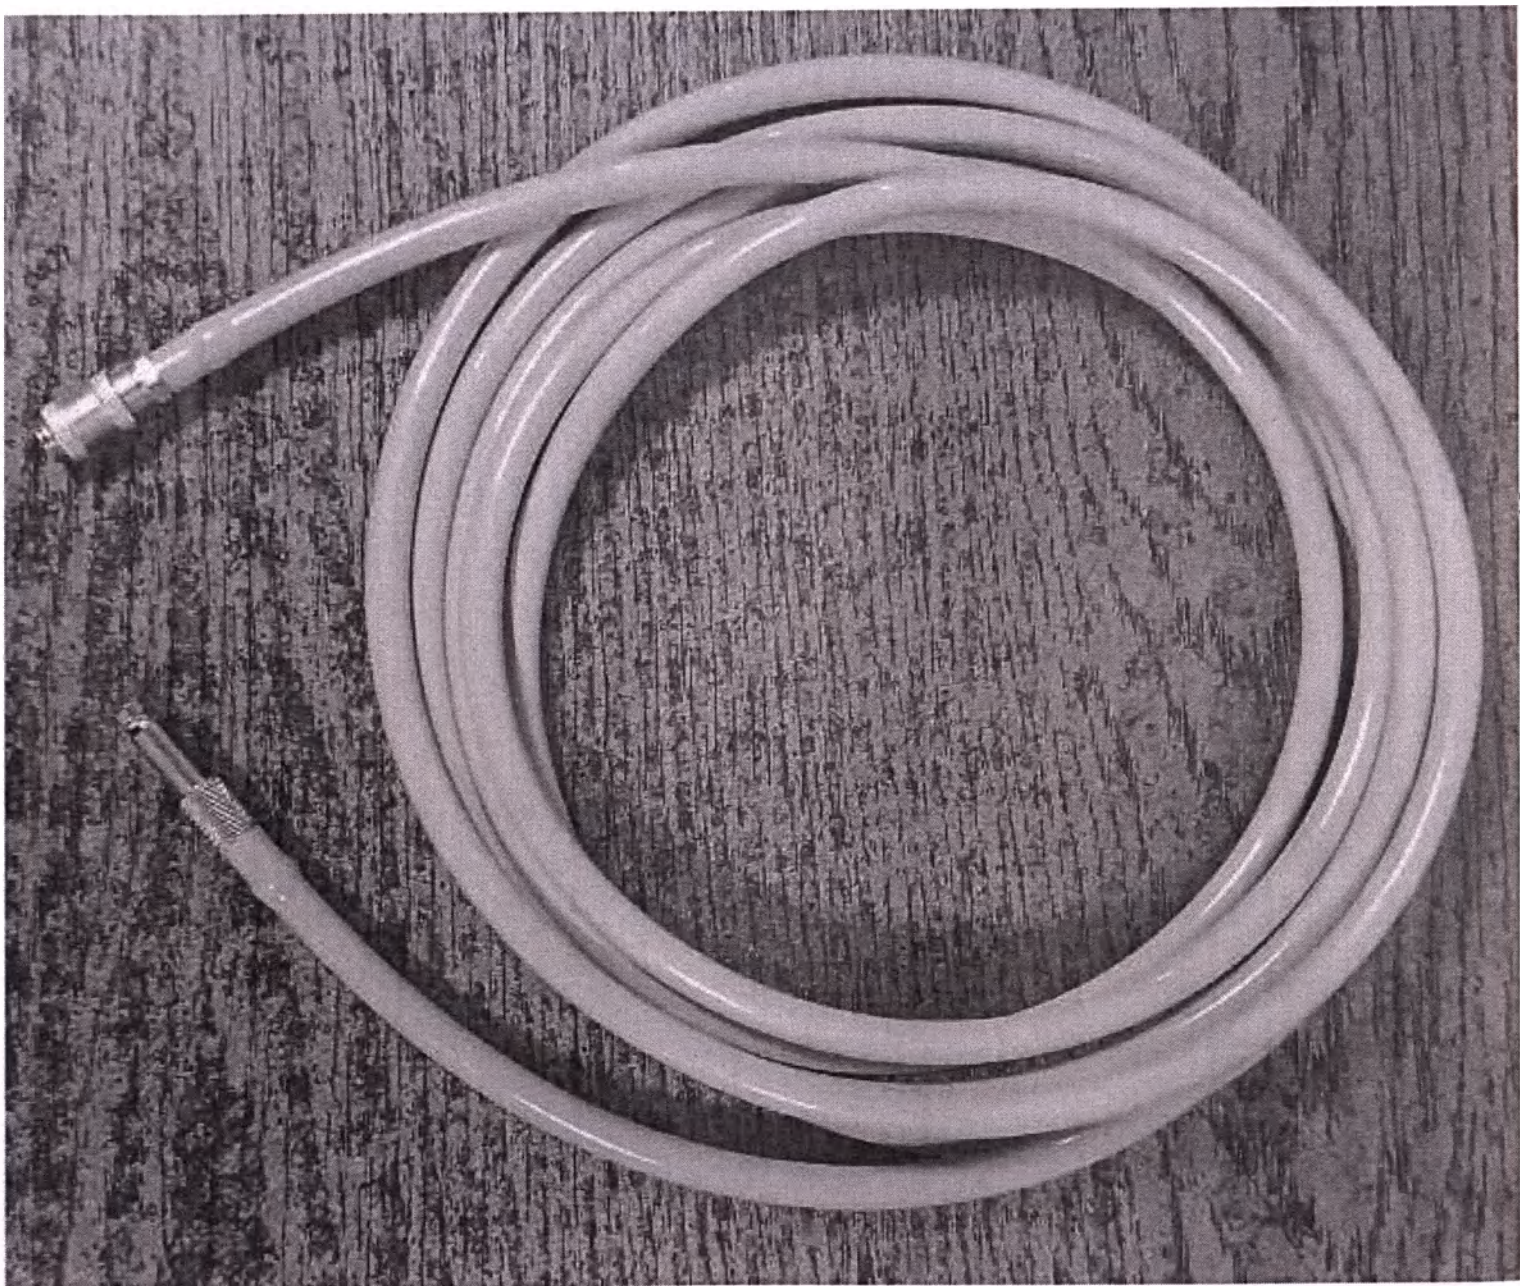


Трубка НИИД (3м):

Трубка НИАД (2м):

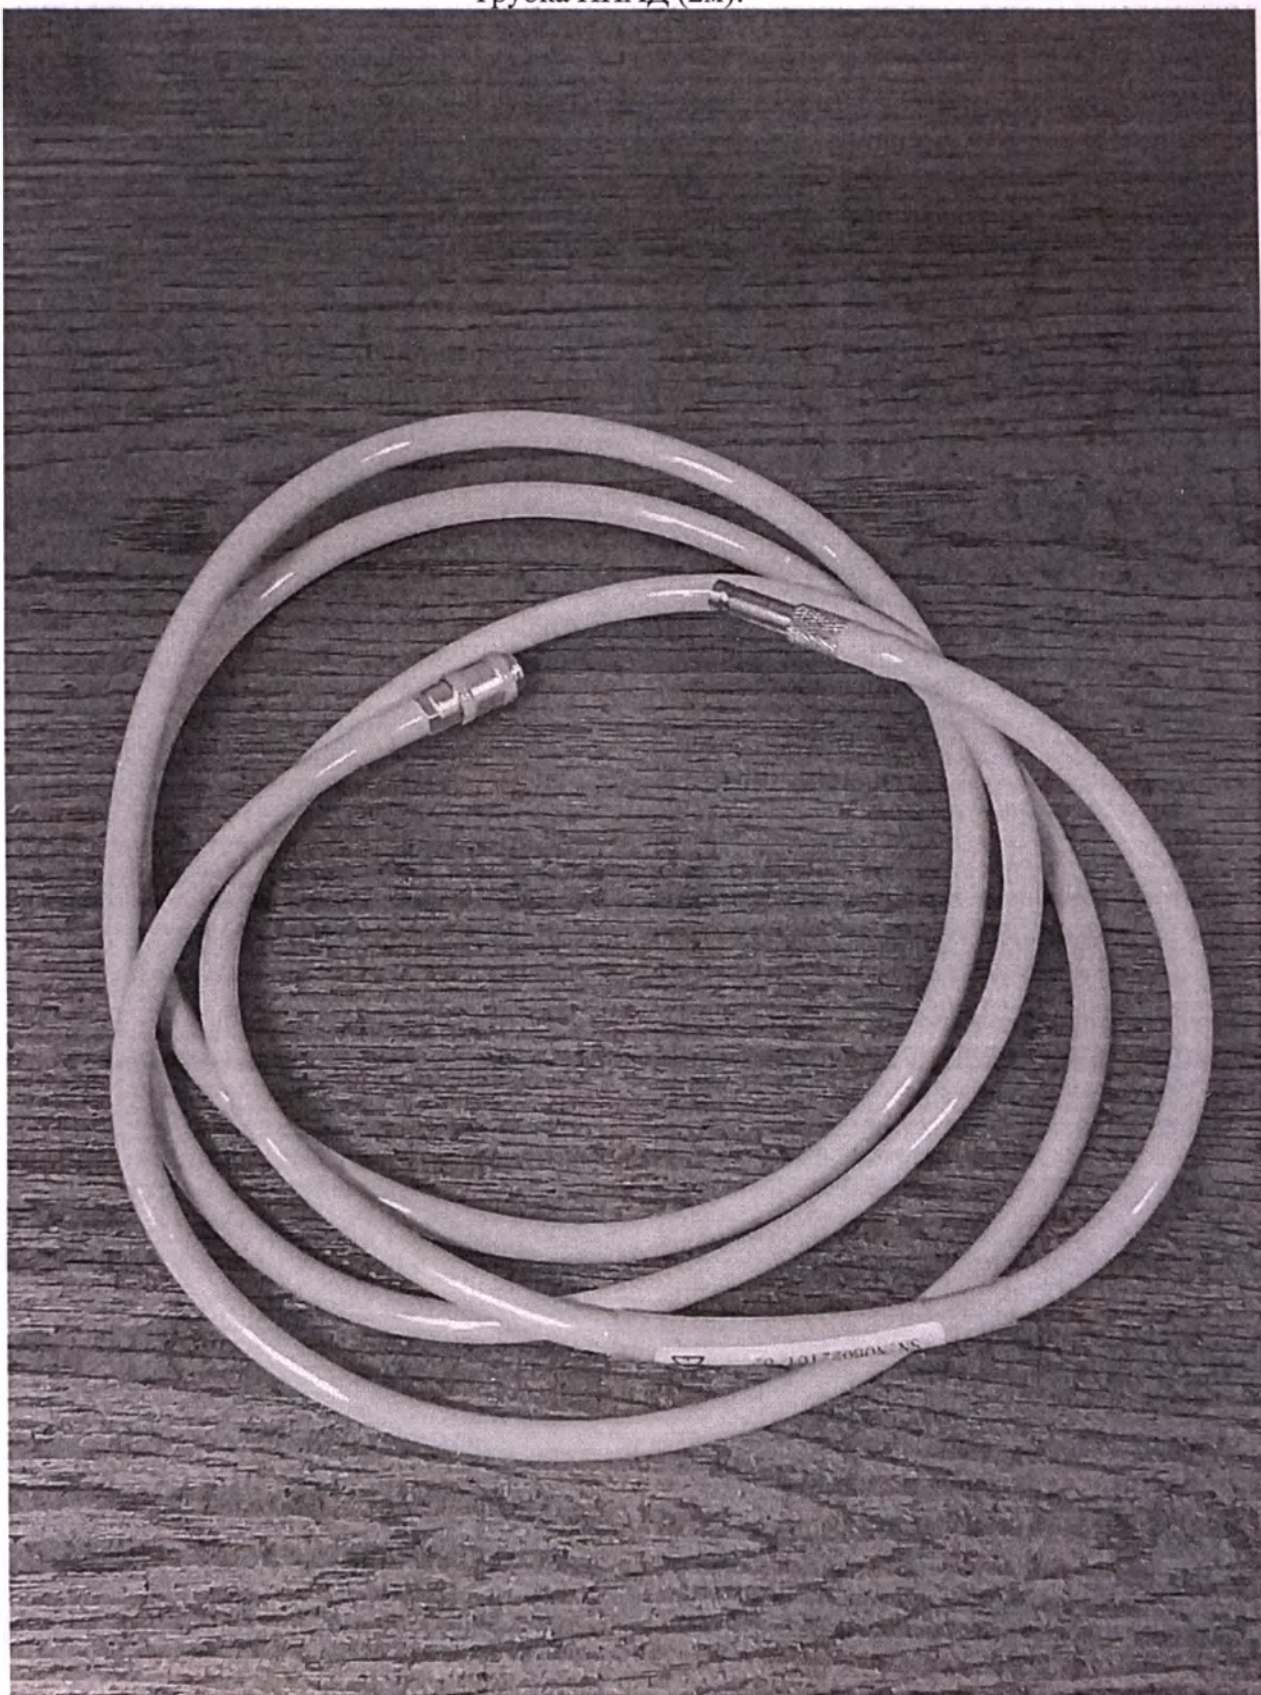

Манжета НИАД для взрослых:

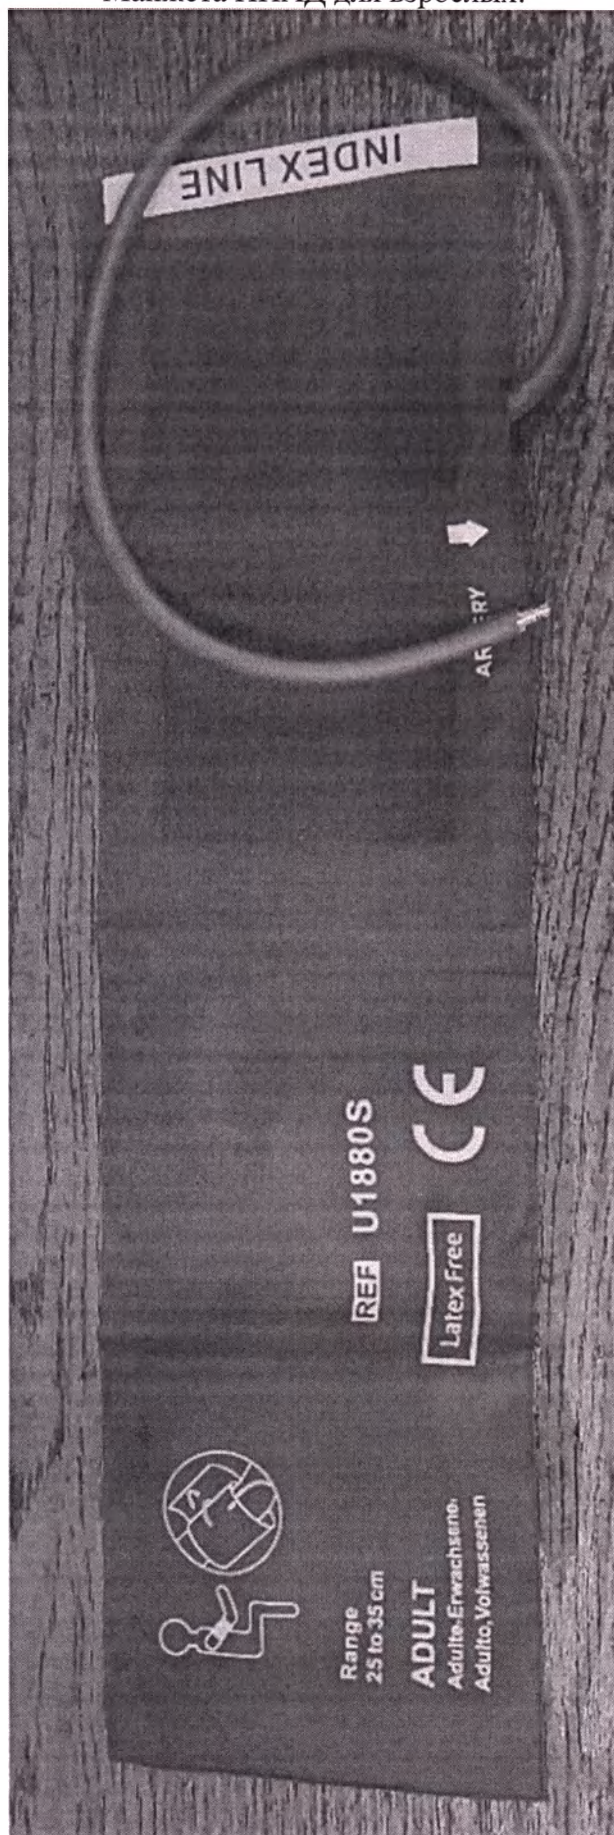


Манжета НИАД для детей:




Манжета НИАД для младенцев:




Манжета НИАД для новорожденных:

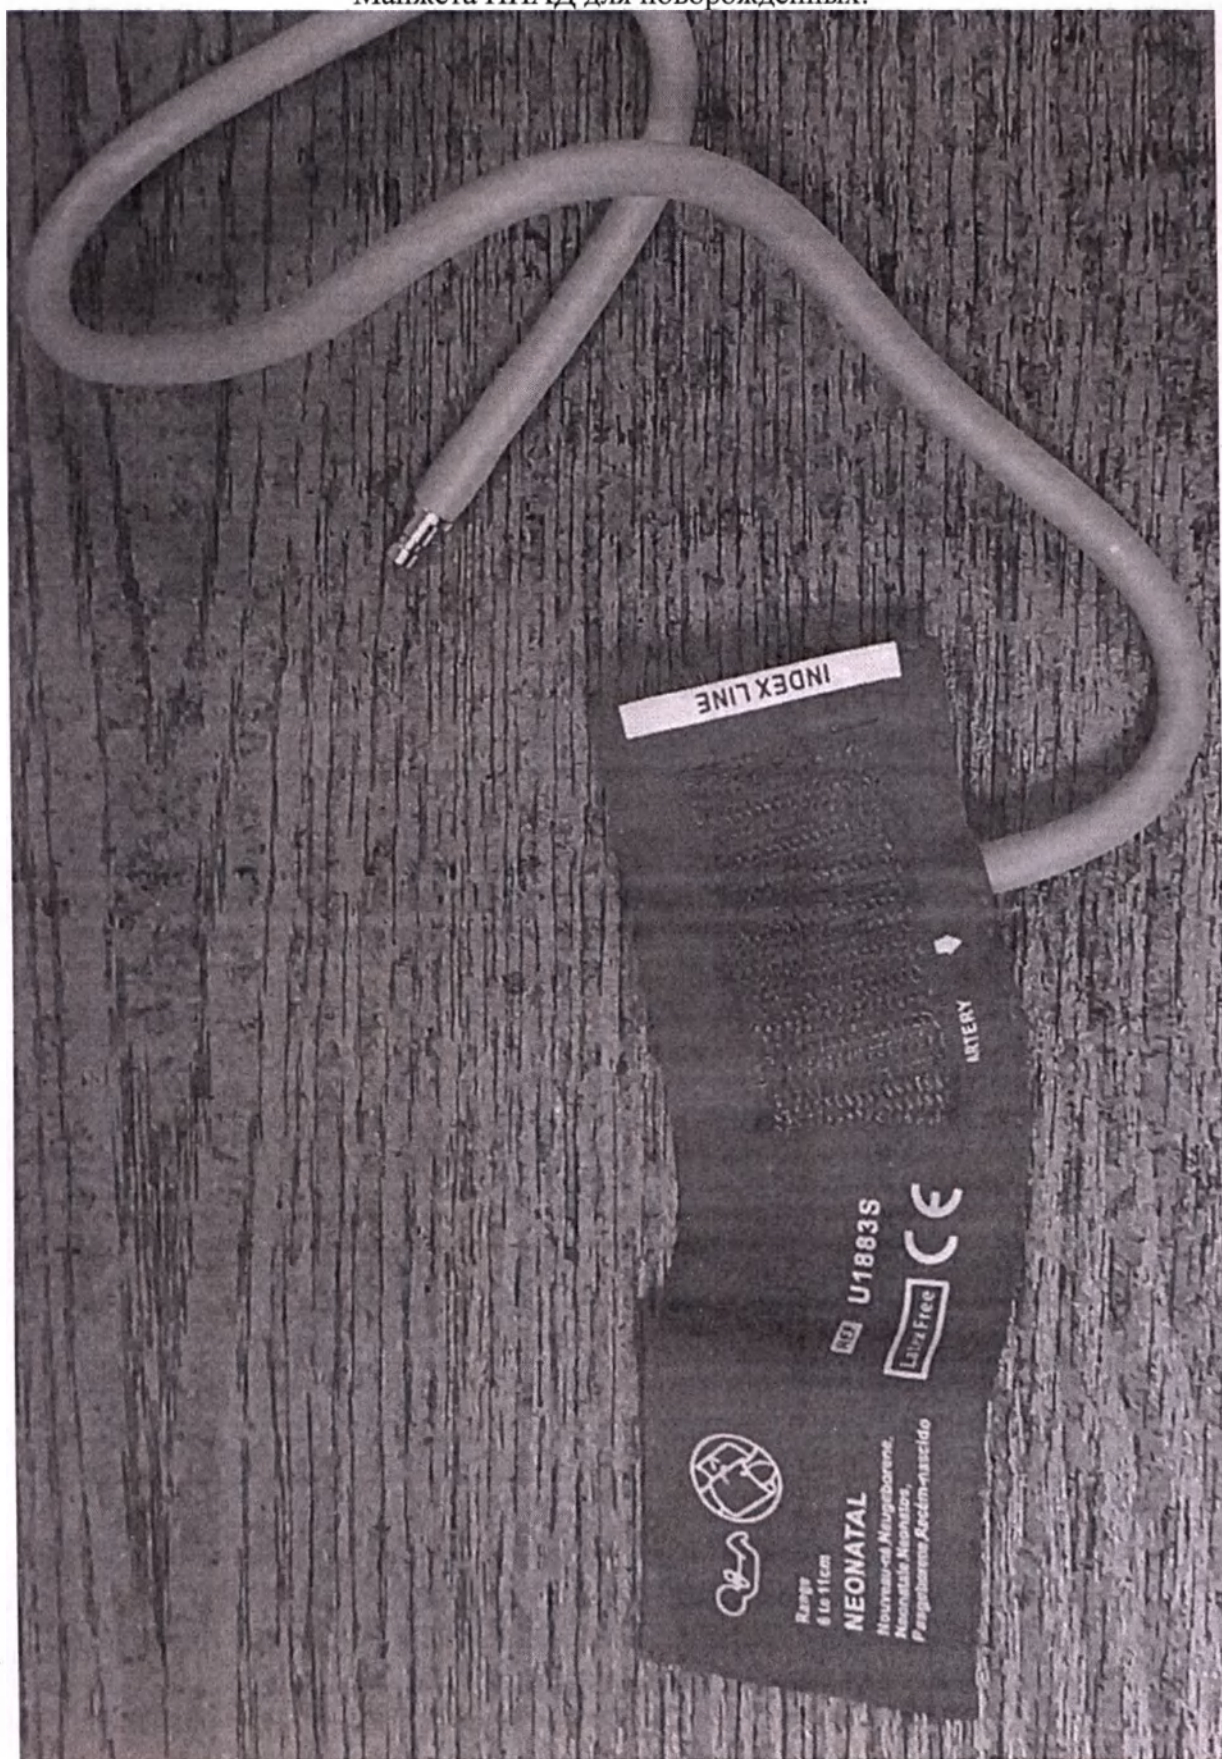

Манжета НИАД для новорожденных, одноразовая:

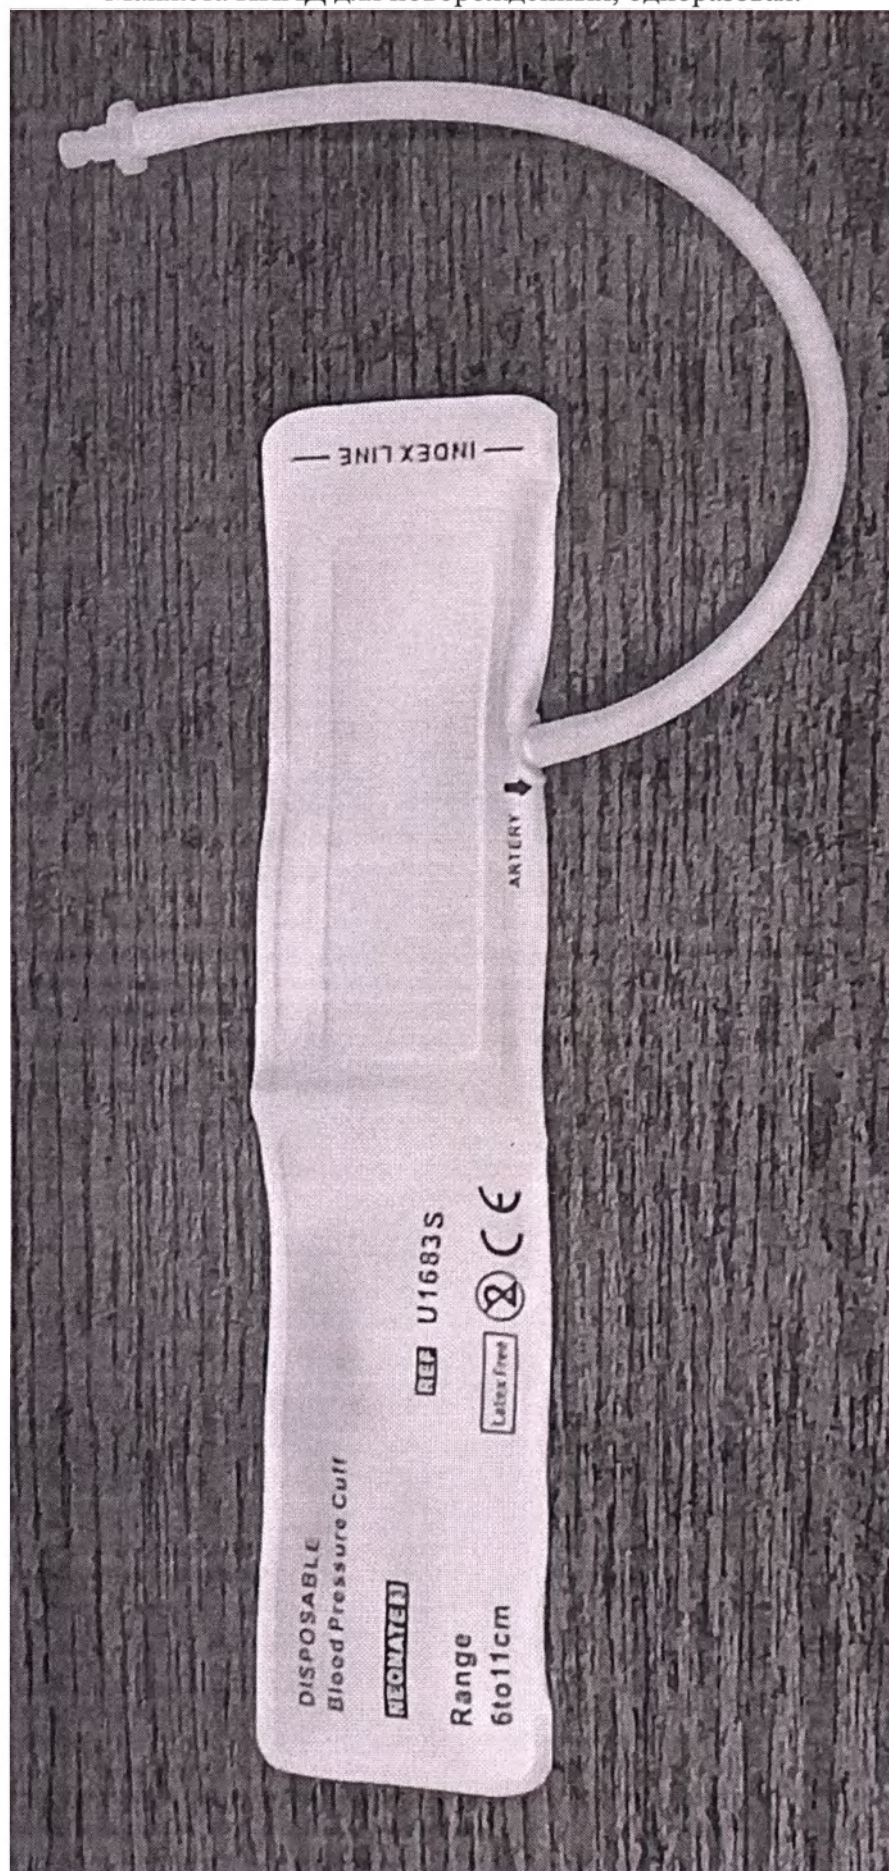


М200 Держатель кронштейна шприцевого насоса:

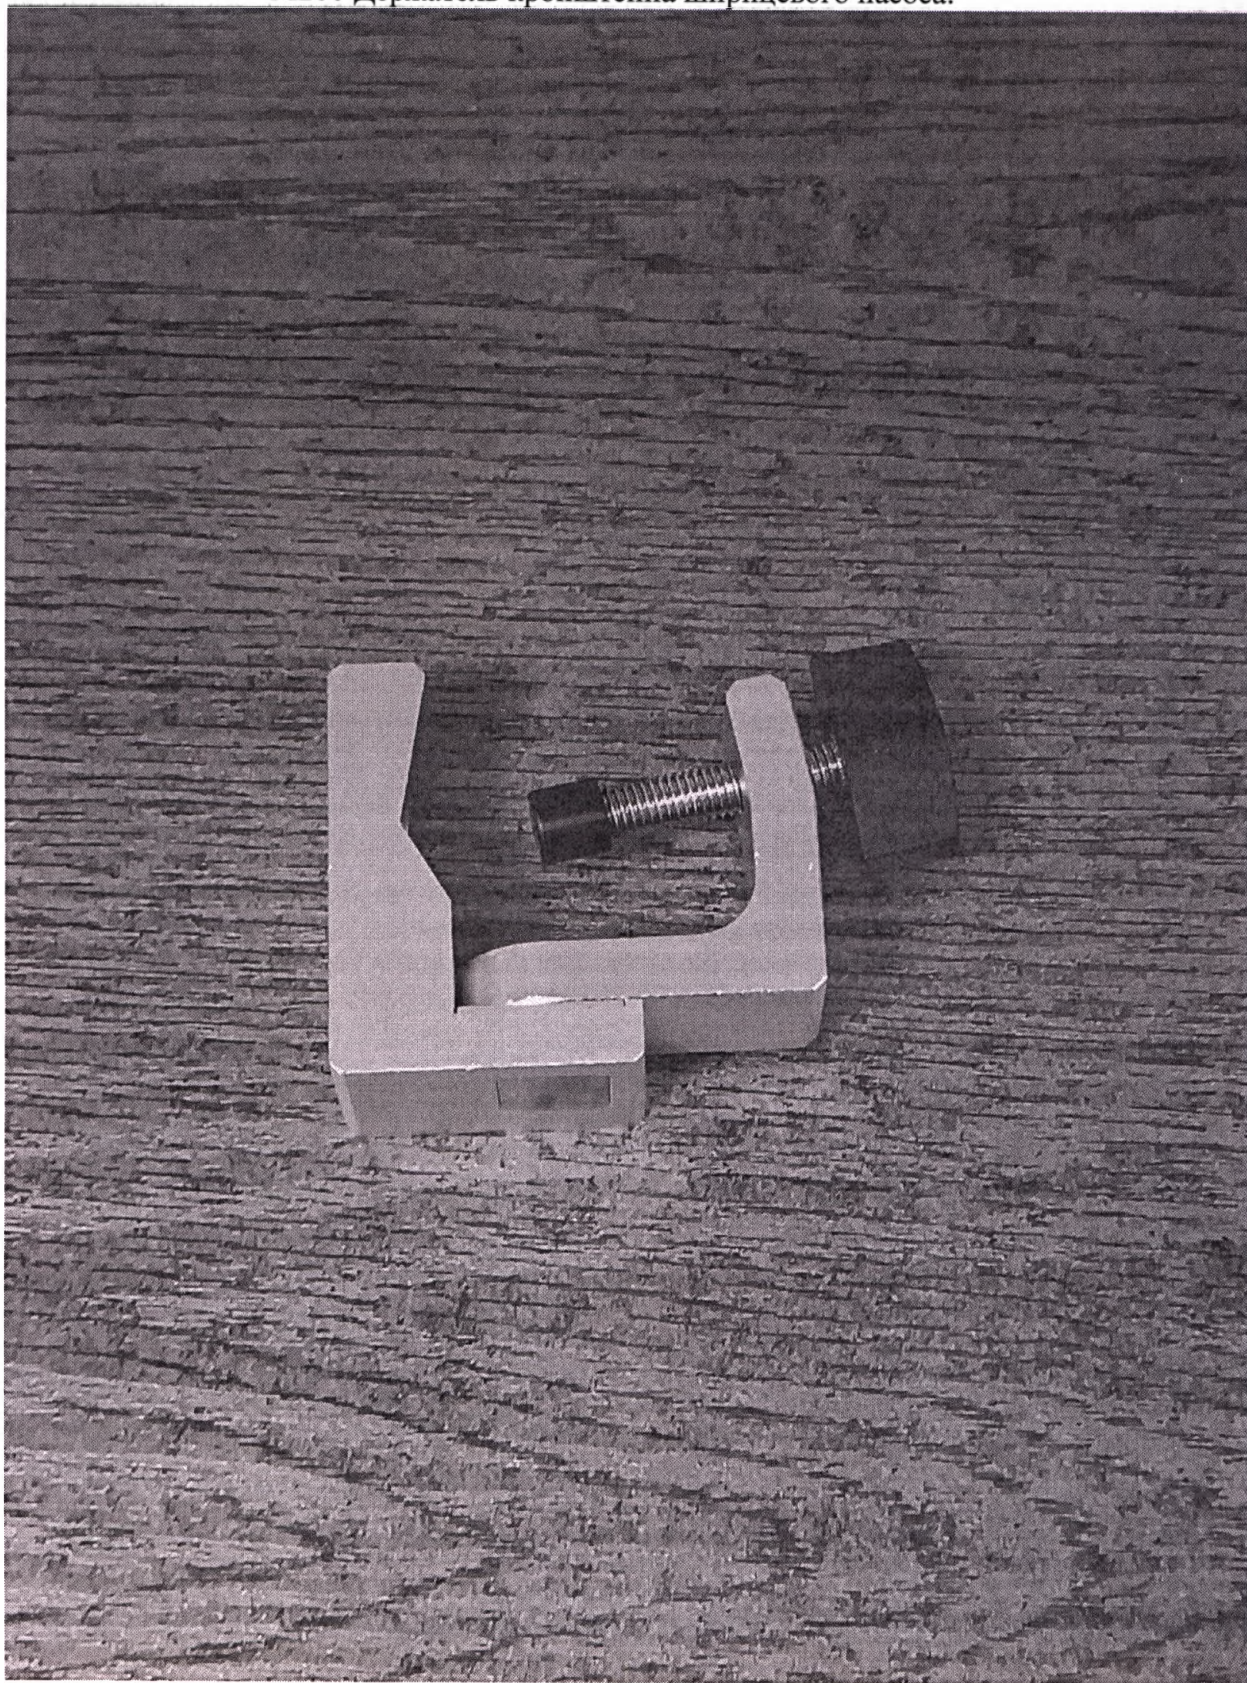


Тележка транспортная для монитора:





Крепление на стену навесное:

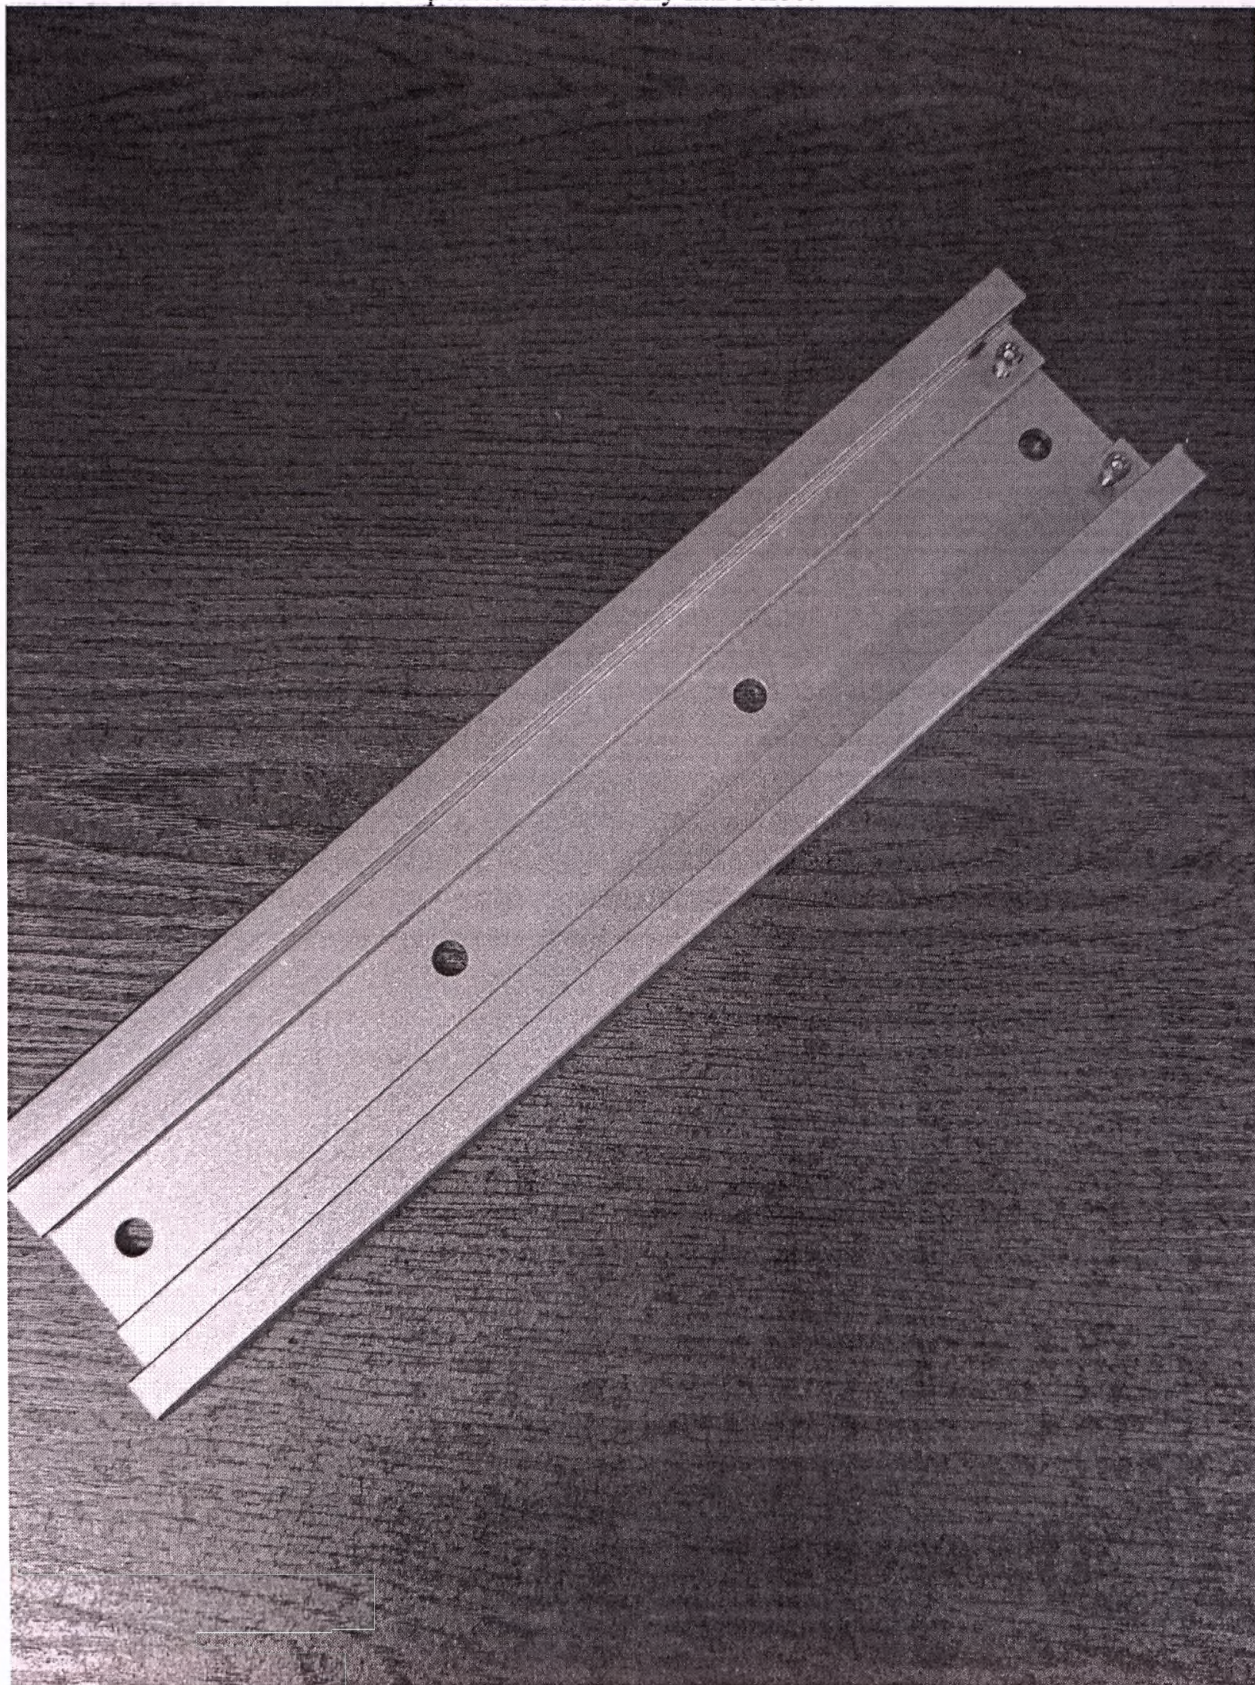





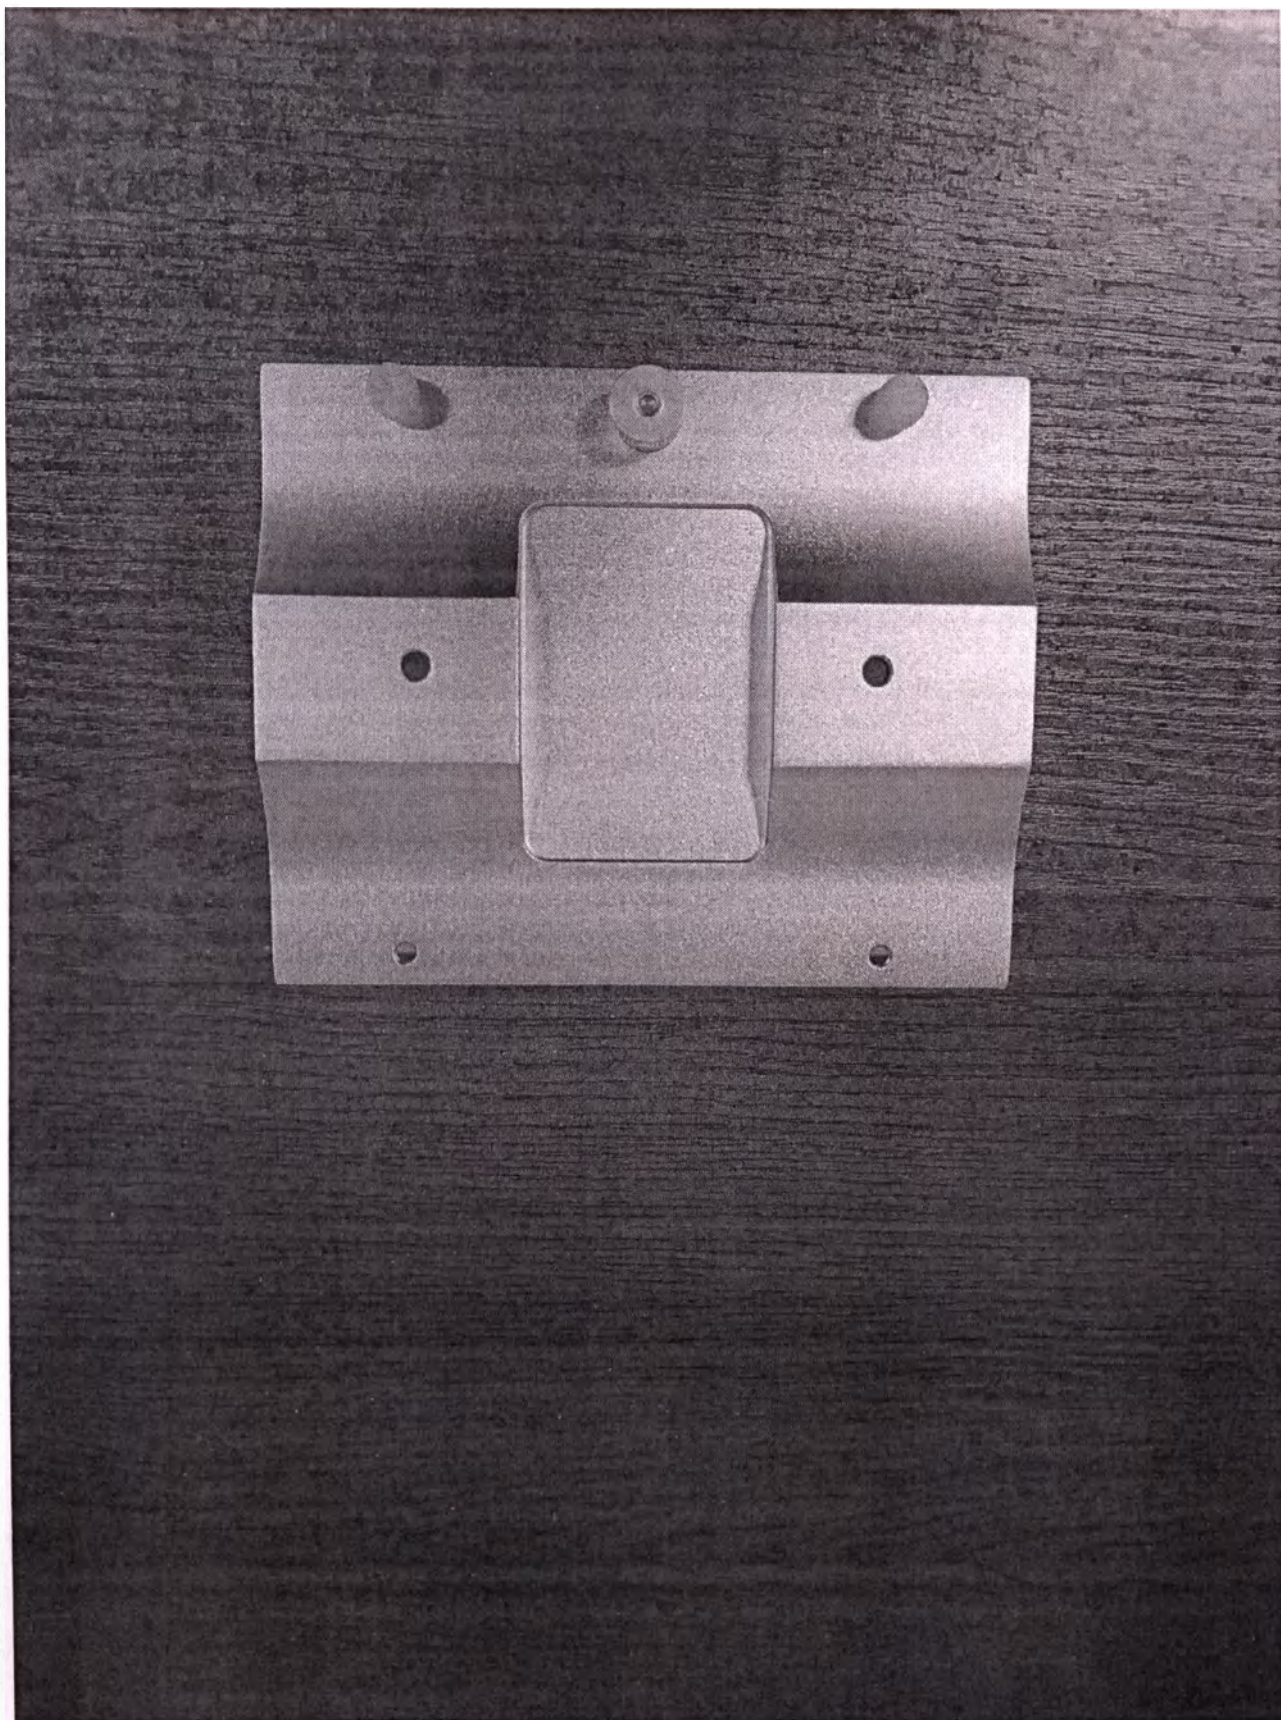

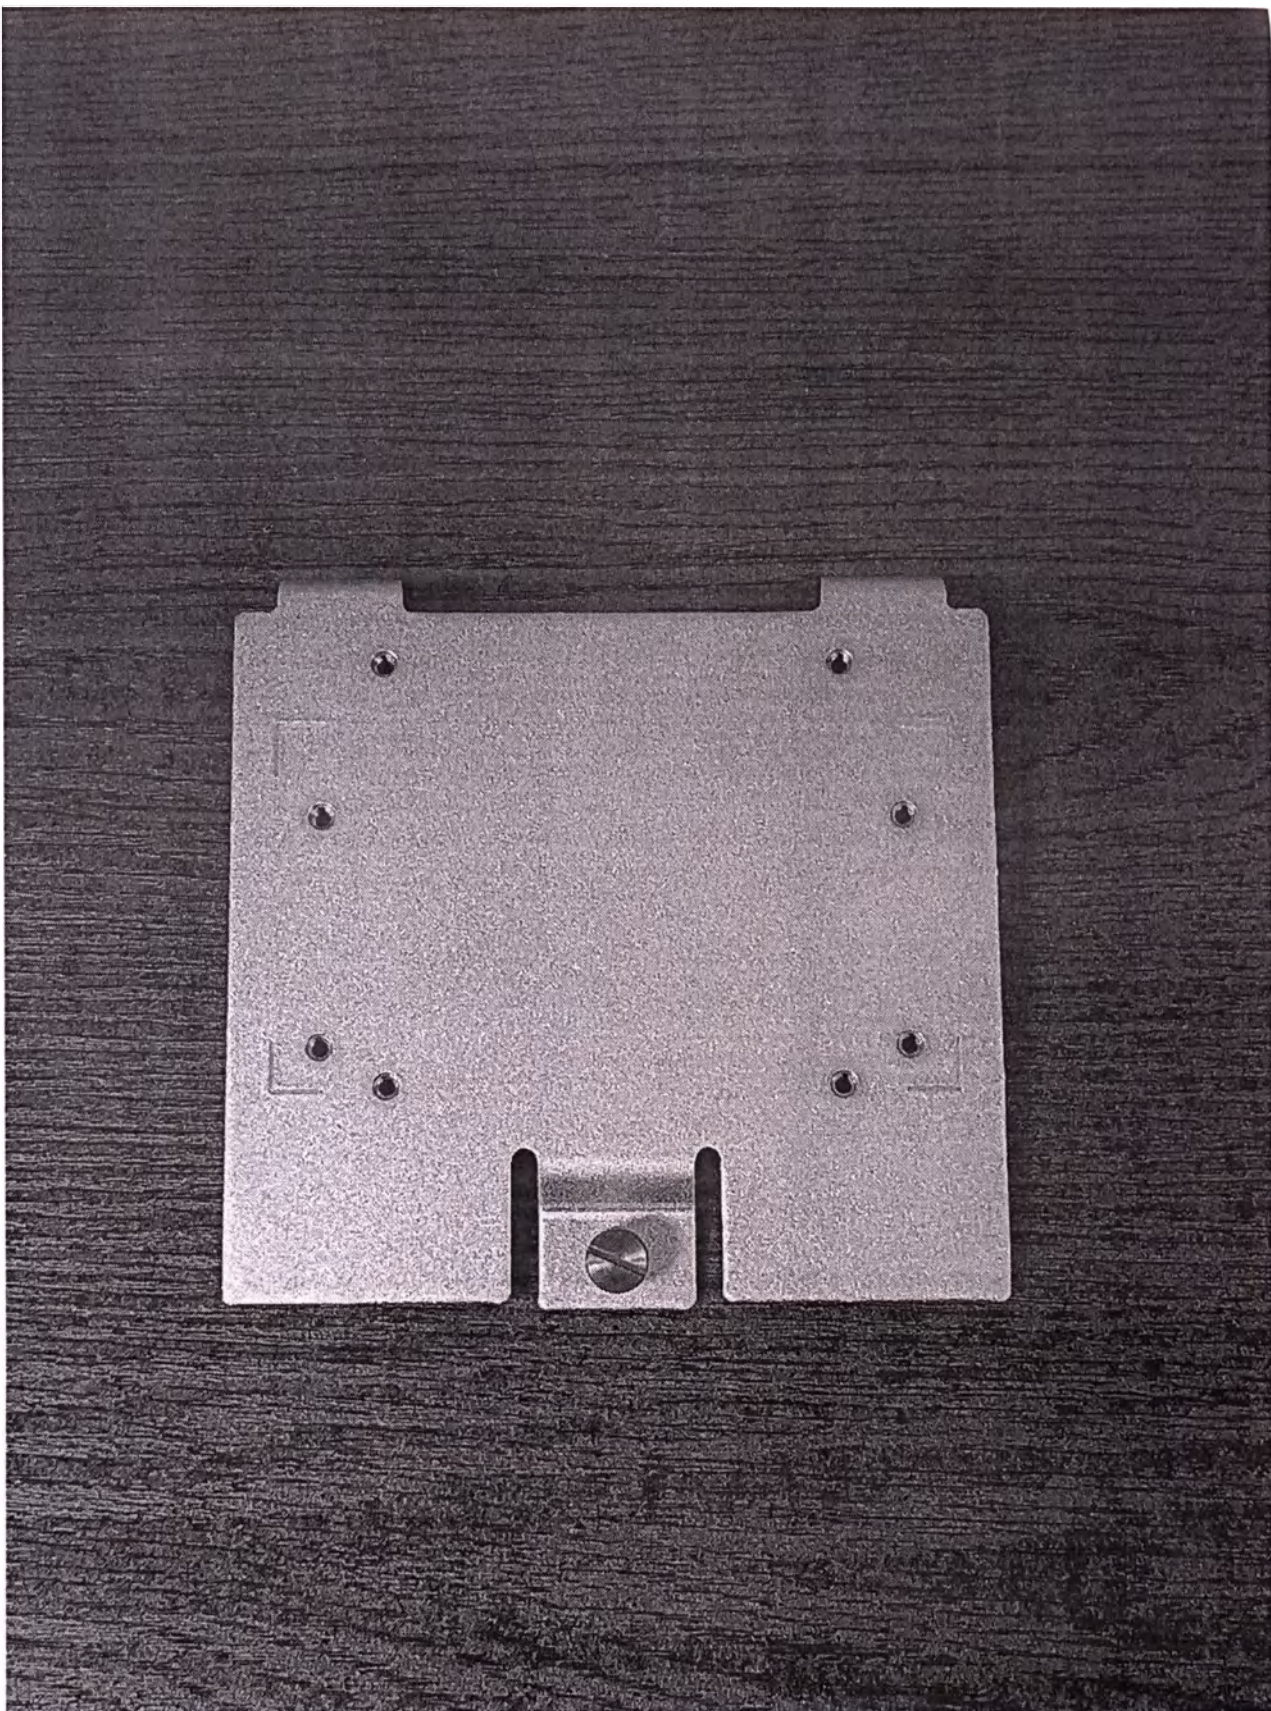

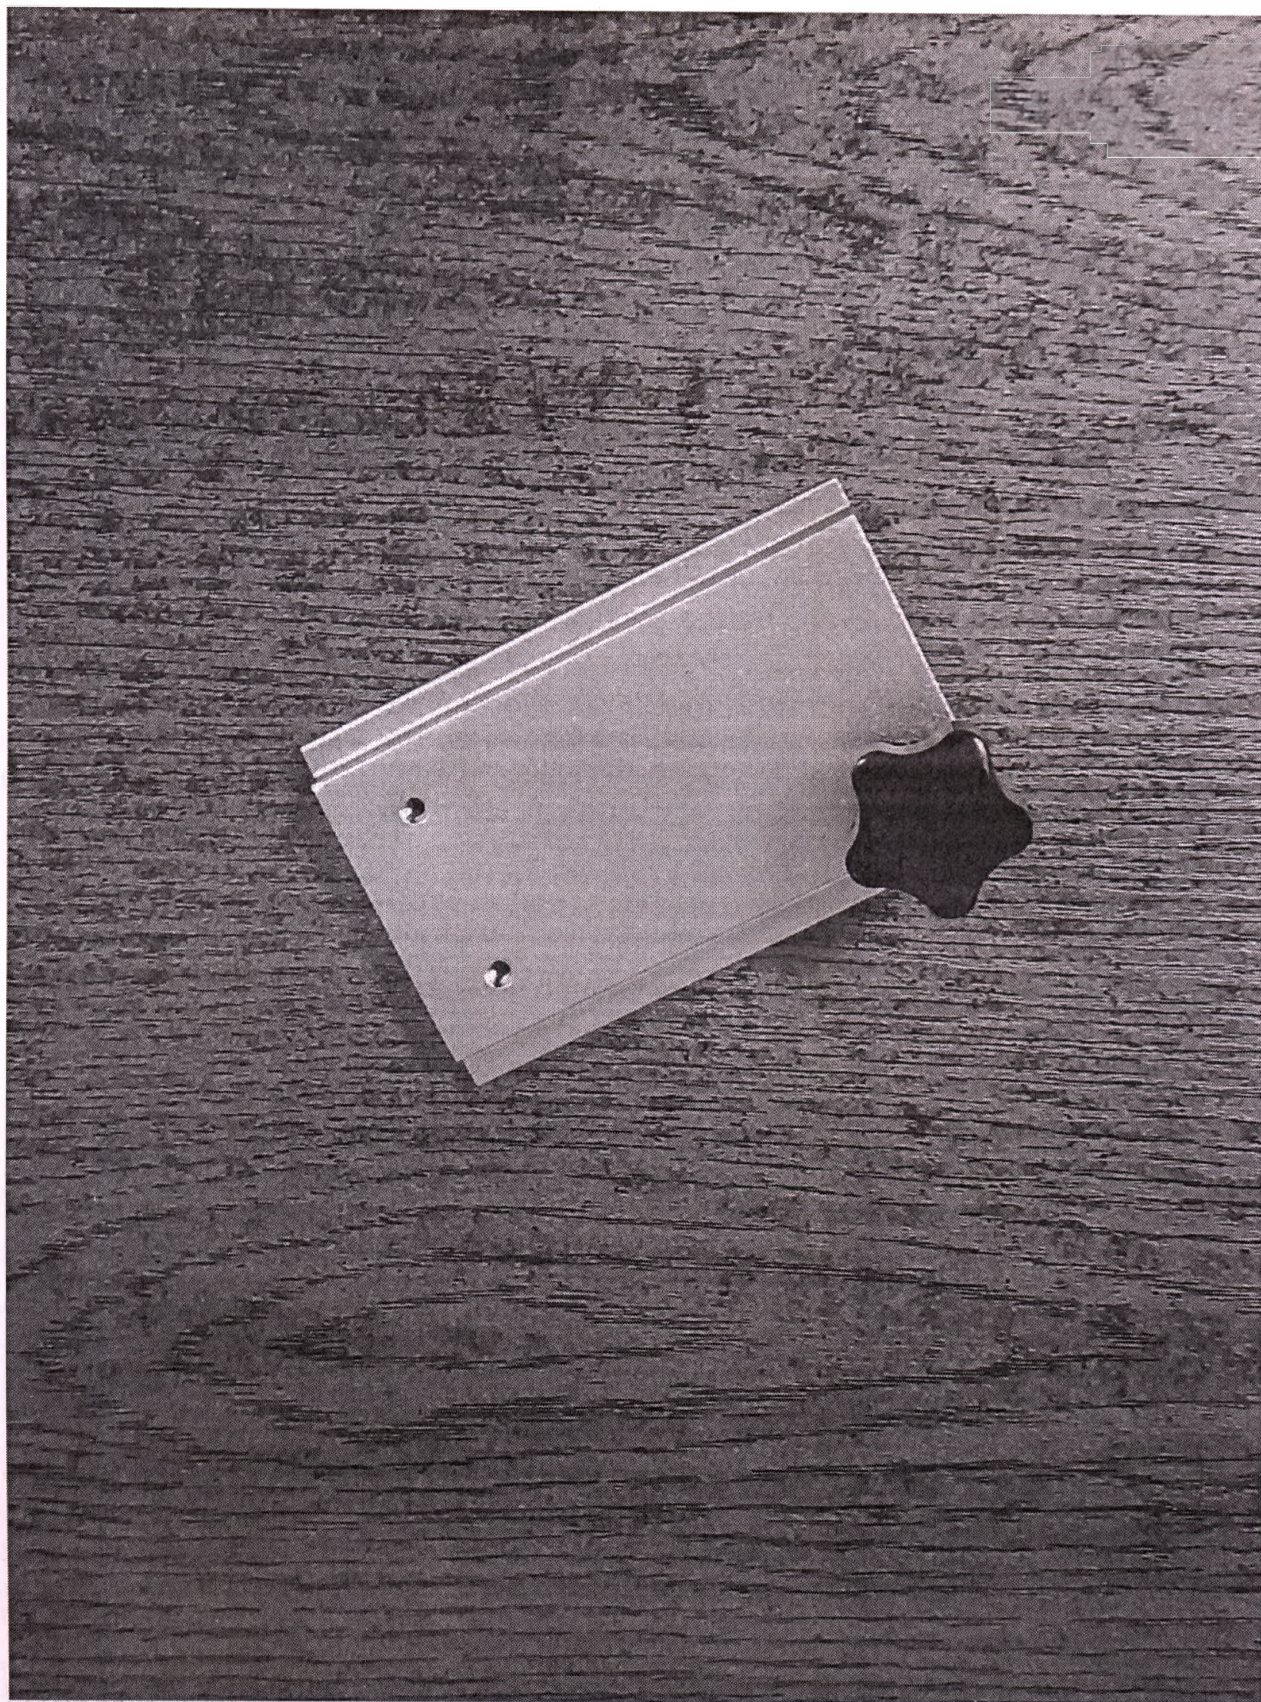

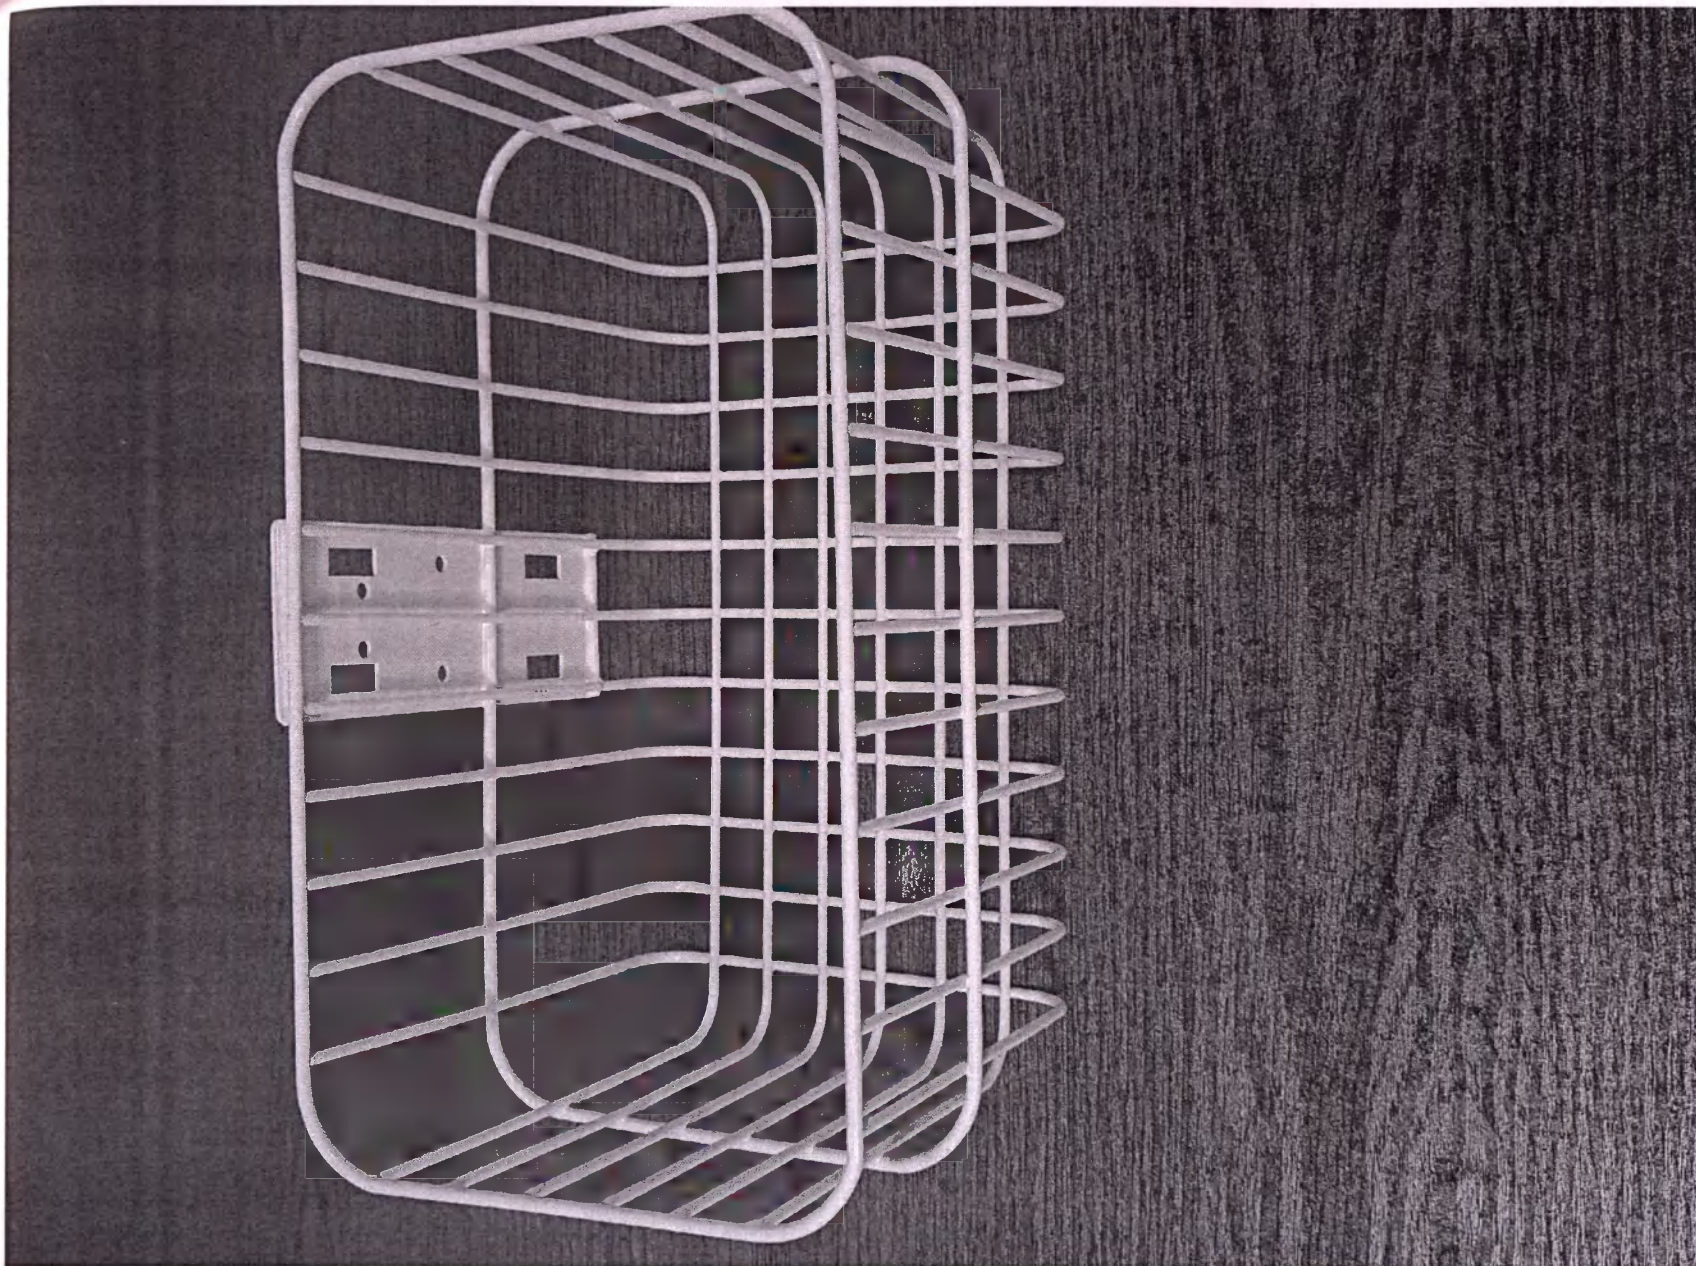

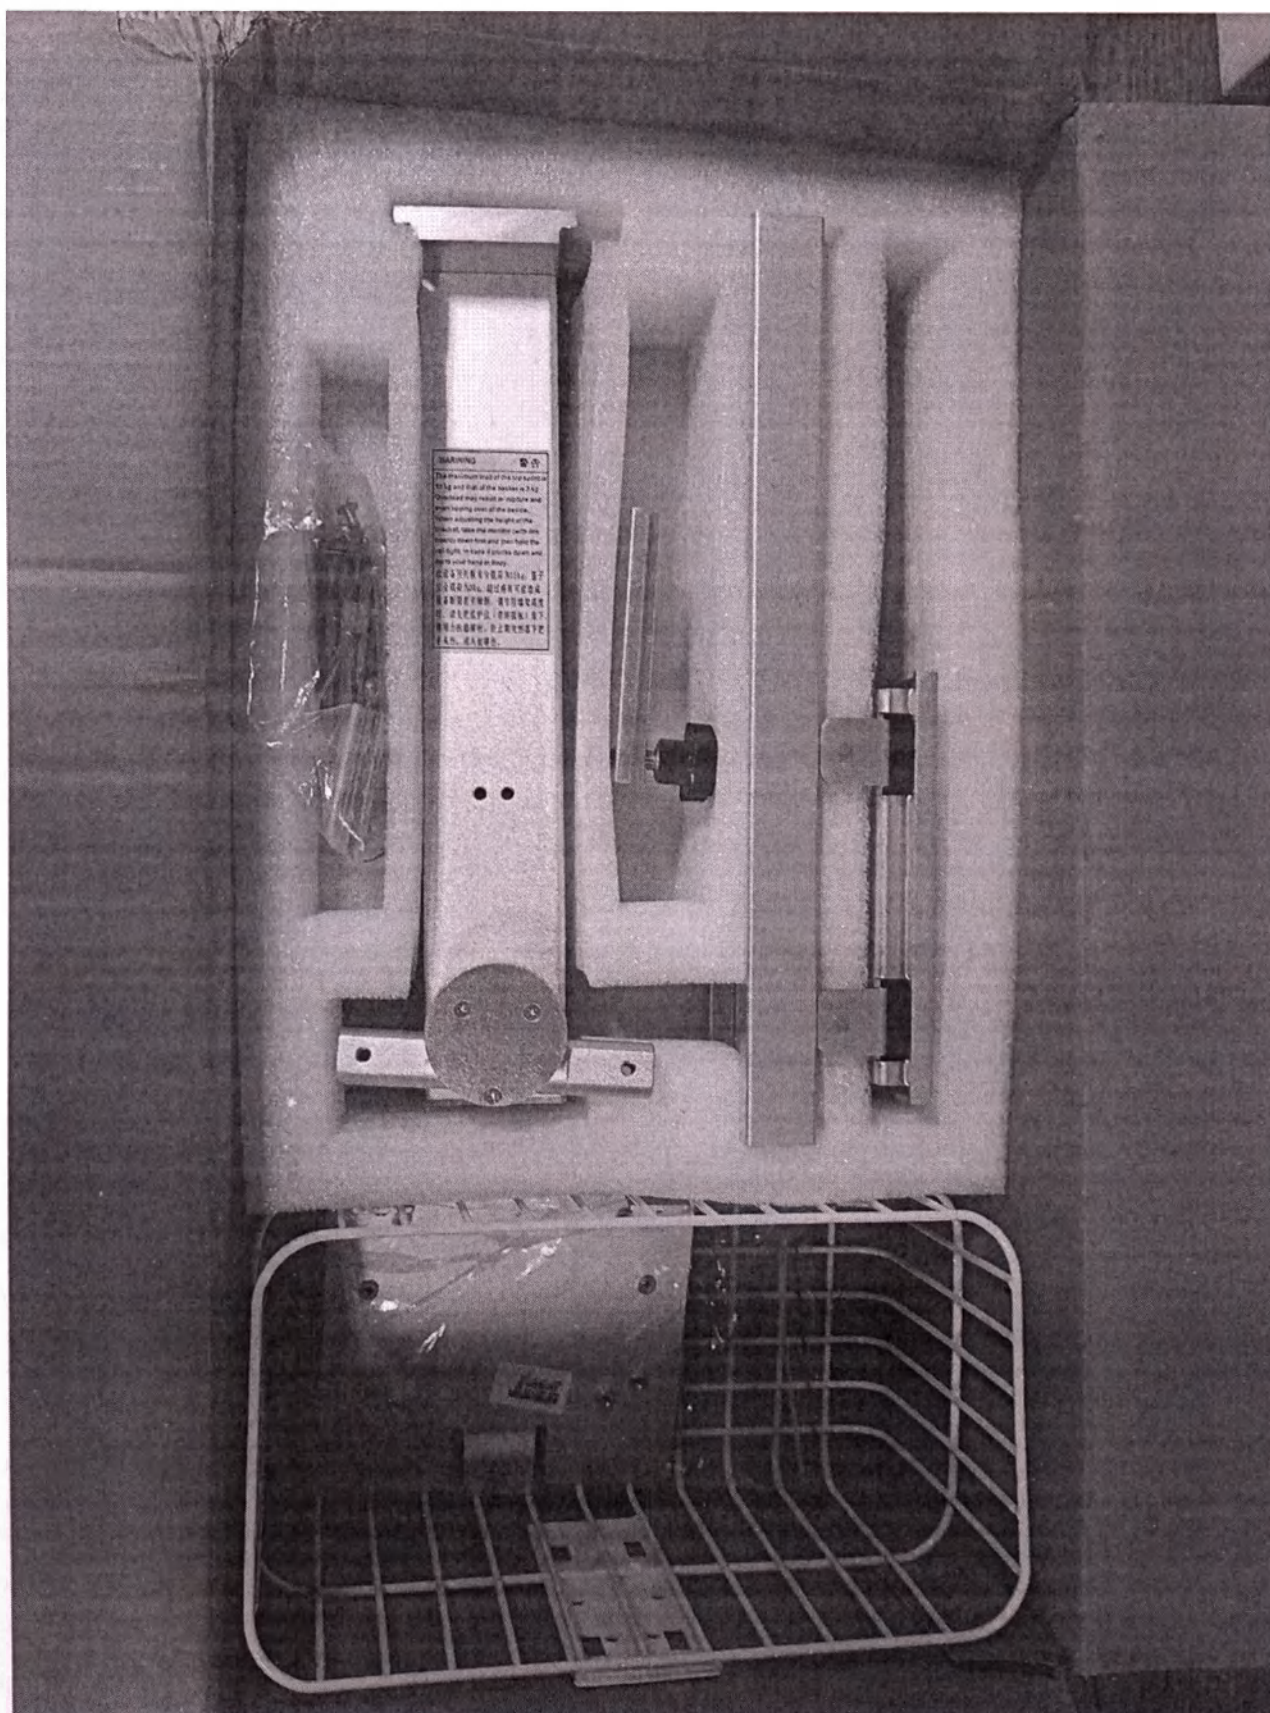

Беспроводная сетевая карта:



Сетевой кабель для сетевой карты:



Принтер:



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

(двадцать один)

