

mindray

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюнь Вэй.
«27» декабря 2022 г.



**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus
(Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»

129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,

пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39

ИНН 7705815069 КПП 770201001



Рисунок 1. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 1)

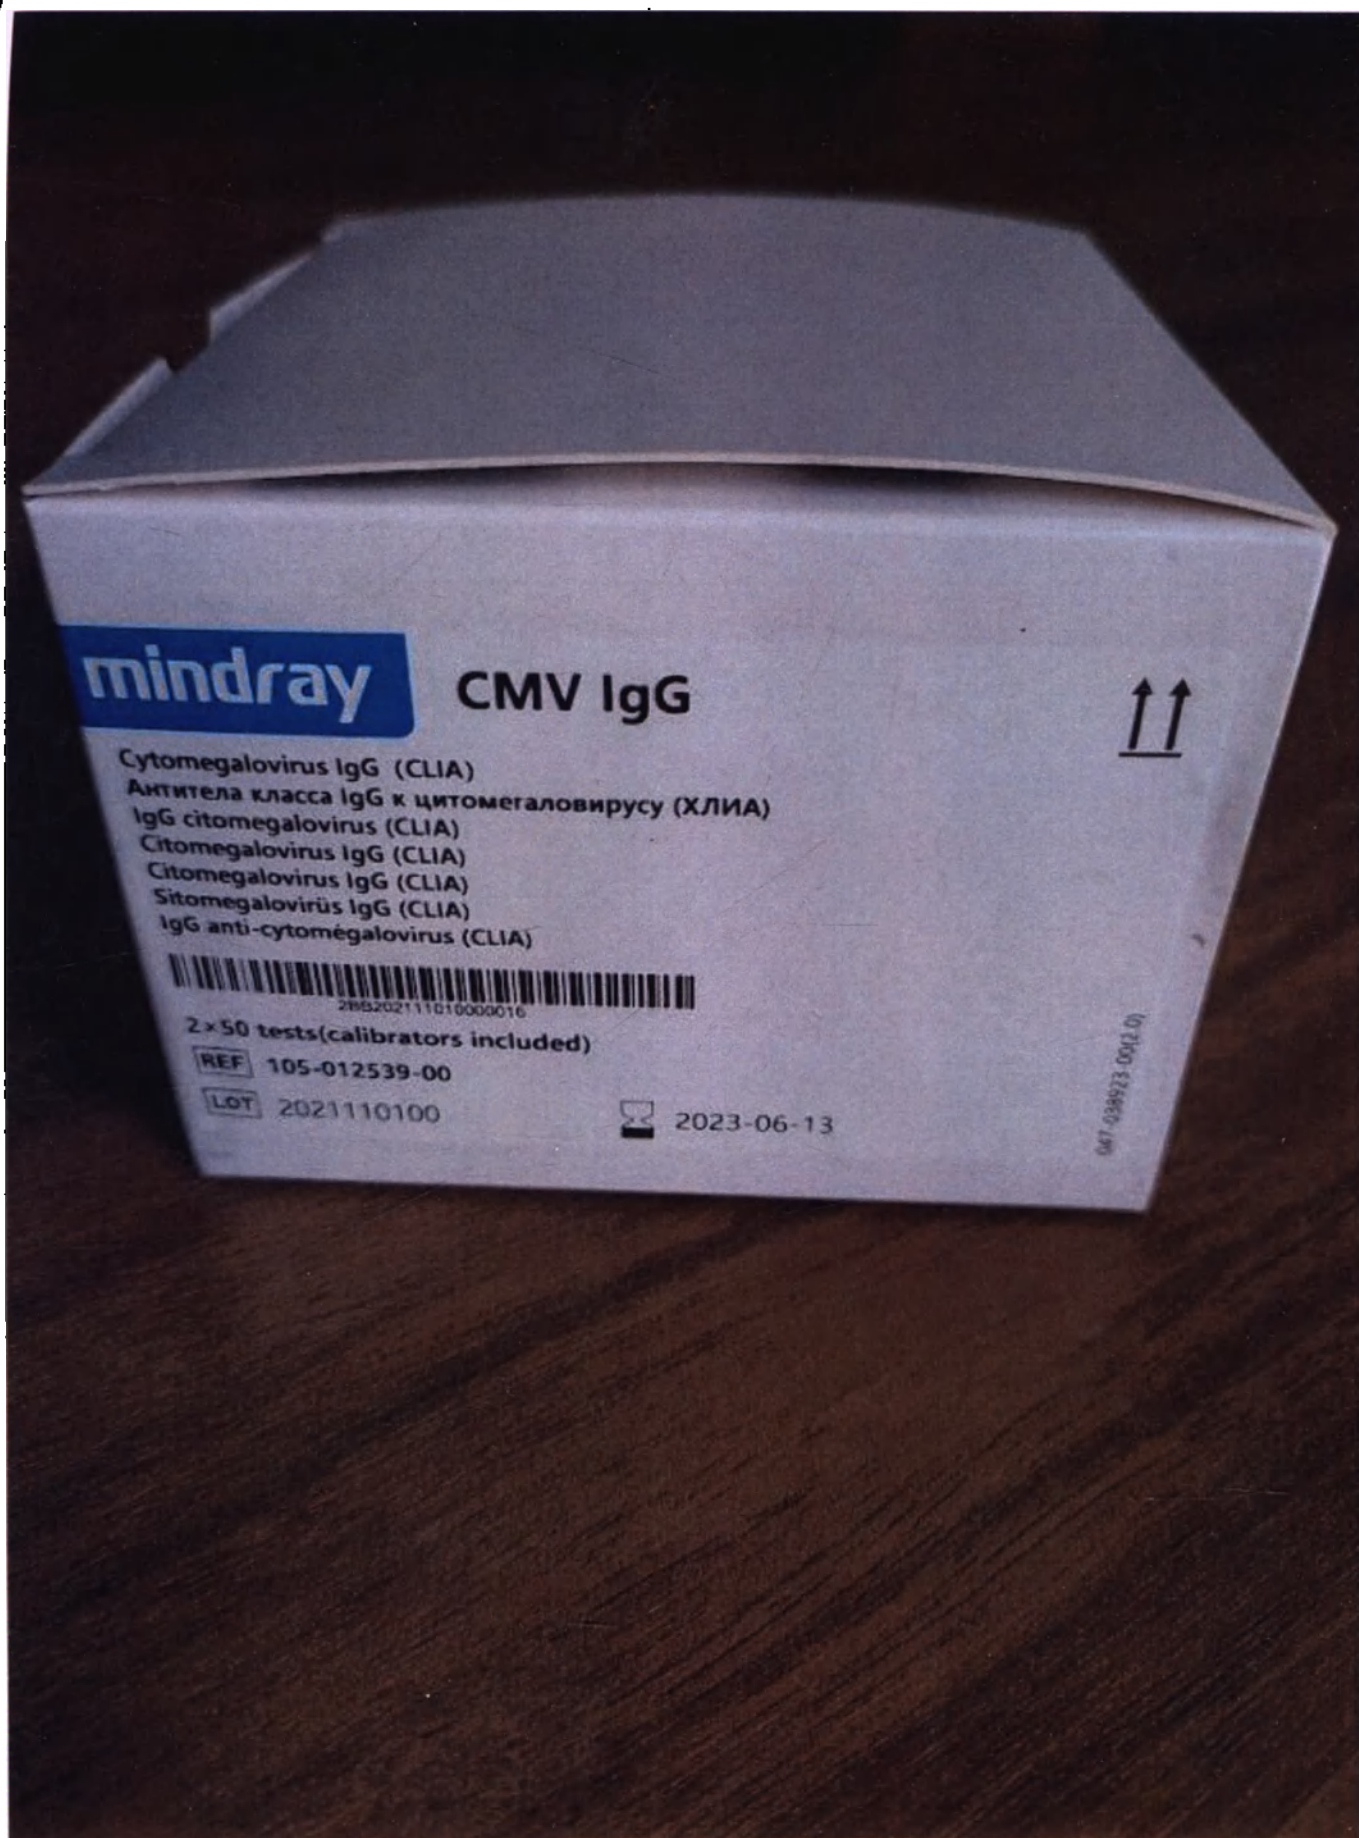


Рисунок 2. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 2)



Рисунок 3. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид3)



Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт (вид 1)



Рисунок 6. Кассета с реагентами - 2 шт (вид 2)

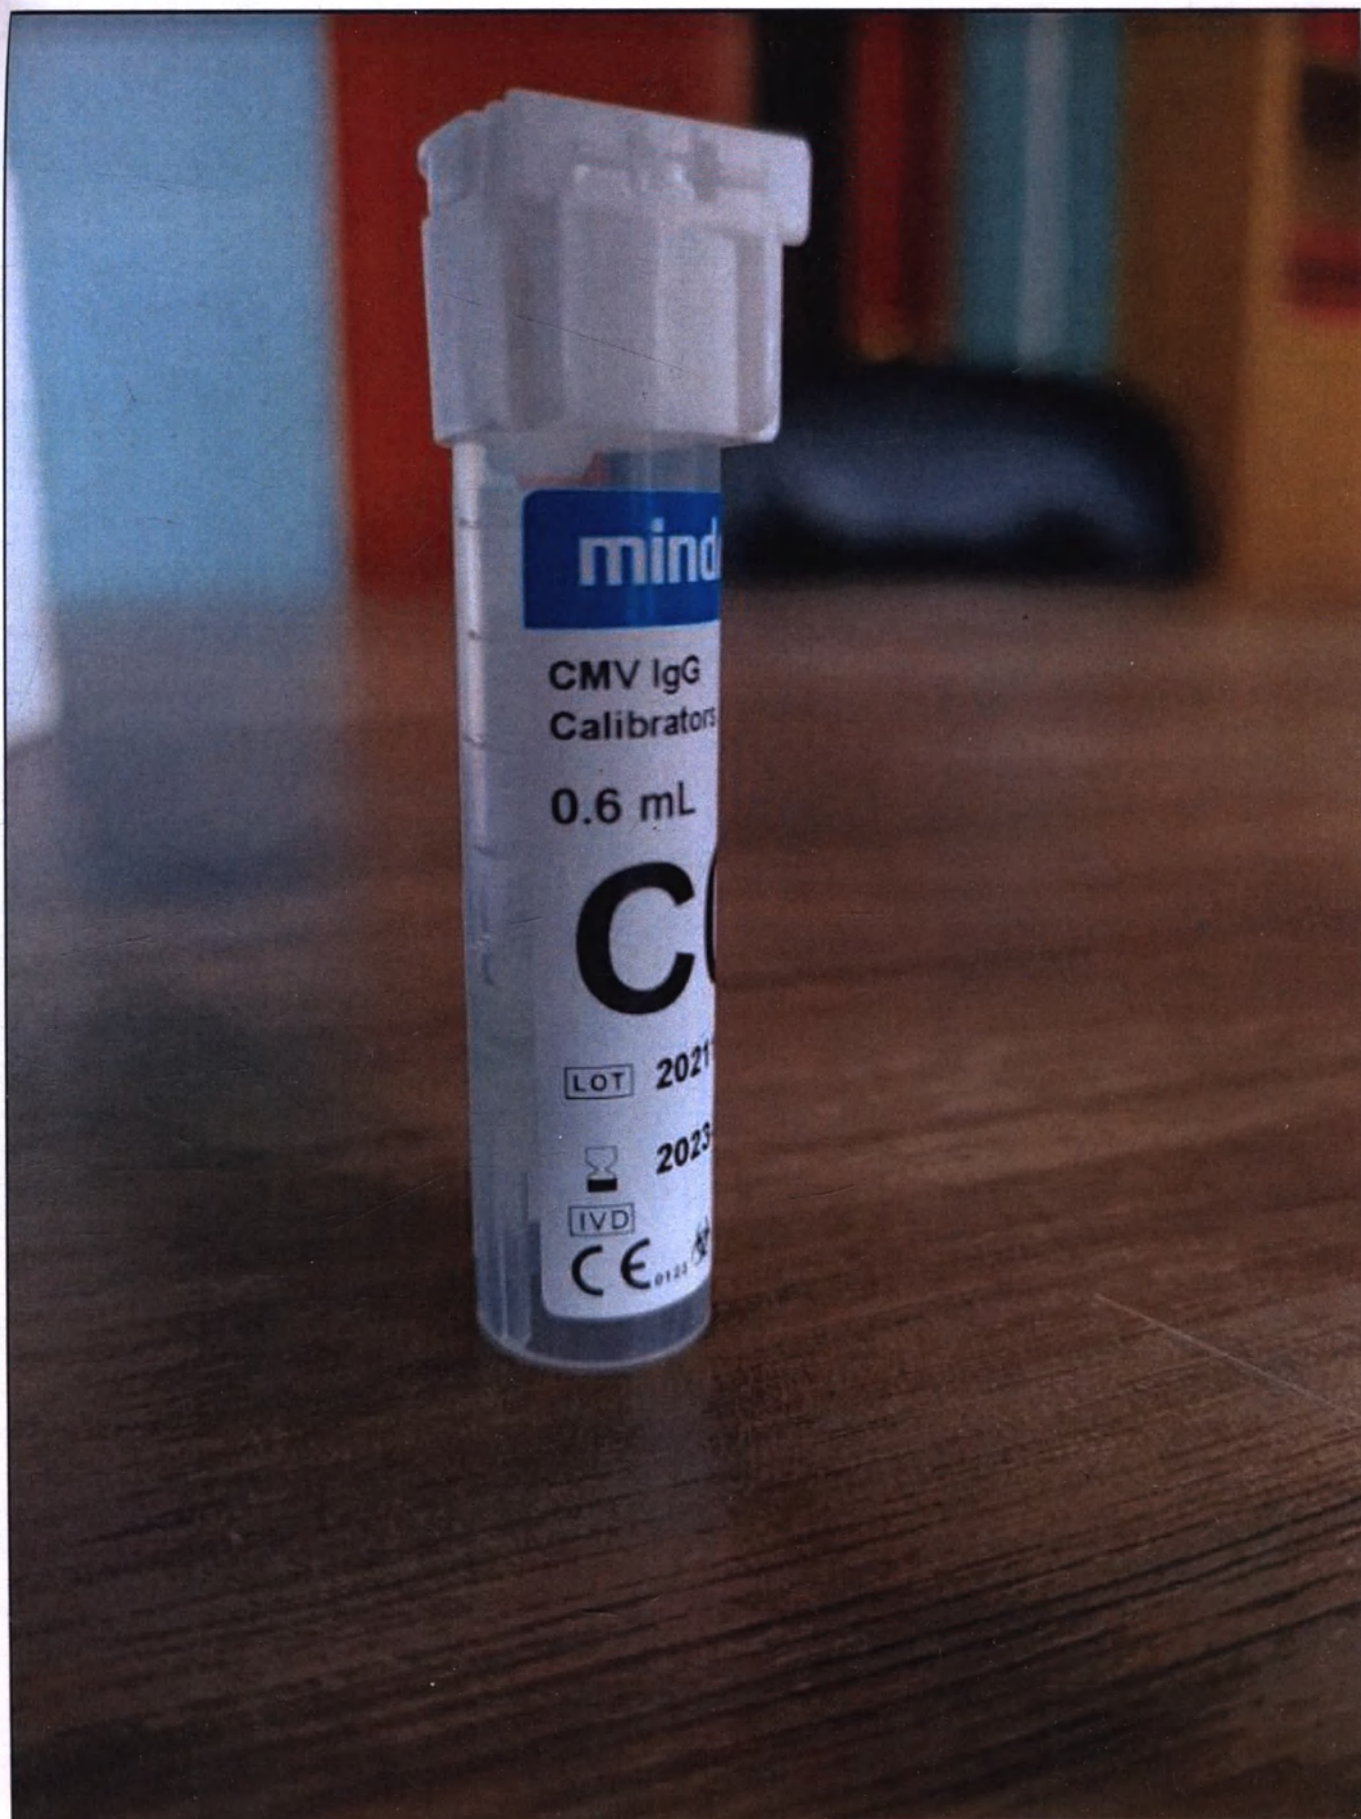


Рисунок 7. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 1)

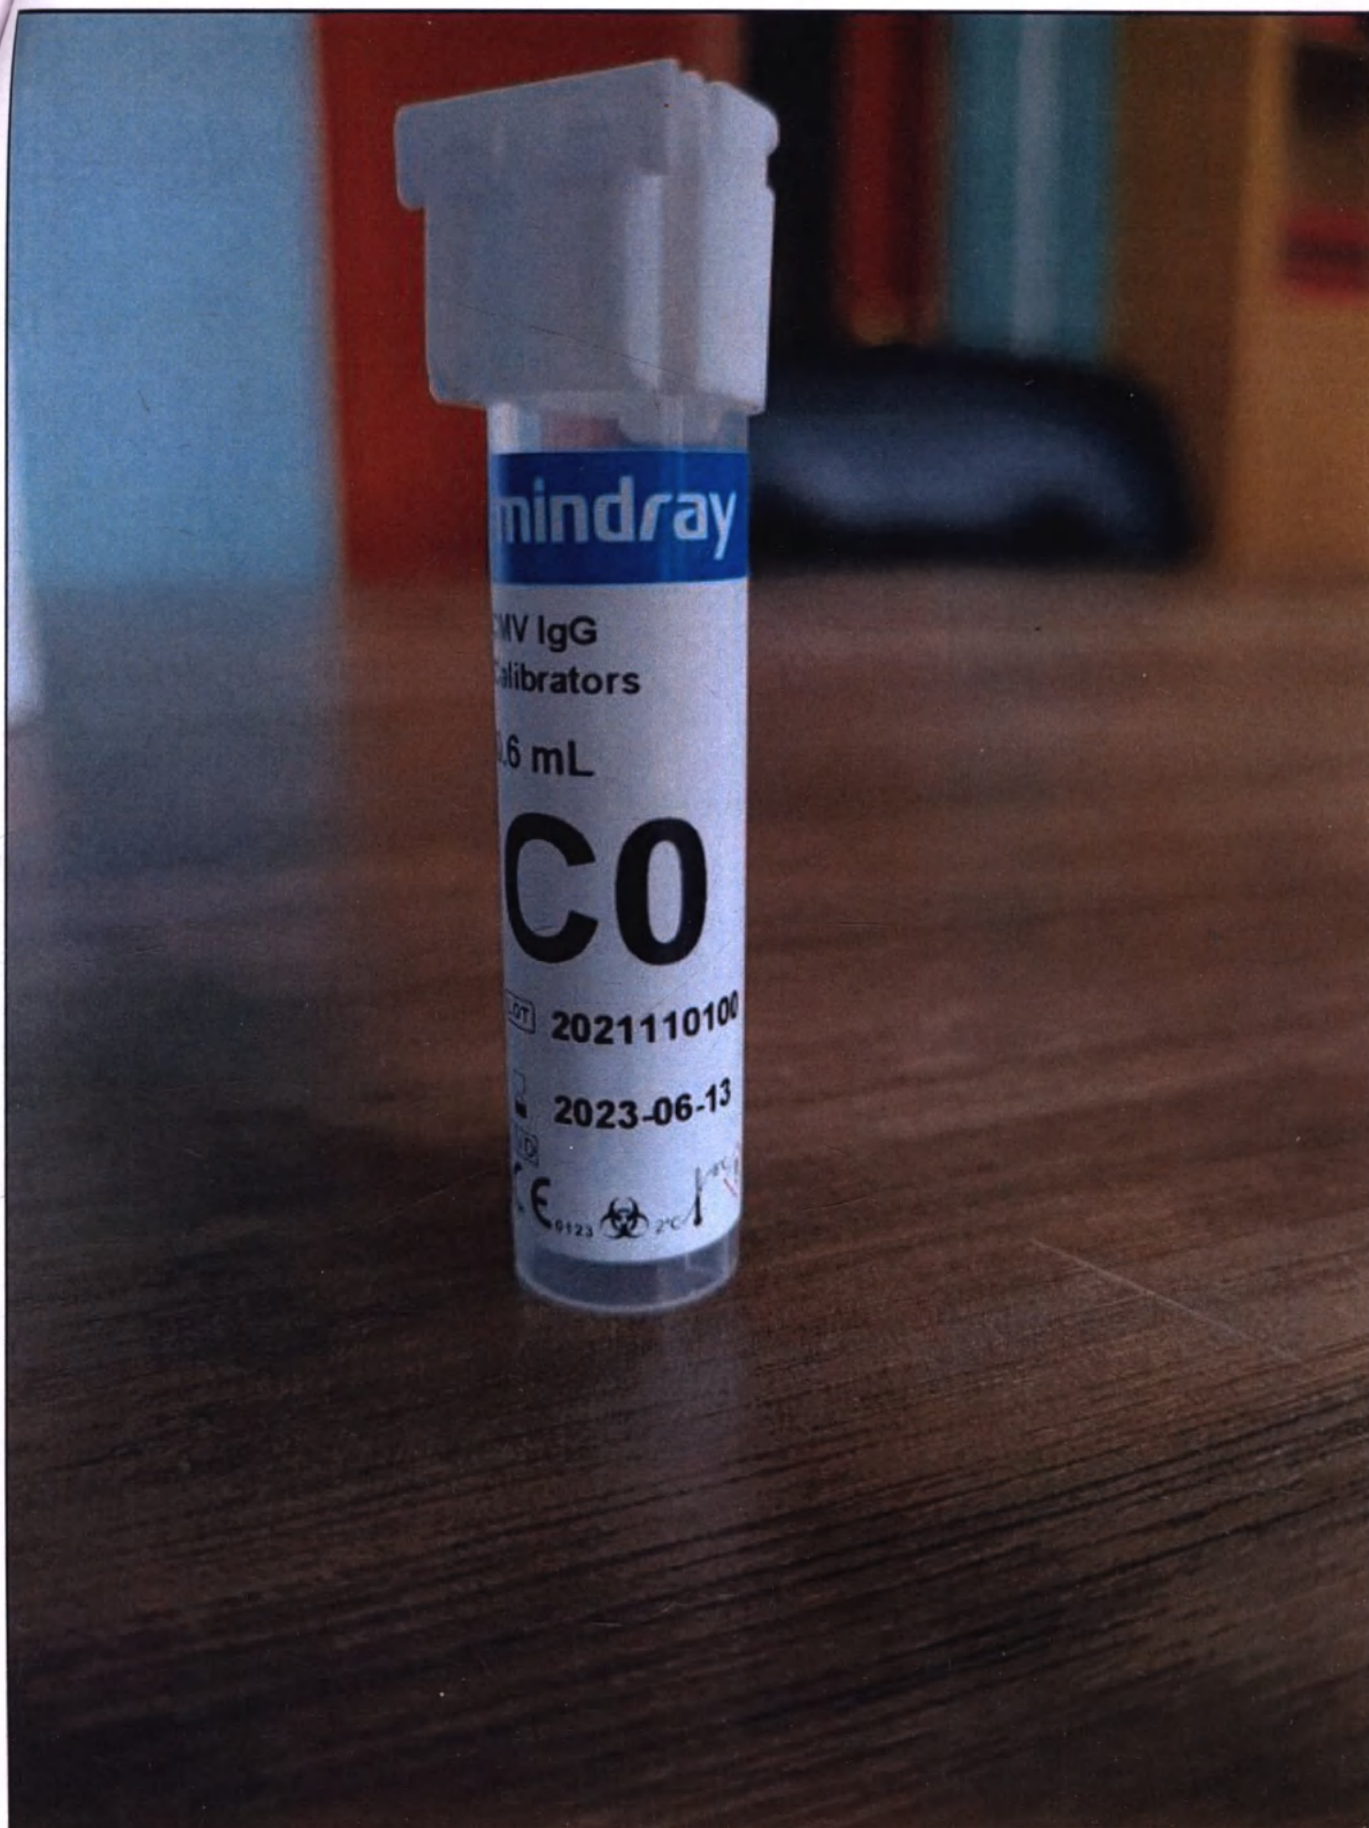


Рисунок 8. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт. (вид2)



Рисунок 9. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид3)



Рисунок 10. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт. (вид 1)



Рисунок 11. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт. (вид 2)



Рисунок 12. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 3)



Рисунок 13. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт. (вид 1)

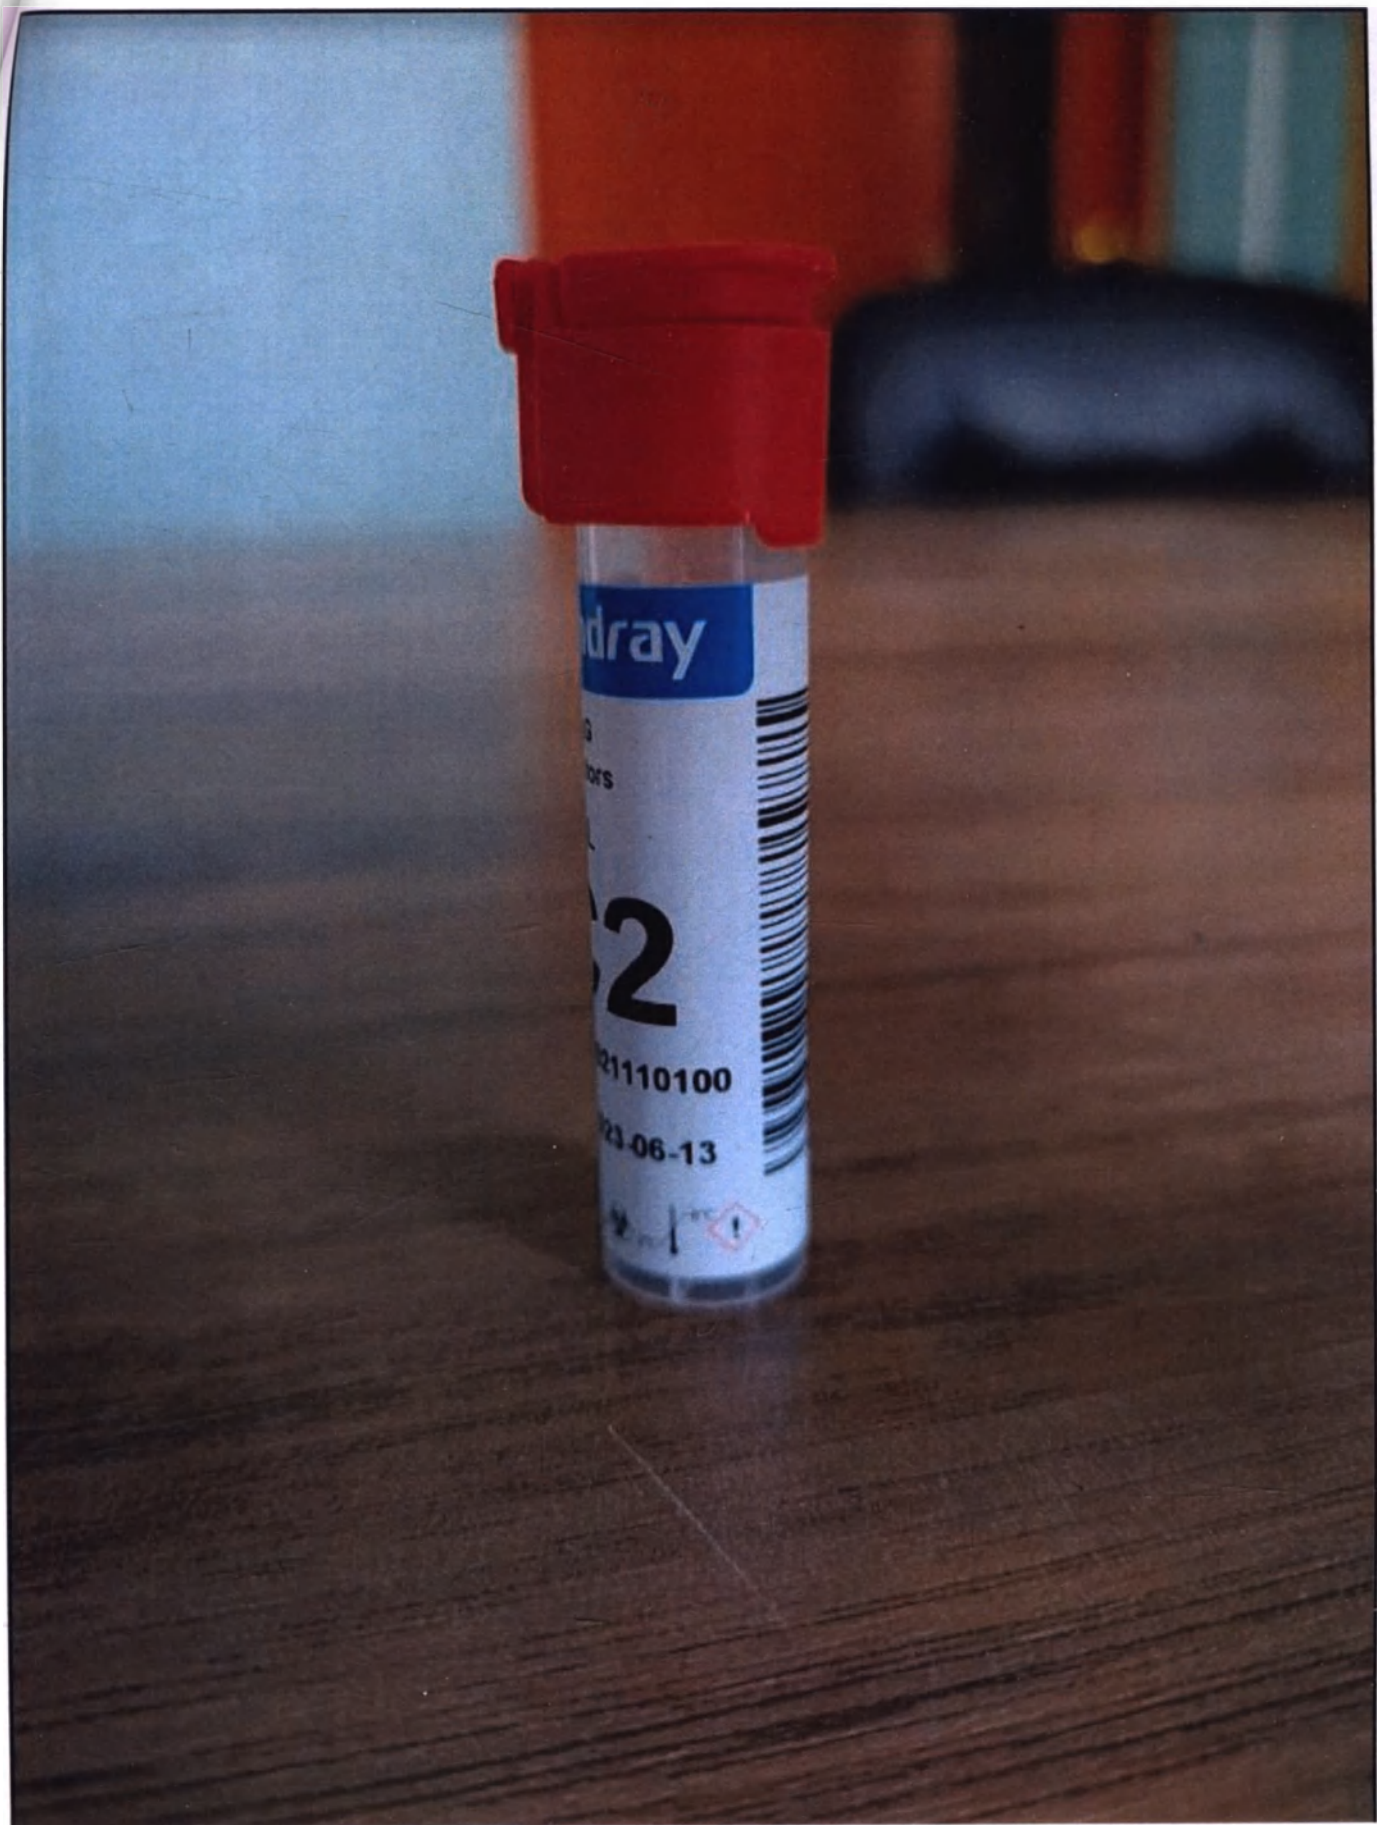


Рисунок 14. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт. (вид 2)

mindray

CMV IgG (CLIA)

Cytomegalovirus IgG (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012536-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012537-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012539-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012540-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series Cytomegalovirus IgG assay is a Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) for the quantitative detection of Cytomegalovirus IgG in human serum and plasma. The results of this assay can be used as an aid in the diagnosis of Cytomegalovirus infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Cytomegalovirus (CMV), a member of the herpes virus family, is ubiquitous in all human populations, causing infections which are followed by life-long latency in the host with occasional reactivations. Serological survey results show that 90% of the population in Asia and Africa have been infected with cytomegalovirus. The serological positive rate increases with age, and there is no significant difference between men and women. Horizontal transmission is the most common route of infection of cytomegalovirus, which is mainly caused by contact with viral secretions, including saliva, urine, feces, cervical or vaginal secretions, semen, etc. In addition, cytomegalovirus can also spread vertically through placenta or cause iatrogenic infection⁽¹⁻²⁾.

Most normal adults and children do not have obvious clinical symptoms after infection with cytomegalovirus. After infection, antibodies can be produced, but the virus can not be completely eliminated. Cytomegalovirus can enter tissue cells through fusion with cell membrane, showing a long-term carrying state. When the

Рисунок 15. Инструкция по применению – 1 шт



Рисунок 16. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 1)

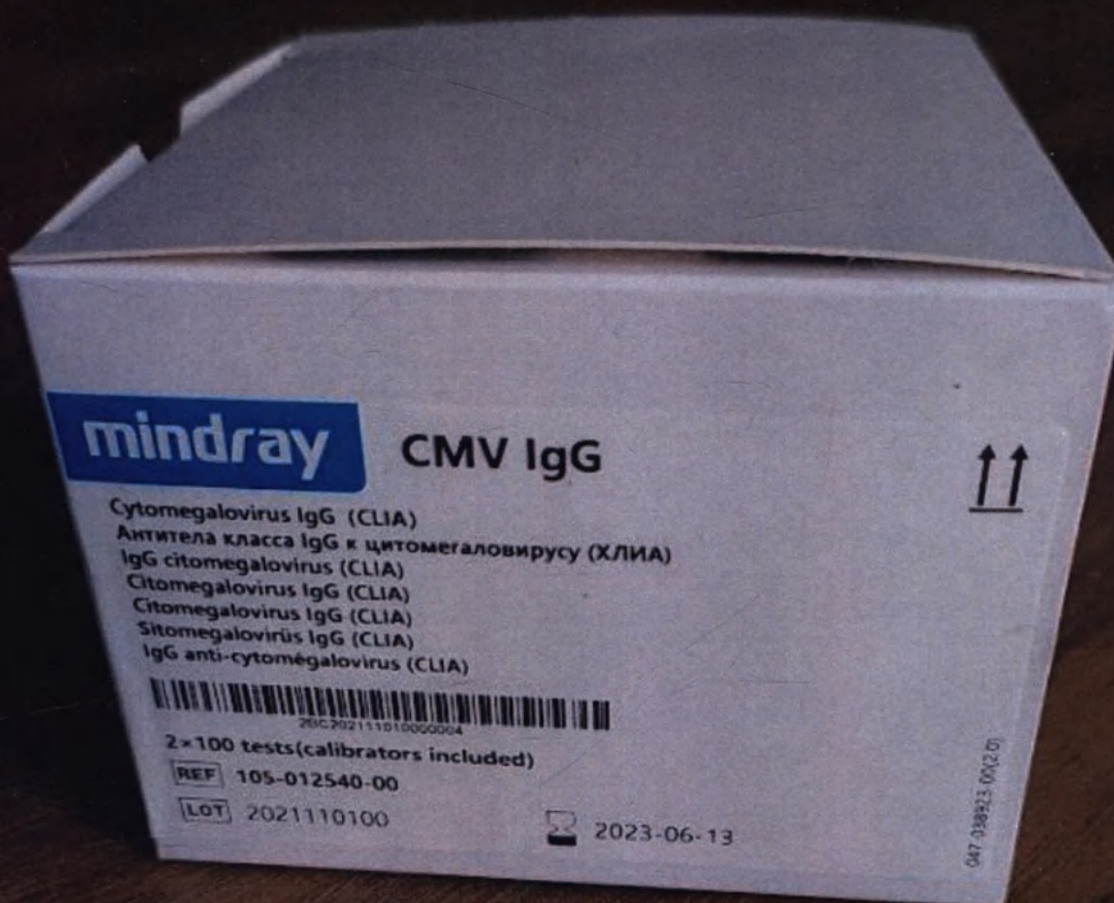


Рисунок 17. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 2)



Рисунок 18. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 3)

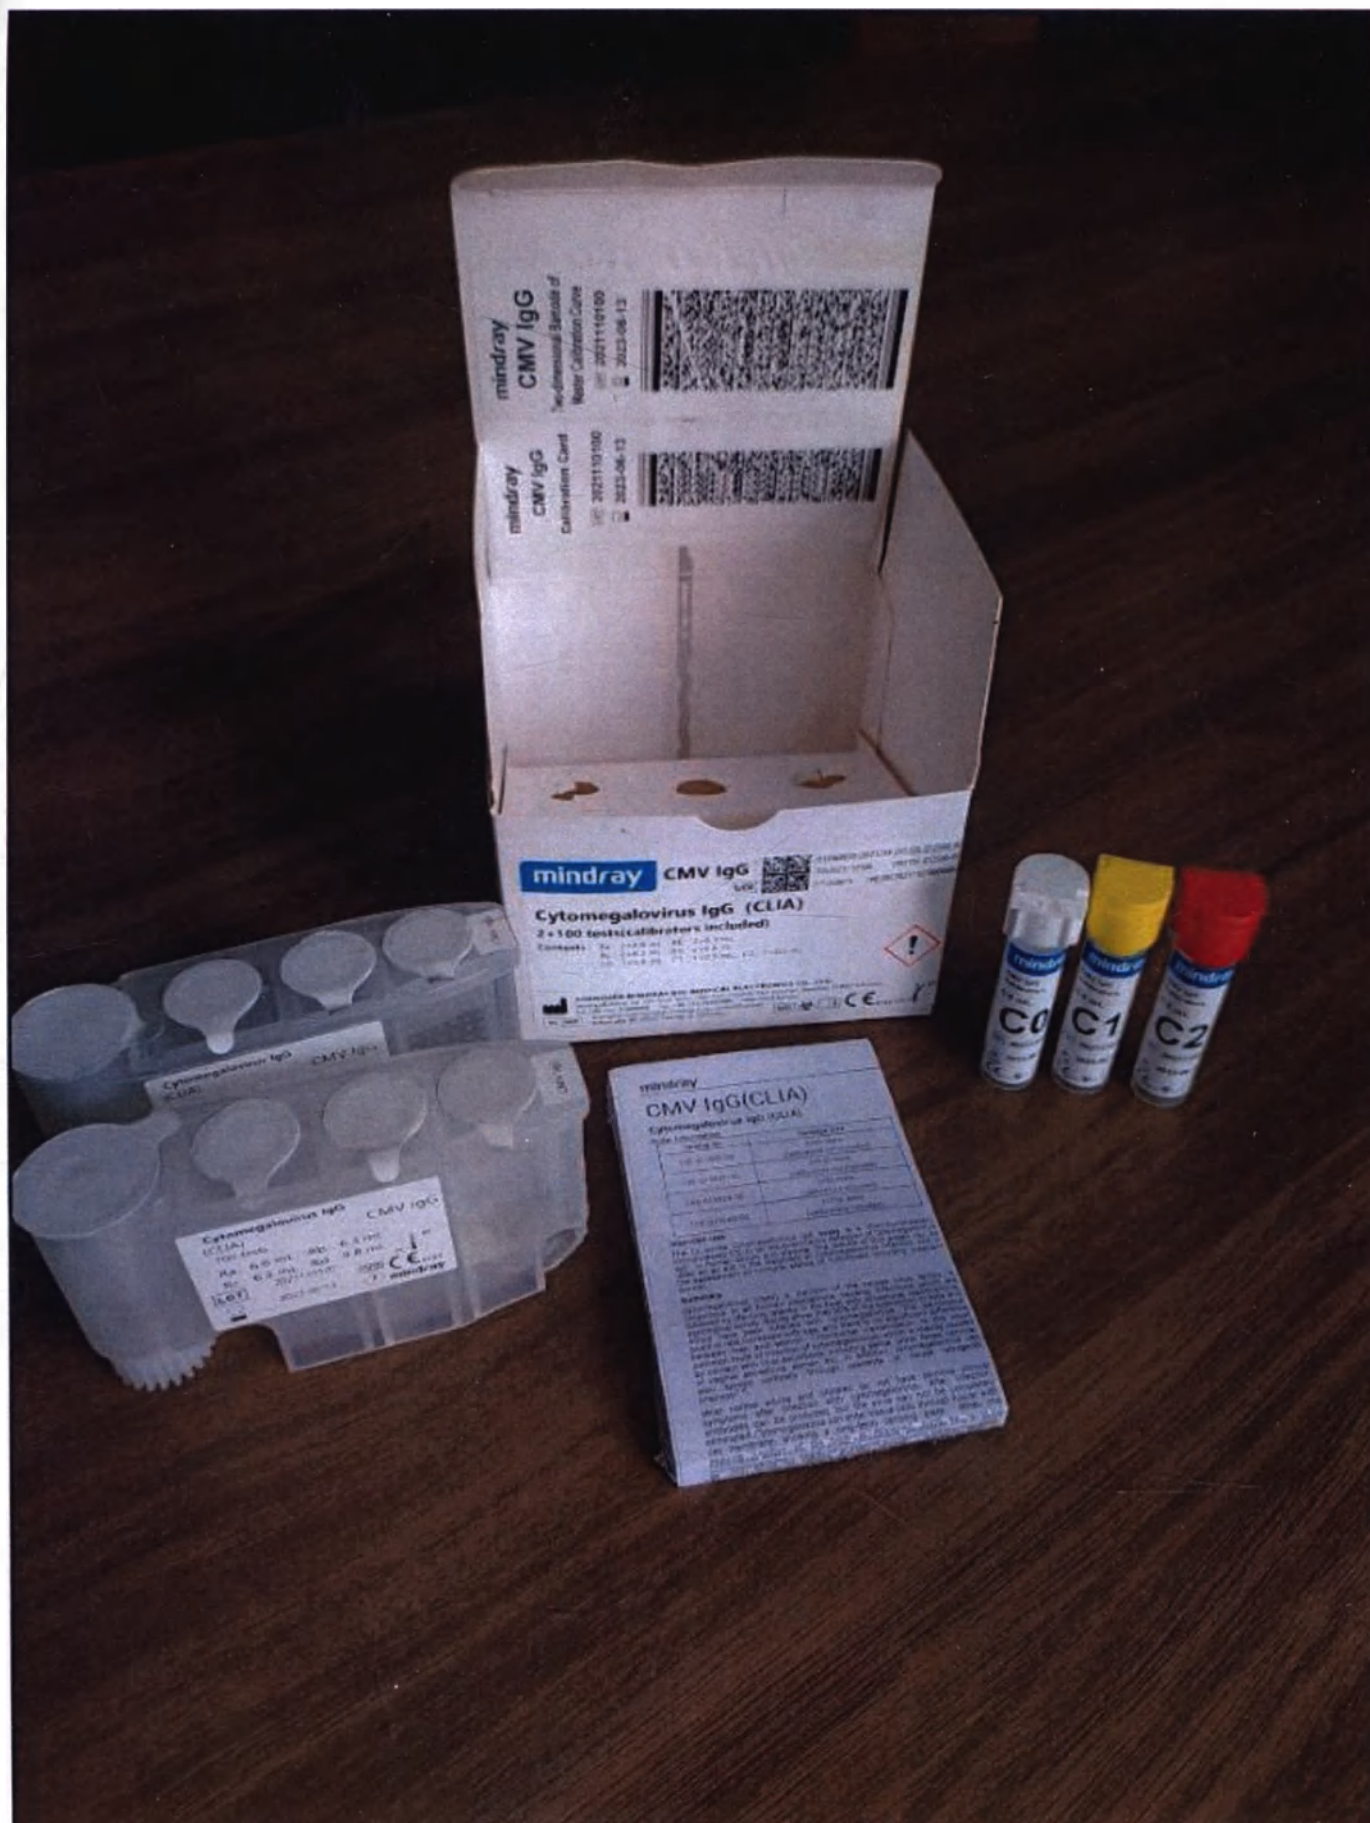


Рисунок 19. Общий вид Набор реагентов для количественного определения IgG к Cytomegalovirus (Cytomegalovirus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен)

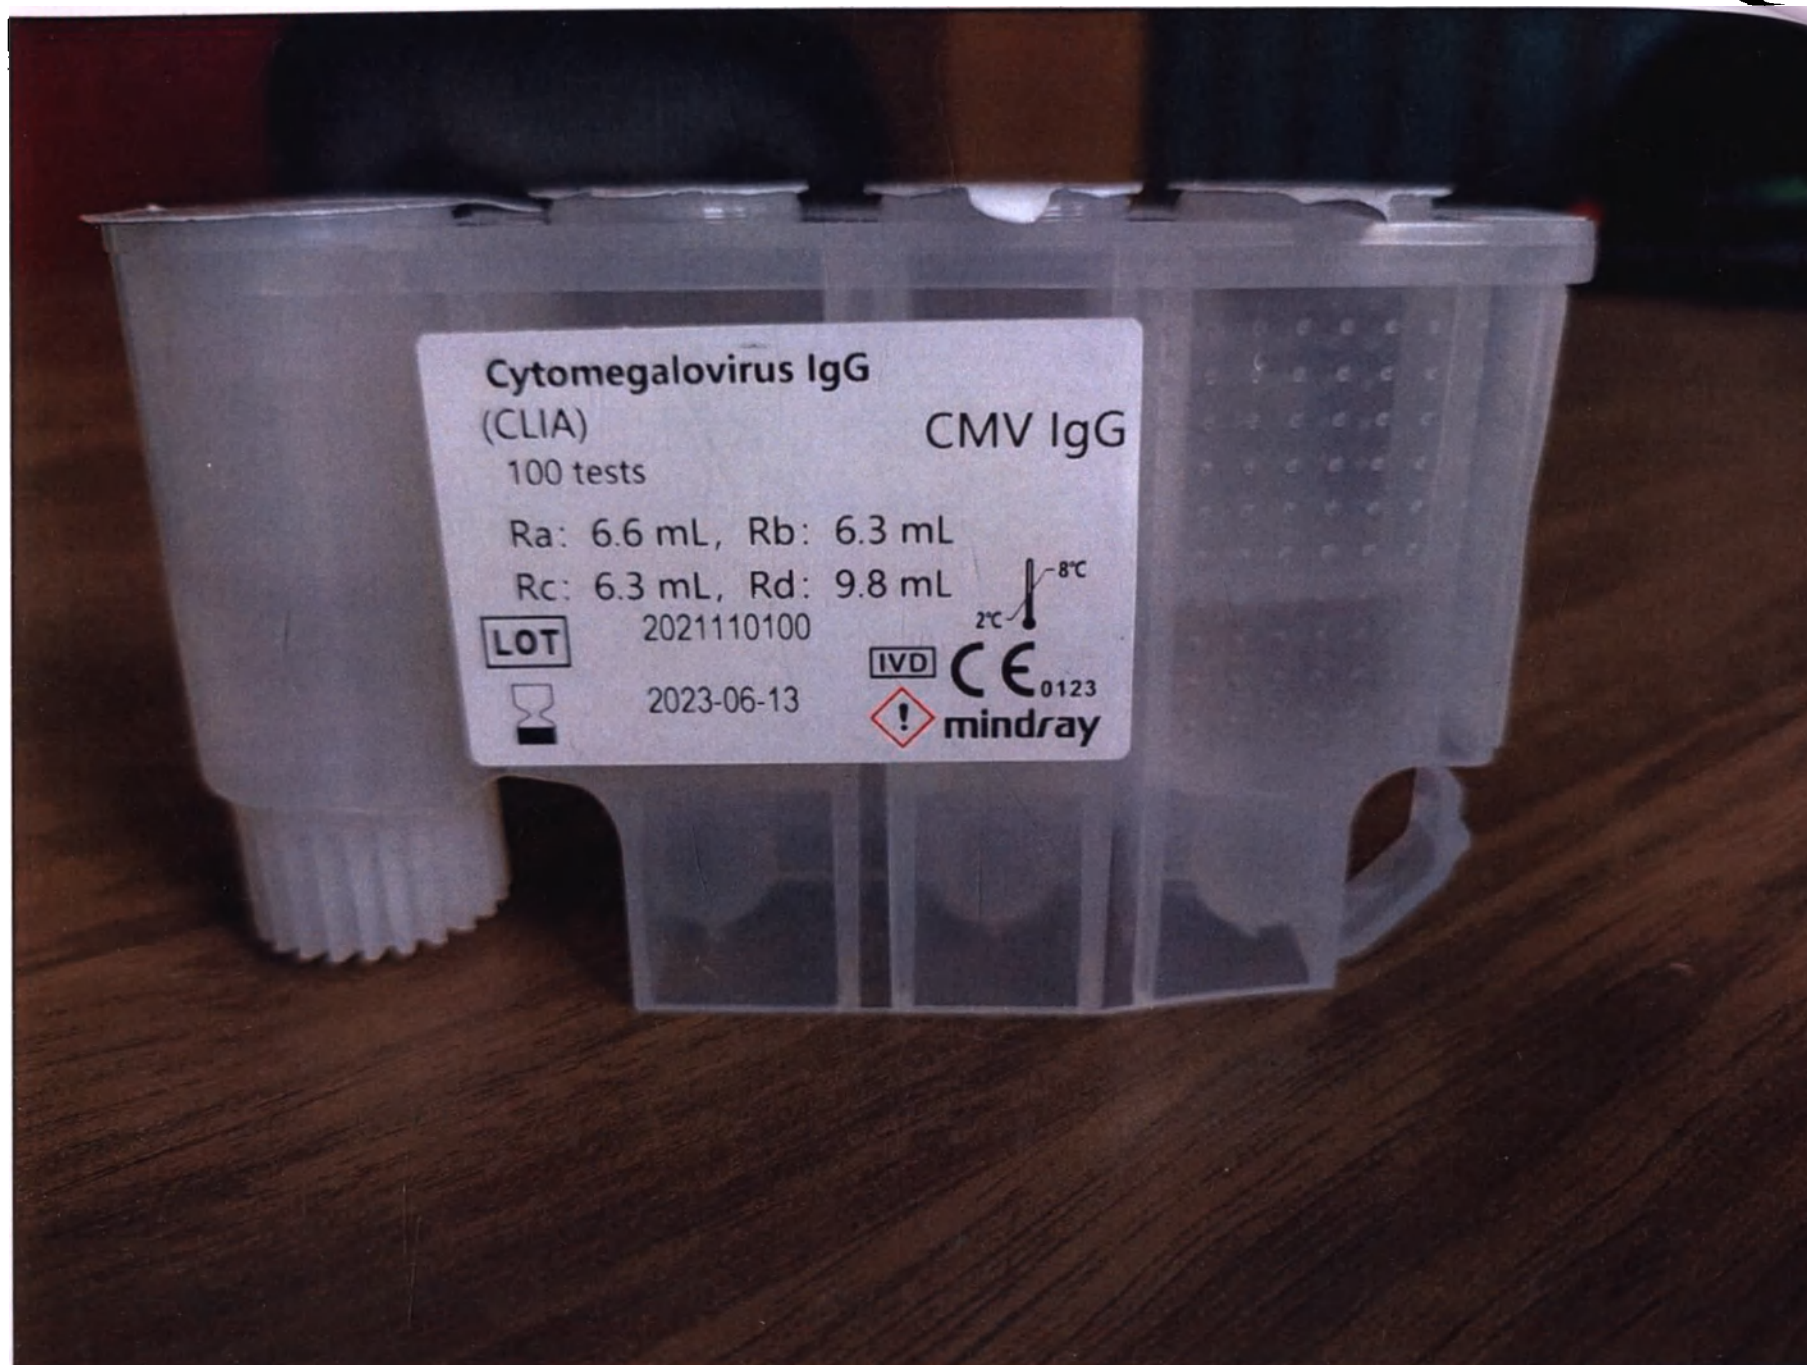


Рисунок 20. Кассета с реагентами - 2 шт



Рисунок 21. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 22. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 23. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 24. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 25. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 1)

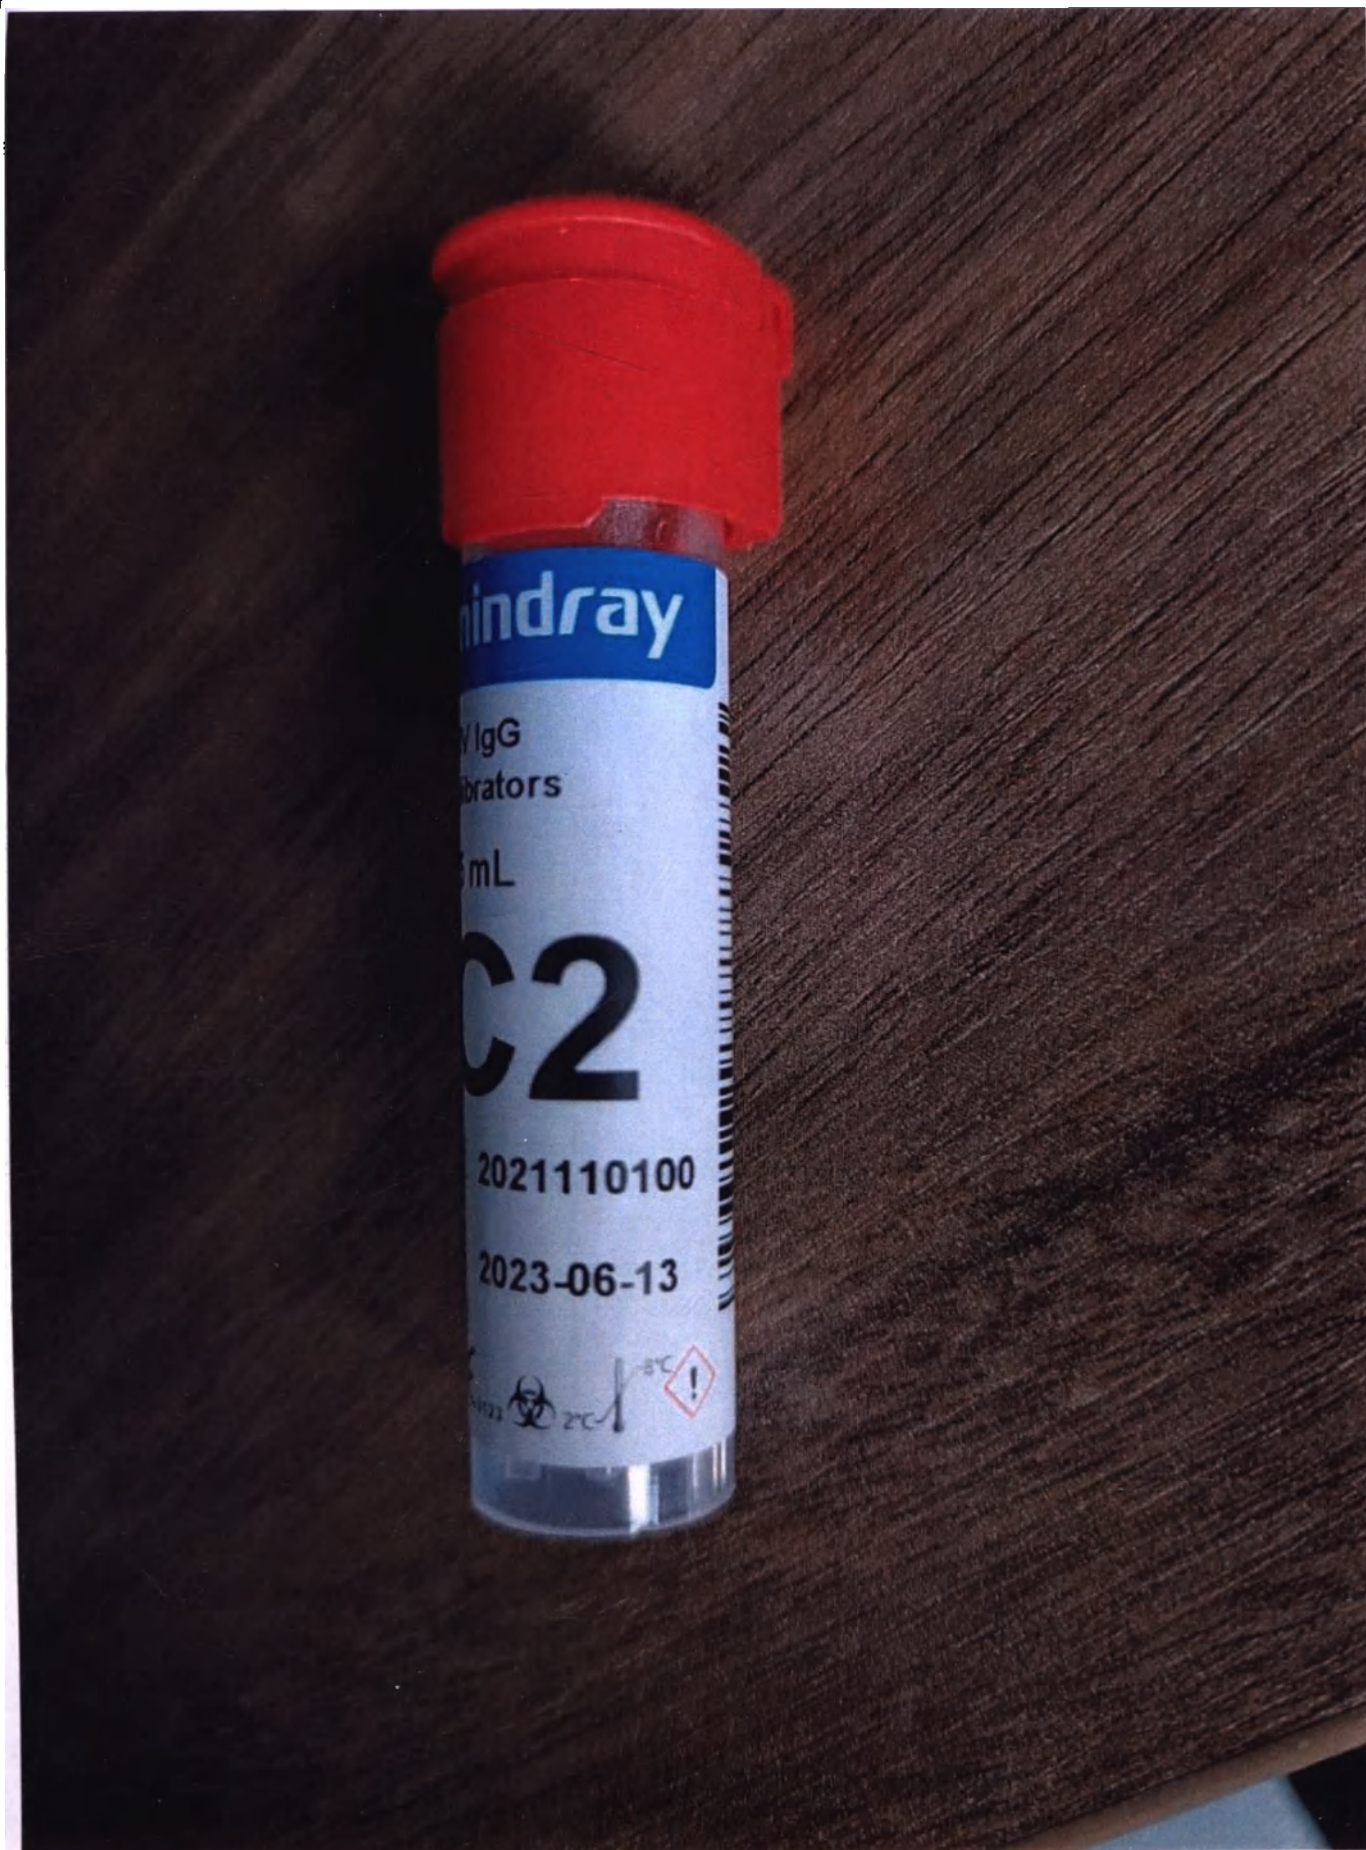


Рисунок 26. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 27. Калибратор (С2), уровень 2 – 1 шт (вид 3)

mindray

CMV IgG(CLIA)

Cytomegalovirus IgG (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012536-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012537-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012539-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012540-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series Cytomegalovirus IgG assay is a Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) for the quantitative detection of Cytomegalovirus IgG in human serum and plasma. The results of this assay can be used as an aid in the diagnosis of Cytomegalovirus infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Cytomegalovirus (CMV), a member of the herpes virus family, is ubiquitous in all human populations, causing infections which are followed by life-long latency in the host with occasional reactivations. Serological survey results show that 90% of the population in Asia and Africa have been infected with cytomegalovirus. The serological positive rate increases with age, and there is no significant difference between men and women. Horizontal transmission is the most common route of infection of cytomegalovirus, which is mainly caused by contact with viral secretions, including saliva, urine, feces, cervical or vaginal secretions, semen, etc. In addition, cytomegalovirus can also spread vertically through placenta or cause iatrogenic infection^[1-2].

Most normal adults and children do not have obvious clinical symptoms after infection with cytomegalovirus. After infection, antibodies can be produced, but the virus can not be completely eliminated. Cytomegalovirus can enter tissue cells through fusion with cell membrane, showing a long-term carrying state. When the immune function of the body is decreased, such as when the

Рисунок 28. Инструкция по применению – 1 шт

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

29

листа (об)

