

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ТД «Альянс»

А.У.о. Сулейманов



» *Сулеев* 2023 г.

# ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

**Соединение трахеостомическое прямое НАС-2**

Shenyang RMS Medical Tech Co., Ltd. («Шэньян Ар-Эм-Эс Медикал Тек Ко., Лтд»), Китай

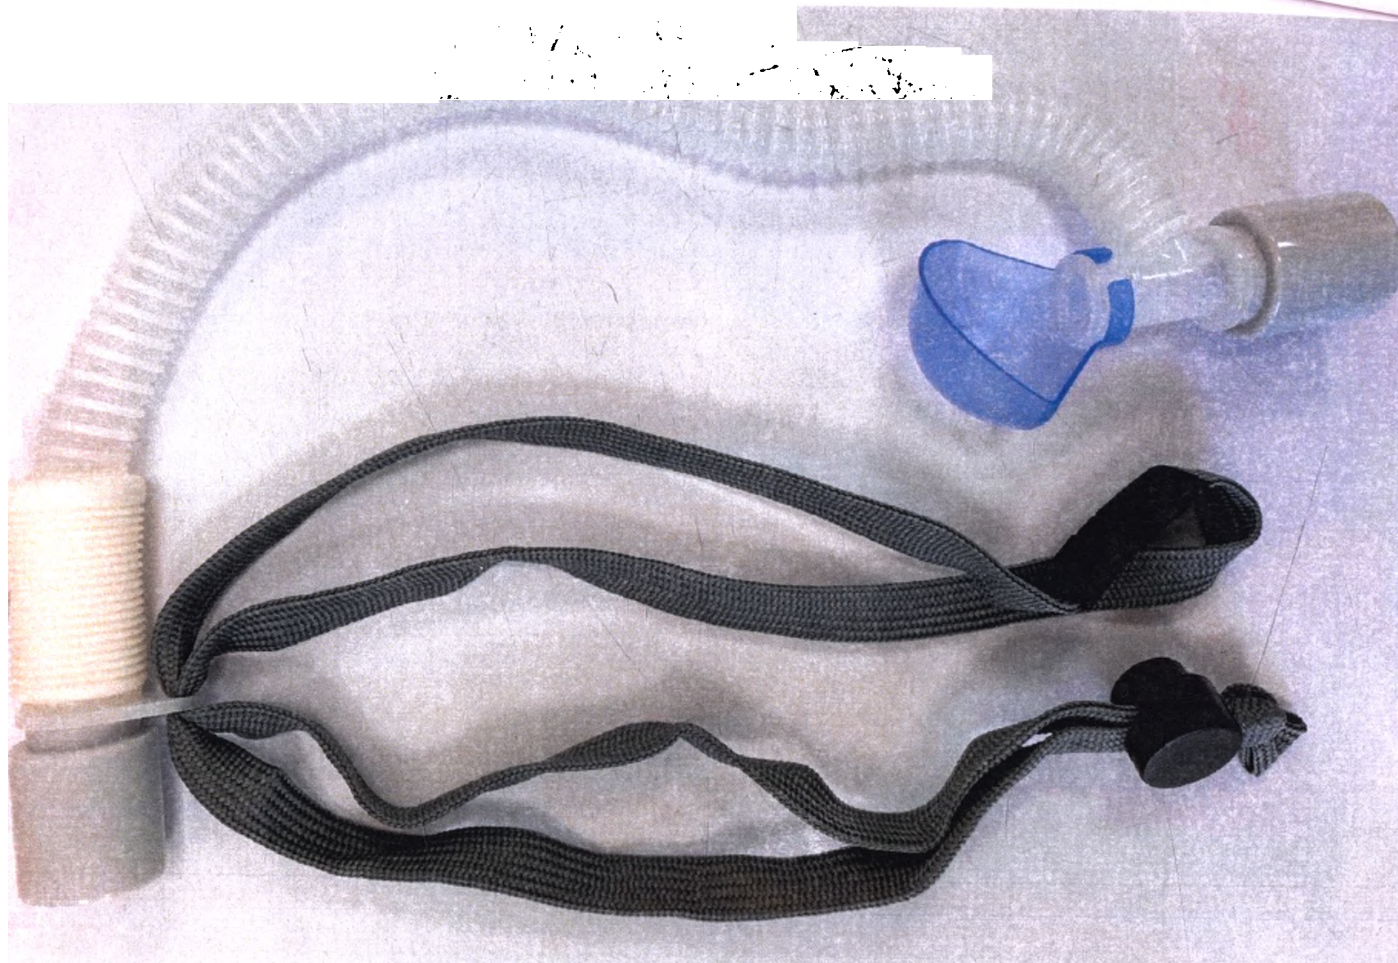


Рисунок 1. Соединение трахеостомическое прямое NAC-2

Shengrong KMS Medical Tech Co., Ltd. (a Chinese company)  
Ap. 2b-3, 3rd Floor, Building 1, Huanan District, Shengrong  
No. 10-1, 10179 Lianjiang P.R. China  
TEL: 0086-022-31682960  
Protein GmbH  
Pohlmann 56, 40219 Düsseldorf, Germany  
Tel: 0049-2131-401968-0

**Сосудистое графическое изображение**  
**Вариант изображения: NAC-2**

CE 019 09 07 2021 08 07 2024

506030903821070901

1. Не использовать при повреждении упаковки  
2. Обращаться к инструкции по применению  
Внимание! Проверить срок годности  
Действительность срока годности 24 мес.  
Использовать в течение срока годности  
специально для хранения в холодильнике  
Срок годности: 24 мес.  
198055, Российская Федерация, г. Москва, улица Ботаника, 20с  
7, этаж 1, комната №4  
Тел: 7701 1788-80  
Р/с № \_\_\_\_\_

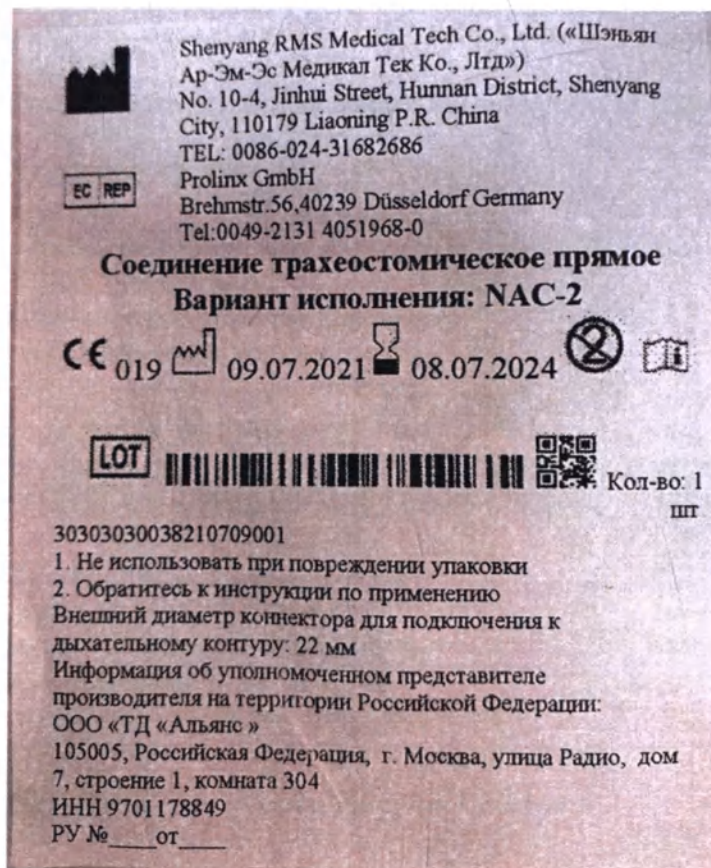


Рисунок 2. Соединение трахеостомическое прямое NAC-2 в потребительской упаковке

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Shenyang RMS Medical Tech Co., Ltd. («Шэньян Ар-Эм-Эс Медикал Тек Ко., Лтд»)</p> <p>No. 10-4, Jinhui Street, Hunnan District, Shenyang City, 110179 Liaoning P.R. China</p> <p>TEL: 0086-024-31682686</p> |
| <div>EC REP</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Prolinx GmbH</p> <p>Brehmstr.56,40239 Düsseldorf Germany</p> <p>Tel:0049-2131 4051968-0</p> <p><b>Соединение трахеостомическое прямое</b></p> <p><b>Вариант исполнения: NAC-2</b></p>                     |
| <div> <div>CE 0197</div> <div> 02-02-2019</div> <div> 02-02-2022</div> <div></div> <div></div> </div>                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
| <div> <div>LOT</div> <div></div> <div>303030038190202001</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| <div> <div>1. Не использовать при повреждении упаковки</div> <div>2. Обратитесь к инструкции по применению</div> <div>Внешний диаметр коннектора для подключения к дыхательному контуру: 22 мм</div> <div>Информация об уполномоченном представителе производителя на территории Российской Федерации:</div> <div>ООО «ТД «Альянс »</div> <div>105005, Российская Федерация, г. Москва, улица Радио, дом 7, строение 1, комната 304</div> <div>ИНН 9701178849</div> <div>РУ № ____ от ____</div> </div> |                                                                                                                                                                                                              |
| <div> <div></div> <div>Кол-во: 1 шт.</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |

Рисунок 3. Проект стикера маркировки потребительской упаковки


|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Соединение трахеостомическое прямое</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Вариант исполнения</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>NAC-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Количество</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>15 шт</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                 | Shenyang RMS Medical Tech Co., Ltd. («Шэньян Ар-Эм-Эс Медикал<br>Тек Ко., Лтд»)<br>No. 10-4, Jinhui Street, Hunnan District, Shenyang City, 110179<br>Liaoning P.R. China                                                                                         |
| Информация об уполномоченном представителе производителя на<br>территории Российской Федерации:<br>ООО «ТД «Альянс»<br>105005, Российская Федерация, г. Москва, улица Радио, дом 7, строение 1,<br>комната 304<br>ИНН 9701178849 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | <br><br> |
| РУ № _____ от _____                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Рисунок 4. Проект стикера маркировки транспортной упаковки

Прошито и скреплено печатью

6 / шесть листов

Генеральный директор Общества с  
ограниченной ответственностью «Торговый дом  
«Альянс»



 Сулейманов А.У.о.