




УТВЕРЖДАЮ
Финансовый директор
ЗАО "АНАЛИТИКА"
 В.Г. Гуляева

Фотографические изображения медицинского изделия

Реагент для количественного определения содержания неорганического
фосфора в сыворотке крови человека (Phosphorus liquirapid)

ETI10027300-2

PHOSPHORUS liquirapid HumaStar

Σ 120

LOT

REF 10027300

LOT 22003

RGT / R1 4 x 30 Σ 0013



2024-04-30

2...25°C

IVD



CE



Warning

H290, H315, H319

(01)04033145192084

(10)22003(93)0(17)240430

human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21·65205 Wiesbaden Germany

Human

Diagnostics Worldwide

Реагент для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови человека (Phosphorus liquidrapid)

Вариант исполнения I, в составе:

- Реагент окрашивающий (R1), 4 флакона по 30 тестов,
- Инструкция по применению, 1 шт.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Температура хранения и транспортирования от +2 °C до +25 °C

Регистрационное Удостоверение №: РЗН ____ от ____ г.

Медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения,

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",


129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1.

Символы, применяемые в маркировке изделия, приведены на оригинальной упаковке.

Кат. №: 10027300

ЛОТ №: 22003


Годен до: 30.04.2024




human

Diagnostics Worldwide

Фотографическое изображение 2 – Внешний вид потребительской упаковки Реагента «Phosphorus liquidrapid» с русскоязычным стикером, Вариант исполнения I

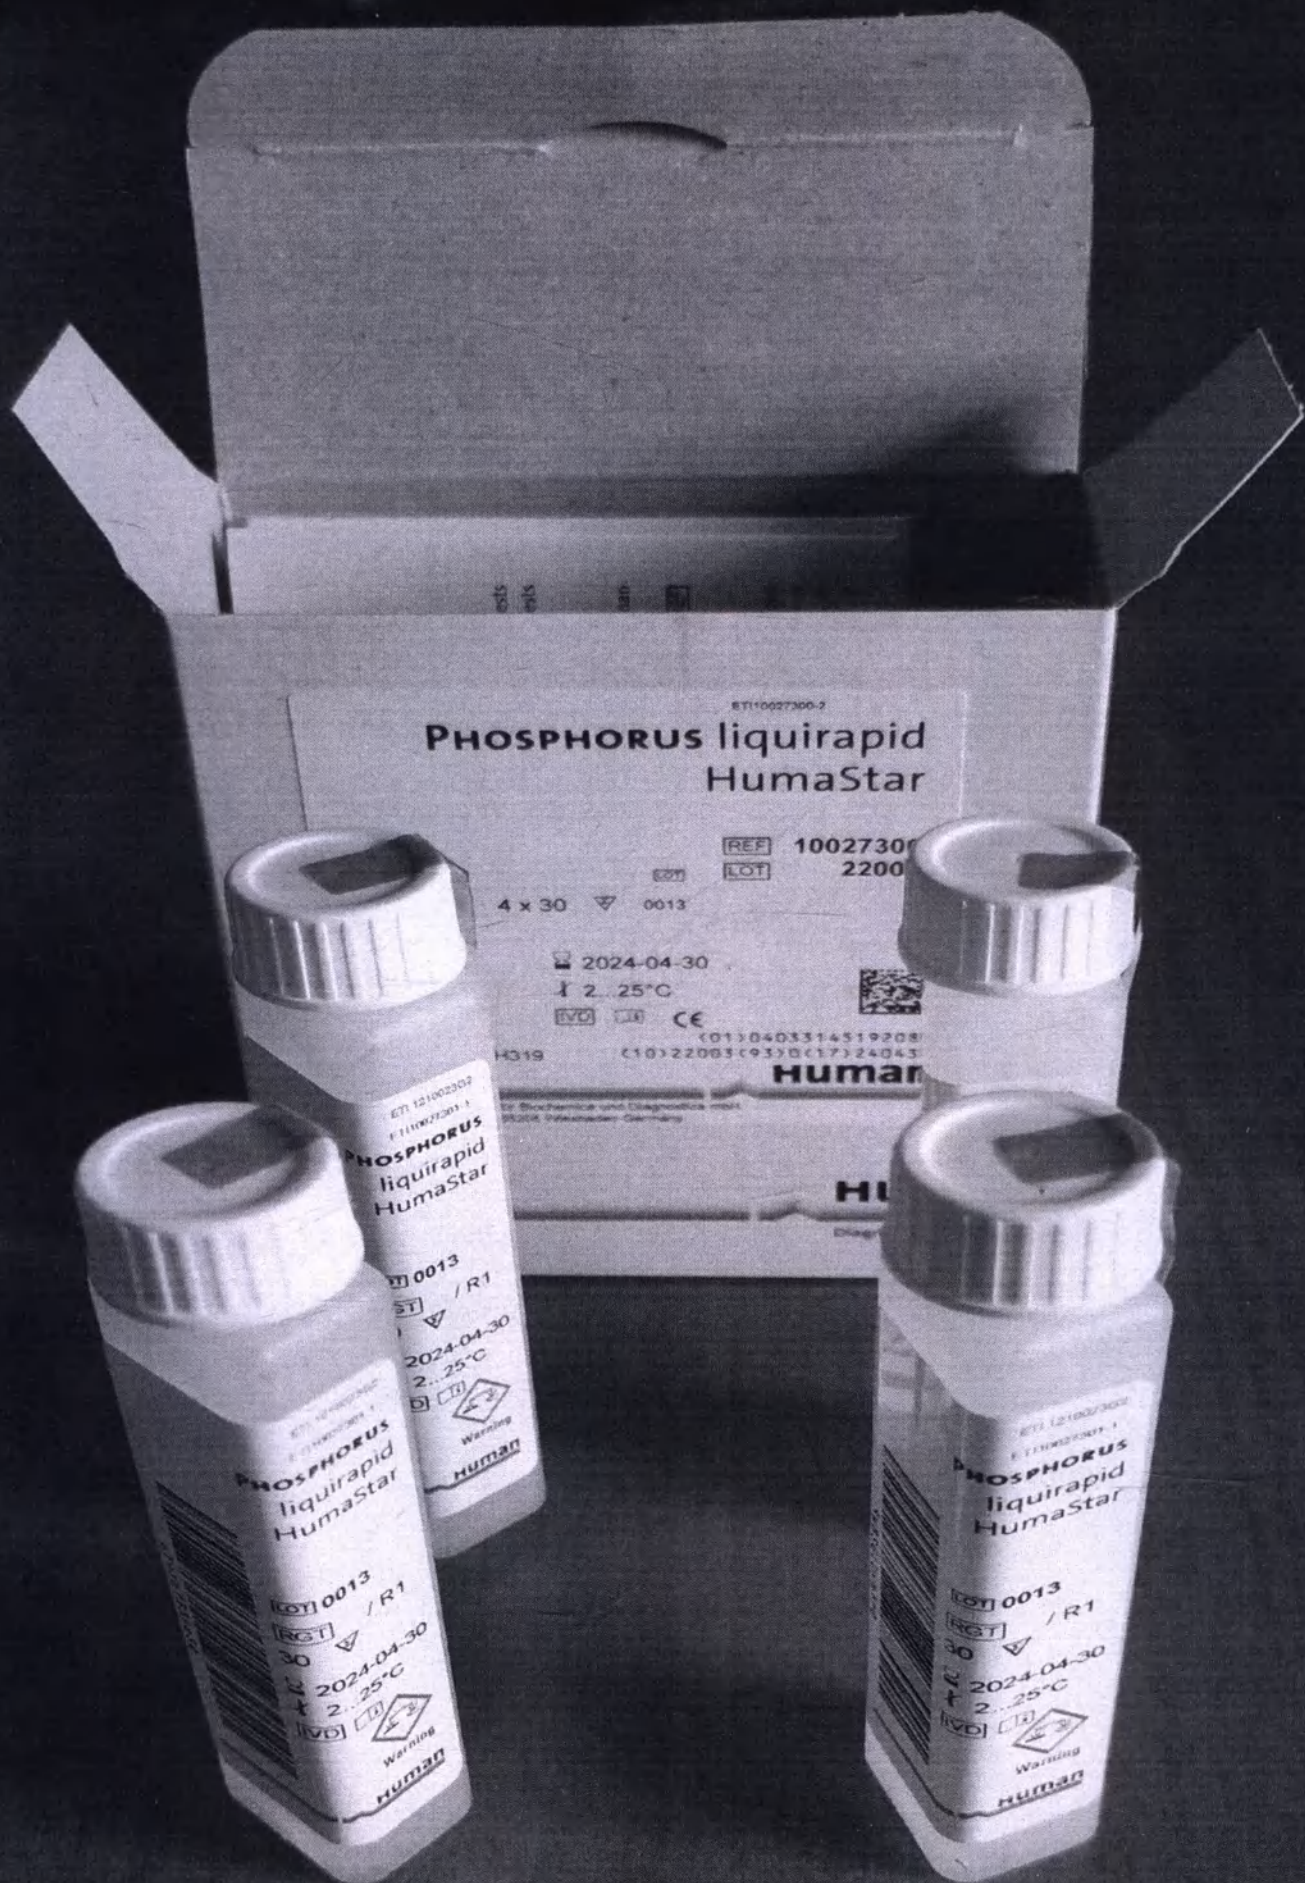

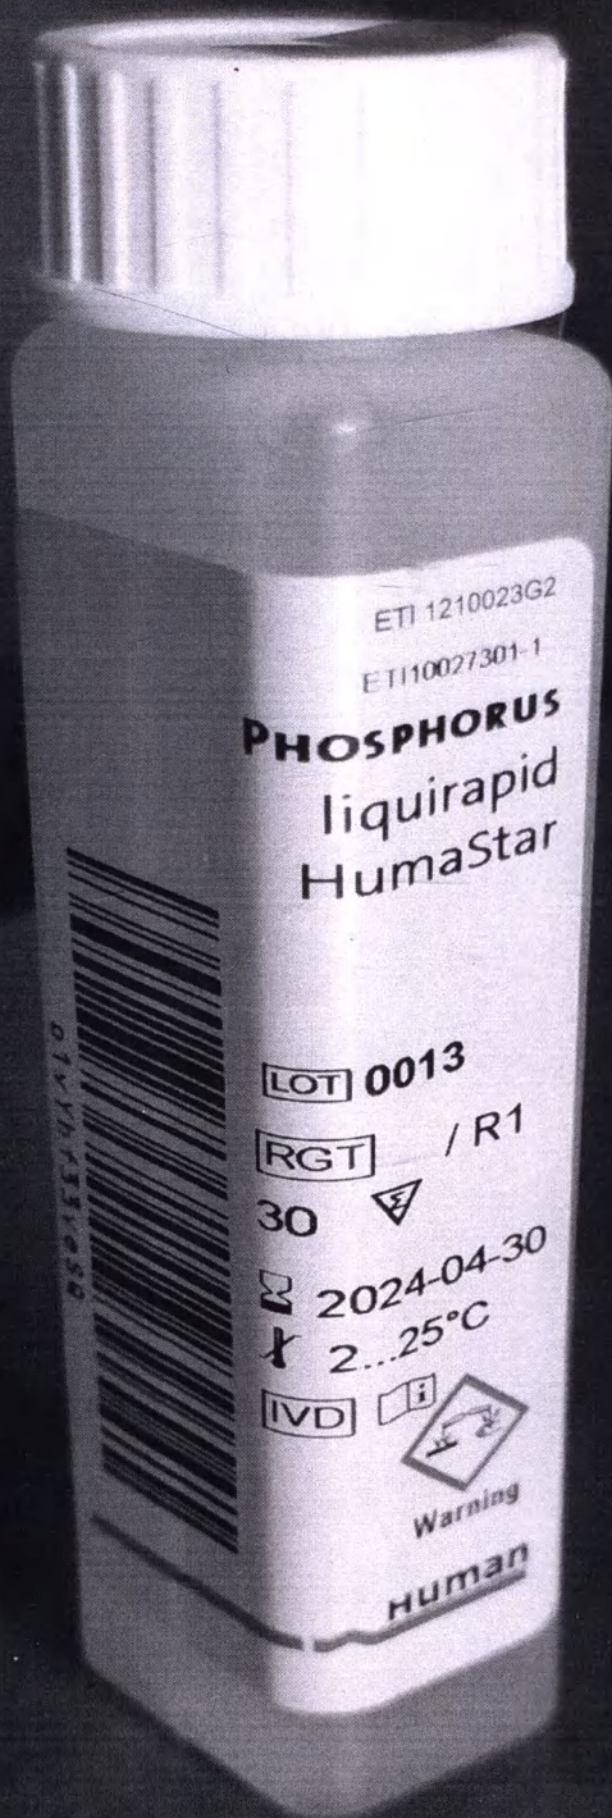

ETI 1210023G2

ETI10027301-1

PHOSPHORUS
liquid rapid
HumaStar



LOT 0013


RGT / R1

30

2024-04-30

2...25°C

IVD



Warning

human

ET110027600-6

PHOSPHORUS liquirapid

HumaStar

REF 10027600

LOT 22002

Σ 240

LOT



RGT / R1 4 x 60 Σ 0054

Warning

H290, H315,
H319

⌚ 2024-01-31

✂ 2...25°C

IVD ⓘ CE



(01)04033145122883(10)22002(93)0(17)240131

Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21·65205 Wiesbaden·Germany

Human

Diagnostics Worldwide

Реагент для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови человека (Phosphorus liquidrapid)

Вариант исполнения 2, в составе:

- Реагент окрашивающий (R1), 4 флакона по 60 тестов;
- Инструкция по применению, 1 шт.

Производитель:

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Германия

Температура хранения и транспортирования от +2 °C до +25 °C

Регистрационное Удостоверение №: РЗН _____ от _____ г,

Медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения.

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО "АНАЛИТИКА",


129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1.

Символы, применяемые в маркировке изделия, приведены на оригинальной упаковке.

Кат. №: 10027600

ЛОТ №: 22002


Годен до: 31.01.2024



human

Diagnostics Worldwide

Фотографическое изображение 6 – Внешний вид потребительской упаковки Реагента «Phosphorus liquidrapid» с русскоязычным стикером, Вариант исполнения 2

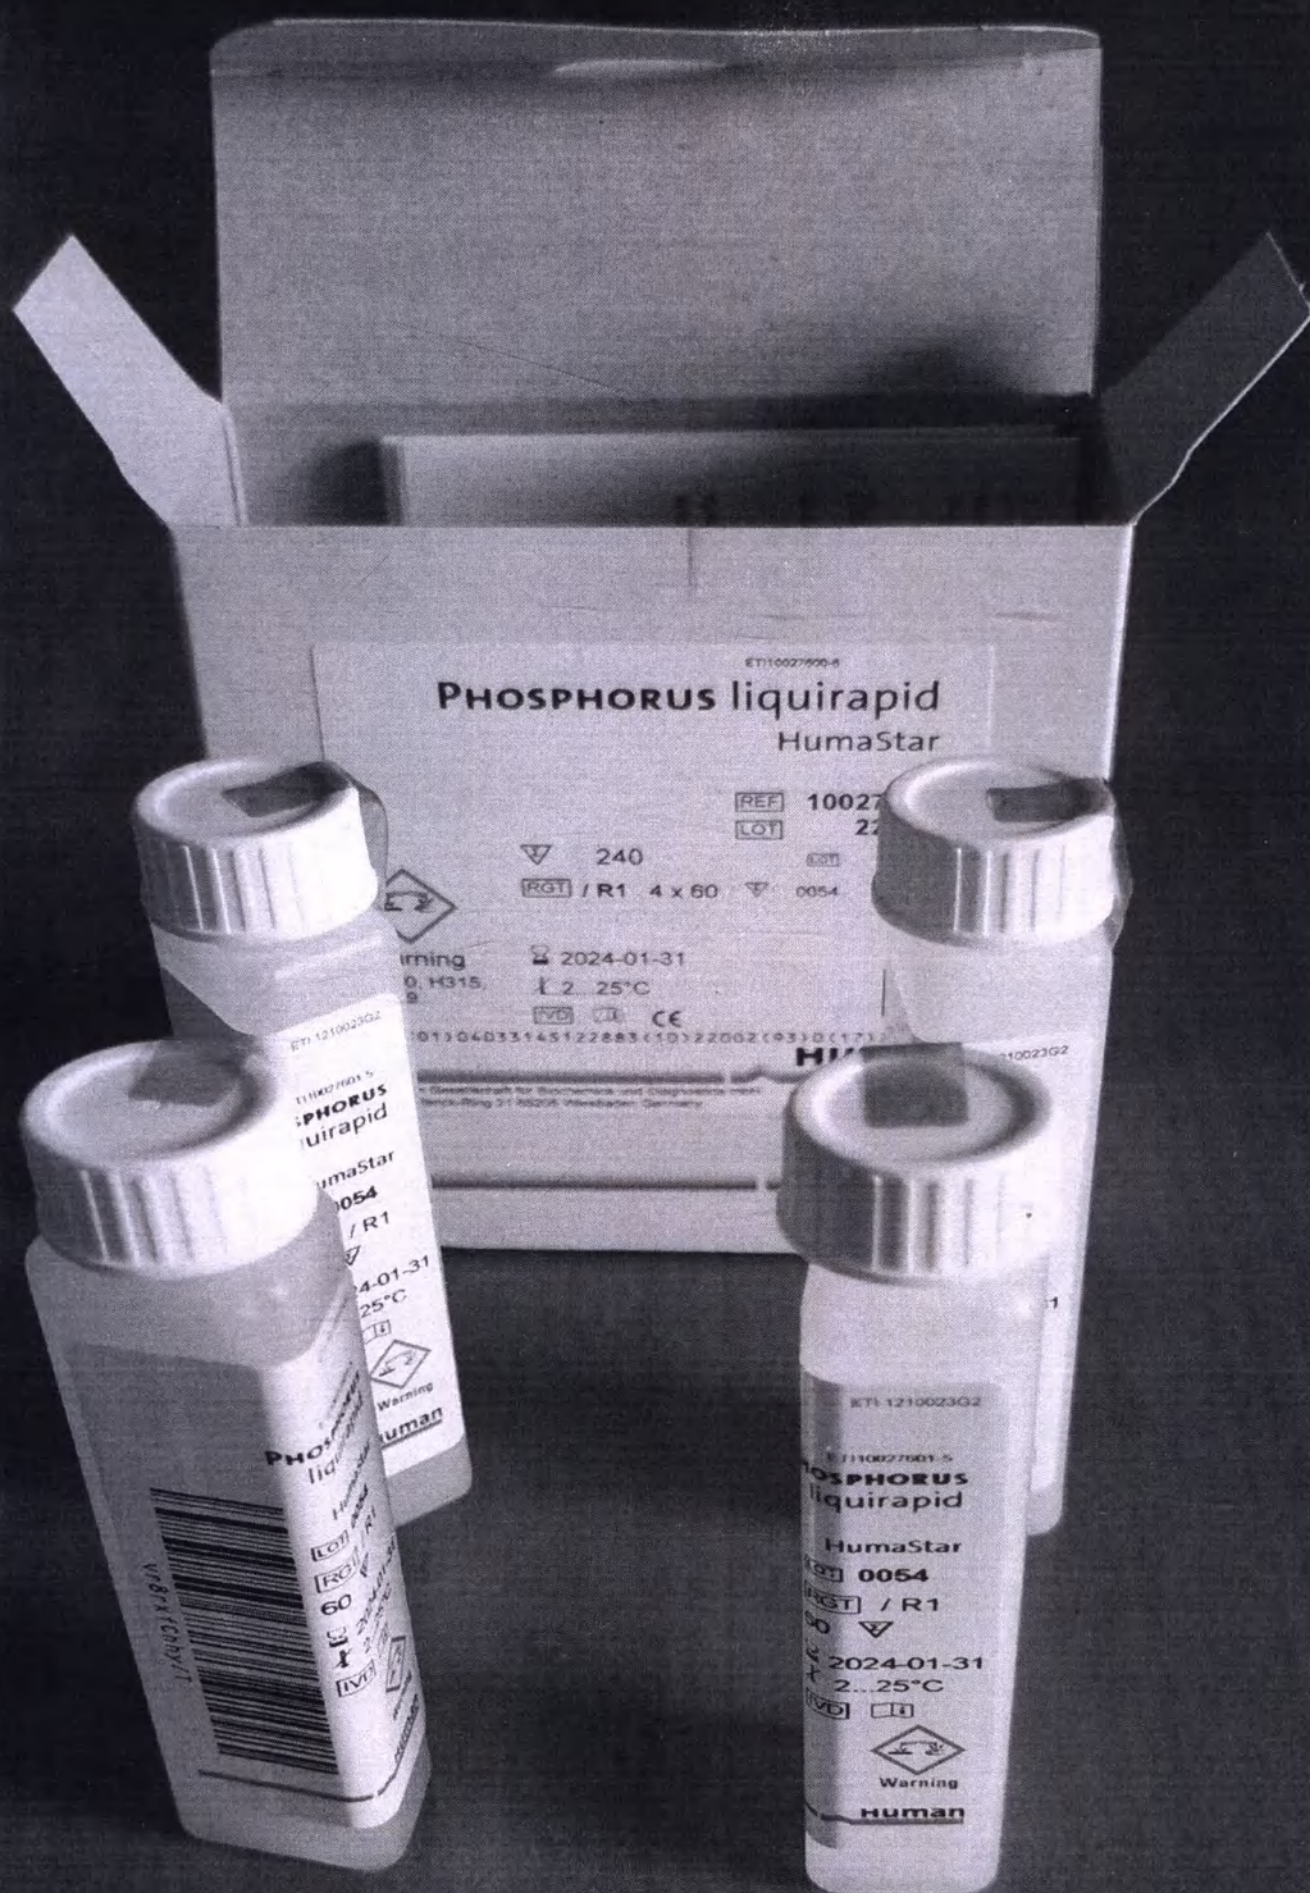

PHOSPHORUS liquirapid
HumaStar

REF 10027
LOT 22

240
RGT / R1 4 x 60
0054

2024-01-31
25°C


CE

01304033145122883 (10) 22002 (03) 0 (17)

Greenstadt für Biochemie und Diagnostik
Bismarck-Ring 21 66206 Wiesbaden, Germany

PHOSPHORUS
liquirapid
HumaStar
0054
R1
2024-01-31
25°C
Warning
human

PHOSPHORUS
liquirapid
HumaStar
0054
R1
2024-01-31
25°C
Warning
human

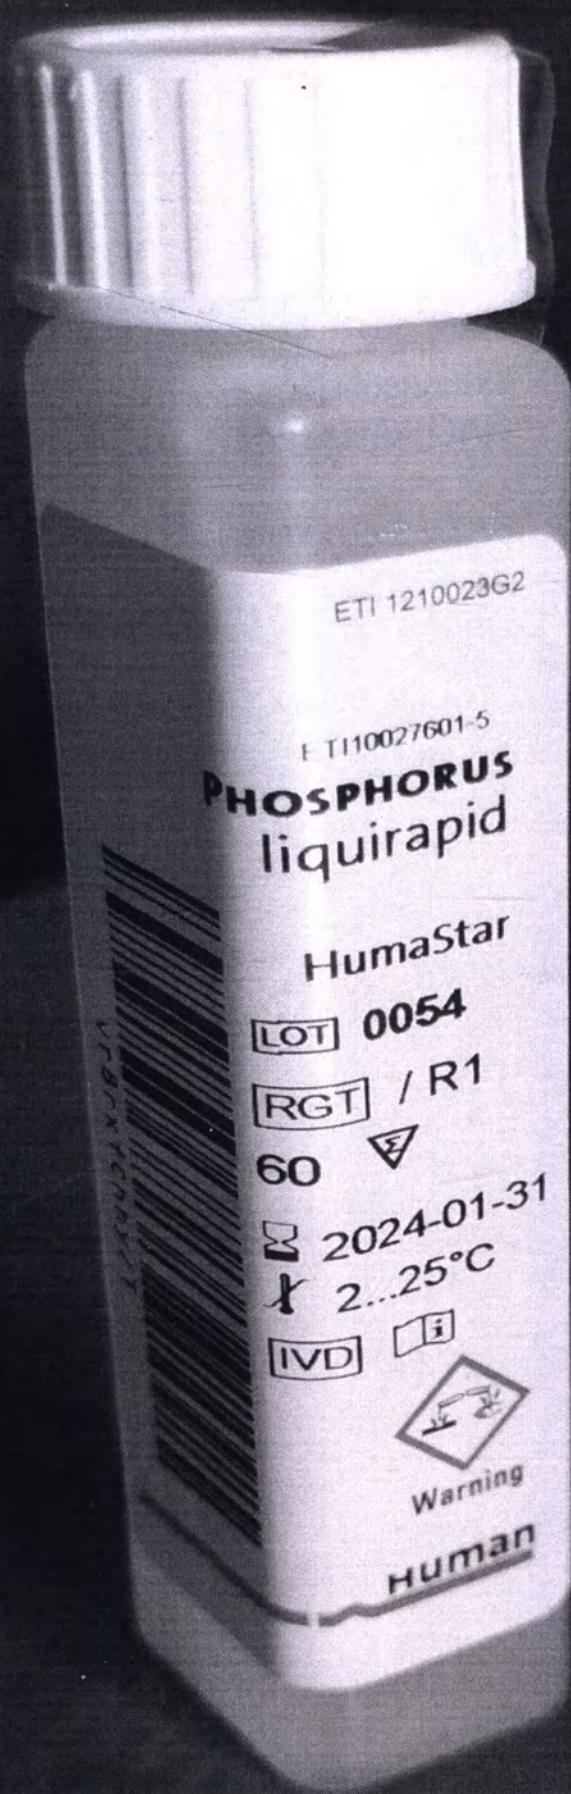

Фотографическое изображение 8 – Внешний вид «Реагент окрашивающий (R1)» Реагента «Phosphorus liquid rapid».

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 9 листов.



Финансовый директор
ЗАО «АНАЛИТИКА»

 Гуляева В.Г.