


ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»


Сюн Вэй.
«27» декабря 2022 г.



24.05.22г
В.
ДЕЛА

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus
(Rubella virus IgG) в клиническом образце человека
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001

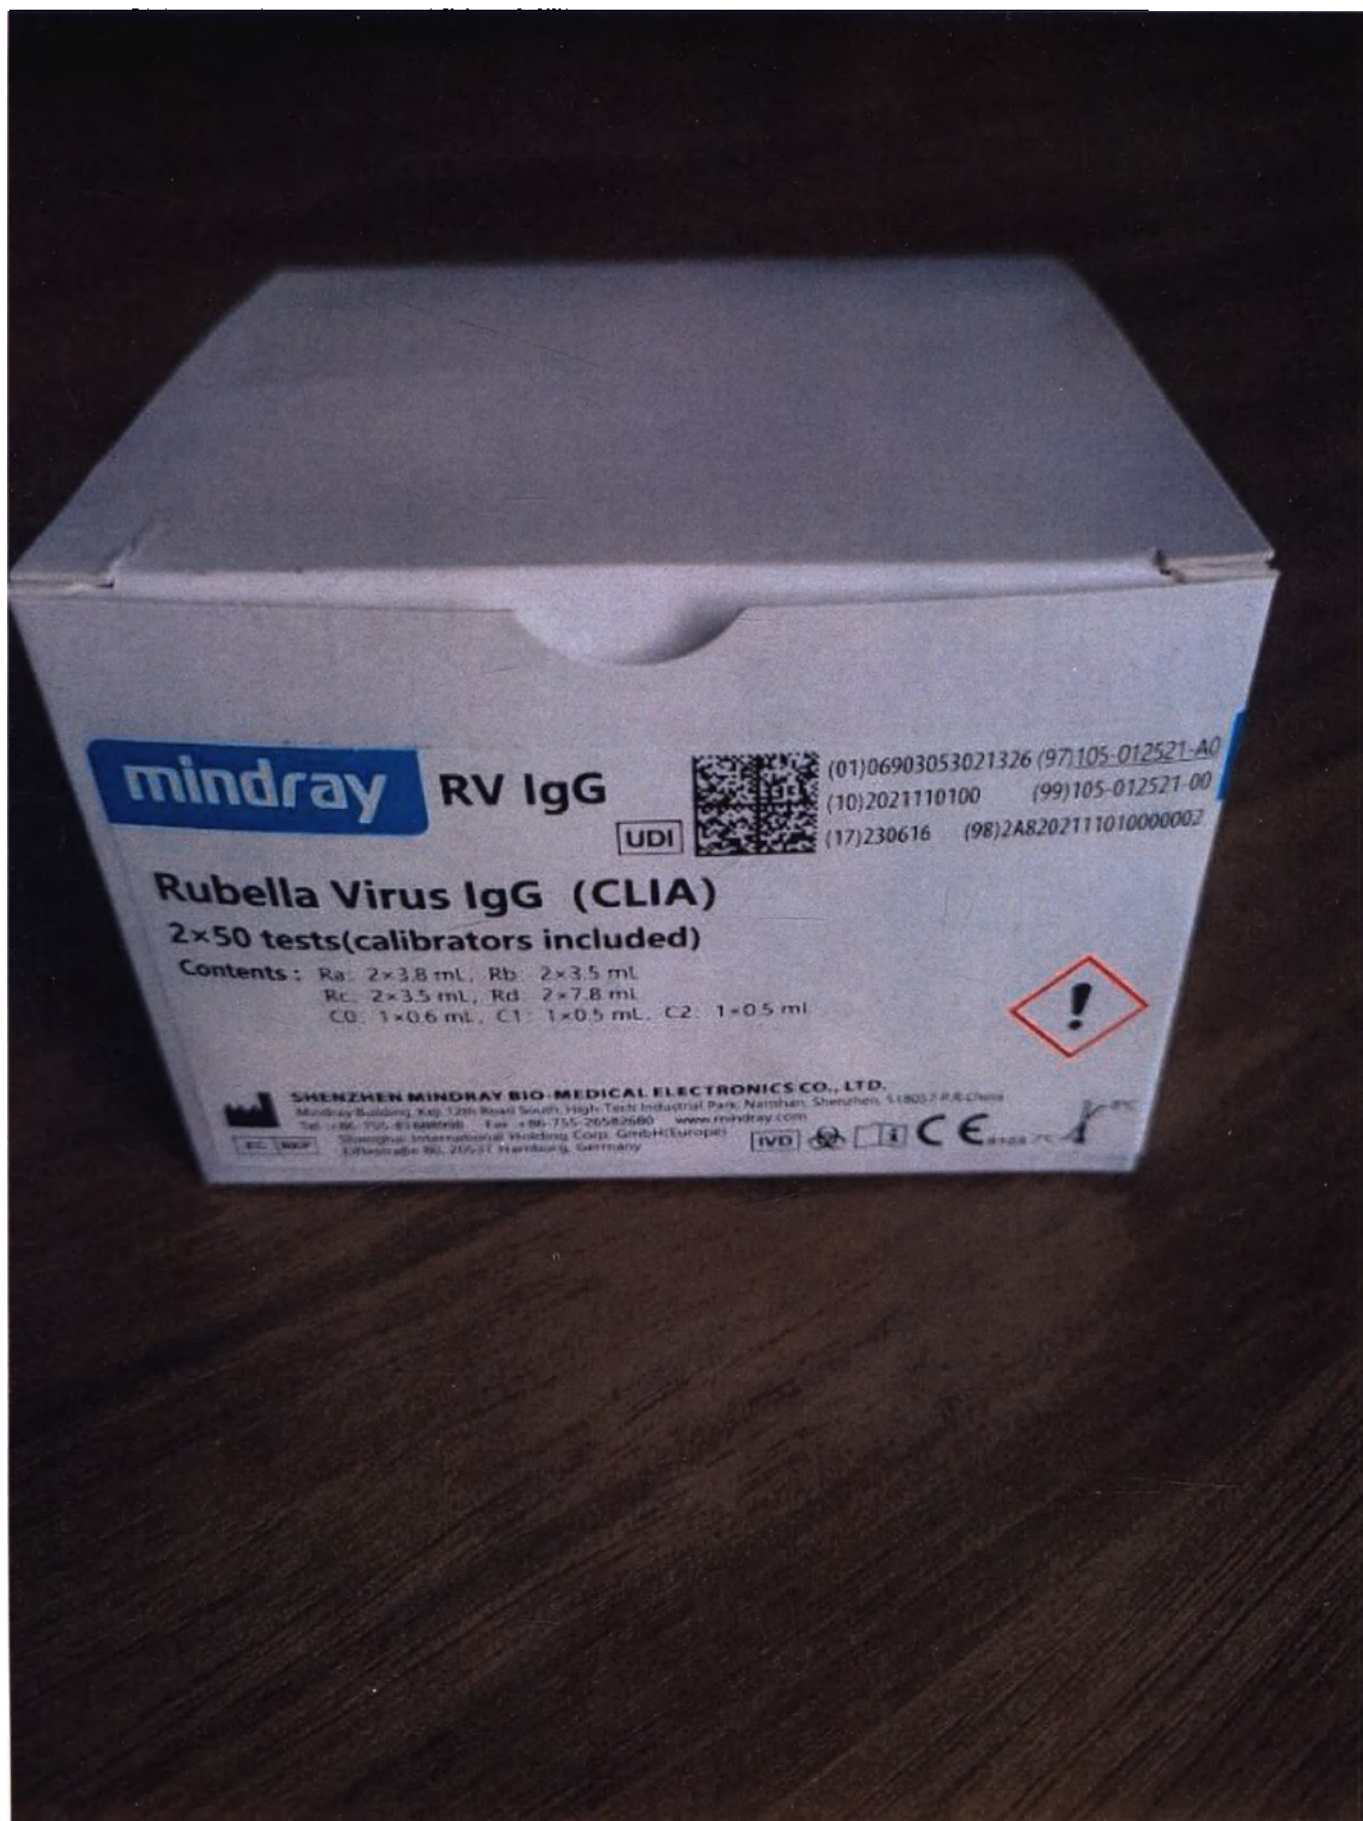


Рисунок 1. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 1)

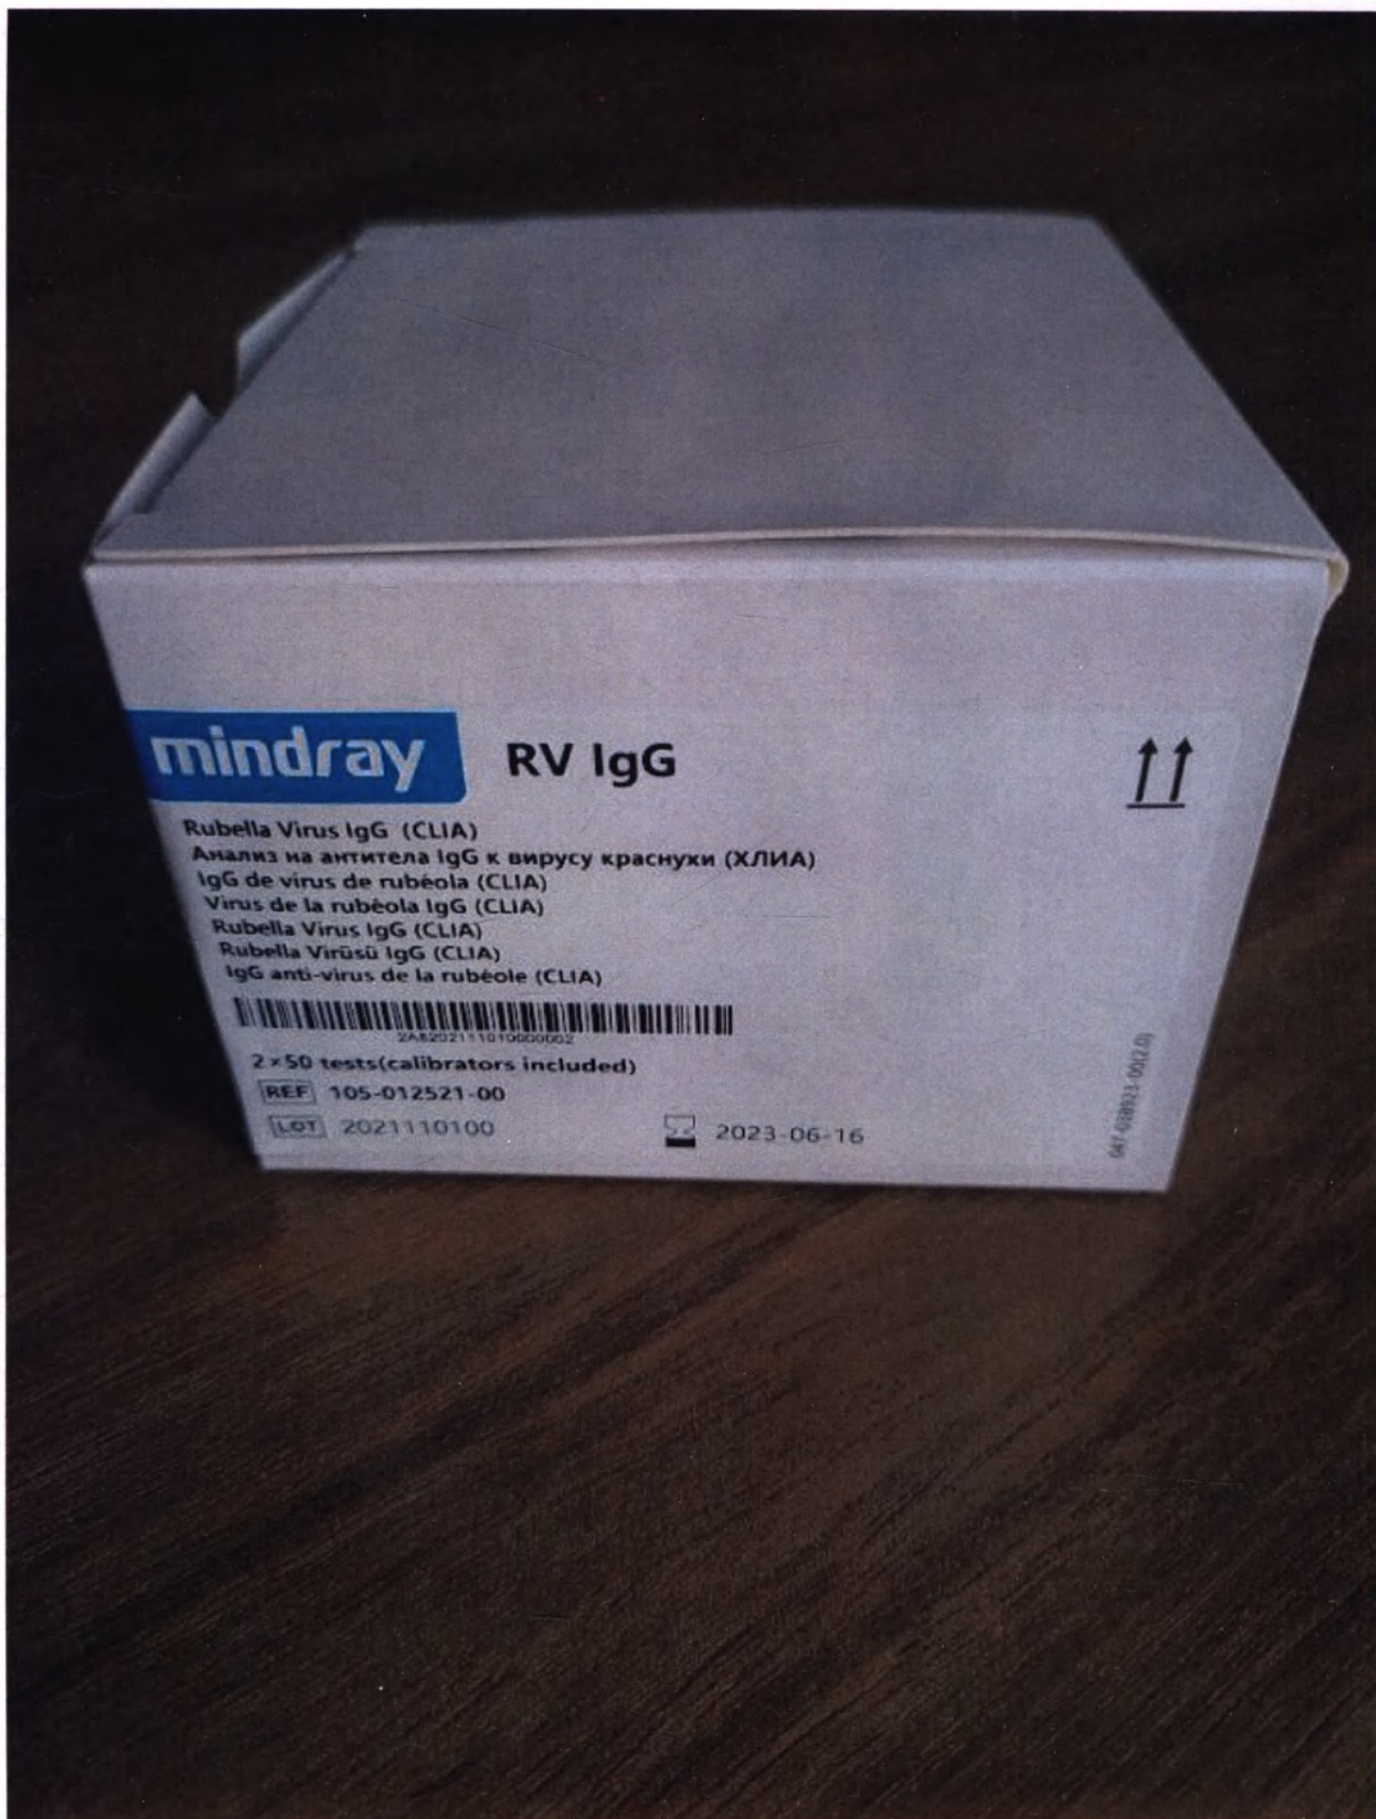


Рисунок 2. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 2)

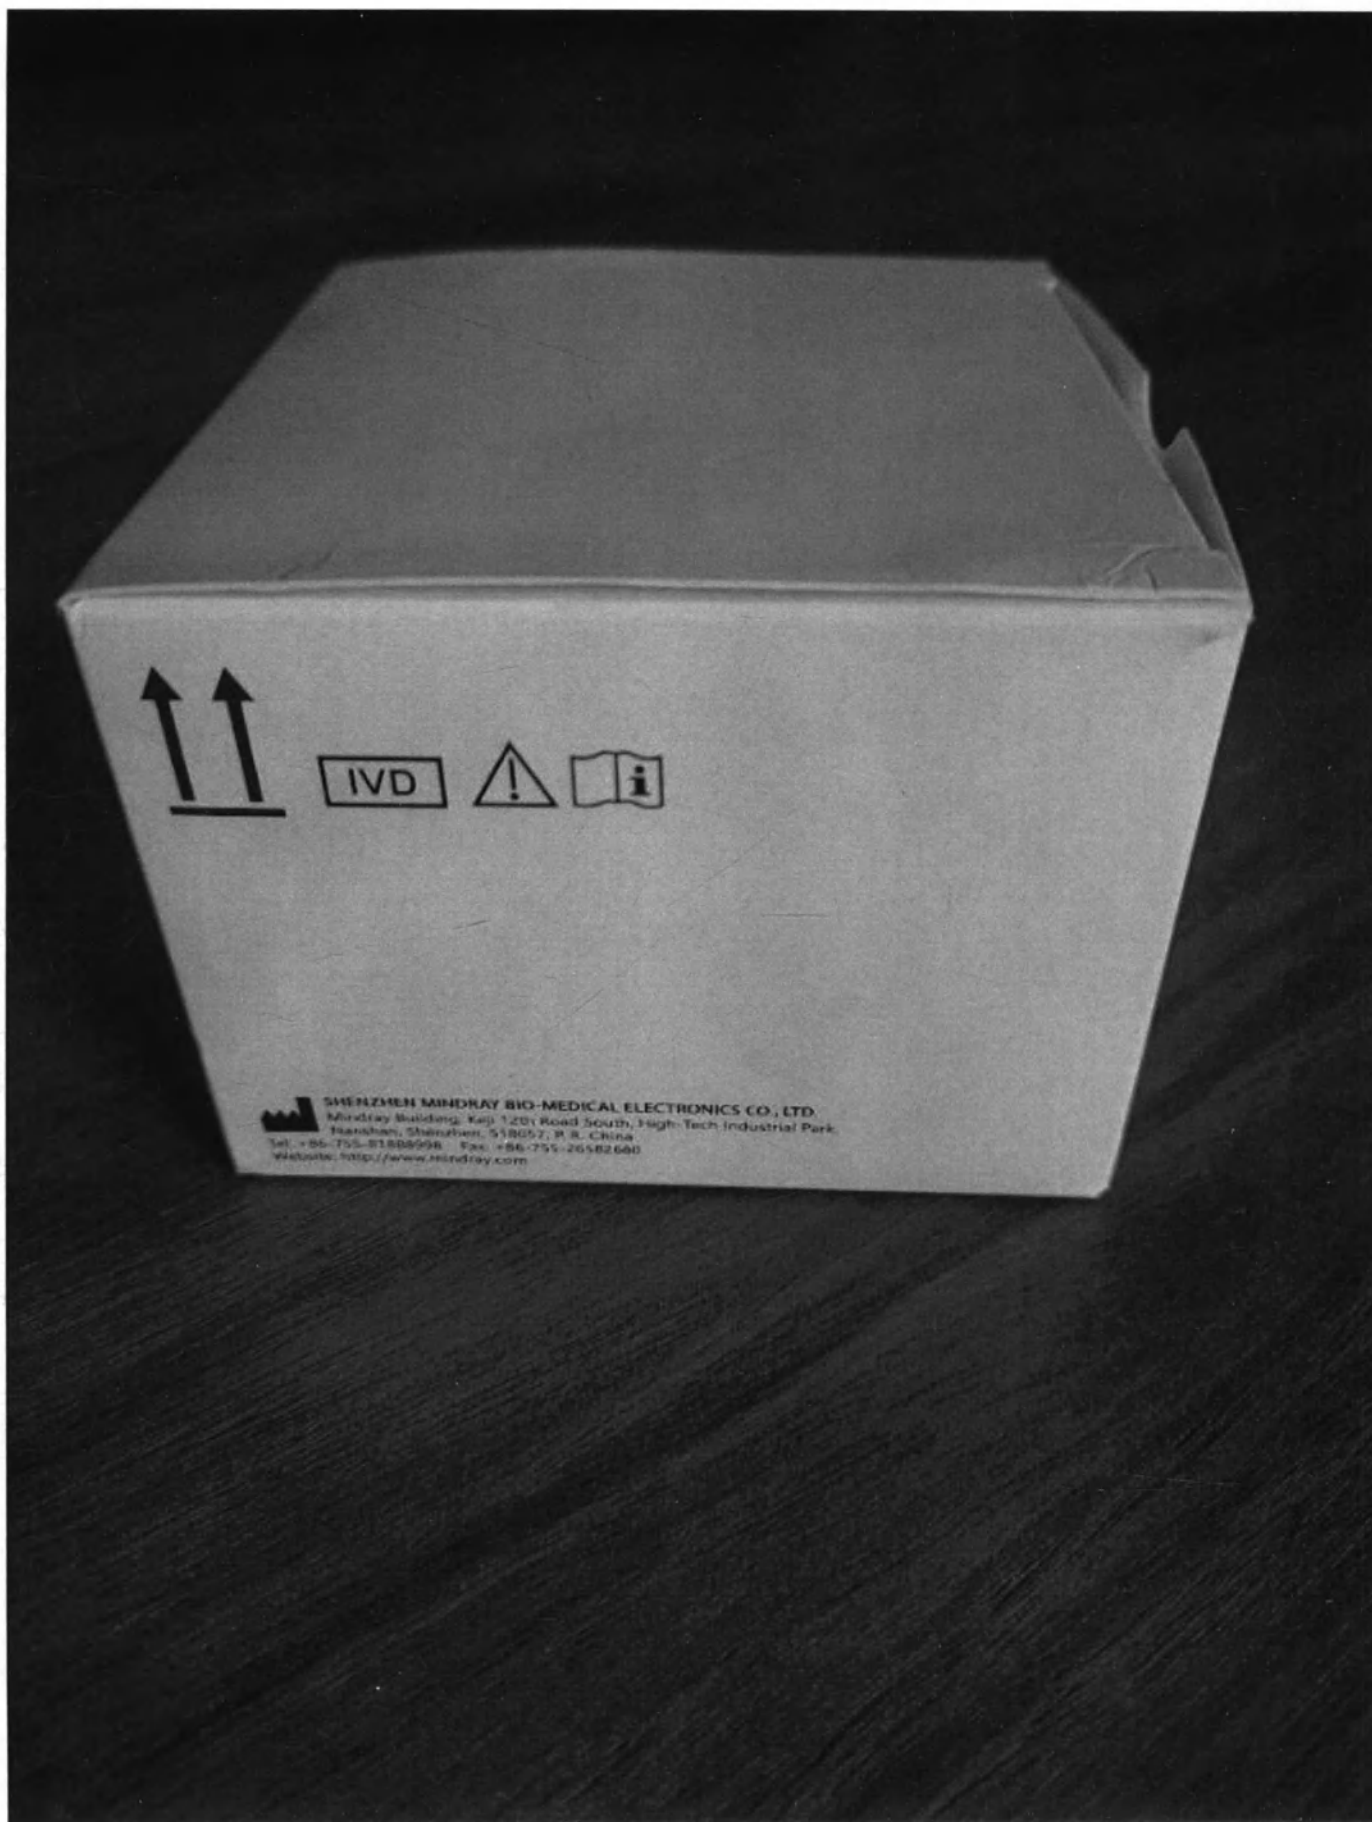


Рисунок 3. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 3)

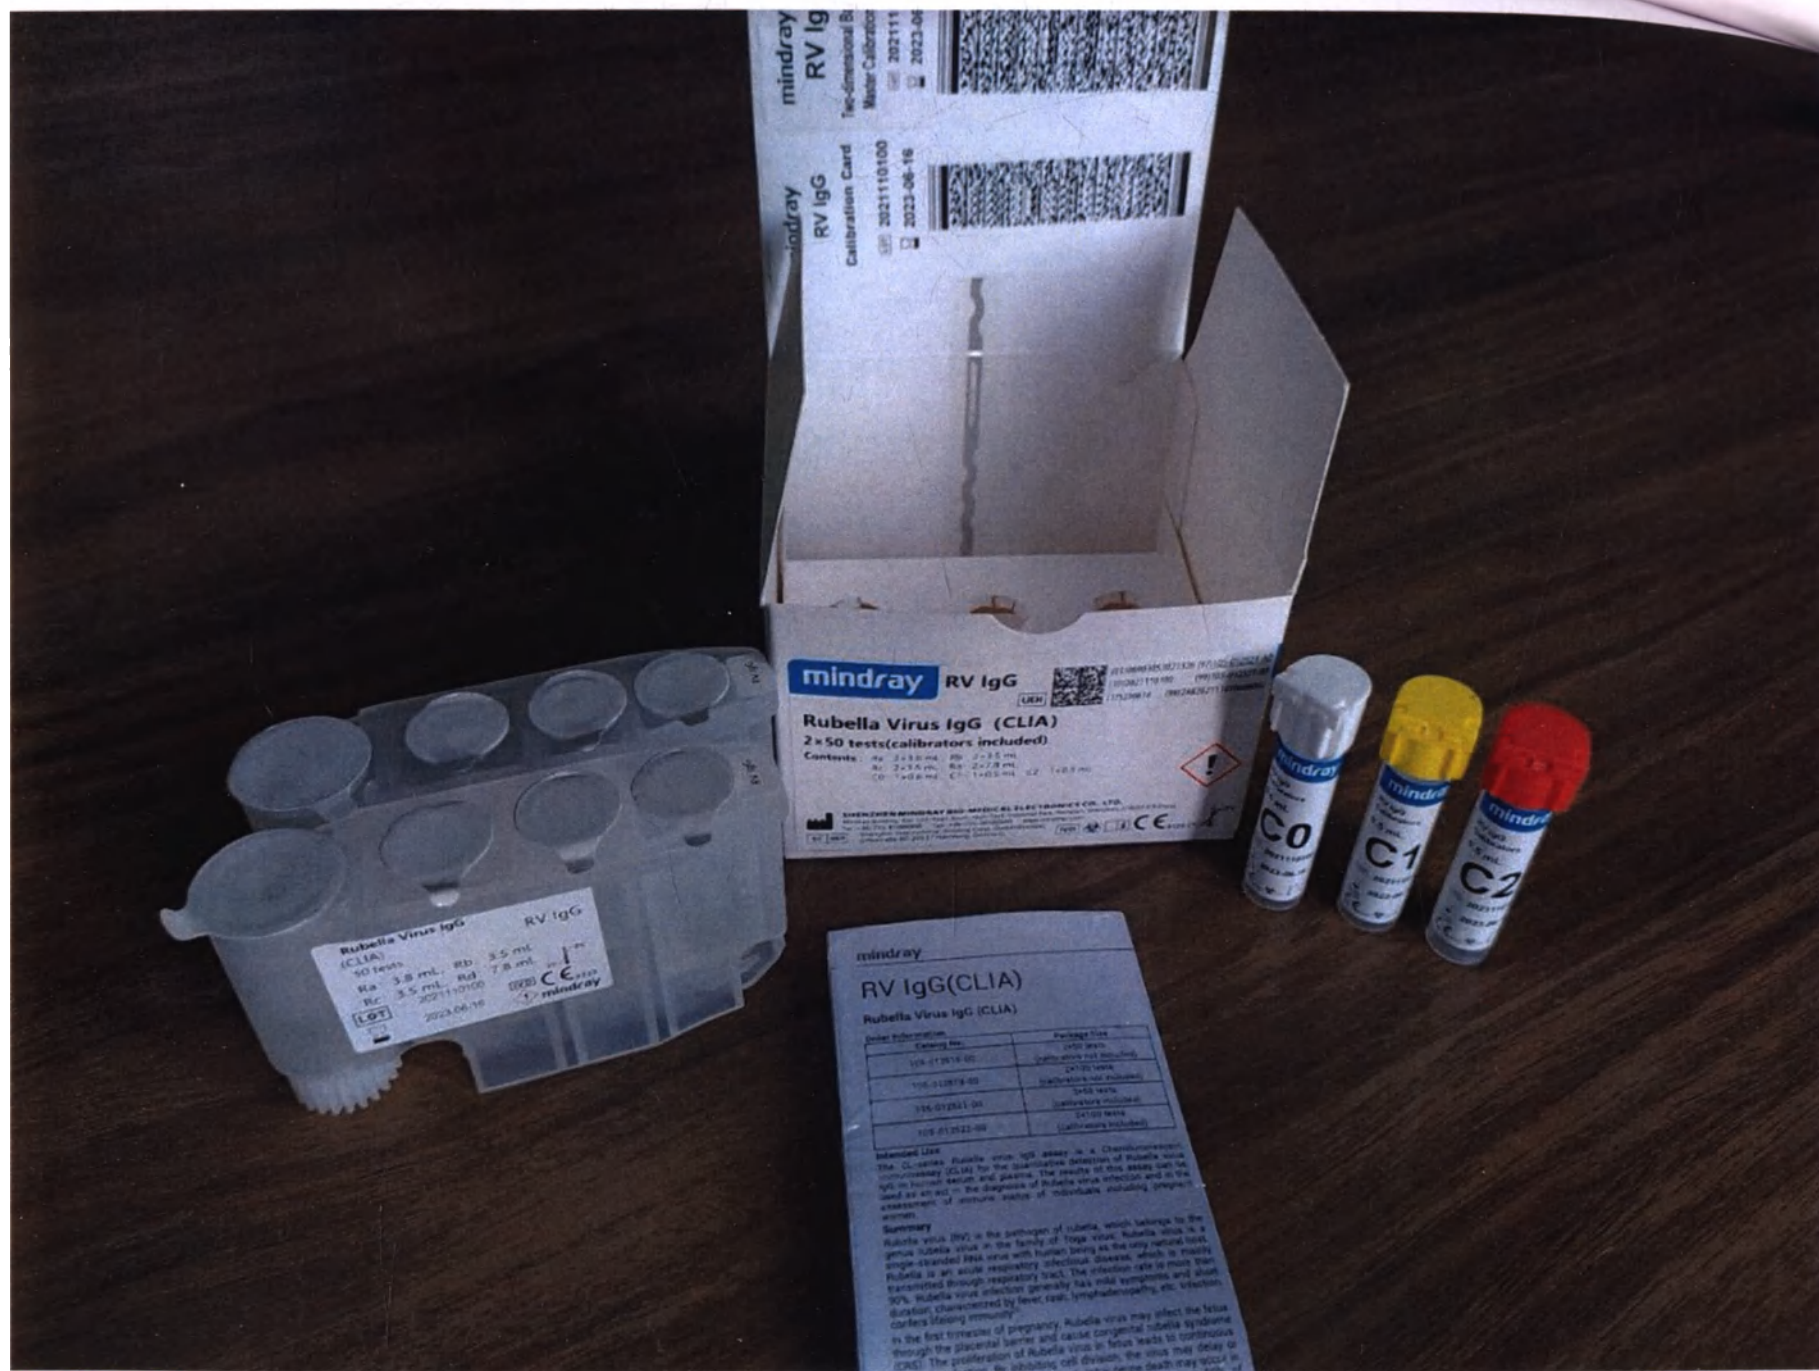


Рисунок 4. Общий вид Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен)

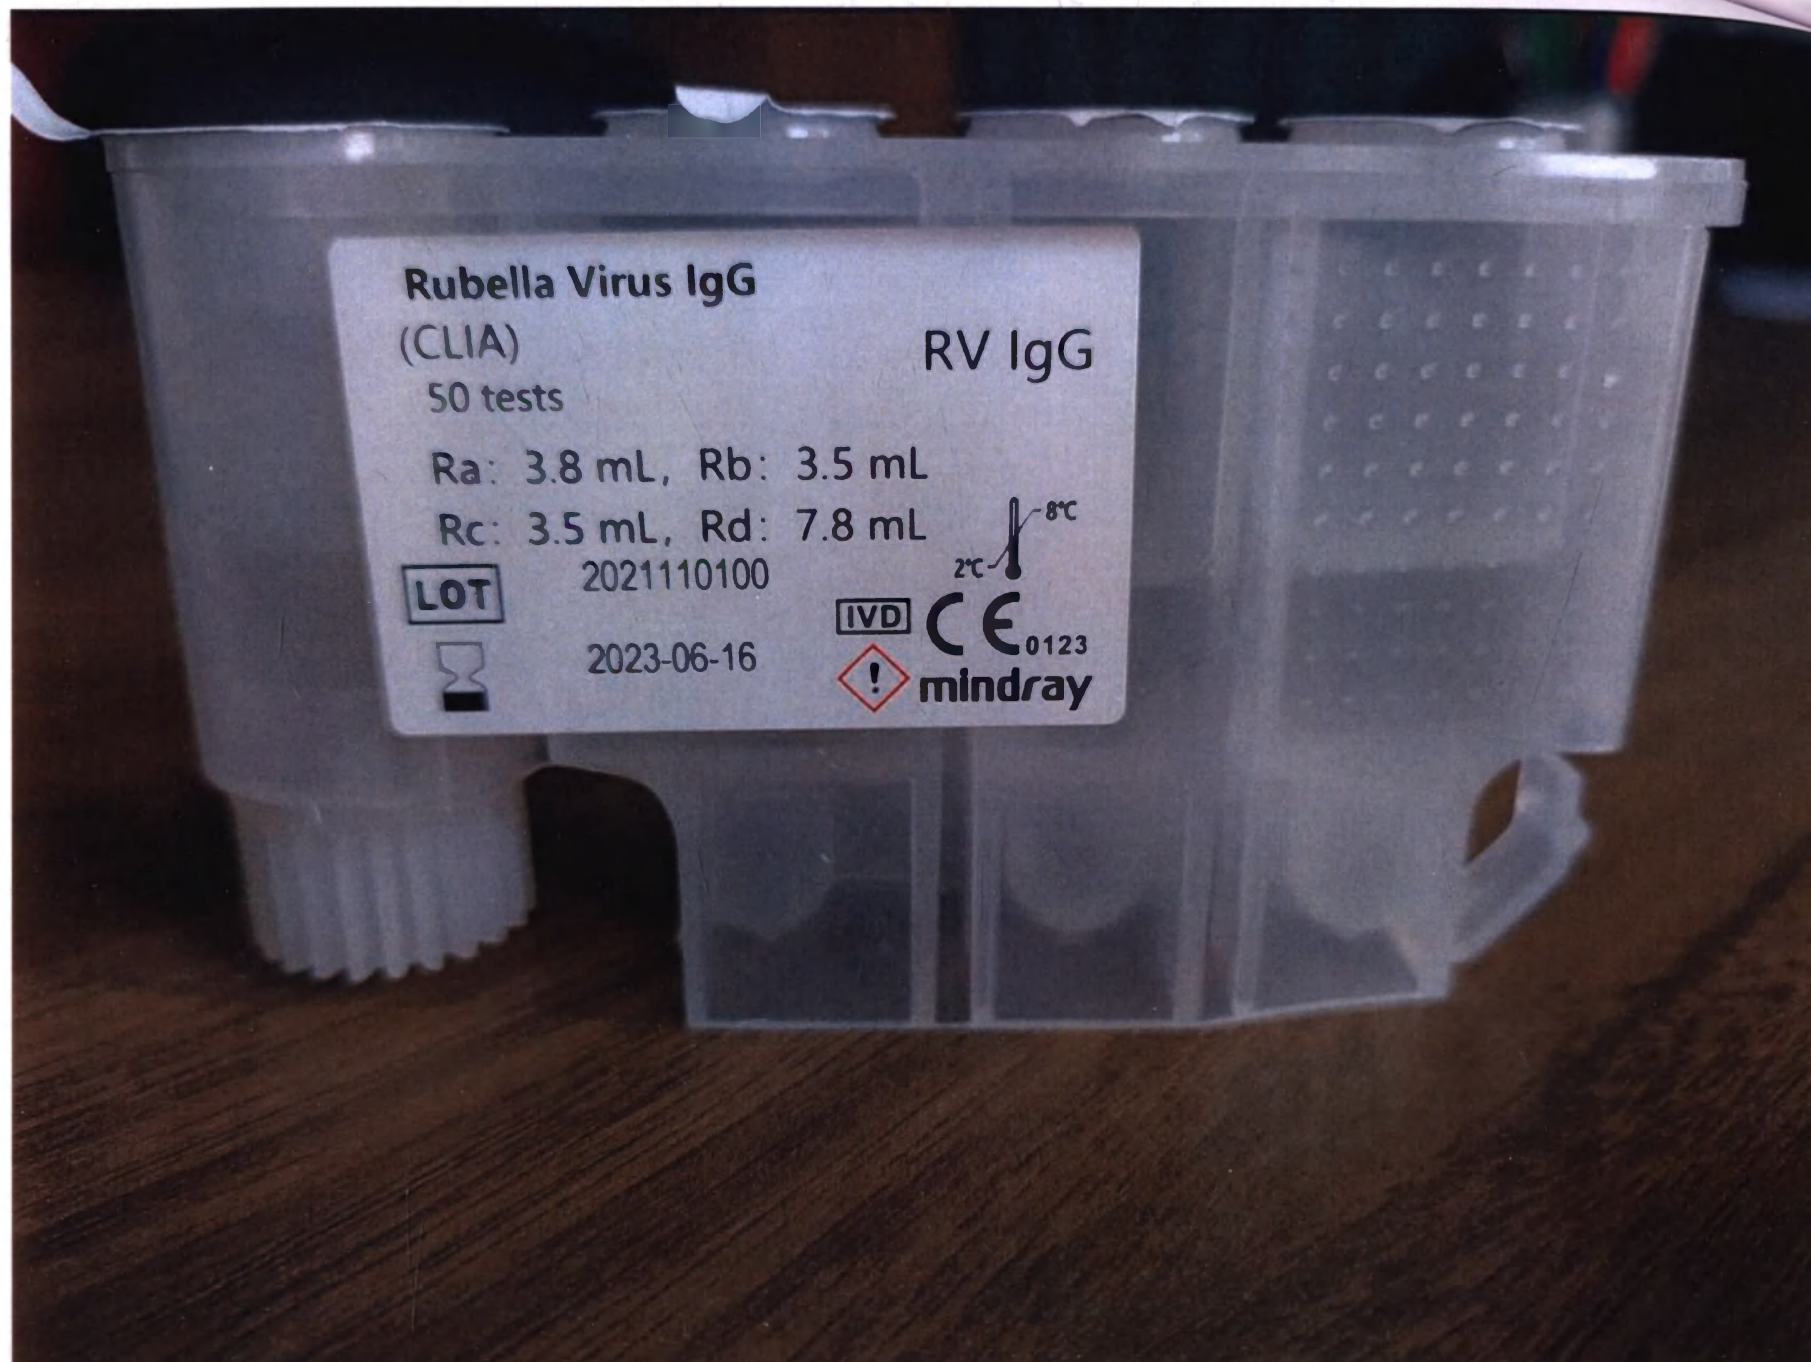


Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт (вид 1)



Рисунок 6. Кассета с реагентами - 2 шт (вид 2)



Рисунок 7. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 8. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 9. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 3)



Рисунок 10. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 11. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 2)

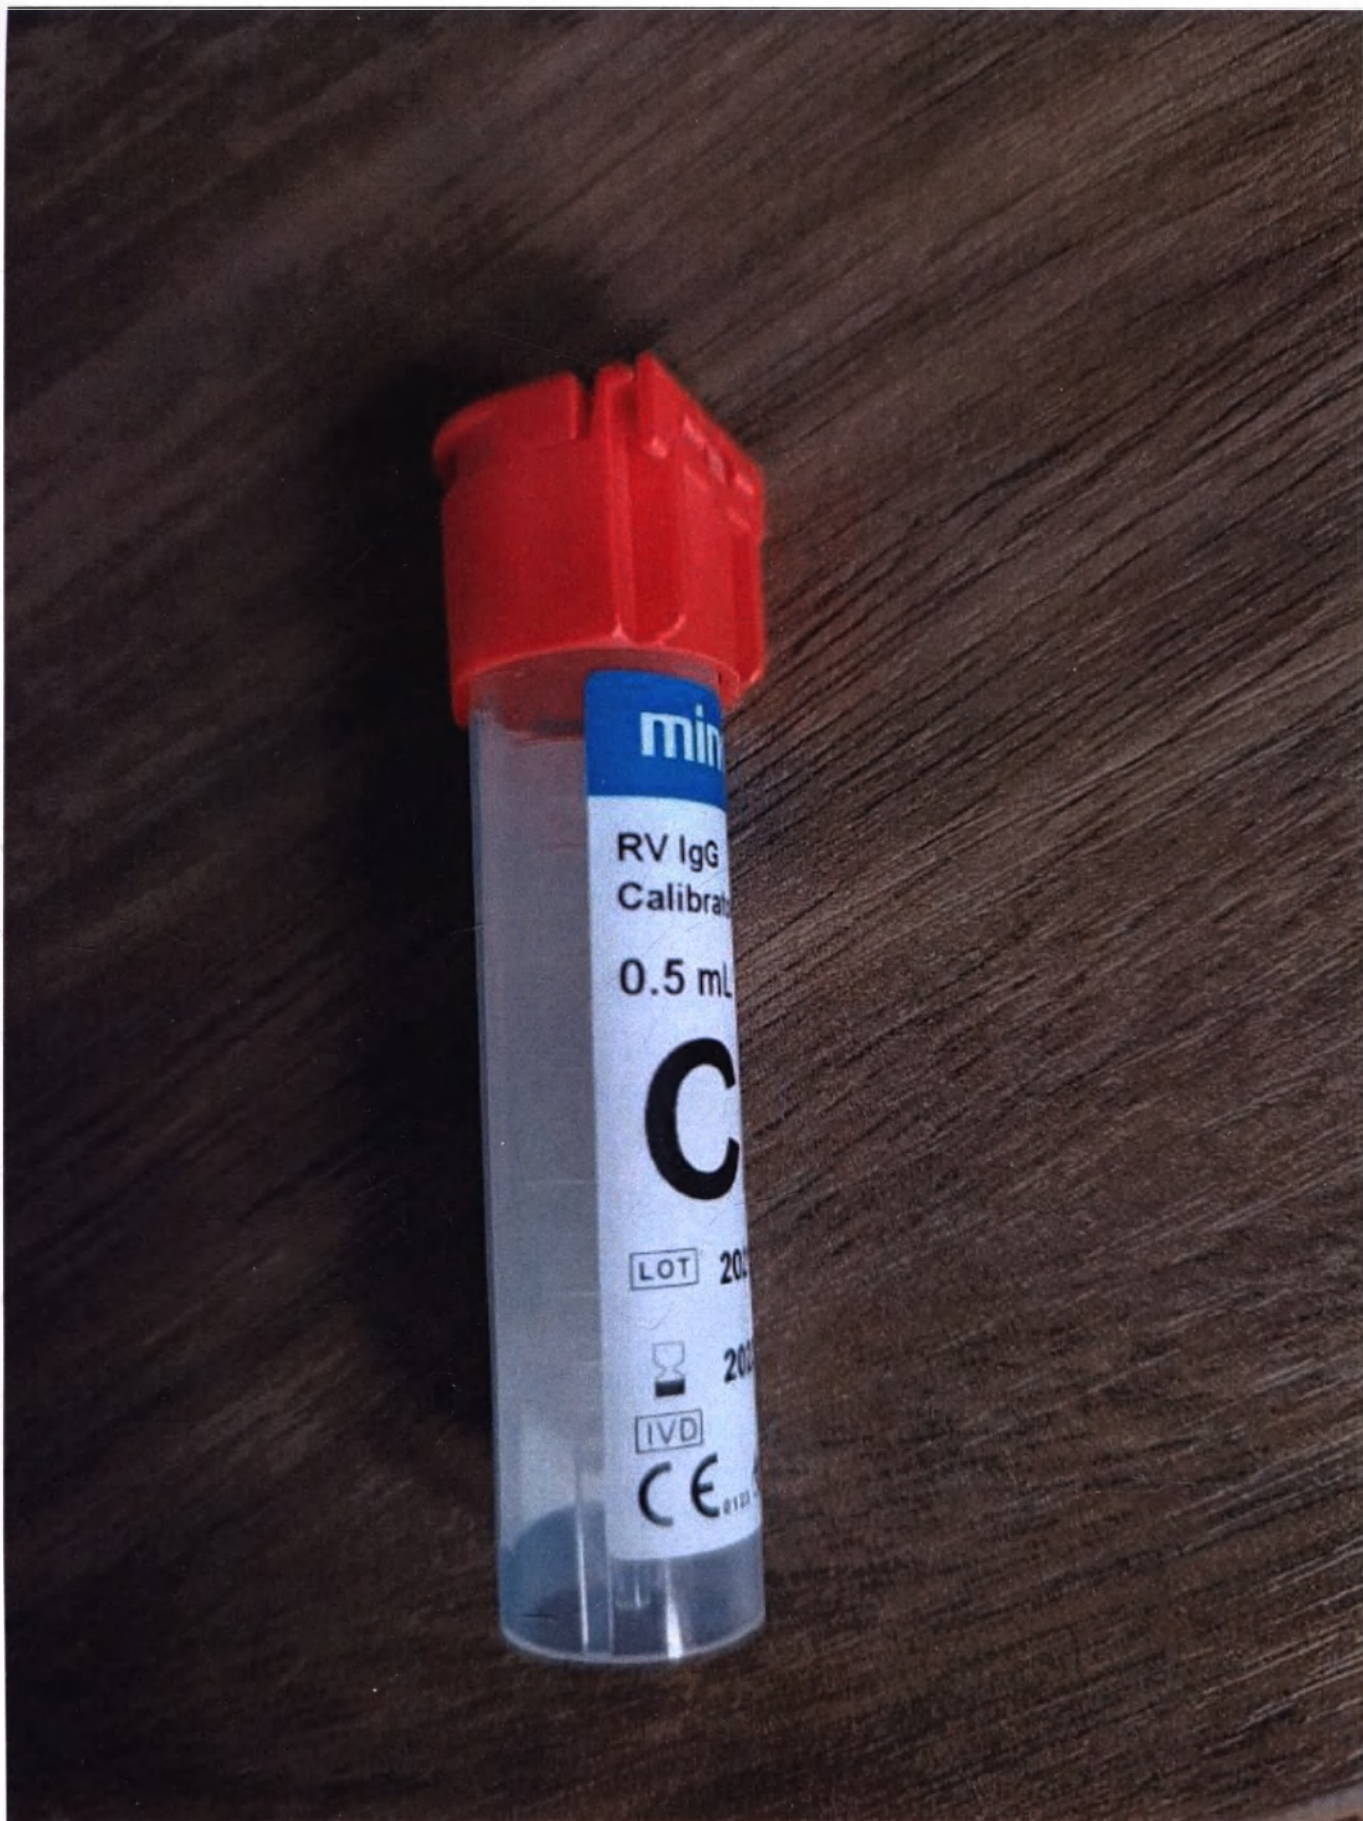


Рисунок 12. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 13. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 14. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 3)

mindray

RV IgG(CLIA)

Rubella Virus IgG (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012518-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012519-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012521-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012522-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series Rubella virus IgG assay is a Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) for the quantitative detection of Rubella virus IgG in human serum and plasma. The results of this assay can be used as an aid in the diagnosis of Rubella virus infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Rubella virus (RV) is the pathogen of rubella, which belongs to the genus rubella virus in the family of Toga virus. Rubella virus is a single-stranded RNA virus with human being as the only natural host. Rubella is an acute respiratory infectious disease, which is mainly transmitted through respiratory tract. The infection rate is more than 90%. Rubella virus infection generally has mild symptoms and short duration, characterized by fever, rash, lymphadenopathy, etc. Infection confers lifelong immunity^[1].

In the first trimester of pregnancy, Rubella virus may infect the fetus through the placental barrier and cause congenital rubella syndrome (CRS). The proliferation of Rubella virus in fetus leads to continuous systemic infection. By inhibiting cell division, the virus may delay or even arrest the embryo development. Intrauterine death may occur in some fetuses. The overall defect rate of neonates is up to 90%, of which the mild ones show growth retardation, and the severe ones

Рисунок 15 Инструкция по применению – 1 шт

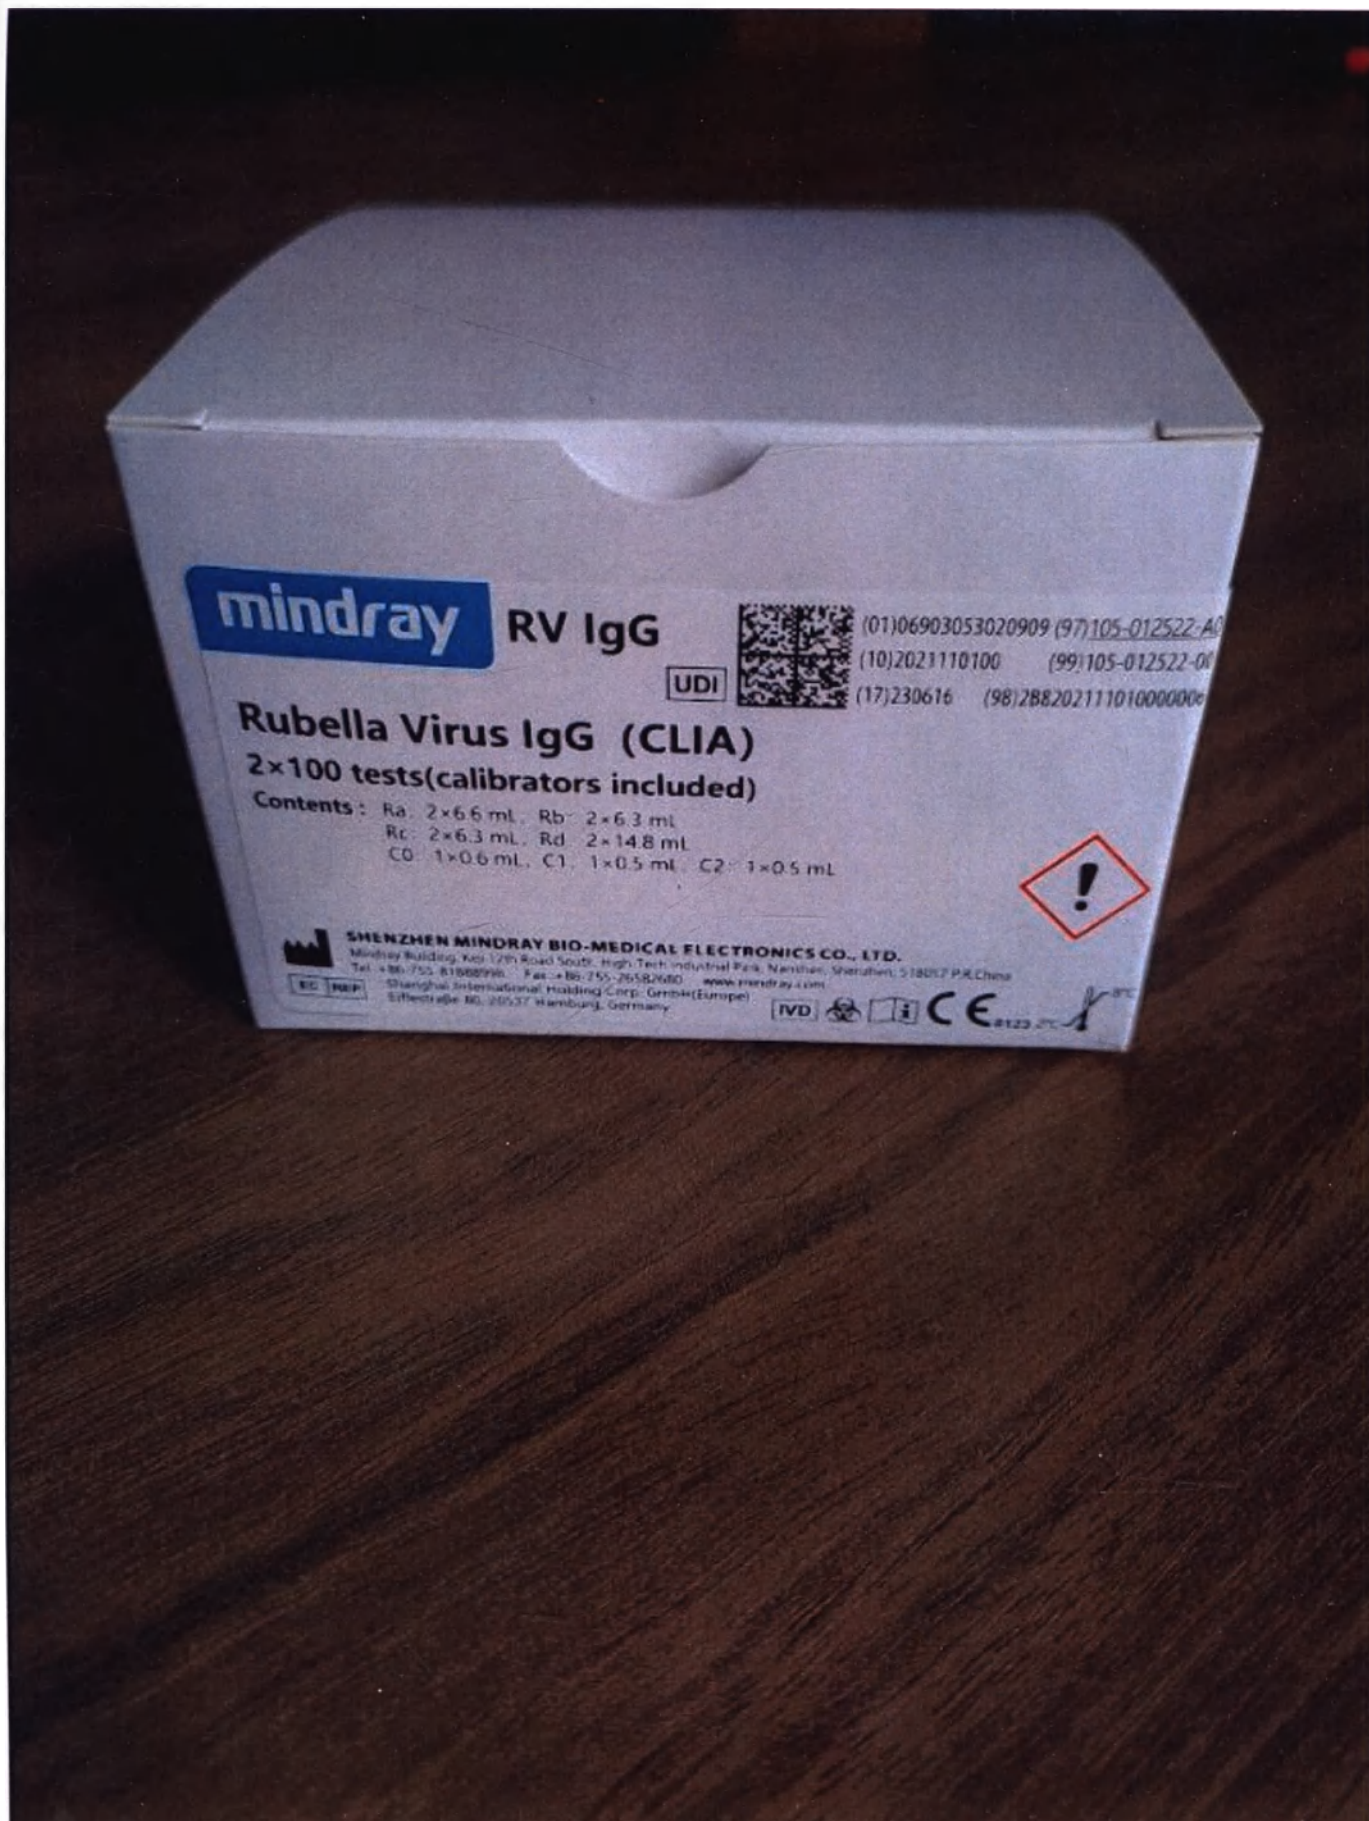


Рисунок 16. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилуминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 1)

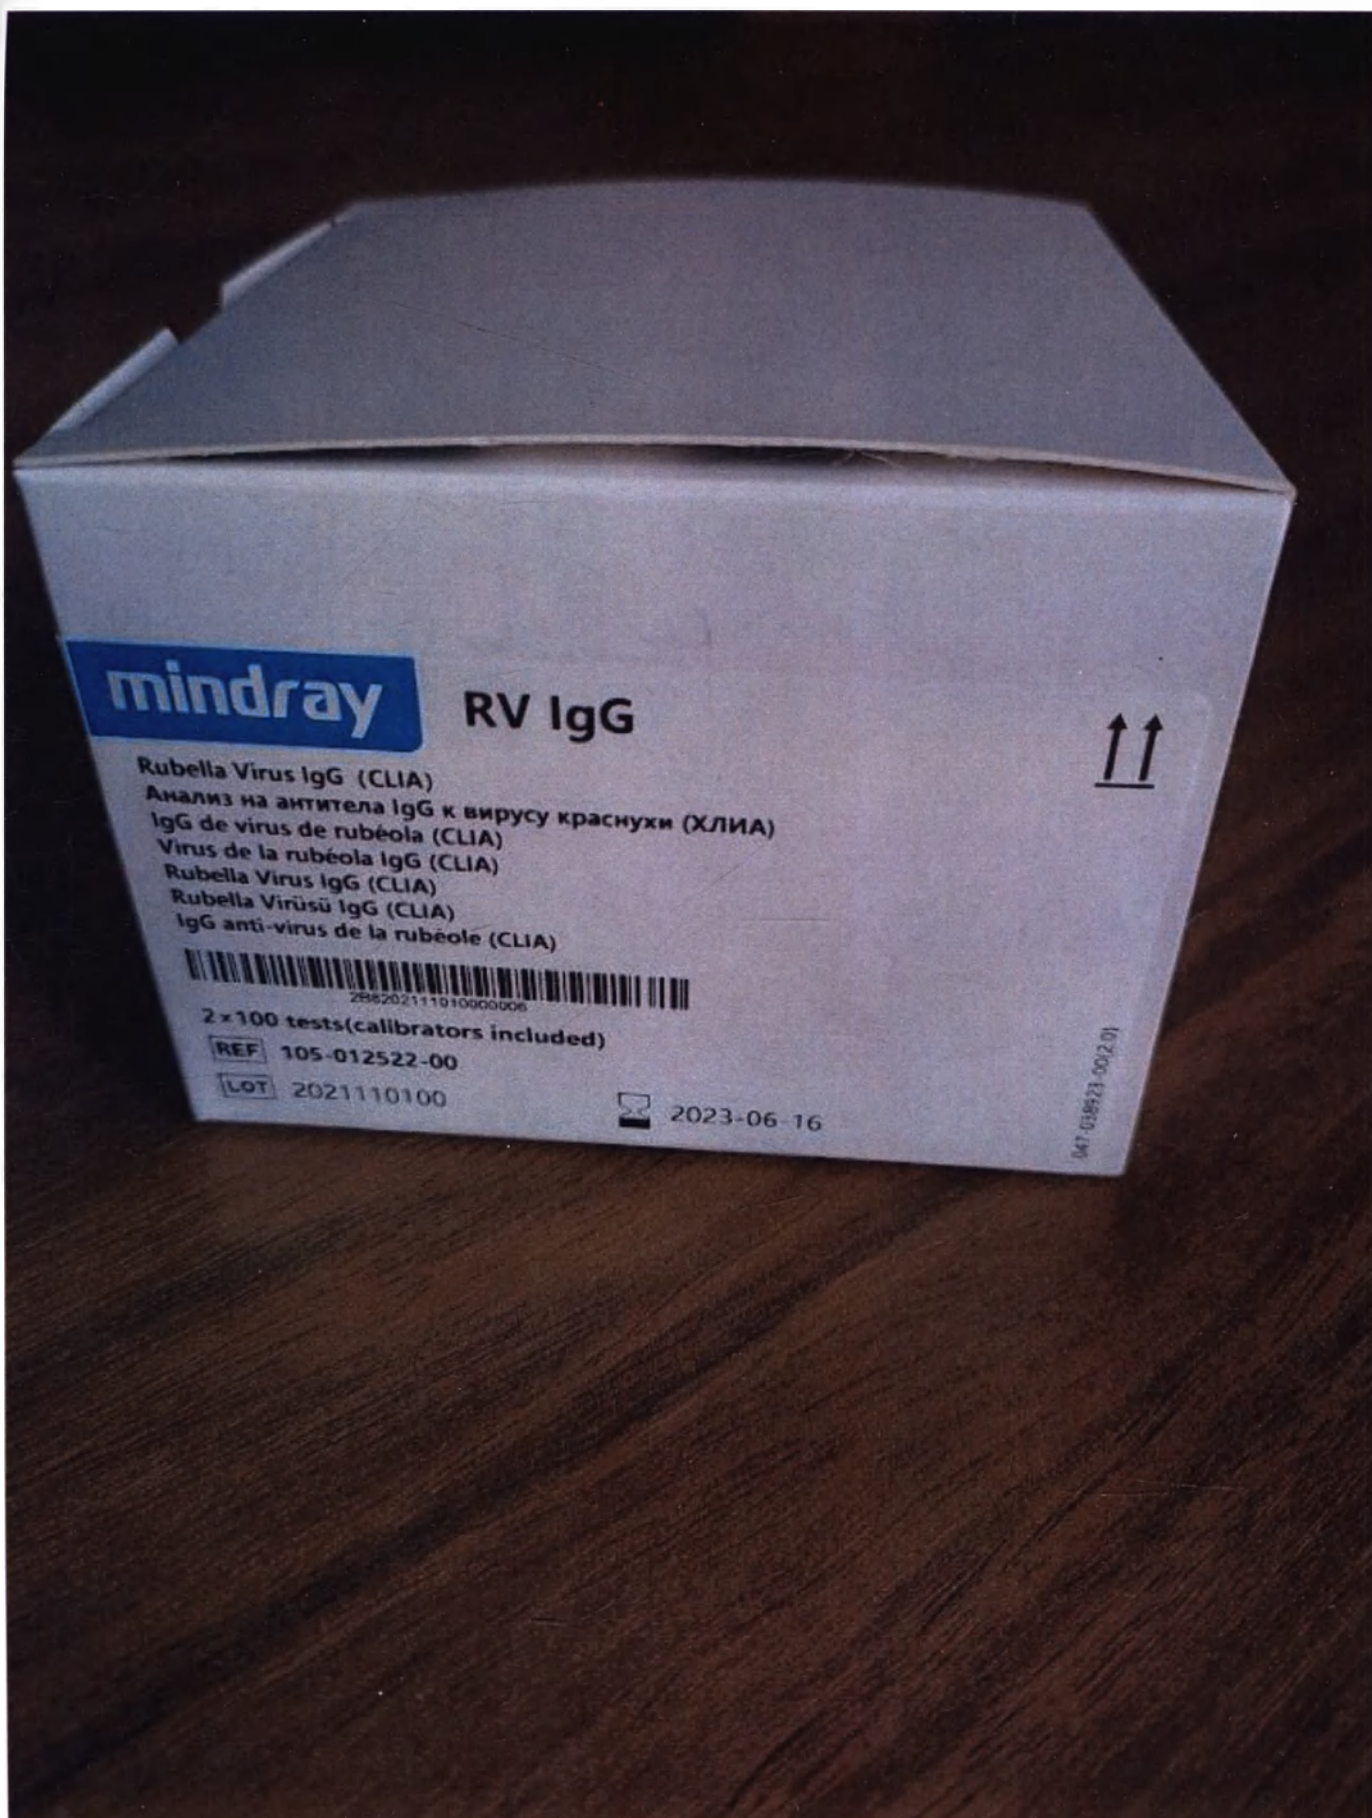


Рисунок 17. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 2)

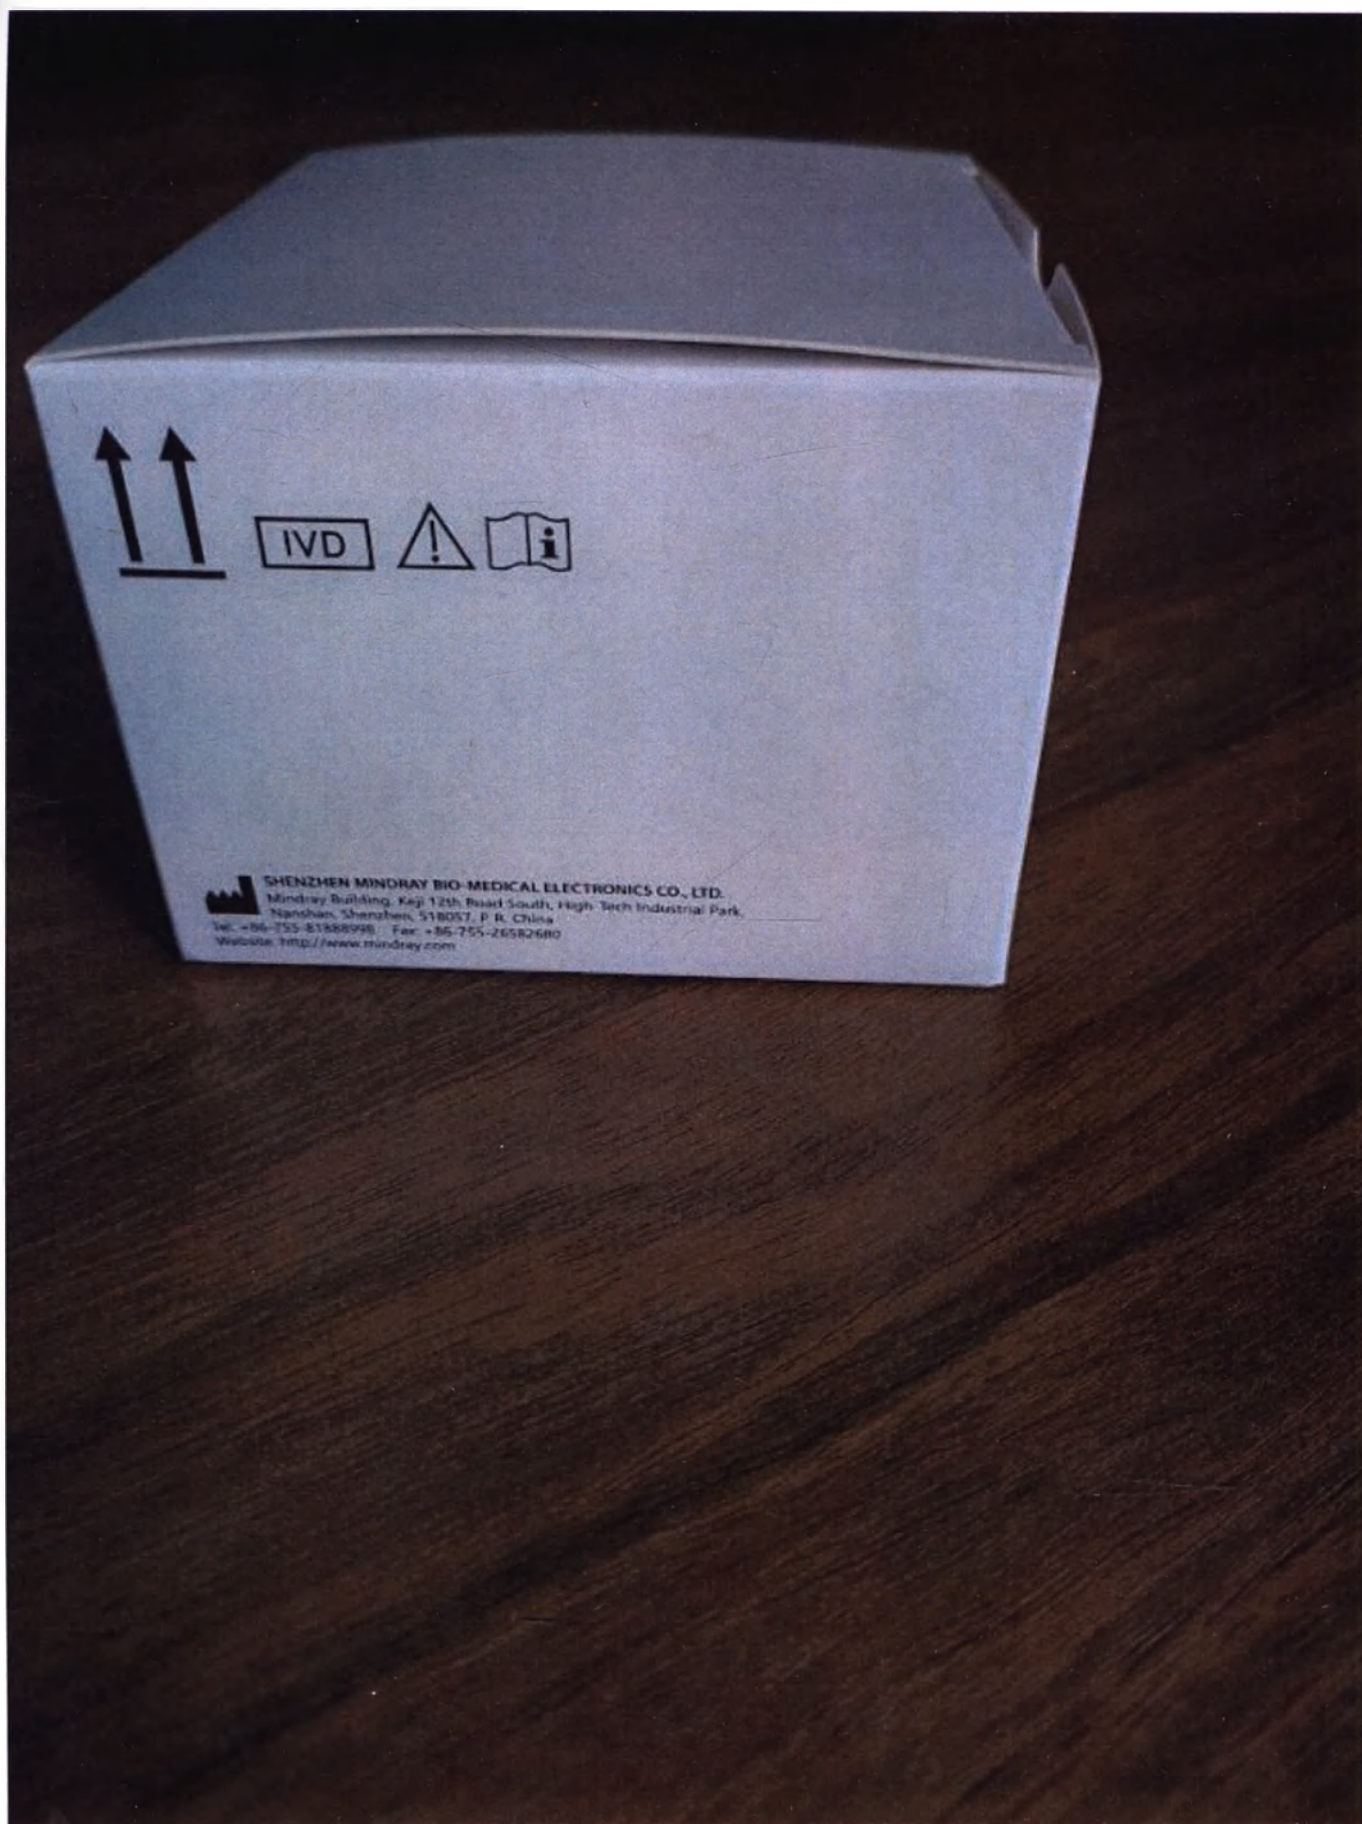


Рисунок 18. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 3)

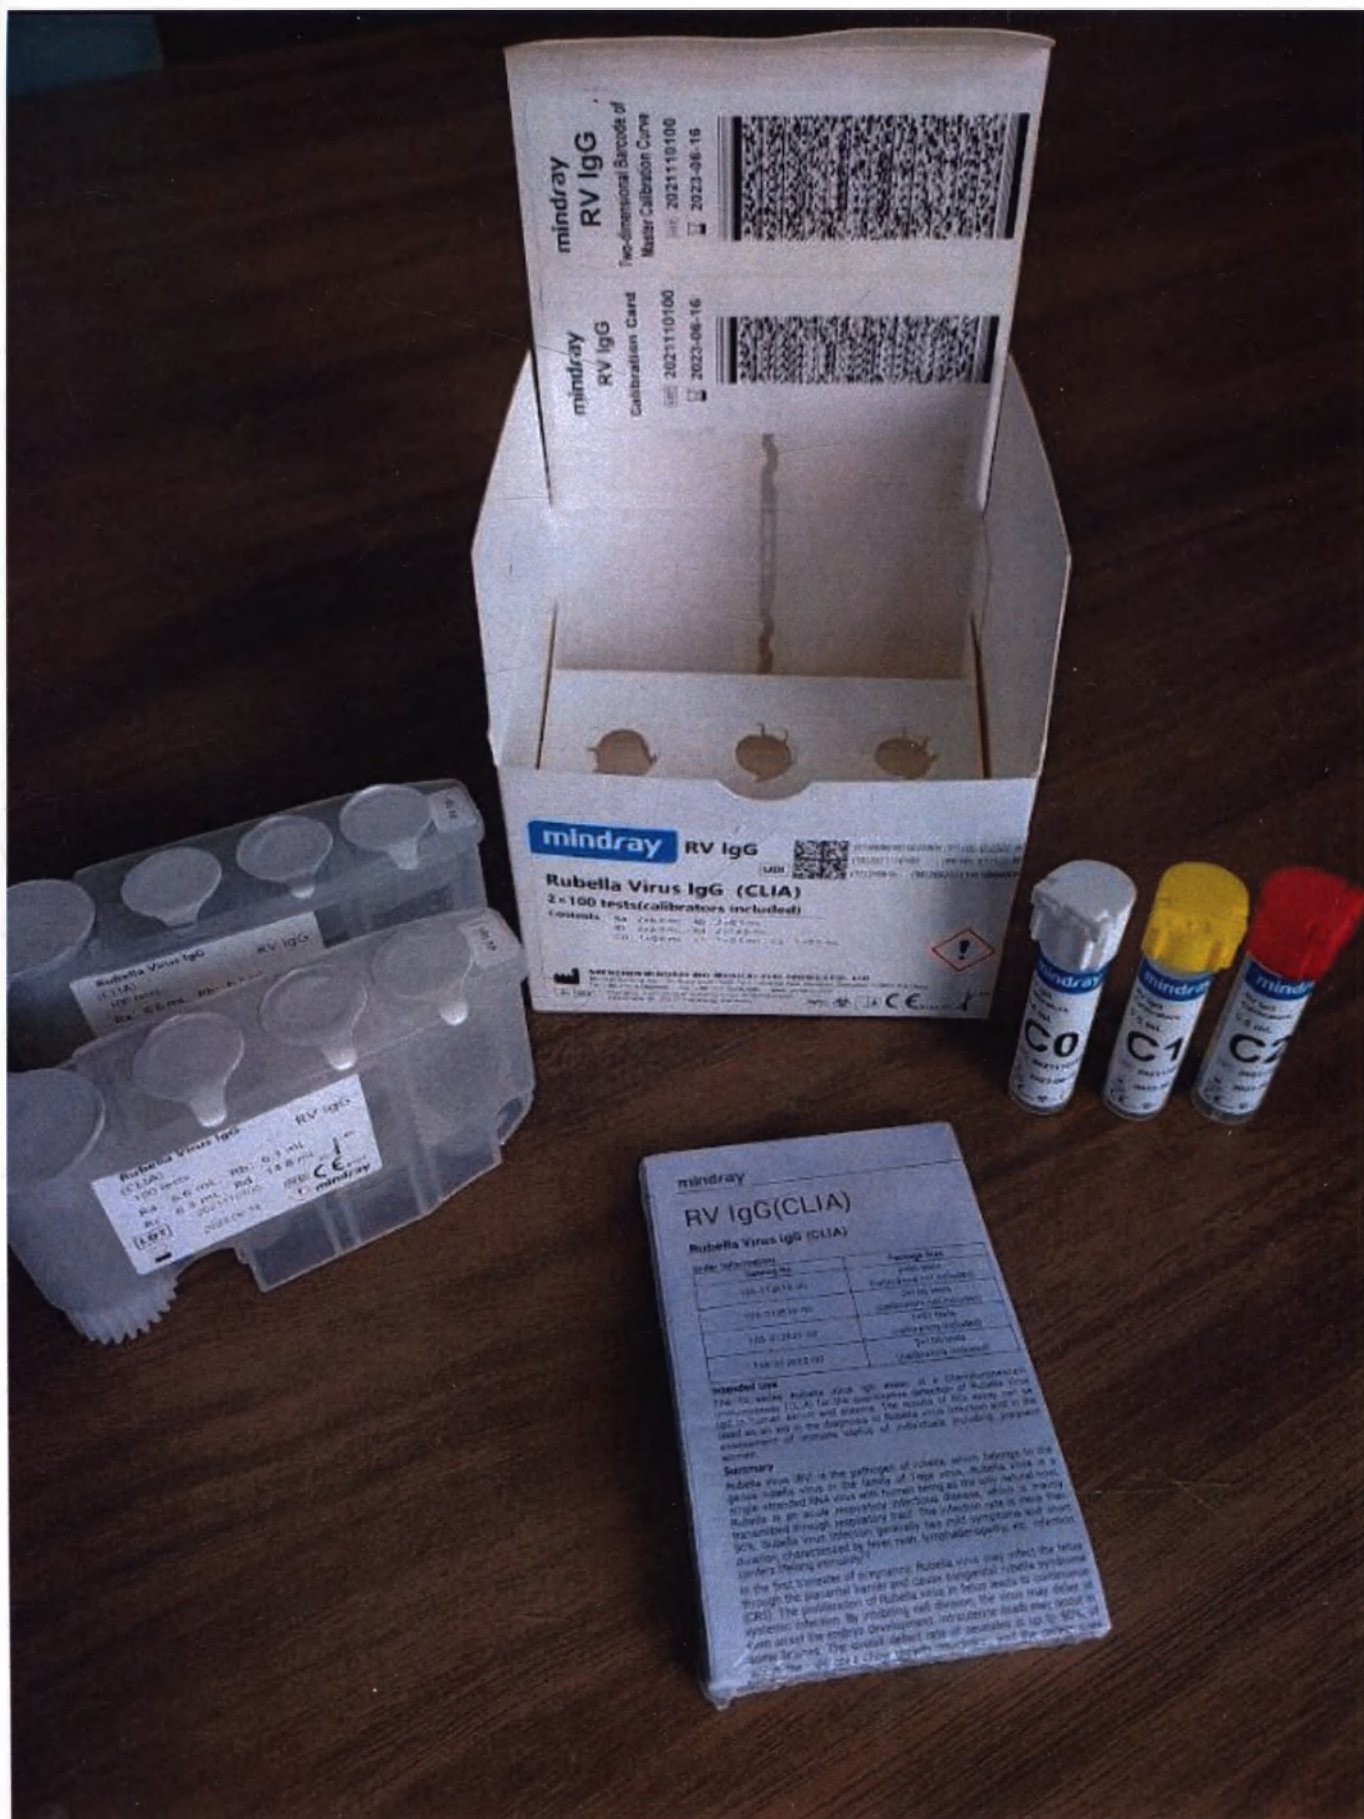


Рисунок 19.Общий вид Набор реагентов для количественного определения IgG к Rubella virus (Rubella virus IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен)

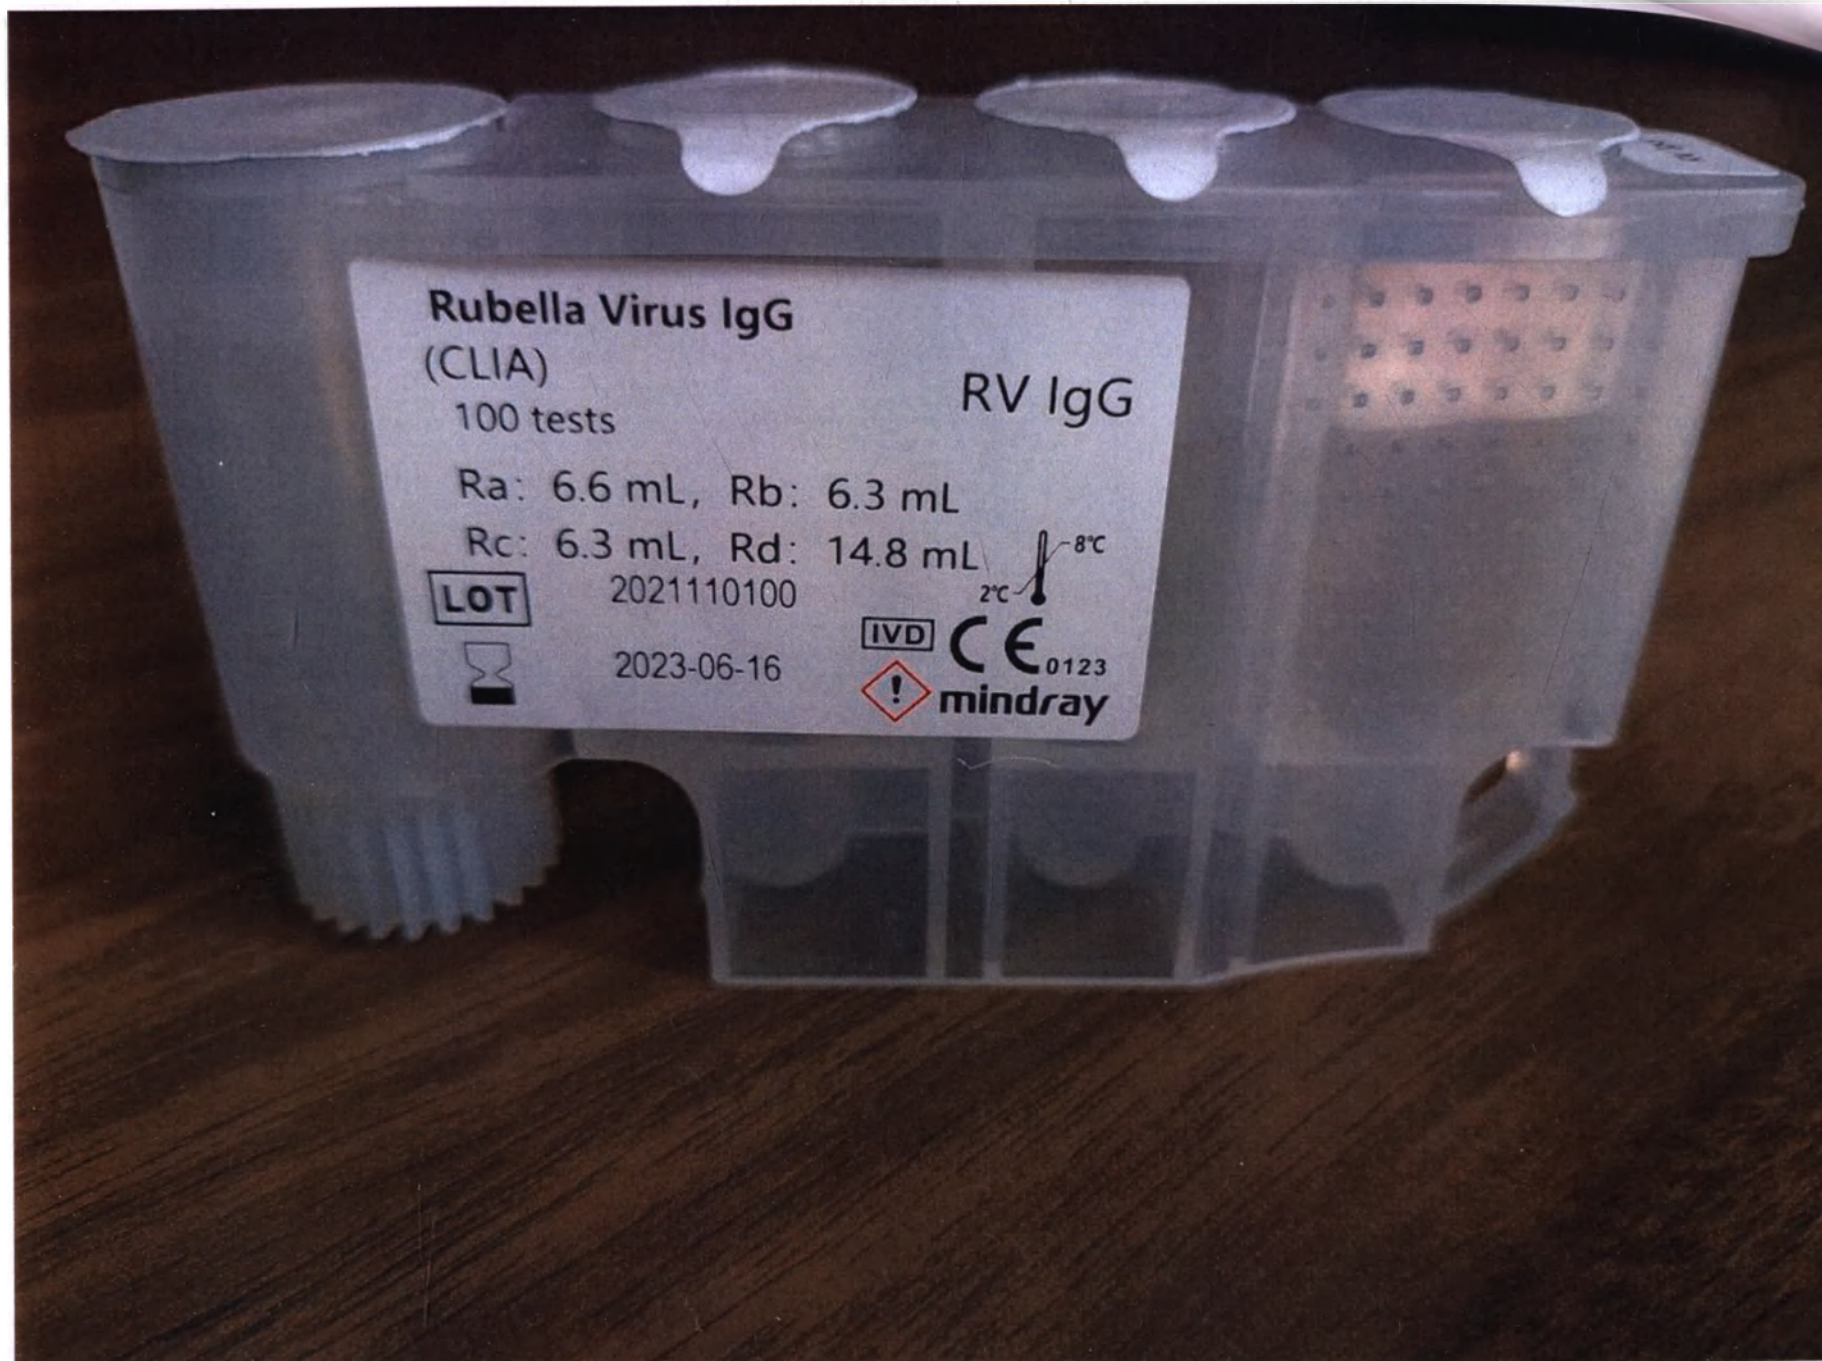


Рисунок 20. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 1)



Рисунок 22. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 23. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид2)



Рисунок 24. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 25. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 26. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 27. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид2)

mindray

RV IgG(CLIA)

Rubella Virus IgG (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012518-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012519-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012521-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012522-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series Rubella virus IgG assay is a Chemiluminescent immunoassay (CLIA) for the quantitative detection of Rubella virus IgG in human serum and plasma. The results of this assay can be used as an aid in the diagnosis of Rubella virus infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Rubella virus (RV) is the pathogen of rubella, which belongs to the genus rubella virus in the family of Toga virus. Rubella virus is a single-stranded RNA virus with human being as the only natural host. Rubella is an acute respiratory infectious disease, which is mainly transmitted through respiratory tract. The infection rate is more than 90%. Rubella virus infection generally has mild symptoms and short duration, characterized by fever, rash, lymphadenopathy, etc. Infection confers lifelong immunity^[1].

In the first trimester of pregnancy, Rubella virus may infect the fetus through the placental barrier and cause congenital rubella syndrome (CRS). The proliferation of Rubella virus in fetus leads to continuous systemic infection. By inhibiting cell division, the virus may delay or even arrest the embryo development. Intrauterine death may occur in some fetuses. The overall defect rate of neonates is up to 90%, of which the mild ones show growth retardation, and the severe ones

Рисунок 28. Инструкция по применению – 1 шт



Исход

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
29 листа (ов)