

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.
2017



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Материалы стоматологические композитные под товарным знаком IDS»

Инструкция по применению **Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения** **LC MH CERAMIC NANO** (оттенки по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Translucent, A1 Оpaque, A2 Оpaque, A3 Оpaque, A 3.5 Оpaque, A4 Оpaque). LC MH CERAMIC NANO – светоотражаемый пакуемый керамический микрогибридный композитный материал с нано-наполнителями. В основе LC MH CERAMIC NANO смола BisGMA, частицы неорганического наполнителя 0.05-0.9 мкм. Общее содержание наполнителя по массе составляет 82%. Композитный материал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Реставрация всех классов на тонких реставрациях из полувсплавающей или другой керамики.
- Не применяйте изделия для регулировки вязкости в интра- и жевательных областях.
- Не используйте смолы для реставрации в области композитного материала.
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и носите защиту для глаз.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Побочные эффекты:

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.

Несовместимость с другими материалами:

Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эugenol, так как эugenol ингибирует полимеризацию композита. Не храните композитный материал в непосредственной близости от продуктов, содержащих эugenol, не позволяйте композиту вступать в контакт с материалами, содержащими эugenol. Очистите препаратку полировочной пастой без фтора (например, Opalescence) до подготовки и выбора цвета. Очистите пемзой с водой, пока зубы еще влажные, и выберите подходящий цвет.

Финишная обработка:

Проверьте окклюзию и проведите финишную обработку. Контурируйте с помощью алмазных боров, камусов, твердосплавных боров. Отполируйте при помощи резиновых полиров. Обработка межпроксимальных и окклюзионных поверхностей при помощи лент мелкой зернистости осуществляется при температуре не выше 25°C (78°F).

Хранение:

Хранить при температуре не выше 25°C (78°F). Защищать от попадания солнечных лучей. Не использовать после окончания срока годности. Закрывайте шприц сразу после использования, чтобы избежать попадания света на материал.

Гарантия:

P.L. Superior Dental Materials GmbH гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов. P.L. Superior Dental Materials GmbH не дает никаких других гарантий, включая любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности, или пригодности для определенной цели. Пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта. Если этот продукт будет иметь дефект в течение гарантийного срока, Вашим исключительным правом и единственной обязанностью P.L. Superior Dental Materials GmbH будет ремонт или замена продукта.

Ограничение ответственности:

За исключением случаев, предусмотренных законом, P.L. Superior Dental Materials GmbH не будет нести ответственность за какой-либо ущерб или убытки, возникшие от этого продукта, будь то прямые, косвенные, специальные, случайные или логически вытекающие, независимо от теории права, в том числе по гарантии, контракту, возникшие по причине небрежности или строгой ответственности.



Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS
LC MH CERAMIC NANO 4г



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC MH CERAMIC NANO.»



Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC MH CERAMIC NANO.

Инструкция по применению медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC MH CERAMIC NANO.»

Инструкция по применению

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC МН CERAMIC AP (оттени по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Translucen, A1 Opac, A2 Opac, A3 Opac, A3.5 Opac, A4 Opac).

LC МН CERAMIC AP – светоотверждаемый набухающий керамический композитный материал 0,05-0,9 мм. Общее содержание наполнителя по массе составляет 82%. Композитный материал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Реставрация всех классов.
- Препарирование и склеивание на тонких реставрациях из полимерных или другой низкотемпературной керамики.
- Не применяйте материал для реставрации височных вывихов и мостов Мерленда.
- Не используйте материал для реставрации случайных контактов.
- Не используйте материал в сочетании с вставками из нержавеющей стали.
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошла повреждение, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Возможные эффекты:

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходима накладка пломбировочного материала.

Неиспользование в сочетании с вставками из нержавеющей стали. Не используйте материал в сочетании с вставками из нержавеющей стали, так как материал может вызвать коррозию нержавеющей стали.

Подготовка поверхности и подбор цвета. Препарировать пломбу до подготовки и выбора цвета. Очистите поверхность от влаги, пока зубы еще влажные, и выберите соответствующий цвет зуба.

Финишная обработка: Проверьте окклюзию и проведите финишную обработку. Контролируйте с помощью ладоней при пощипывании твердых тканей. Обработка межзубных пространств.

Срок годности: 3 года. Хранить при температуре не выше 25°C (78°F). Небольшое количество материала можно использовать после окончания срока годности. Закрытые шприцы после использования.

Хранение: Хранить при температуре не выше 25°C (78°F). Небольшое количество материала можно использовать после окончания срока годности. Закрытые шприцы после использования.

Гарантия: Denial Materials GmbH гарантирует, что данный материал соответствует требованиям FDA, CE, ISO 13485.

Отказ от ответственности: Denial Materials GmbH не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования данного материала.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.


Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Пользователь: Пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и использовать материал в соответствии с инструкцией.

Шприц с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
LC МН CERAMIC AP.



Потребительская индивидуальная
упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
LC МН CERAMIC AP.»

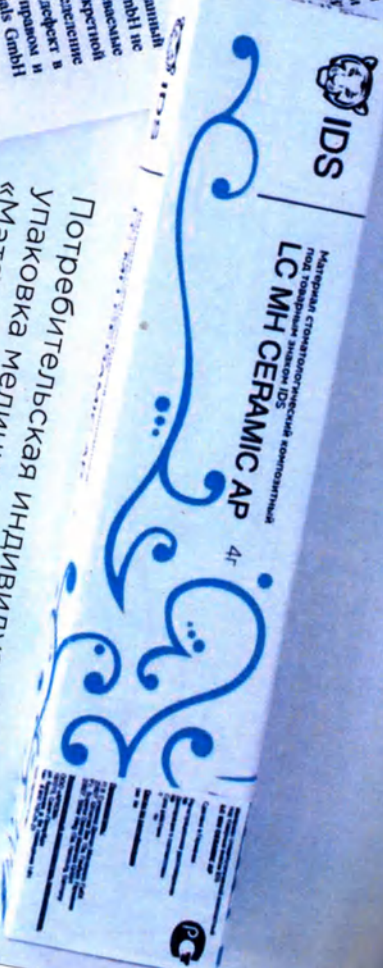

Инструкция по применению
Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения
LC MICROHYBRID (оттенки по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Translucent, A1 Opaque, A2 Opaque, A3 Opaque, A3.5 Opaque, A4 Opaque).

LC MICROHYBRID – светоотверждаемый пакуемый микрогибридный композитный материал. В основе LC MICROHYBRID смола BIS-GMA, частицы неорганического наполнителя 0.05-1.5 мкм. Общее содержание наполнителя по массе составляет 80%. Композитный материал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Реставрация всех классов.

Противопоказания:

- Не применяйте изделия на тонких реставрациях из полнотелой или другой низкотемпературной керамики, винирах и мостах Мерилена.
- Не используйте смолы для регулировки вязкости композитного материала.
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами/слизистыми оболочками немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Побочные эффекты:

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.

Несовместимость с другими материалами:

Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эвенол, так как эвенол ингибирует полимеризацию композита. Не храните композитный материал в непосредственной близости от продуктов, содержащих эвенол, не позволяйте композиту вступать в контакт с материалами, содержащими эвенол.

Подготовка препаровки и подбор цвета:

Очистите препаровку полировочной пастой без фтора (например, суспензией пемзы с водой) до подготовки и выбора цвета. Определите цвет зуба, пока зубы еще влажные, и выберите

Финишная обработка:

Проверьте окклюзию и проведите финишную обработку. Контурируйте с помощью алмазных боров, как твердосплавных боров. Отполируйте при помощи д резиновых полиров. Обработка межпроксимальных не осуществляется при помощи лент мелкой зернистости.

Срок годности: 3 года

Хранение:

Хранить при температуре не выше 25°C (78°F). Избегать попадания солнечных лучей. Не используйте после окончания срока годности. Закрывайте шприц сразу после использования, чтобы избежать попадания света на материал.

Гарантия:

P.L. Superior Dental Materials GmbH гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов. P.L. Superior Dental Materials GmbH не дает никаких других гарантий, включая любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности, или пригодности для конкретной цели. Пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта. Если этот продукт будет иметь дефект в течение гарантийного срока, Вашим исключительным правом и единственной обязанностью P.L. Superior Dental Materials GmbH будет ремонт или замена продукта.

Ограничение ответственности:

За исключением случаев, предусмотренных законом, P.L. Superior Dental Materials GmbH не будет нести ответственность за какой-либо ущерб или убытки, возникшие от этого продукта, будь то прямые, косвенные, специальные, случайные или логически вытекающие, независимо от теории права, в том числе по гарантии, контракту, возникшие по причине небрежности или



Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS
LC MICROHYBRID 4,5г

Потребительская индивидуальная
упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
LC MICROHYBRID.»



Шприц с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
LC MICROHYBRID.

Инструкция по применению медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный под товарным
знаком IDS. Вариант исполнения LC MICROHYBRID.»

Инструкция по применению
LC FLOWFILL (оттенки по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Translucent, A1 Opaque, A2 Opaque, A3 Opaque, A3.5 Opaque, A4 Opaque)
 Принадлежности: игольчатая канюля 20 га, диаметр 0,812 мм
 LC FLOWFILL – светоотверждаемый композитный материал. В основе LC FLOWFILL метакрилатная смола и частицы неорганического наполнителя 0,05-1 мкм. Общее содержание наполнителя по массе составляет 60%. Композитный материал соответствует требованиям DIN ISO 4049.

Показания к применению:

- Реставрация передних зубов (класс III, IV, V)
- Небольшие полости
- Заполнение полости
- Формирование изолирующего слоя.

Противопоказания:

- Не применяйте изделия на тонких реставрациях из винирах и мостах Мерилена.
- Не используйте смолы для регуляции вязкости композитного материала.
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Побочные эффекты:

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо положить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.

Несовместимость с другими материалами:

Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эugenol. Не используйте полимеризацию композита от так как эugenol ингибирует полимеризацию композитных продуктов. Содержащих эugenol, не позволяйте композиту вступать в контакт с материалами, содержащими эugenol.

резиновых полиров. Обработка межпроксимальных поверхностей осуществляется при помощи лент мелкой зернистости.

Срок годности:

Хранить при температуре не выше 25°C (78°F). Хранить в темном месте. Не использовать после окончания срока годности. Закрывайте шприц сразу после использования, чтобы избежать попадания света на материал.

Гарантия:

P.L. Superior Dental Materials GmbH гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов. P.L. Superior Dental Materials GmbH не дает никаких других гарантий, включая любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности, или пригодности для конкретной цели. Пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта. Если этот продукт будет иметь дефект в течение гарантийного срока, Вашим исключительным правом и обязанностью P.L. Superior Dental Materials GmbH будет ремонт или замена продукта.

Ограничение ответственности:

За исключением случаев, предусмотренных законом, P.L. Superior Dental Materials GmbH не будет нести ответственность за какой-либо ущерб или убытки, возникшие от этого продукта, будь то прямые, косвенные, специальные, случайные или логически вытекающие, независимо от теории права, в том числе по гарантии, контракту, возникшие по причине небрежности или строгой ответственности.

Берегите от детей!

Используется только в стоматологии.



Материал стоматологический композитный
 под товарным знаком IDS
LC FLOWFILL 2мл



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL.»

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL.

Инструкция по применению медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL.»

Материалы с...
MONOLINE (характеристики о...
... 20 гд. диаметр 0,812 мм

Принципиальность: молдчатый стеклонитерный композит — светостоверждаемый стеклонитерный композит по требованиям DIN EN ISO 4049.

Koshiba

- [illegible]

Побочные эффекты
Возможно раздражение

Побочные эффекты
Возможно раздражение

Для защиты цулыны из гидрокарбоната натрия прокладку из гидрокарбоната натрия натирают на поверхности.

[illegible]

Удалите крышку с ширинца LC
вступить в контакт с материалами, содержащими
Толкатель: ...

Очистите и вставьте использованный блокнот на блокнот JOURNAL и присоедините количество обращения с LC вылавливаете небольшое количество бетонное обращение с LC вылавливаете, чтобы обеспечить безопасное обращение с LC вылавливаете.

Срок годности: 3 года

Хранение: не выше 25 °C в темноте. Хранить при температуре не выше 25 °C в темноте. Не использовать после окончания срока годности.

попадания света на материал. Закрывайте ширму с срока годности. Попадания света на материал. Чтобы избежать попадания света на материал.

[illegible]

бывает ремонт или замена

Отмечается, что, к сожалению, продукция не отвечает требованиям безопасности. За исключением сырья, полученного от своего производителя Dental Materials GmbH не будет нести ответственности за использование или утилизацию сырья. В том числе и при использовании в качестве сырья. В том числе и при использовании в качестве сырья. В том числе и при использовании в качестве сырья.

...or better?

Беребь и
Используется только в...

Инструкция по применению
использования

аппарат — натуральный белок



Материал статоров и роторов комбинированный
полюсовый знак ID5
LC IONOLINE
2мг

Потребительская индивидуальная
упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологического изделия
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE.»

Инструкция по применению медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный под товарным
знаком IDS. Вариант исполнения LC IONOLINE.»

Шпирц с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
LC IONOLINE.



Инструкция по применению Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC HI-FLOW NANO (оттенки по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Translucent, A1 Оранже, A2 Оранже, A3 Оранже, A3.5 Оранже, A4 Оранже). Принадлежности: иглообразная канюля 17 ga, диаметр 1,15 мм

LC HI-FLOW NANO – светоотверждаемый микрогибридный композитный материал с нано-наполнителями. Обладая низкой усадкой и высокой устойчивостью к истиранию, LC HI-FLOW NANO хорошо обрабатывается и имеет превосходные механические свойства.
В основе LC HI-FLOW NANO смола BIS-GMA и частицы неорганического наполнителя <1,0 мкм. Общее содержание наполнителя по массе составляет 65%. Композитный материал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Реставрация передних зубов (классе III, IV, V)
- Небольшие реставрации I и II классов
- Заполнение полостей

Противопоказания:

- Не применяйте изделие на тонких реставрациях из полувоспалительной или другой низкотемпературной керамики, винирах и мостах Меркленда.
- Не используйте смолы для регулировки вязкости композитного материала.
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами/слизистыми оболочками немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Побочные эффекты:

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.

Несовместимость с другими материалами

Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эugenol, так как эugenol ингибирует полимеризацию композита. Не храните композитный материал в непосредственной близости от продуктов, содержащих эugenol, не позволяйте композиту вступать в контакт с материалами, содержащими эugenol.

резиновых полиров. Обработка межпроксимальных осуществляется при помощи легкого шлифования.

Срок годности: 3 года

Хранение:

Хранить при температуре не выше 25°C. Избегать попадания солнечных лучей. Не используйте после истечения срока годности. Закрывайте сразу после использования, чтобы избежать попадания света на материал.

Гарантия:

P.L. Superior Dental Materials GmbH гарантирует, что продукт не имеет дефектов. P.L. Superior Dental Materials GmbH не несет ответственности за определение пригодности продукта, или пригодности для конкретной цели. Пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта. Если этот продукт будет иметь дефект в течение гарантийного срока, Вашим исключительным правом и единственной обязанностью P.L. Superior Dental Materials GmbH будет ремонт или замена продукта.

Ограничение ответственности:

За исключением случаев, предусмотренных законом, P.L. Superior Dental Materials GmbH не будет нести ответственность за какой-либо ущерб или убытки, возникшие от этого продукта, будь то прямые, косвенные, специальные, случайные или логически вытекающие, независимо от теории права, в том числе по гарантии, контракту, возникшие по причине небрежности или строгой ответственности.

Береж. от детей!



IDS


Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS

LC HI-FLOW NANO

2мл



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC HI-FLOW NANO.»

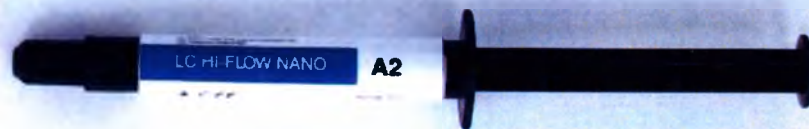

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC HI-FLOW NANO.

Инструкция по применению медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC HI-FLOW NANO.»

Инструкция по применению
Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения
LC NANOFILL XP (оттенки по шкале VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Translucen, A1 Opacite, A2 Opacite, A3 Opacite, A3.5 Opacite, A4 Opacite).
 Принадлежность: игольчатая канюля 20 га, диаметр 0,812 мм
 LC NANOFILL XP – светоотверждаемый пастусый композитный материал с нано-наполнителями. Обладая низкой усадкой и устойчивостью к истиранию, LC NANOFILL XP хорошо обрабатывается и имеет превосходные механические свойства. В основе LC NANOFILL XP уретрандиставрилатная смола и частицы неорганического наполнителя <1,0 мкм. Общее содержание наполнителя составляет 82 % по массе. Композитный материал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Реставрация всех классов
- Не применяйте на тонких реставрациях из винирах и мостах Мерила.
- Не используйте композитного материала для регулировки вязкости
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Побочные эффекты:

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция. Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эugenol, так как эugenol ингибирует полимеризацию композита. Не храните композитный материал, содержащий эugenol, в контакте с материалами, содержащими эugenol, так как эugenol может вызвать повреждение композита. Смешайте препарат полировочной пастой без фтора (например, 52690).

Финишная обработка:

Проверьте окклюзию и проведите финишную обработку бором. Контурируйте с помощью алмазных резиновых полиров. Обработка микроскопическими полировочными пастами при помощи дент. мягкой зернистости.

Срок годности:

Хранить при температуре не выше 25°C. Срок годности: 3 года.

Гарантия:

P.L. Superior Dental Materials GmbH гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов. P.L. Superior Dental Materials GmbH не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования продукта. Если этот продукт будет иметь дефект в течение гарантийного срока, Вашим исключительным правом будет ремонт или замена продукта. Единственной обязанностью P.L. Superior Dental Materials GmbH является замена продукта, если дефект возникнет в течение гарантийного срока. P.L. Superior Dental Materials GmbH не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникшие от этого продукта, будь то прямые, косвенные, специальные, случайные или логически вытекающие от теории права, в том числе по...

Ограничение ответственности:

За исключением случаев, предусмотренных законом, P.L. Superior Dental Materials GmbH не будет нести ответственность за какой-либо ущерб или убытки, возникшие от этого продукта, будь то прямые, косвенные, специальные, случайные или логически вытекающие от теории права, в том числе по...



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC NANOFILL XP.»



Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC NANOFILL XP.

**Инструкция по применению
Вариант исполнения**

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS, Вариант исполнения
LC FLOWFILL SE (оттенки по шкале VITA: A1, A2, A3, B1).
Принадлежности: иглообразная каниюла 20 га, диаметр 0,812 мм
LC FLOWFILL SE – светоотверждаемый самоотгизивный композитный материал. В основе LC FLOWFILL SE метакрилатная смола и неорганические наполнители. Общее содержание наполнителя по массе составляет 60%. Композитный материал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Небольшие реставрации I класса
- Выстилка полостей I класса
- Герметизация ямок и fissur
- Заполнение полостей

Противопоказания:

- Не применяйте изделия на тонких реставрациях из полешошнатной или другой низкотемпературной керамики.
- Заполнение ямок и fissur
- Не используйте смолы для регулировки вязкости композитного материала
- Не используйте смолы для регулировки вязкости композитного материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Побочные эффекты:

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.

Несовместимость с другими материалами:

Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эвгенол, так как эвгенол ингибирует полимеризацию композита. Не храните композитный материал в непосредственной близости от продуктов, содержащих эвгенол, не позволяйте композиту вступать в контакт с материалами, содержащими эвгенол.

Подготовка препаровки и подбор цвета

компрессора, оставьте блестящую поверхность эмали немного влажной. Нанесите тонкий слой LC FLOWFILL SE непосредственно подготовленные области. При помощи прилагаемого микробрас распределите его по полостям стен и скошенным краям небольшим давлением в течение 20 секунд. Удалите излишки материала вокруг краев при помощи микробраса.

Отвердите LC FLOWFILL SE следующим образом:
Светлые оттенки (например A1, A2, B2) 20 секунд
Темные оттенки (например A3.5) 30 секунд

Финишная обработка:

Проверьте окклюзию, скорректируйте ее, если необходимо. Контурируйте с помощью алмазных боров, камней или твердосплавных боров. Отполируйте при помощи дисков или резиновых полиров. Обработка межпроксимальных поверхностей осуществляется при помощи лент мелкой зернистости.

Срок годности:

2 года

Хранение:


Хранить при температуре не выше 25°C (78°F). Избегайте попадания солнечных лучей. Не используйте после окончания срока годности. Закрывайте шприц сразу после использования, чтобы избежать попадания света на материал.

Примечания:


- Для отверждения используйте галогеновую лампу с мощностью светового потока минимум 500 мВт/см² или LED-лампу с мощностью светового потока минимум 1000 мВт/см².
- VITA® является зарегистрированной торговой маркой VITA-Zahnfabrik, Bad Sackingen, Германия.

Гарантия:

P1 Superior Dental Materials GmbH, Германия

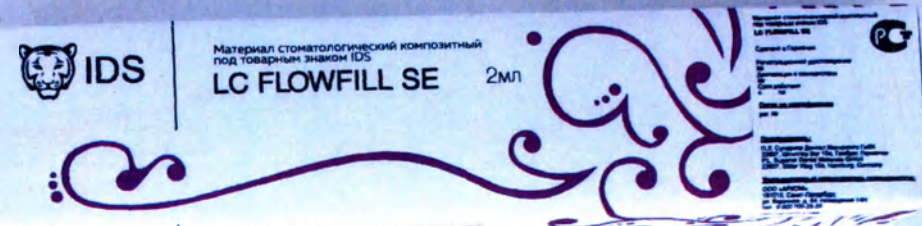

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL SE.»



Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL SE.

Инструкция по применению медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL SE.»

Инструкция по применению Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения

LC IONOLINE SE (оттенки по шкале VITA: A2, A3)
Принадлежности: игольчатый шпатель 20 га, диаметр 0,8/12 мм

LC IONOLINE SE – светоотверждаемый самоадгезивный композитный материал. Умеренно кислотные свойства LC IONOLINE SE д...
идеальным лайнером, особенно при использовании для покрытия МТА цемента после покрытия им дупла. LC IONOLINE SE
При использовании LC IONOLINE SE, травление тканей зуба до применения лайнера, не является обязательным. Тем не менее, применение светоотверждаемо...
самоадгезивного лайнера, поэтому использование LC IONOLINE SE с дентином и эмалью, что гарантирует более надежную связь между тканям...
повышает прочность соединения LC IONOLINE SE с дентином и эмалью, что гарантирует более надежную связь между тканям...
IONOLINE SE. LC IONOLINE SE самонаправляющийся композит. Текучесть оптимизирована для легкого нанесения. В основе LC IONOLINE SE метакрилаты и неорганические наполнители. Общее содержание наполнителя по массе составляет 66%. Композитный материал соответствует...
требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Выстилка полостей
- Покрытие МТА цемента после покрытия им дупла.
- Противопоказания
- Не применяйте кислоты на тонких реставрациях из...- постоянной или другой...- винирах и мостах Мерилелд...- Не используйте смолы для регулировки вязкости...- композитного материала.
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете...- об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт...- немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения...- Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами немедленно промойте большим количеством воды и...- оболочками немедленно промойте большим количеством воды и...- обратитесь к врачу.

Побочные эффекты:
Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой.
Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо наложить...- моллирующую прокладку из гидроксида кальция.

Несовместимость с другими материалами:
Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эфирно...- так как эфирно...- храните композитный материал в непосредственной близости от...

Срок годности: 2 года (хранить в оригинальной упаковке)
Хранение:
Хранить в заводском герметичном пакете, использовать LC IONOLINE SE в течение 6 месяцев, и до окончания срока годности. 25°C.
После того, как вы вскрыли герметичный пакет, используйте LC IONOLINE SE в течение 6 месяцев, и до окончания срока годности. 25°C.
Избегайте хранения во влажной среде. Не храните в холодильнике. Не используйте после окончания срока годности.

Гарантия:
P.L. Superior Dental Materials GmbH гарантирует продукт не имеет дефектов. P.L. Superior Dental M...- даст никаких других гарантий, включая любые...- гарантии товарной пригодности, или пригоднос...- цели. Пользователь несет ответственность...- пригодности продукта. Если этот продукт бу...- течение гарантийного срока, Ваши исклю...- единственной обязанностью P.L. Superior D...- будет ремонт или замена продукта.

Ограничение ответственности:
За исключением случаев, предусмотренных...- Dental Materials GmbH не будет нести от...- либо ущерб или убытки, возникшие от...- прямые, косвенные, специальные, слу...- вытекающие, независимо от теории...- гарантии, контракту, возникшие по п...




IDS

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE

2мл

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC IONOLINE SE.»

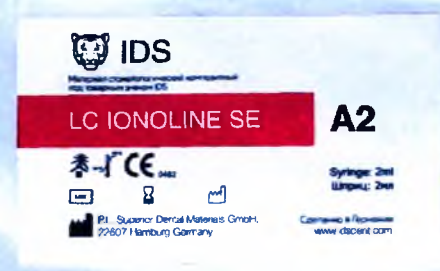

Производственная майларовая упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC IONOLINE SE.»



Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC IONOLINE SE.

Инструкция по применению медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC IONOLINE SE.»

Инструкция по применению Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC CALCIUM HYDROXID LINER (характеристика оттенков по шкале VITA не применима для данной позиции, цвет материала белый) LC CALCIUM HYDROXID LINER – светоотражаемый композитный материал с гидроксилом кальция. Общее содержание наполнителя по массе составляет 49%. Композитный материал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Покладка к применению

- Исправное покрытие пульпы на тонких реставрациях из композитного материала.
- Не применяйте материал на тонких реставрациях из композитного материала.
- Не используйте материал для регулярной окклюзии.
- Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.
- Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами немедленно обратитесь к врачу.

Побочные эффекты

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо изолировать полость с помощью гидроксида кальция. Не используйте материал в непосредственной близости от тканей, содержащих живые клетки. Не используйте материал в контакте с материалами, содержащими живые клетки. Не используйте материал в контакте с материалами, содержащими живые клетки.

Подбор цвета:

Для данного пигмента. Характеристика оттенков по шкале VITA не применима для данной позиции, цвет материала белый.

Срок годности: 1,5 года

Хранение:

Хранить при температуре 4-25 °C (39-78°F) в темном и сухом месте. Закрывайте шприц сразу после применения.

Примечание:

- При использовании LC CALCIUM HYDROXID LINER носите защитные очки и закрывайте глаза пациента.
- Неполноценный композит может оказывать раздражающее действие и вызывать сенсibilization.

Гарантия:

P.L. Superior Dental Materials GmbH гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов. P.L. Superior Dental Materials GmbH не несет ответственности за определение пригодности продукта. Если этот продукт будет иметь дефект в течение гарантийного срока, P.L. Superior Dental Materials GmbH будет нести ответственность за замену продукта.

Ограничение ответственности:

За исключением случаев, предусмотренных законом, P.L. Superior Dental Materials GmbH не будет нести ответственность за какой-либо ущерб или убытки, возникающие от этого продукта, будь то прямые, косвенные, специальные, случайные или логические, возникающие по причине небрежности или строгой ответственности.

Берегите от детей!



Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS
LC CALCIUM HYDROXID LINER

2мл



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC CALCIUM HYDROXID LINER.»



Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC CALCIUM HYDROXID LINER.

Инструкция по применению медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC CALCIUM HYDROXID LINER.»

Инструкция по применению
Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения

DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) (оттенки по шкале VITA[®]: A1, A2).

Принадлежности: смешивающая канюля MI 2.5-08-D, смешивающая канюля MB 4.2-12-D, эндодонтическая канюля IOR209, внутриротовая канюля.

DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) – композитный материал двойного отверждения. Благодаря его превосходным механическим свойствам препаровка под коронку может быть сделана более точно. DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) также подходит для фиксации коронок и мостов, вкладок и накладок, если нет высоких эстетических требований.

DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) представлен в двойной шприц AUTOMIX, 1:1. Это позволяет точно наносить и легко распределять. DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) быстро полимеризуется, даже без воздействия высоких температур. Общее содержание наполнителя по массе составляет 64%.

DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) соответствует требованиям DIN EN ISO 4049.

Показания к применению:

- Восстановление культи
- Фиксация штифтов, коронок и мостов, вкладок и накладок

Противопоказания

• Не применяйте изделия на тонких реставрациях из полнотелой или другой низкотемпературной керамики, винирах и мостах Мерилена.

• Не используйте смолы для регулировки жесткости композитного материала.

• Избегайте контакта материала с кожей, особенно, если знаете об аллергии на смолы. Если произошел случайный контакт, немедленно промойте пораженный участок водой.

• Контакт с глазами может вызвать серьезные повреждения. Носите защиту для глаз. В случае контакта с глазами/слизистыми оболочками немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Побочные эффекты

Возможно раздражение в результате прямого контакта с пульпой. Для защиты пульпы, если полость глубокая, необходимо наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.

Несовместимость с другими материалами

Не используйте в сочетании с веществами, содержащими эвгенол, так как эвгенол ингибирует полимеризацию композита. Не храните композитный материал в непосредственной близости от

канала. DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) самоотверждается в течение 3 минут 30 секунд.

Для стабилизации штифта засветите коронарную часть зафиксированного штифта в течение 20 секунд.

Как только DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX) полимеризован – приступайте к наращиванию культи.

2. Наращивание культи

2.1. Изоляция

Настоятельно рекомендуется использовать раббердам для изоляции зуба.

2.2. Подготовка полости

Удалить все существующие старые реставрации и разрушенные части зуба. Вы можете, если это необходимо, установить пины или штифты. Следуйте инструкциям производителя выбранных штифтов.

2.3. Защита пульпы

Для защиты глубокой полости пульпы необходимо наложить изолирующую прокладку из гидроксида кальция.

2.4. Применение адгезива

Нанесите адгезив, в соответствии с инструкцией производителя. Если вы работаете по технике бондинга с тотальным протравливанием, предварительно протравьте препаровку с использованием протравки, в соответствии с инструкциями производителя (рекомендуемая методика). Или используйте подходящий самопротравливающийся адгезив.



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения DS ZIRCORE FLOW NANO (Automix).»

Инструкция по применению медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DS ZIRCORE FLOW NANO (Automix).»



Шприц с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
DS ZIRCORE FLOW NANO (Automix).

Ген. директор ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «АРКОМ»



Селезнев Р.Ю.
2017

Фотографические изображения производственной майларовой упаковки
медицинского изделия «Материалы стоматологические композитные под
товарным знаком IDS» (варианты исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1
и LC IONOLINE SE)

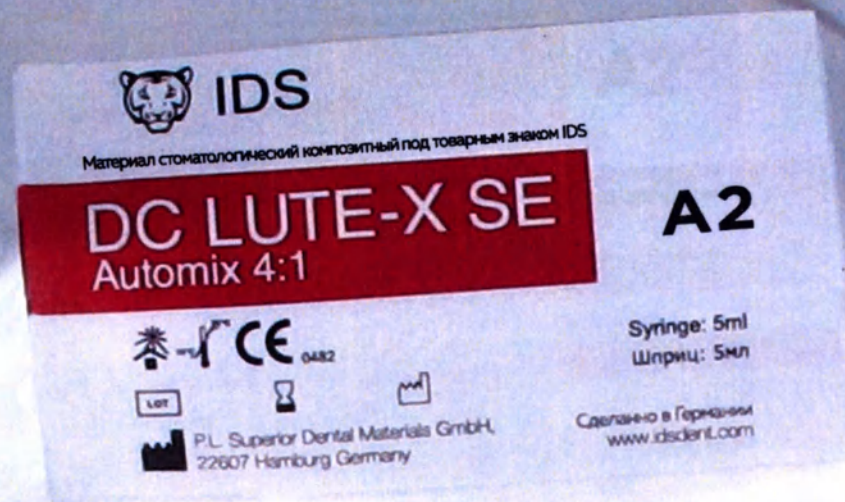

Производственная майларовая упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.»

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.



IDS

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE

A2



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Syringe: 2ml
Шприц: 2мл

Сделано в Германии
www.idscient.com

Производственная майларовая упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE SE.»



Шприц с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE SE.

прошито 3 (Три) листа
Ген. директор ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

✍.


Генеральный директор
ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.

2017



Фотографические изображения потребительской индивидуальной упаковки
медицинского изделия «Материалы стоматологические композитные под
товарным знаком IDS»

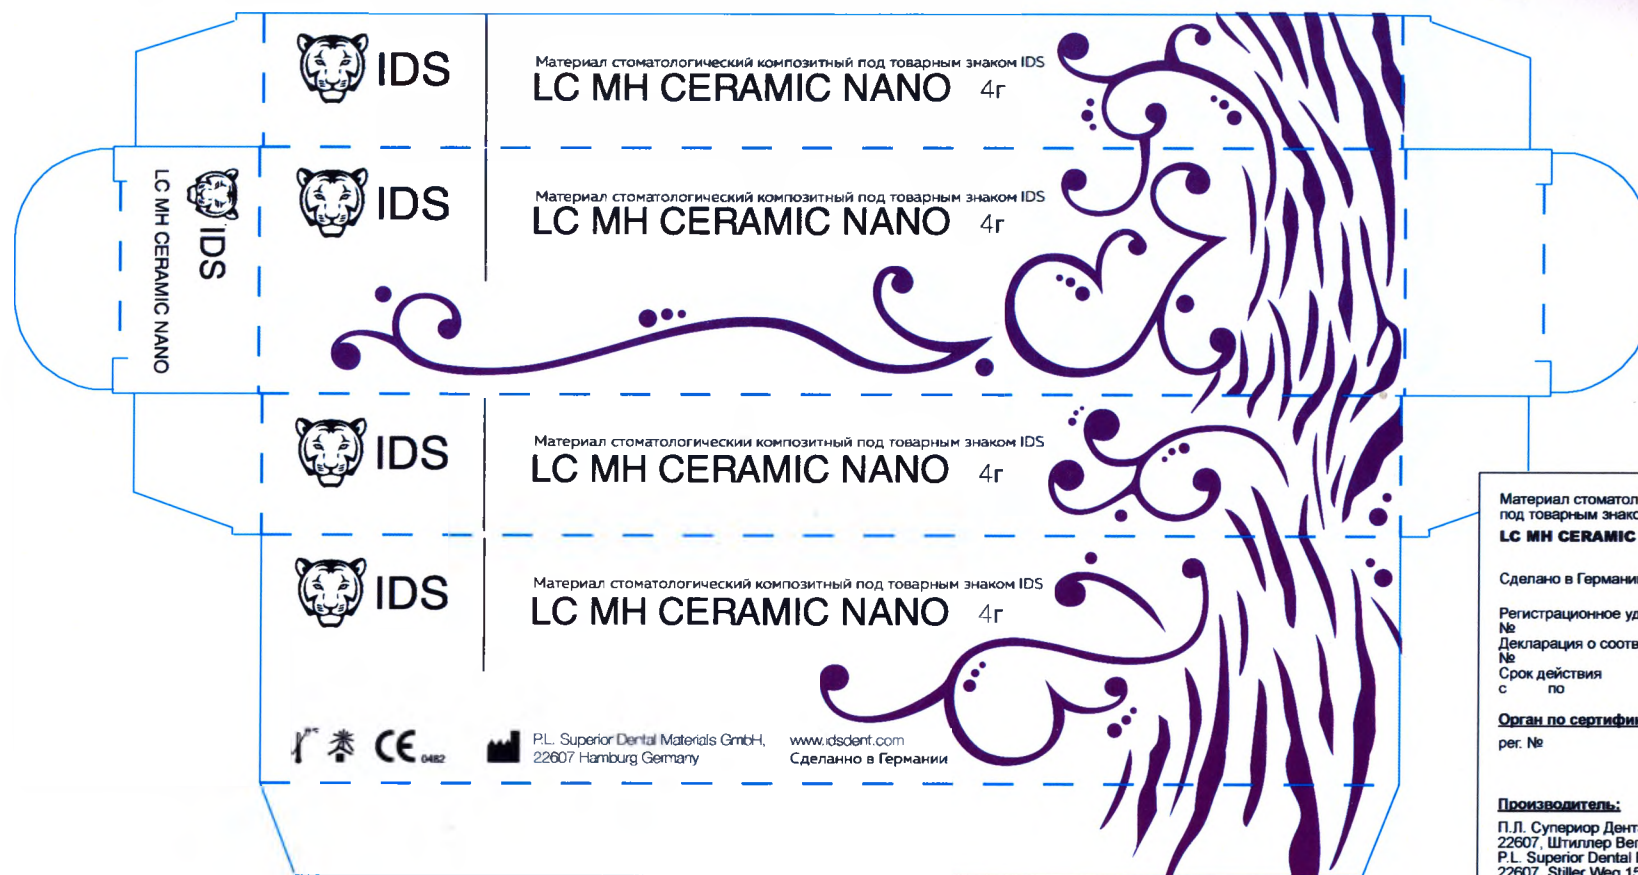

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC MH CERAMIC NANO.»

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS
LC MH CERAMIC NANO

Сделано в Германии.

Регистрационное удостоверение
№
Декларация о соответствии
№
Срок действия
с по


Орган по сертификации
рег. №

Производитель:
П.Л. Супериор Дентал Материалс ГмбХ
22607, Штиллер Берг 15а, Гамбург, Германия
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «АРКОМ»
191015, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н.
тел.: 8 800 700-25-25

Срок годности 3 года.

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC MH CERAMIC NANO.»

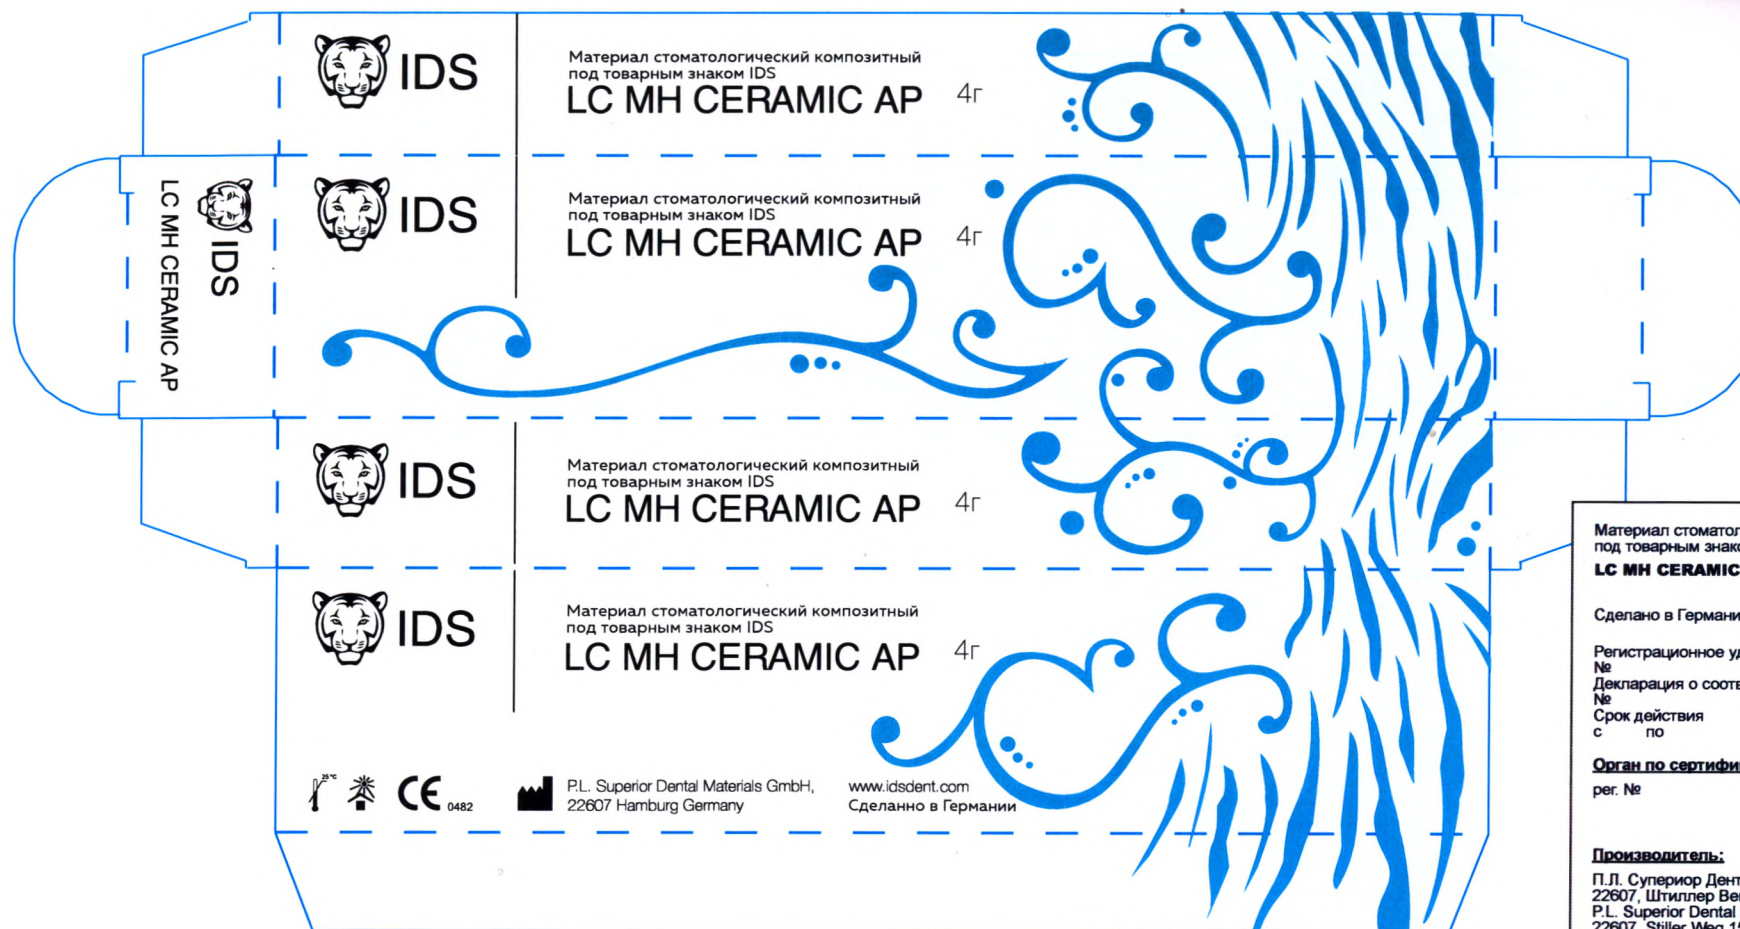

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC MH CERAMIC AP.»

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS
LC MH CERAMIC AP



Сделано в Германии.

Регистрационное удостоверение

№

Декларация о соответствии

№

Срок действия
с по

Орган по сертификации

рег. №

Производитель:


П.Л. Супериор Дентал Материалс ГмбХ
22607, Штиллер Вег 15а, Гамбург, Германия
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «АРКОМ»
191015, Санкт-Петербург,
ул. Кировная, д. 64, помещение 14Н.
тел.: 8 800 700-25-25

Срок годности 3 года.

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC MH CERAMIC AP.»

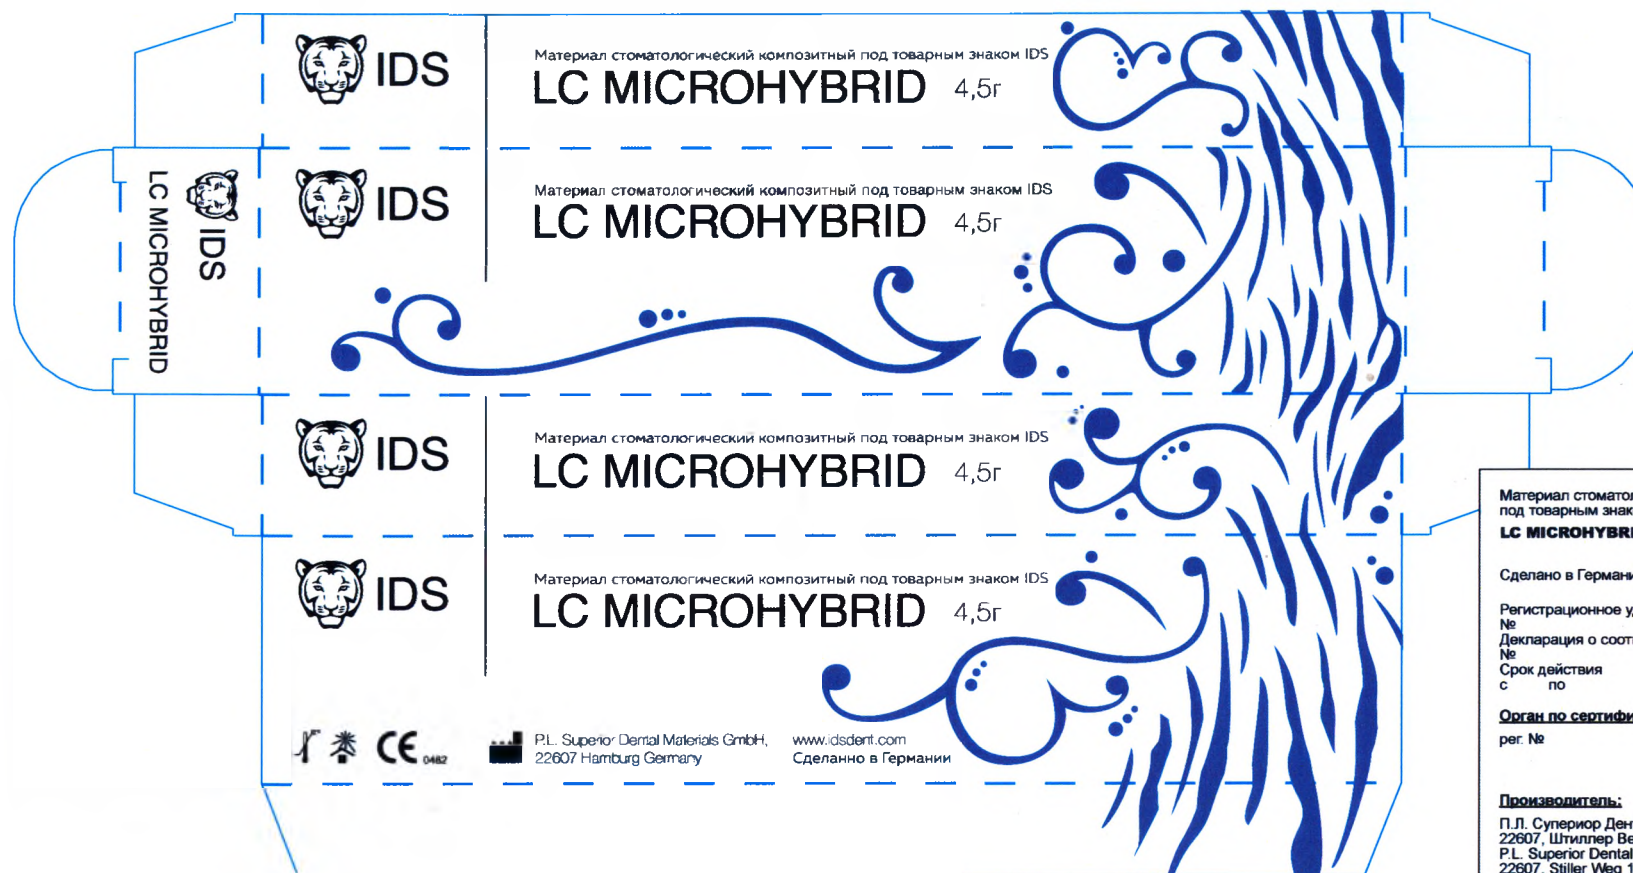

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC MICROHYBRID.»

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS		
LC MICROHYBRID		
Сделано в Германии.		
Регистрационное удостоверение	№	
Декларация о соответствии	№	
Срок действия	с по	
Орган по сертификации		
рег. №		
Производитель:		
П.Л. Супериор Дентал Материалс ГмбХ 22607, Штиллер Вег 15а, Гамбург, Германия P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany		
Уполномоченный представитель производителя:		
ООО «АРКОМ» 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н. тел.: 8 800 700-25-25		
Срок годности 3 года.		

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC MICROHYBRID.»



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL.»

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS
LC FLOWFILL

Сделано в Германии.

Регистрационное удостоверение
№
Декларация о соответствии
№
Срок действия
с по


Орган по сертификации
рег. №

Производитель:
П.Л. СуперIOR Дентал Материалс ГмбХ
22607, Штиллер Берг 15а, Гамбург, Германия
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «АРКОМ»
191015, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н.
тел.: 8 800 700-25-25

Срок годности 3 года.


Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC FLOWFILL.»

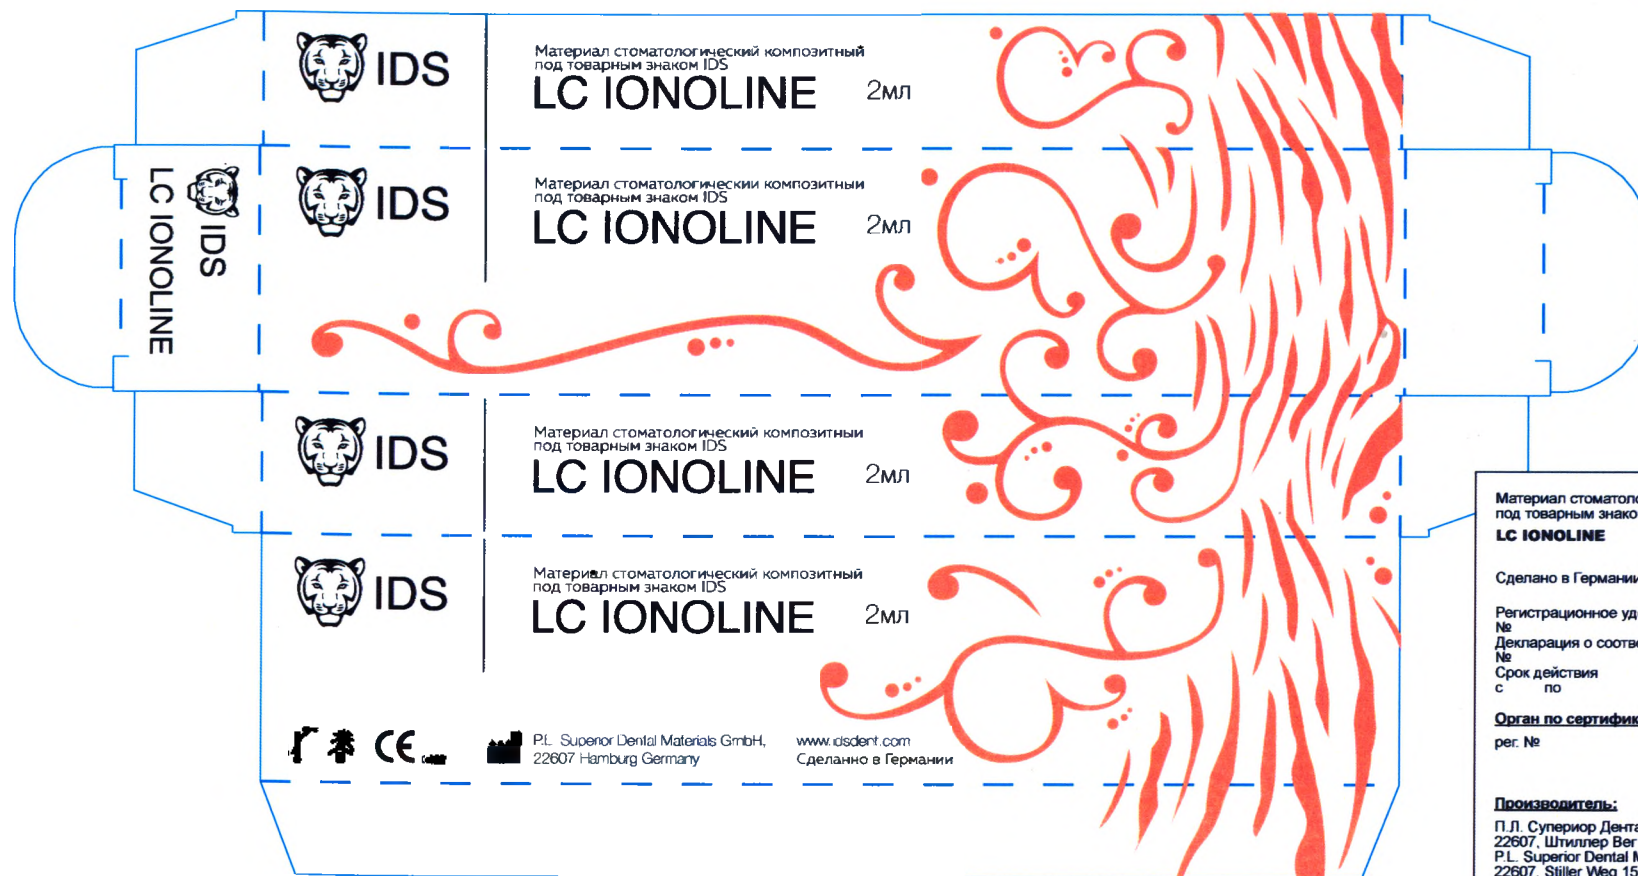

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC IONOLINE.»

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS LC IONOLINE		
Сделано в Германии.		
Регистрационное удостоверение №		
Декларация о соответствии №		
Срок действия с		
Орган по сертификации		
рег. №		
Производитель:		
П.Л. Супериор Дентал Материалс ГмбХ 22607, Штиллер Бер 15а, Гамбург, Германия P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany		
Уполномоченный представитель производителя:		
ООО «АРКОМ» 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н. тел.: 8 800 700-25-25		
Срок годности 3 года.		

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE.»

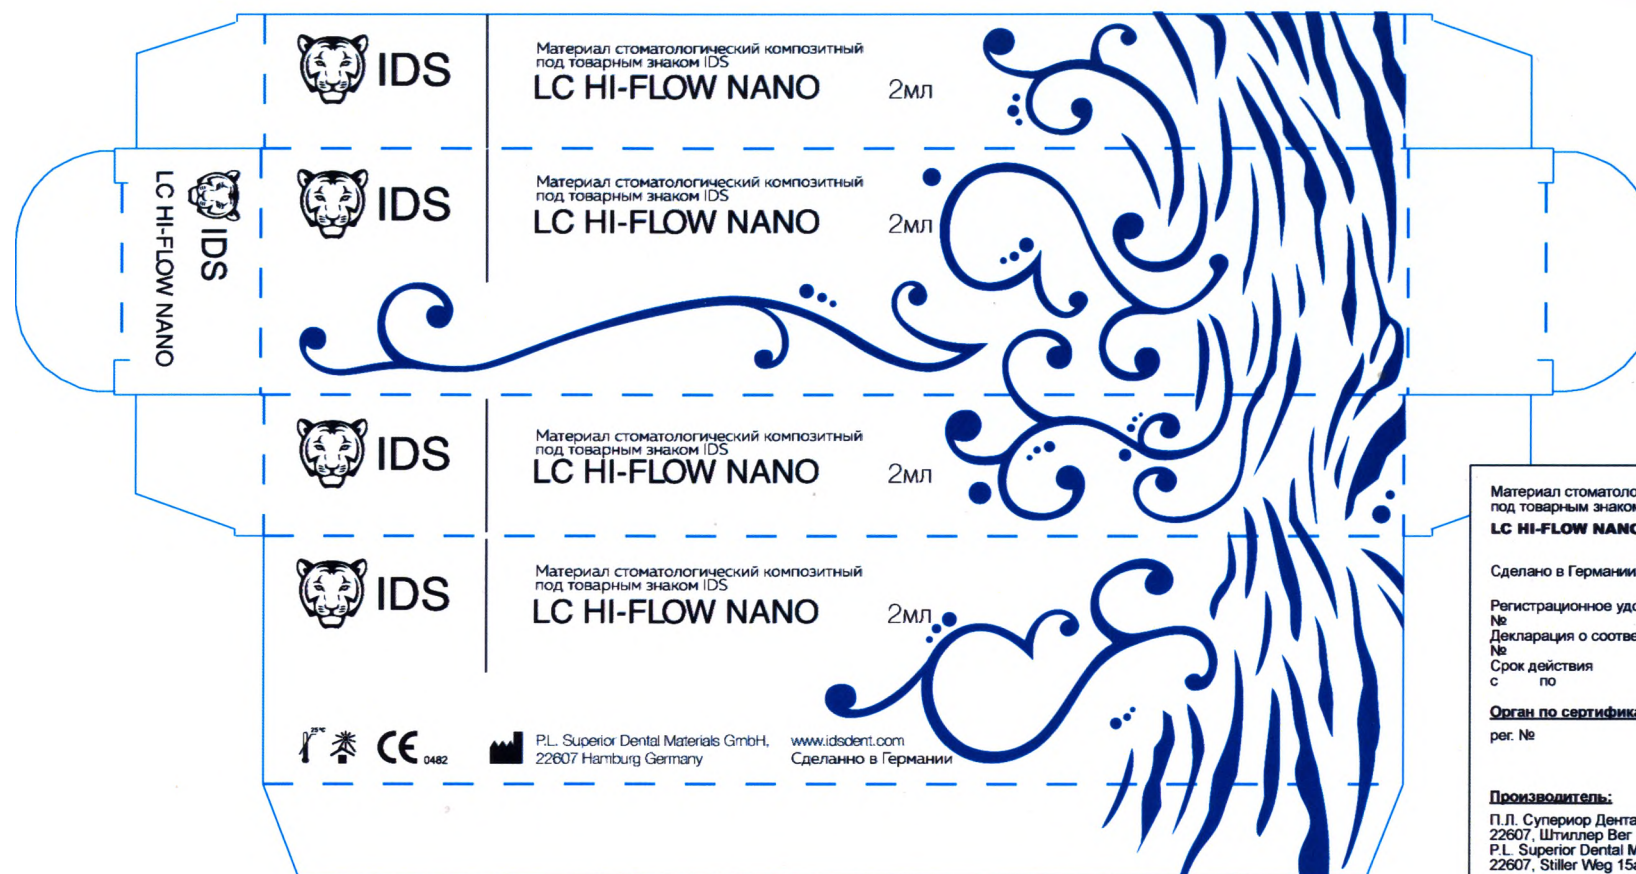

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS
LC HI-FLOW NANO

Сделано в Германии.

Регистрационное удостоверение
№
Декларация о соответствии
№
Срок действия
с по

Орган по сертификации
per. №


Производитель:
П.Л. Супериор Дентал Материалс ГмбХ
22607, Штиллер Бер 15а, Гамбург, Германия
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany

Уполномоченный представитель производителя:
ООО «АРКОМ»
191015, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н.
тел.: 8 800 700-25-25

Срок годности 3 года.

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC HI-FLOW NANO.»

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC HI-FLOW NANO.»

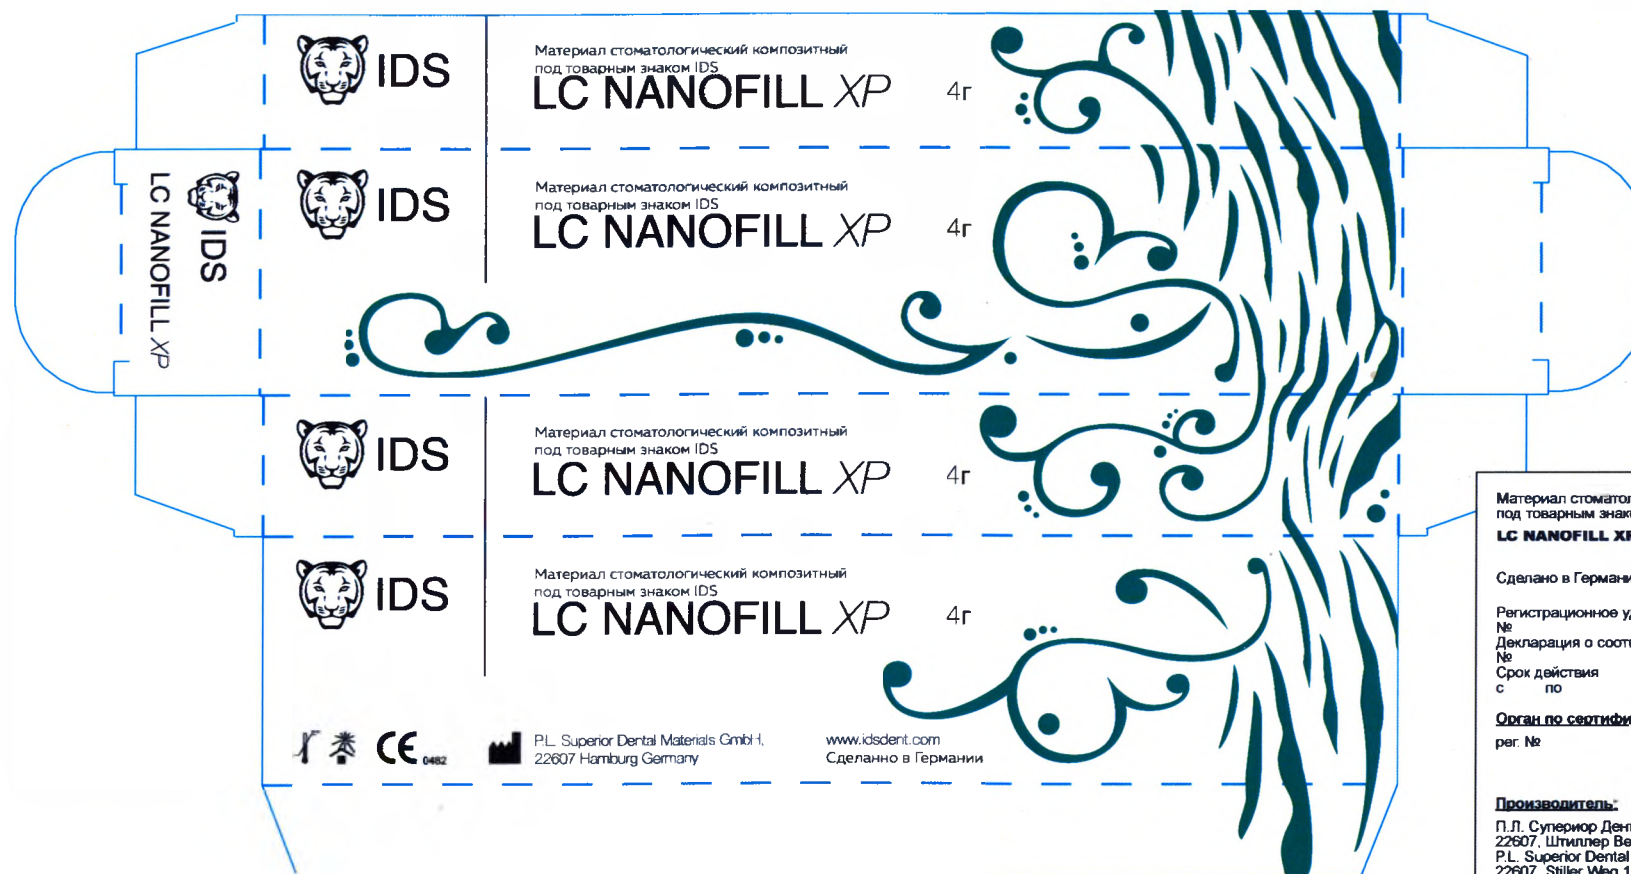

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC NANOFILL XP.»

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS		
LC NANOFILL XP		
Сделано в Германии.		
Регистрационное удостоверение №		
Декларация о соответствии №		
Срок действия с по		
Орган по сертификации		
рег. №		
Производитель:		
П.Л. СуперIOR Дентал Материалс ГмбХ 22607, Штиллер Бер 15а, Гамбург, Германия P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany		
Уполномоченный представитель:		
ООО «АРКОМ» 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н. тел.: 8 800 700-25-25		
Срок годности 3 года.		

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC NANOFILL XP.»



Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFILL SE.»

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS		
LC FLOWFILL SE		
Сделано в Германии.		
Регистрационное удостоверение №		
Декларация о соответствии №		
Срок действия с по		
<u>Орган по сертификации</u>		
рег. №		
<u>Производитель:</u>		
П.Л. СуперIOR Дентал Материалс ГмбХ 22607, Штиллер Вег 15а, Гамбург, Германия P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany		
<u>Уполномоченный представитель производителя:</u>		
ООО «АРКОМ» 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н. тел.: 8 800 700-25-25		
Срок годности 2 года.		

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC FLOWFILL SE.»



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE

2мл



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

www.idsdent.com
Сделано в Германии



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE

2мл



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE

2мл

LC IONOLINE SE



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE

2мл

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE



Сделано в Германии.

Регистрационное удостоверение

№

Декларация о соответствии

№

Срок действия

с

по

Орган по сертификации

рег. №

Производитель:

П.Л. Супериор Дентал Материалс ГмбХ
22607, Штиллер Берг 15а, Гамбург, Германия
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany


Уполномоченный представитель производителя:

ООО «АРКОМ»
191015, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н.
тел.: 8 800 700-25-25

Срок годности 2 года.

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE SE.»


Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE SE.»

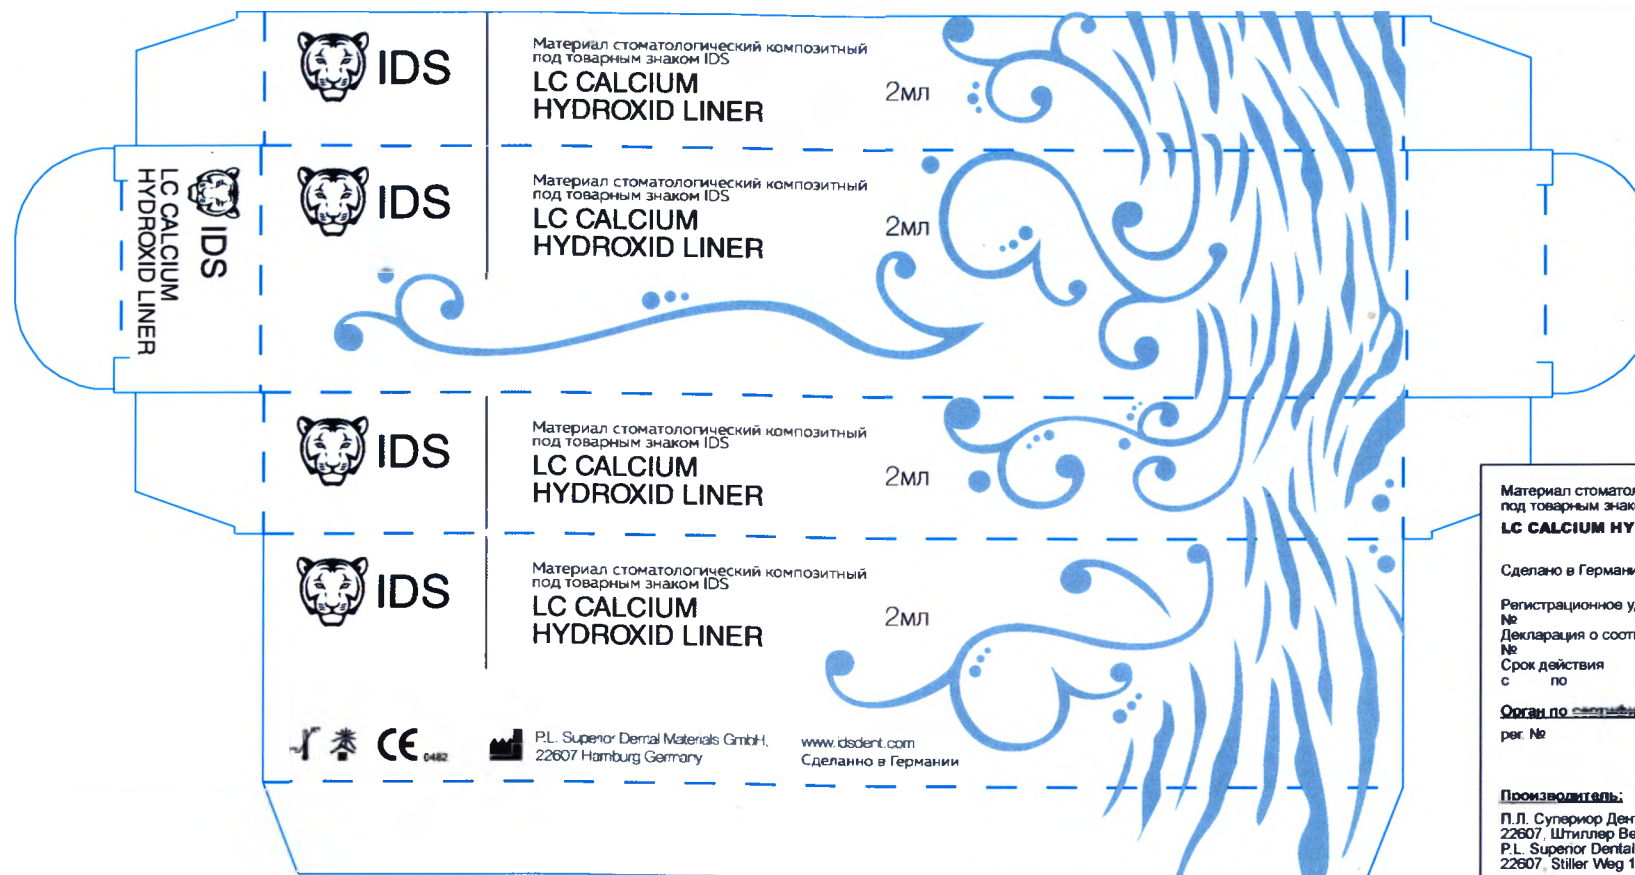

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия
«Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC CALCIUM HYDROXID LINER.»

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS LC CALCIUM HYDROXID LINER Сделано в Германии. Регистрационное удостоверение № Декларация о соответствии № Срок действия с по <u>Орган по сертификации</u> рег. № <u>Производитель:</u> П.Л. СуперIOR Дентал Материалс ГмбХ 22607, Штиллер Бер 15а, Гамбург, Германия P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany <u>Импортер:</u> ООО «АРКОМ» 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н. тел.: 8 800 700-25-25 Срок годности 1,5 года.	
--	---


Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC CALCIUM HYDROXID LINER.»

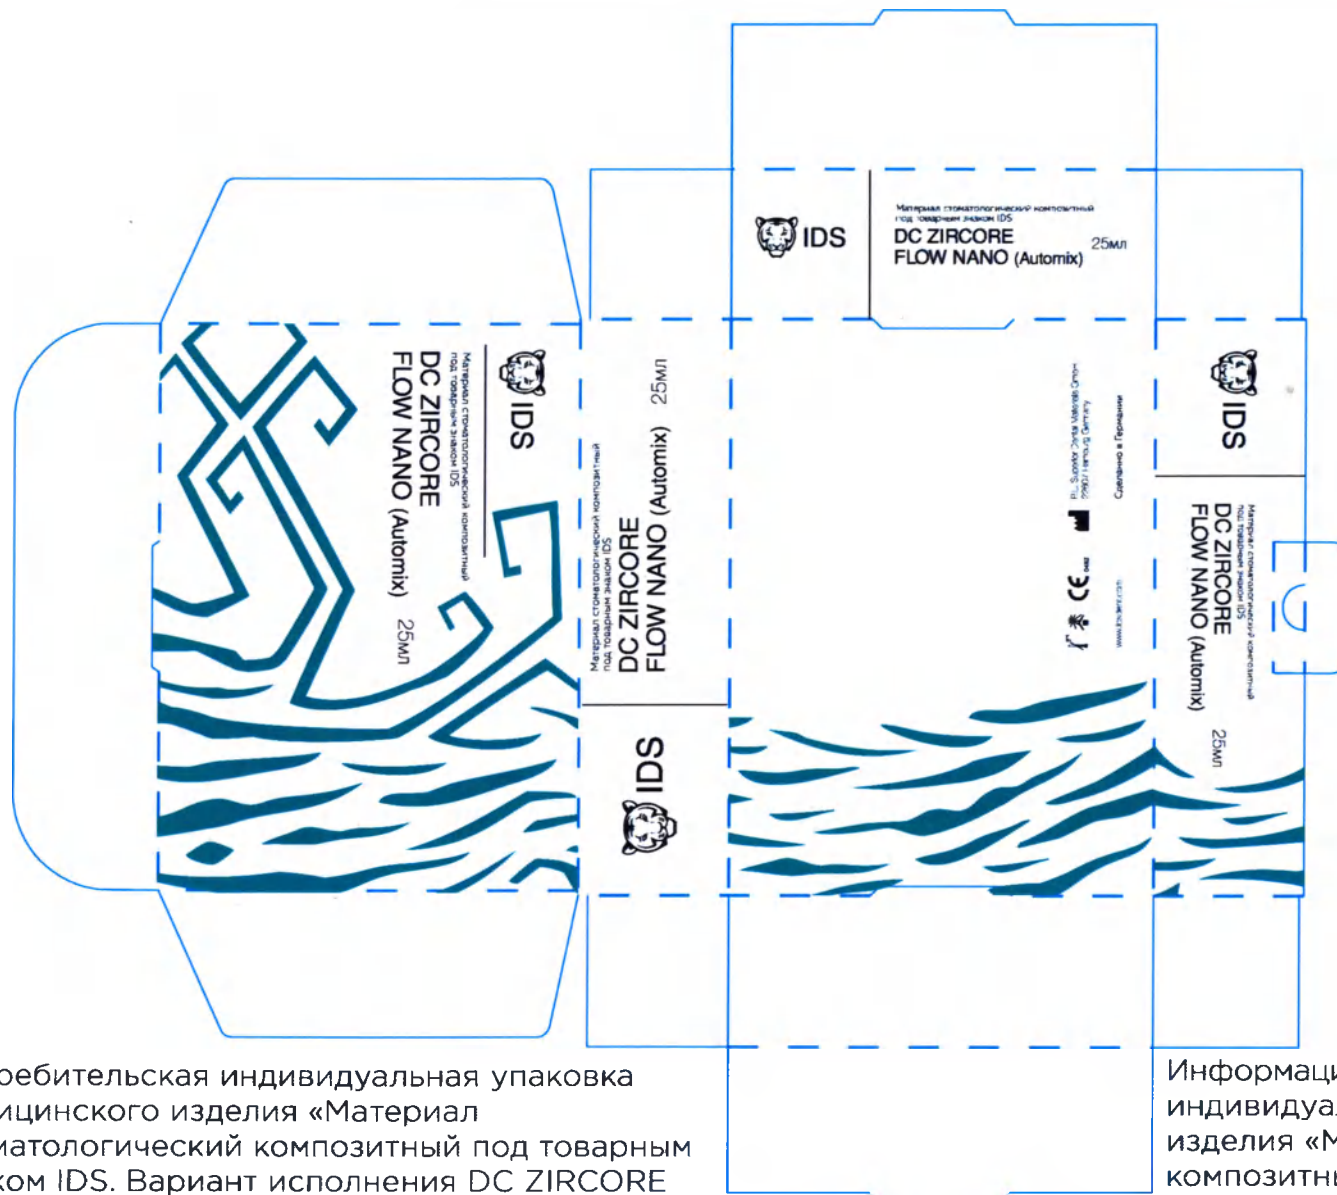

Потребительская индивидуальная упаковка медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения DC ZIRCORE FLOW NANO (Automix).»

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX)	
Сделано в Германии	
Регистрационное удостоверение № Декларация о соответствии № Срок действия с по	
Орган по сертификации per. №	
Производитель: П.Л. СуперIOR Дентал Материалс ГмбХ 22607, Штirnler Ber 15a, Гамбург, Германия P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany	
Уполномоченный представитель, ООО «АРКОМ»: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н. тел.: 8 800 700-25-25 Срок годности 1,5 года.	

Информационный стикер потребительской индивидуальной упаковки медицинского изделия «Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS. Вариант исполнения DC ZIRCORE FLOW NANO (Automix).»

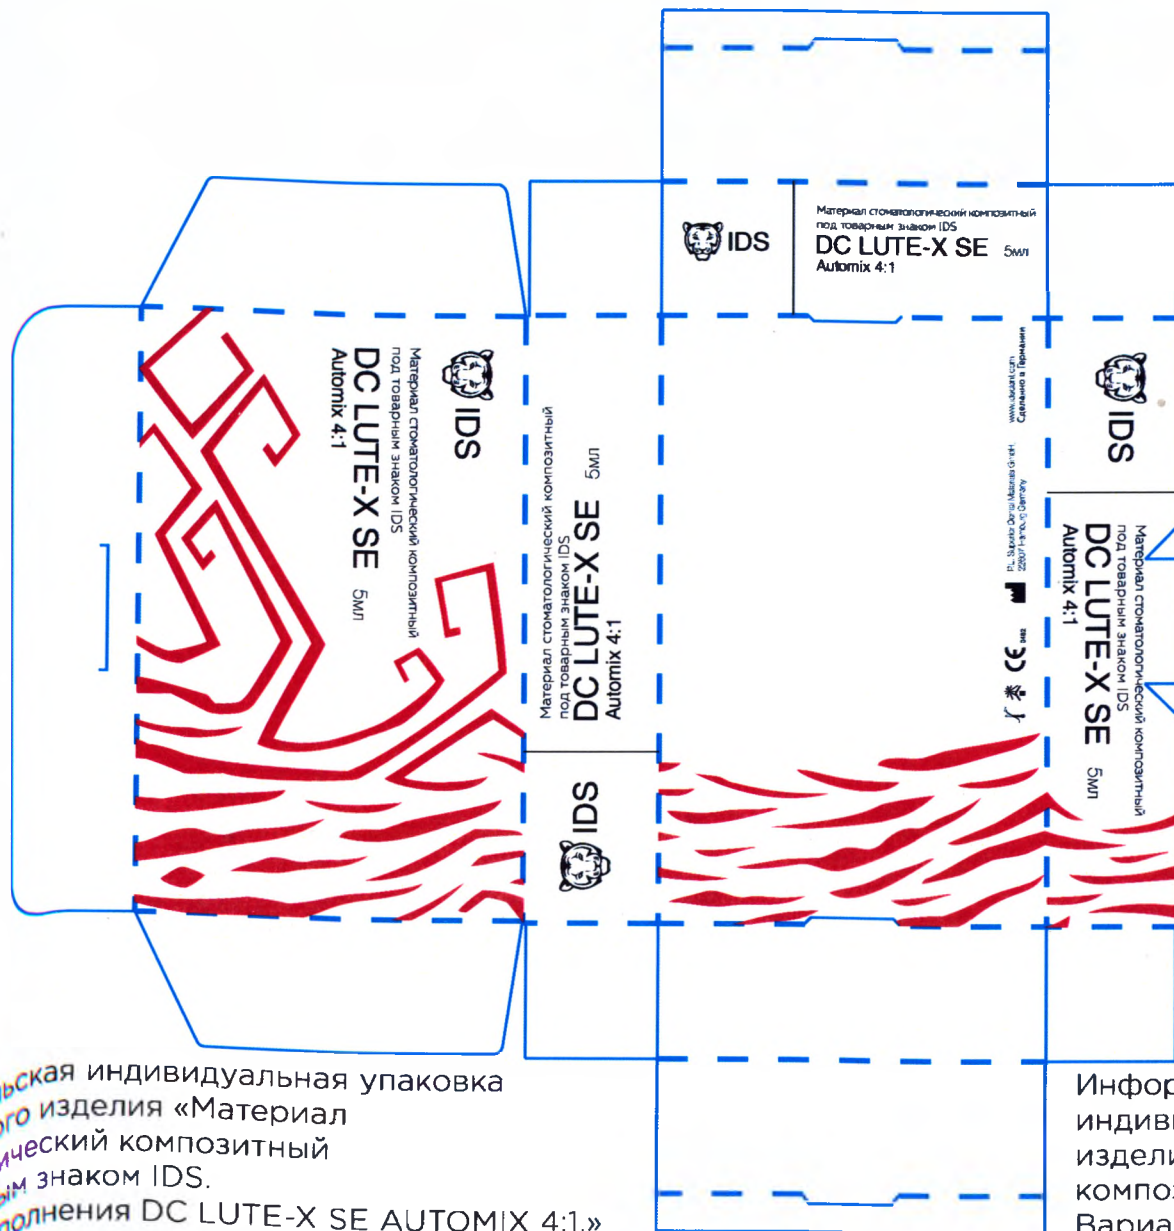

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1



Сделано в Германии.

Регистрационное удостоверение

№

Декларация о соответствии

№

Срок действия
с по

Орган по сертификации

рег. №

Производитель:

П.Л. СуперIOR Дентал Материалс ГмбХ
22607, Штиглер Бер. 15а, Гамбург, Германия
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany


Уполномоченный представителем производителя:

ООО «АРКОМ»
191015, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н.
тел.: 8 800 700-25-25

Срок годности 1,5 года.

Потребительская индивидуальная упаковка
медицинского изделия «Материал
стоматологический композитный
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.»

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.»

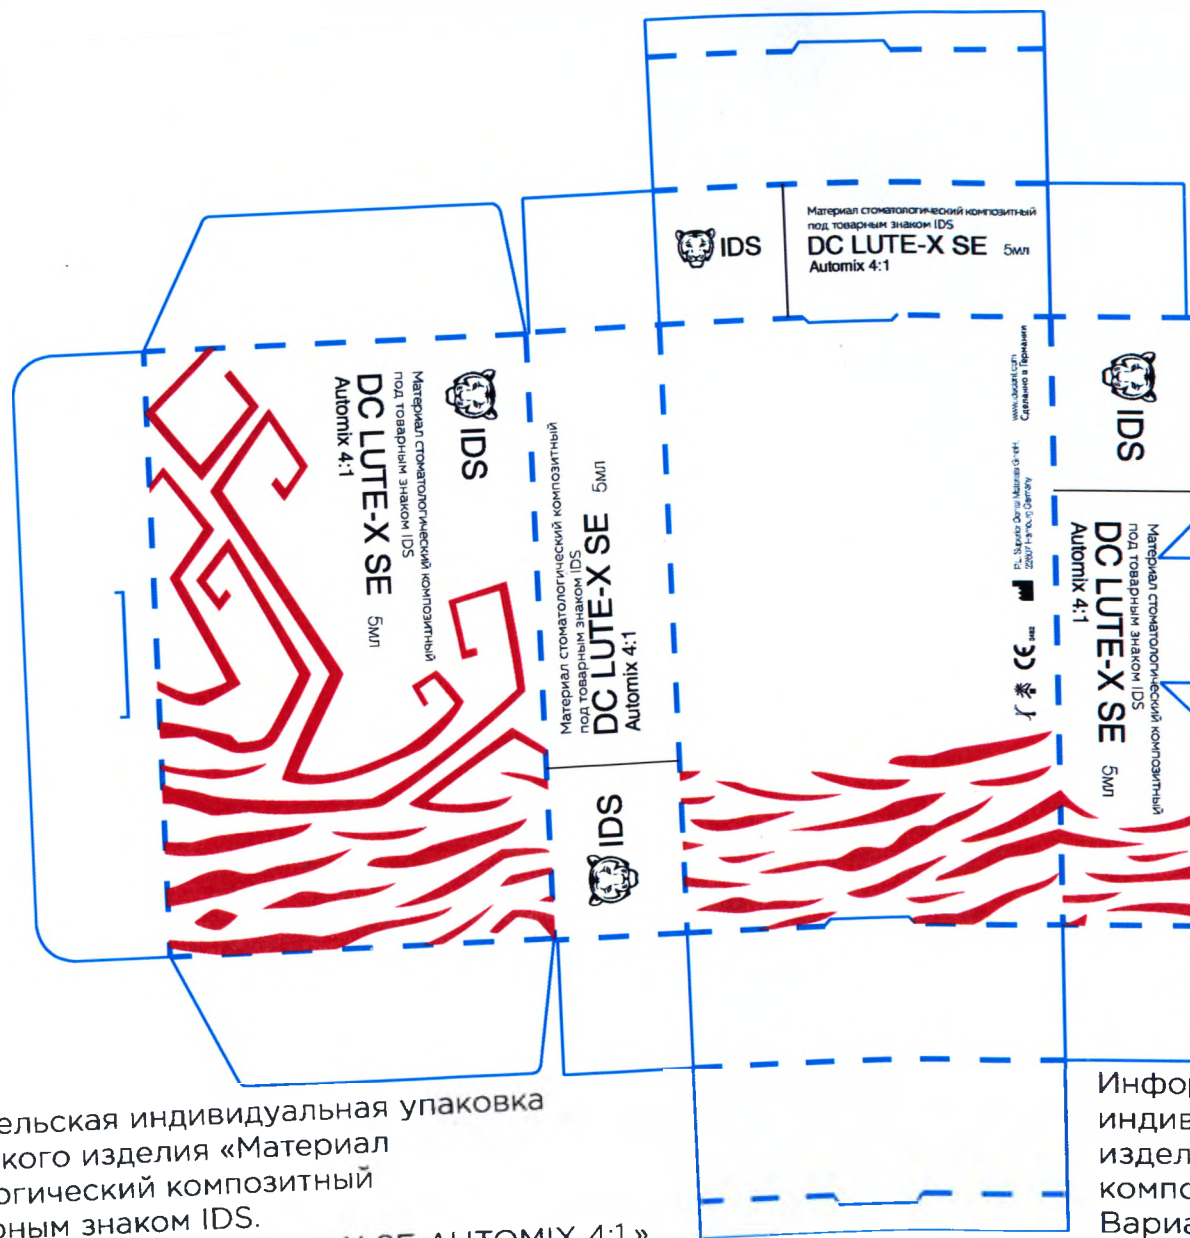

Потребительская индивидуальная упаковка
медицинского изделия «Материал
стоматологический композитный
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.»

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.»

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1

Сделано в Германии.


Регистрационное удостоверение
№
Декларация о соответствии
№
Срок действия
с по

Орган по сертификации
рег. №

Производитель:
П.Л. Супермюр Дентал Материалс ГмбХ
22607 Штиллер Вег 15а, Гамбург, Германия
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607 Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany

Уполномоченный поставитель производителя:
ООО «АРКОМ»
191015, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н
тел.: 8 800 700-25-25

Срок годности 1,5 года.

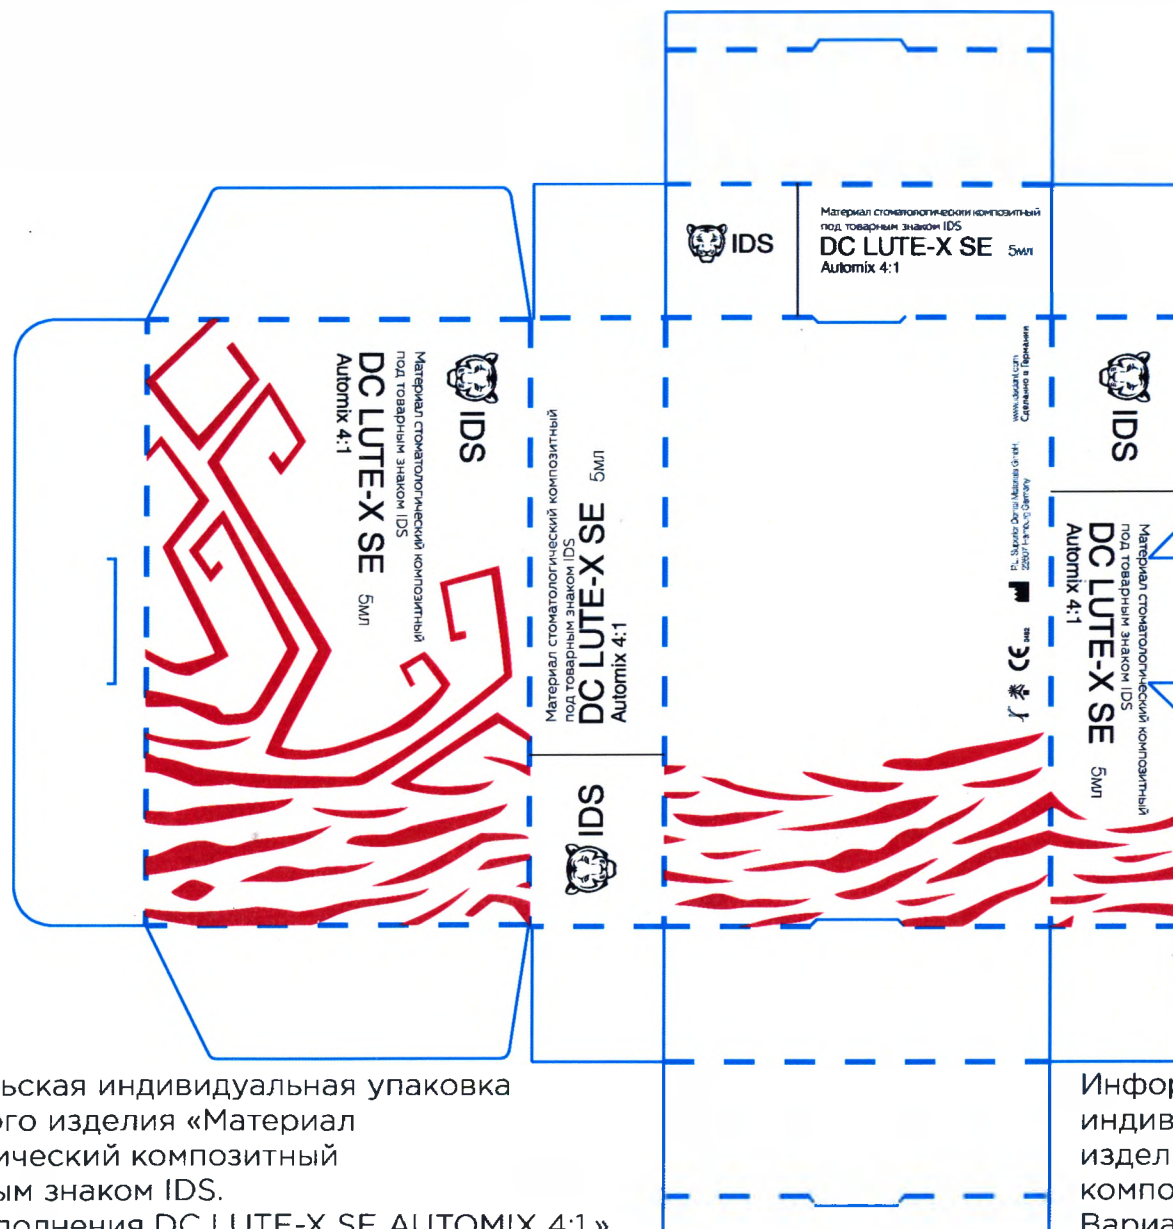

Потребительская индивидуальная упаковка
медицинского изделия «Материал
стоматологический композитный
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.»

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1 Сделано в Германии. Регистрационное удостоверение № Декларация о соответствии № Срок действия с по <u>Орган по сертификации</u> рег. № <u>Производитель:</u> П.Л. Супериор Дентал Материалс ГмбХ 22607, Штиллер Вег 15а, Гамбург, Германия P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607, Stiller Weg 15a, Hamburg, Germany <u>Уполномоченный представитель производителя:</u> ООО «АРКОМ» 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, помещение 14Н. тел.: 8 800 700-25-25 Срок годности 1,5 года.	
---	---

Информационный стикер потребительской
индивидуальной упаковки медицинского
изделия «Материал стоматологический
композитный под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.»

Ген. директор ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.
2017



Фотографические изображения маркировки медицинского изделия
«Материалы стоматологические композитные под товарным знаком IDS»



Шприц с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC MH CERAMIC NANO.



IDS

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC MH CERAMIC NANO A2



0482





P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Сделано в Германии
www.idsdent.com

Syringe: 4g
Шприц: 4г

Маркировка шприца с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC MH CERAMIC NANO.

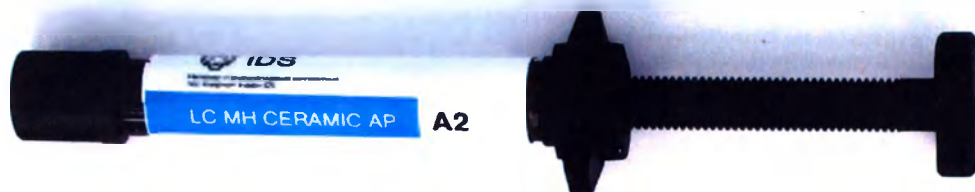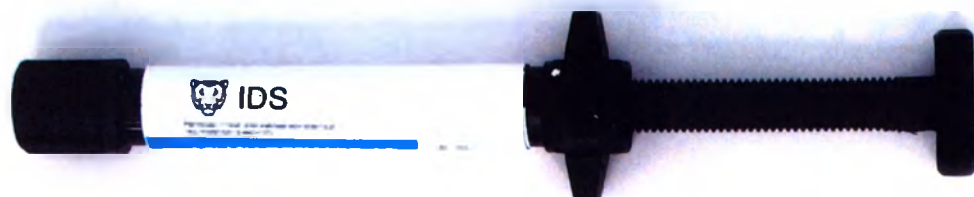

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.
 Вариант исполнения LC MH CERAMIC AP.



Материал стоматологический композитный
 под товарным знаком IDS

LC MH CERAMIC AP

A2




Syringe: 4g
 Шприц: 4г



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
 22607 Hamburg Germany

Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.
 Вариант исполнения LC MH CERAMIC AP.

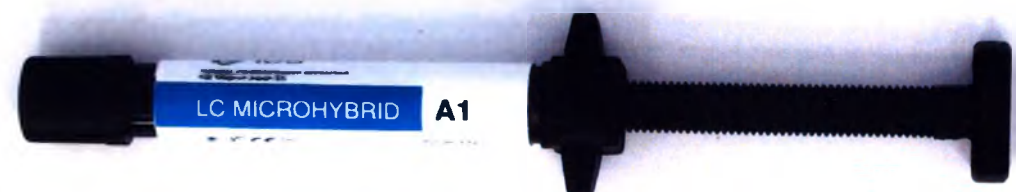

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC MICROHYBRID.



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC MICROHYBRID

A1




P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Syringe: 4,5g
Шприц: 4,5г

Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC MICROHYBRID.

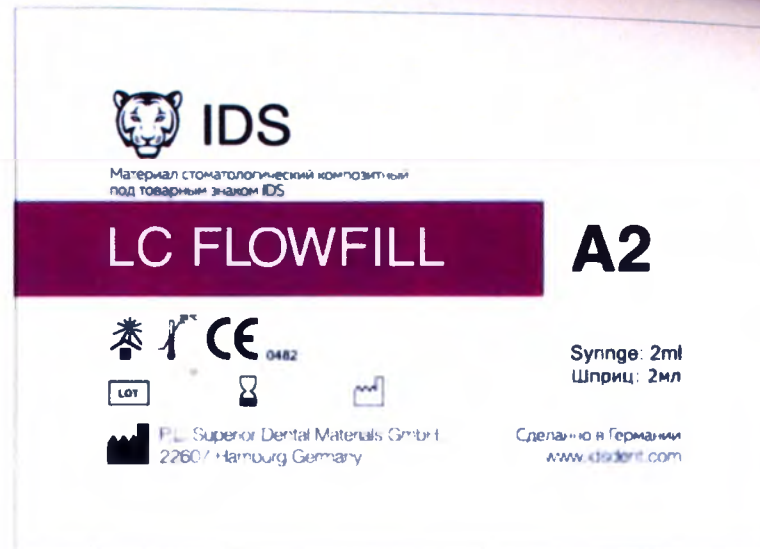

Маркировка шприца с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC FLOWFILL.



Шприц с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.

Вариант исполнения LC FLOWFILL.

Принадлежности:
игольчатая канюля 20 ga, диаметр 0,812 мм

52690
08.09.2017



Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS
Вариант исполнения LC IONOLINE.



IDS

Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC IONOLINE



0482

LOT



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Syringe: 2ml
Шприц: 2мл


Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE.



Принадлежности:
игольчатая канюля 20 га, диаметр 0,812 мм

52690
08.09.2017

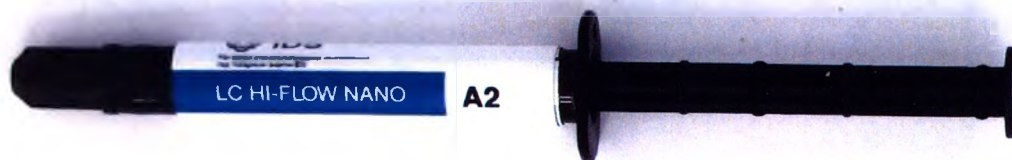

Шприц с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU LC HI-FLOW NANO.



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC HI-FLOW NANO

A2



P.L. Superior Dental Materials GmbH.
22607 Hamburg Germany


Syringe: 2ml
Шприц: 2мл

Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC HI-FLOW NANO.



Принадлежности:
использующая канюля 17 ga, диаметр 1,15 мм
52600
08.09.2017

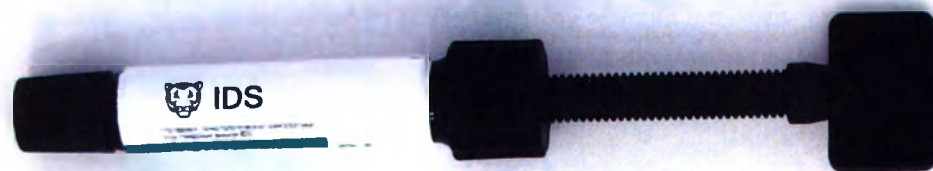

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC NANOFILL XP.



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC NANOFILL *XP* **B1**



Syringe: 4g
Шприц: 4г




P.L. Superior Dental Materials GmbH, 22607 Hamburg Germany
Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC NANOFILL XP.



Принадлежности:
иглы канюля 20 га, диаметр 0,812 мм

52690
08.09.2017

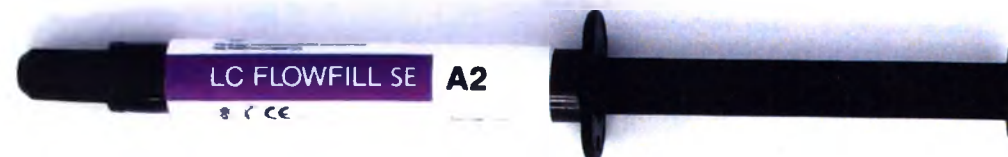

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFIL SE.



Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS

LC FLOWFILL SE A2



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Syringe 2ml
Шприц: 2мл

Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS. Вариант исполнения LC FLOWFIL SE.



Принадлежности:
игольчатая канюля 20 га, диаметр 0,812 мм

52690
08.09.2017



Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU LC IONOLINE SE.



Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS

LC IONOLINE SE

A2



P.L. Superior Dental Materials GmbH.
22607 Hamburg Germany


Syringe: 2ml
Шприц: 2мл

Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC IONOLINE SE.



Принадлежности:
игельчатая канюля 20 га, диаметр 0,812 мм
52690
08.09.2017

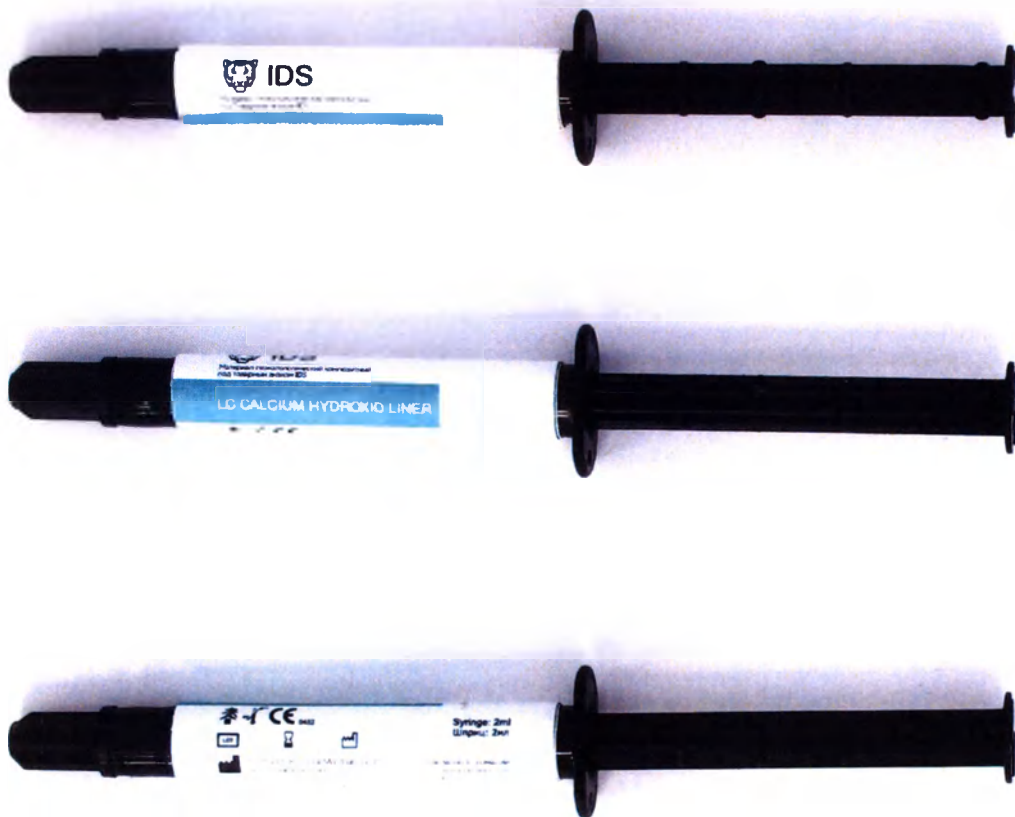

Шприц с материалом стоматологическим композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения LC CALCIUM HYDROXID LINER.



Материал стоматологический композитный
под товарным знаком IDS

LC CALCIUM HYDROXID LINER



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Syringe: 2ml
Шприц: 2мл


Сделанно в Германии
www.idscient.com

Маркировка шприца с материалом
стоматологическим композитным
под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения
LC CALCIUM HYDROXID LINER.



Принадлежности:
игольчатая канюля 18 ga, диаметр 1,024 мм

52690
08.09.2017

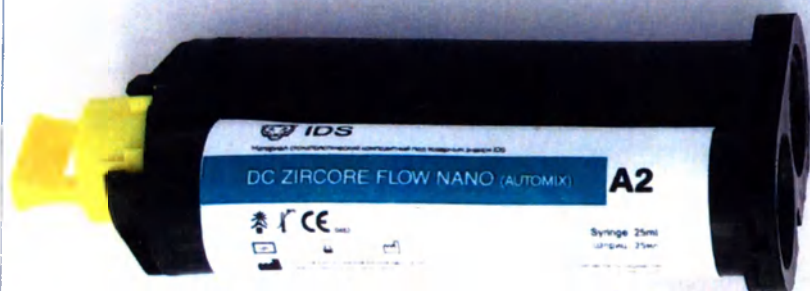

Шприц с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX).



IDS

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS

DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX)

A2



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Syringe: 25ml
Шприц: 25мл

Сделанно в Германии
www.idsdent.com


Маркировка шприца с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DC ZIRCORE FLOW NANO (AUTOMIX).

Принадлежности:

смешивающая канюля,
ML 2.5-08-D,



смешивающая канюля
MB 4.2-12-D,

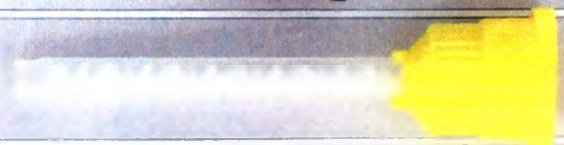

эндодонтическая канюля
IOR209,



внутриоральная канюля



52690
08.09.2017



Шприц с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1.



IDS

Материал стоматологический композитный под товарным знаком IDS

DC LUTE-X SE
Automix 4:1

A2



0482



P.L. Superior Dental Materials GmbH,
22607 Hamburg Germany

Syringe: 5ml

Шприц: 5мл


Сделано в Германии
www.idsdent.com

Маркировка шприца с материалом стоматологическим
композитным под товарным знаком IDS.
Вариант исполнения DC LUTE-X SE AUTOMIX 4:1

Принадлежности:

смешивающая канюля,
MLX 2.5-12-D.

эндодонтическая канюля,
IOR209

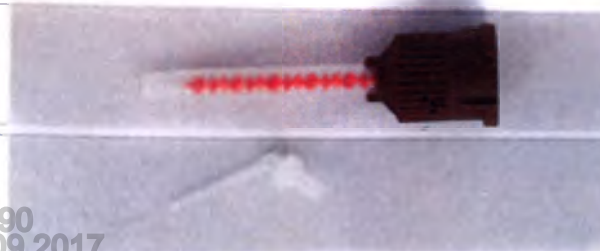

52690
08.09.2017

пришито 15 (Пятнадцать) листов
Ген. директор ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.

