


Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
(ООО «МДЛ») ИНН 7704147436 КПП 773401001
Юридический адрес: 123098, Москва г, Гамалеи ул, дом № 16, строение 3
тел.8(499)190-30-47 факс 8 (499)190-30-47 E-mail: info@m-d-l.ru, mdl-06@list.ru
Банковские реквизиты: р/сч 40702810538200102426
ПАО «Сбербанк России» г.Москва БИК 044525225 кор/сч 30101810400000000225

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МДЛ»

 Чиркова Е.Ю.
«23» апреля 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

*Набор реагентов «PrenatFISH® для
флуоресцентной гибридизации in situ»
“PrenatFISH®”
по ТУ 21.20.23-001-42874316-2021*

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

PrenatFISH® для флуоресцентной
гибридизации *in situ*

PrenatFISH®

ТУ 21.20.23-001-42874316-2021

РУ №

Кат.№ MDL-PF-001

Серия:

Дата изготовления:

Годеи до:

Набор на 10 тестов.

Состав набора:

ДНК-зонды (13/21)

ДНК-зонды (18/ХУ)

1 пробирка (100 мкл)

1 пробирка (100 мкл)



Комплектующие:

Краситель DAPI (ДАР)

Пепсин сухой (ПС)

Буфер для лизиса (БЛ)

Буфер цитратно-солевой

с ипепалом 1 (БИ-1)

Буфер цитратно-солевой

с ипепалом 2 (БИ-2)

Буфер цитратно-солевой (БЦ)

Буфер фосфатно-солевой (БФ)

Буфер фосфатно-солевой

с формальдегидом и хлоридом

магния (БФ-Ф)

Буфер цитратно-солевой

с ипепалом 2 (БИ-3)

1 пробирка (0,3 мл)

4 пробирка (по 20 мг)

4 флакона (по 50 мл)

1 флакон (200 мл)

2 флакона (по 200 мл)

1 флакон (200 мл)

2 флакона (по 200 мл)

1 флакон (200 мл)

1 флакон (200 мл)



ООО "МДЛ"

Россия, 123093, Московская обл.,
г. Москва, ул. Гамалин, д. 16, стр. 3.



Фотографическое изображение 1 – Набор реагентов «PrenatFISH®» для флуоресцентной гибрилизации *in situ*»
«PrenatFISH®» по ТУ 21.20.23-001-42874316-2021, общий вид

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения



PrenatFISH® для флуоресцентной
гибридизации in situ

PrenatFISH®

ТУ 21.20.23-001-42874316-2021

РУ №

Кат.№ MDL-PF-001

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Набор на 10 тестов.

Состав набора:

ДНК-зонды (13/21)	1 пробирка	(100 мкл)
ДНК-зонды (18/X/Y)	1 пробирка	(100 мкл)



Комплекующие:

Краситель DAPI (DAPI)	1 пробирка	(0,3 мл)
Пепсин сухой (ПС)	4 пробирки	(по 20 мг)
Буфер для пепсина (БП)	4 флакона	(по 50 мл)
Буфер цитратно-солевой с игепалом 1 (БИ-1)	1 флакон	(200 мл)
Буфер цитратно-солевой с игепалом 2 (БИ-2)	2 флакона	(по 200 мл)
Буфер цитратно-солевой (БЦ)	1 флакон	(200 мл)
Буфер фосфатно-солевой (БФ)	2 флакона	(по 200 мл)
Буфер фосфатно-солевой с формальдегидом и хлоридом магния (БФ-Ф)	1 флакон	(200 мл)
Буфер цитратно-солевой с игепалом 2 (БИ-3)	1 флакон	(200 мл)




ООО "МДЛ"


Россия, 123098, Московская обл.,
г.Москва, ул. Гамалеи, д. 16, стр.3.




Фотографическое изображение 2 – Макет этикетки Набор реагентов «PrenatFISH® для флуоресцентной
гибридизации in situ» "PrenatFISH®" по ТУ 21.20.23-001-42874316-2021

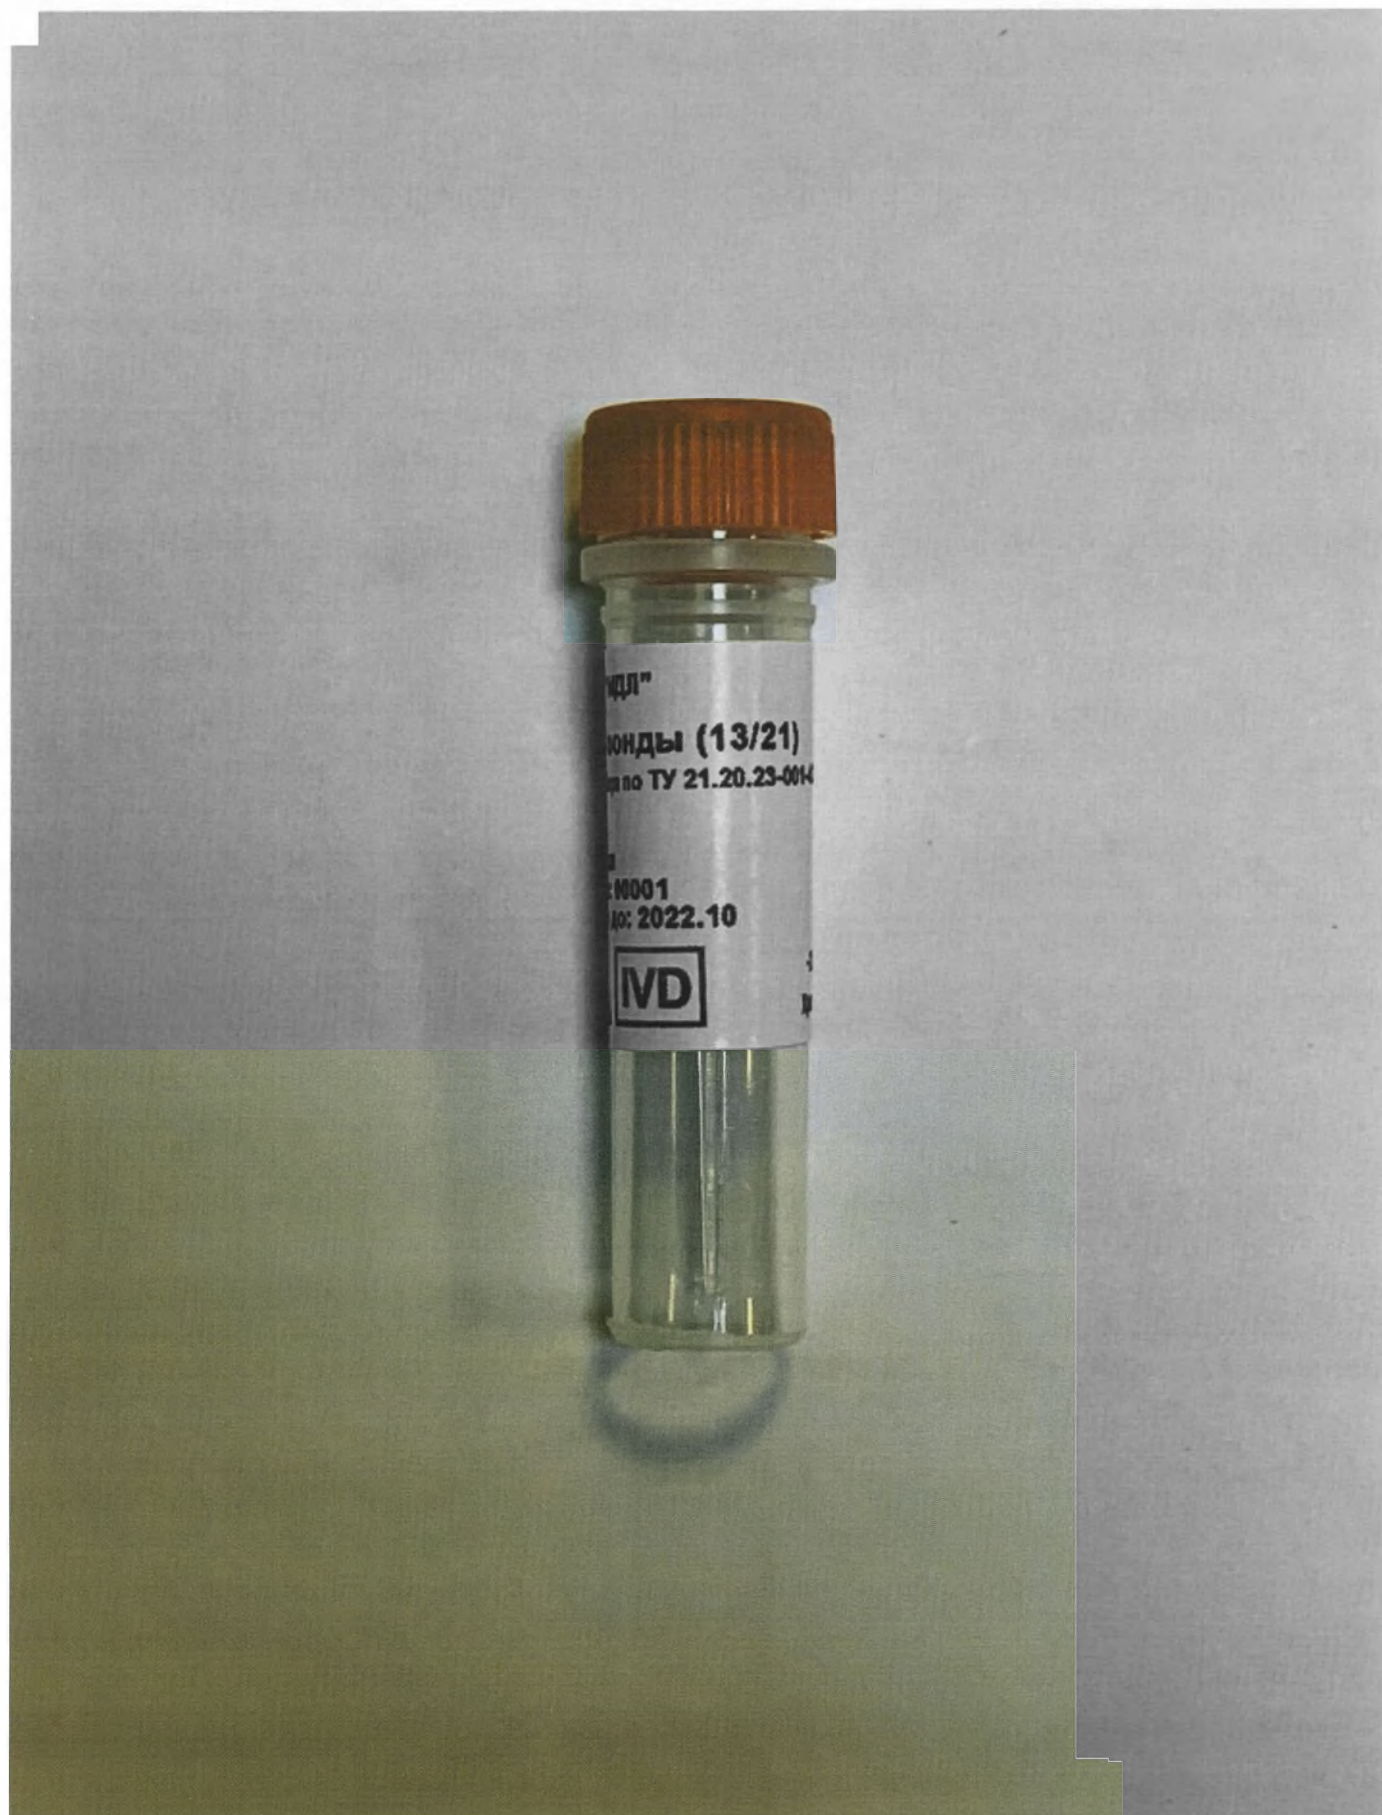


Фотографическое изображение 3 – ДНК-зонды (13/21), 1 пробирка (0,1 мл)

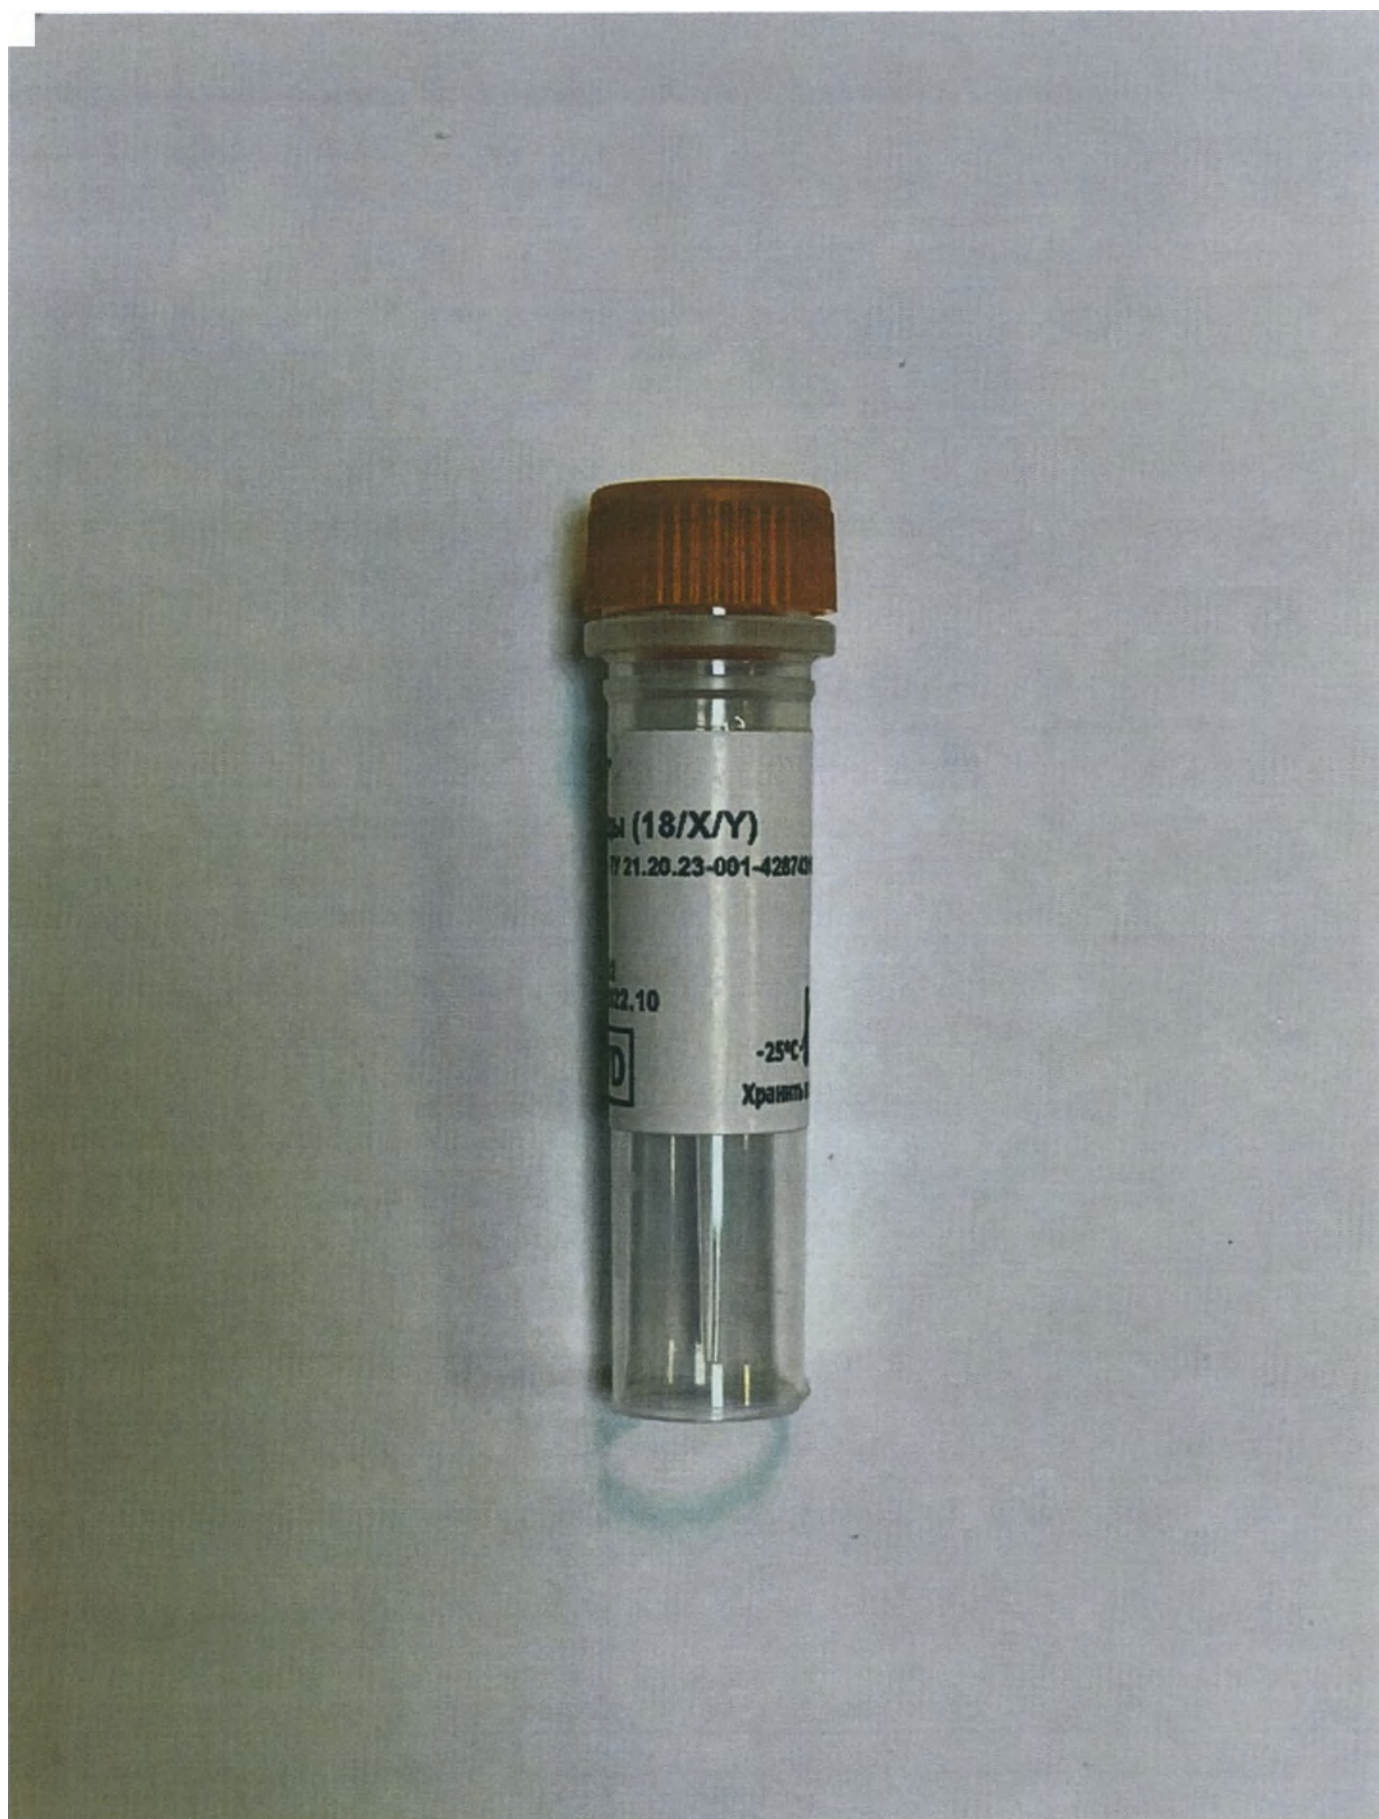


Фотографическое изображение 4 – ДНК-зонды (18/X/Y), 1 пробирка (0,1 мл)

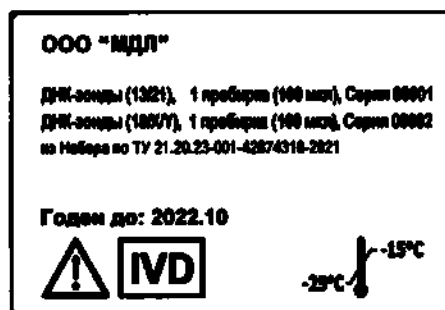


Фотографическое изображение 5 – Макет этикетки ДНК-зонды (13/21) и ДНК-зонды (18/X/Y)




Фотографическое изображение 6 – Макет этикетки ДНК-зонды (13/21)




Фотографическое изображение 7 – Макет этикетки ДНК-зонды (18/X/Y)

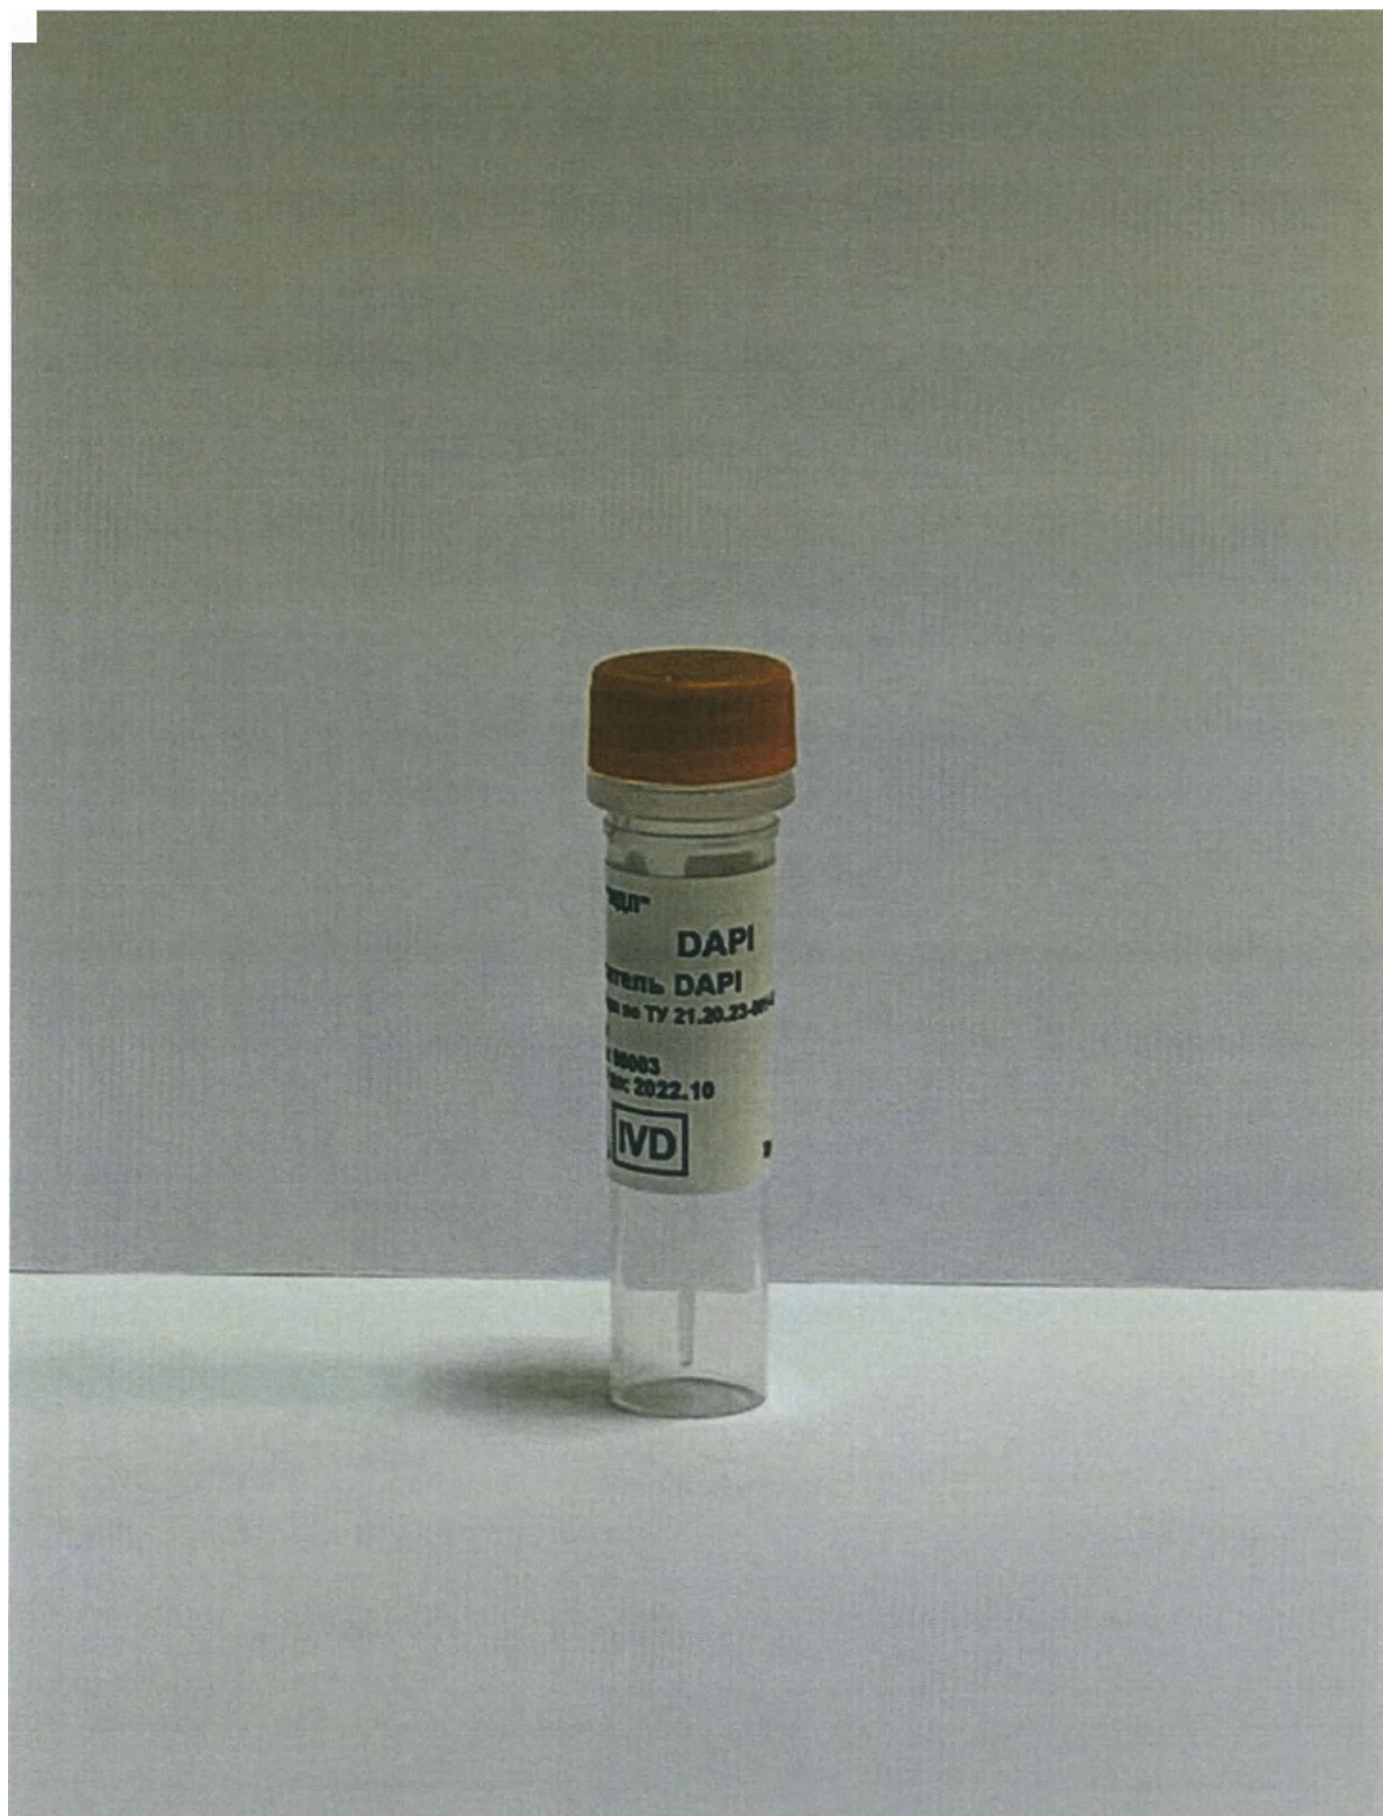


Фотографическое изображение 8 – Краситель DAPI (DAPI), 1 пробирка (0,3 мл), комплектующее



Фотографическое изображение 9 – Макет этикетки Краситель DAPI (DAPI)

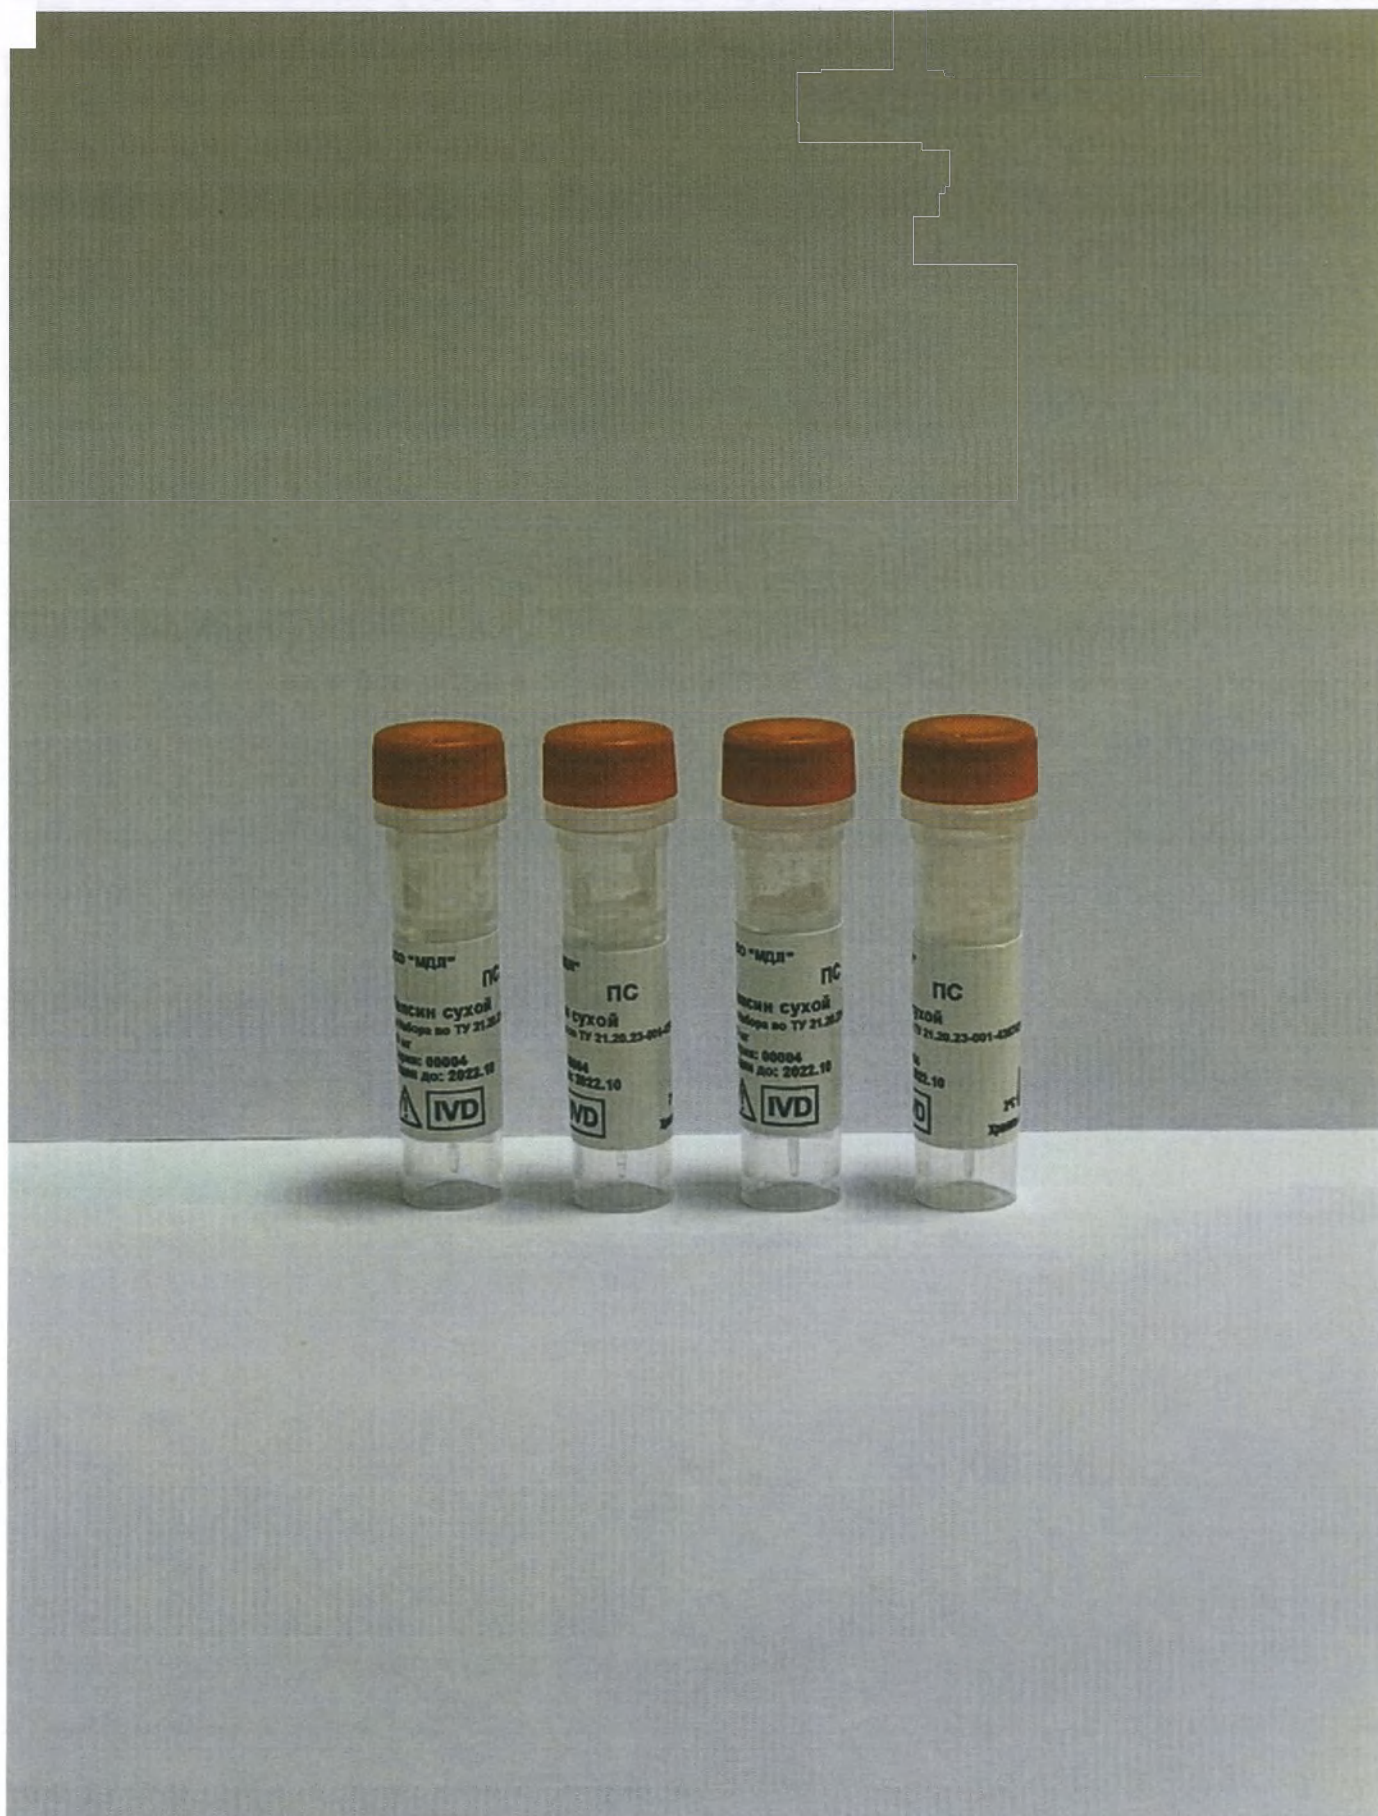

Фотографическое изображение 10 – Пепсин сухой (ПС), 4 пробирки (по 20 мг), комплектующее

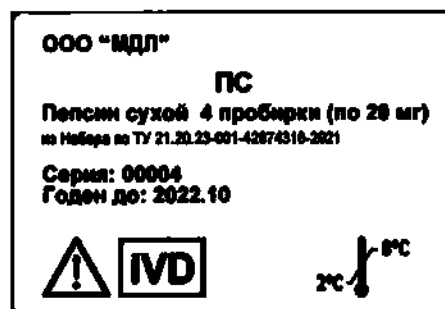


Фотографическое изображение 11 – Макет этикетки Пепсин сухой (ПС), 4 пробирки (по 20 мг)




Фотографическое изображение 12 – Макет этикетки Пепсин сухой (ПС)




Фотографическое изображение 13 – Буфер для пепсина (БП), 4 флакона (по 50 мл), комплектующее

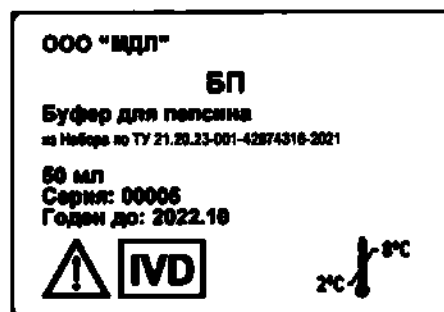


Фотографическое изображение 14 – Макет этикетки Буфер для пепсина (БП)

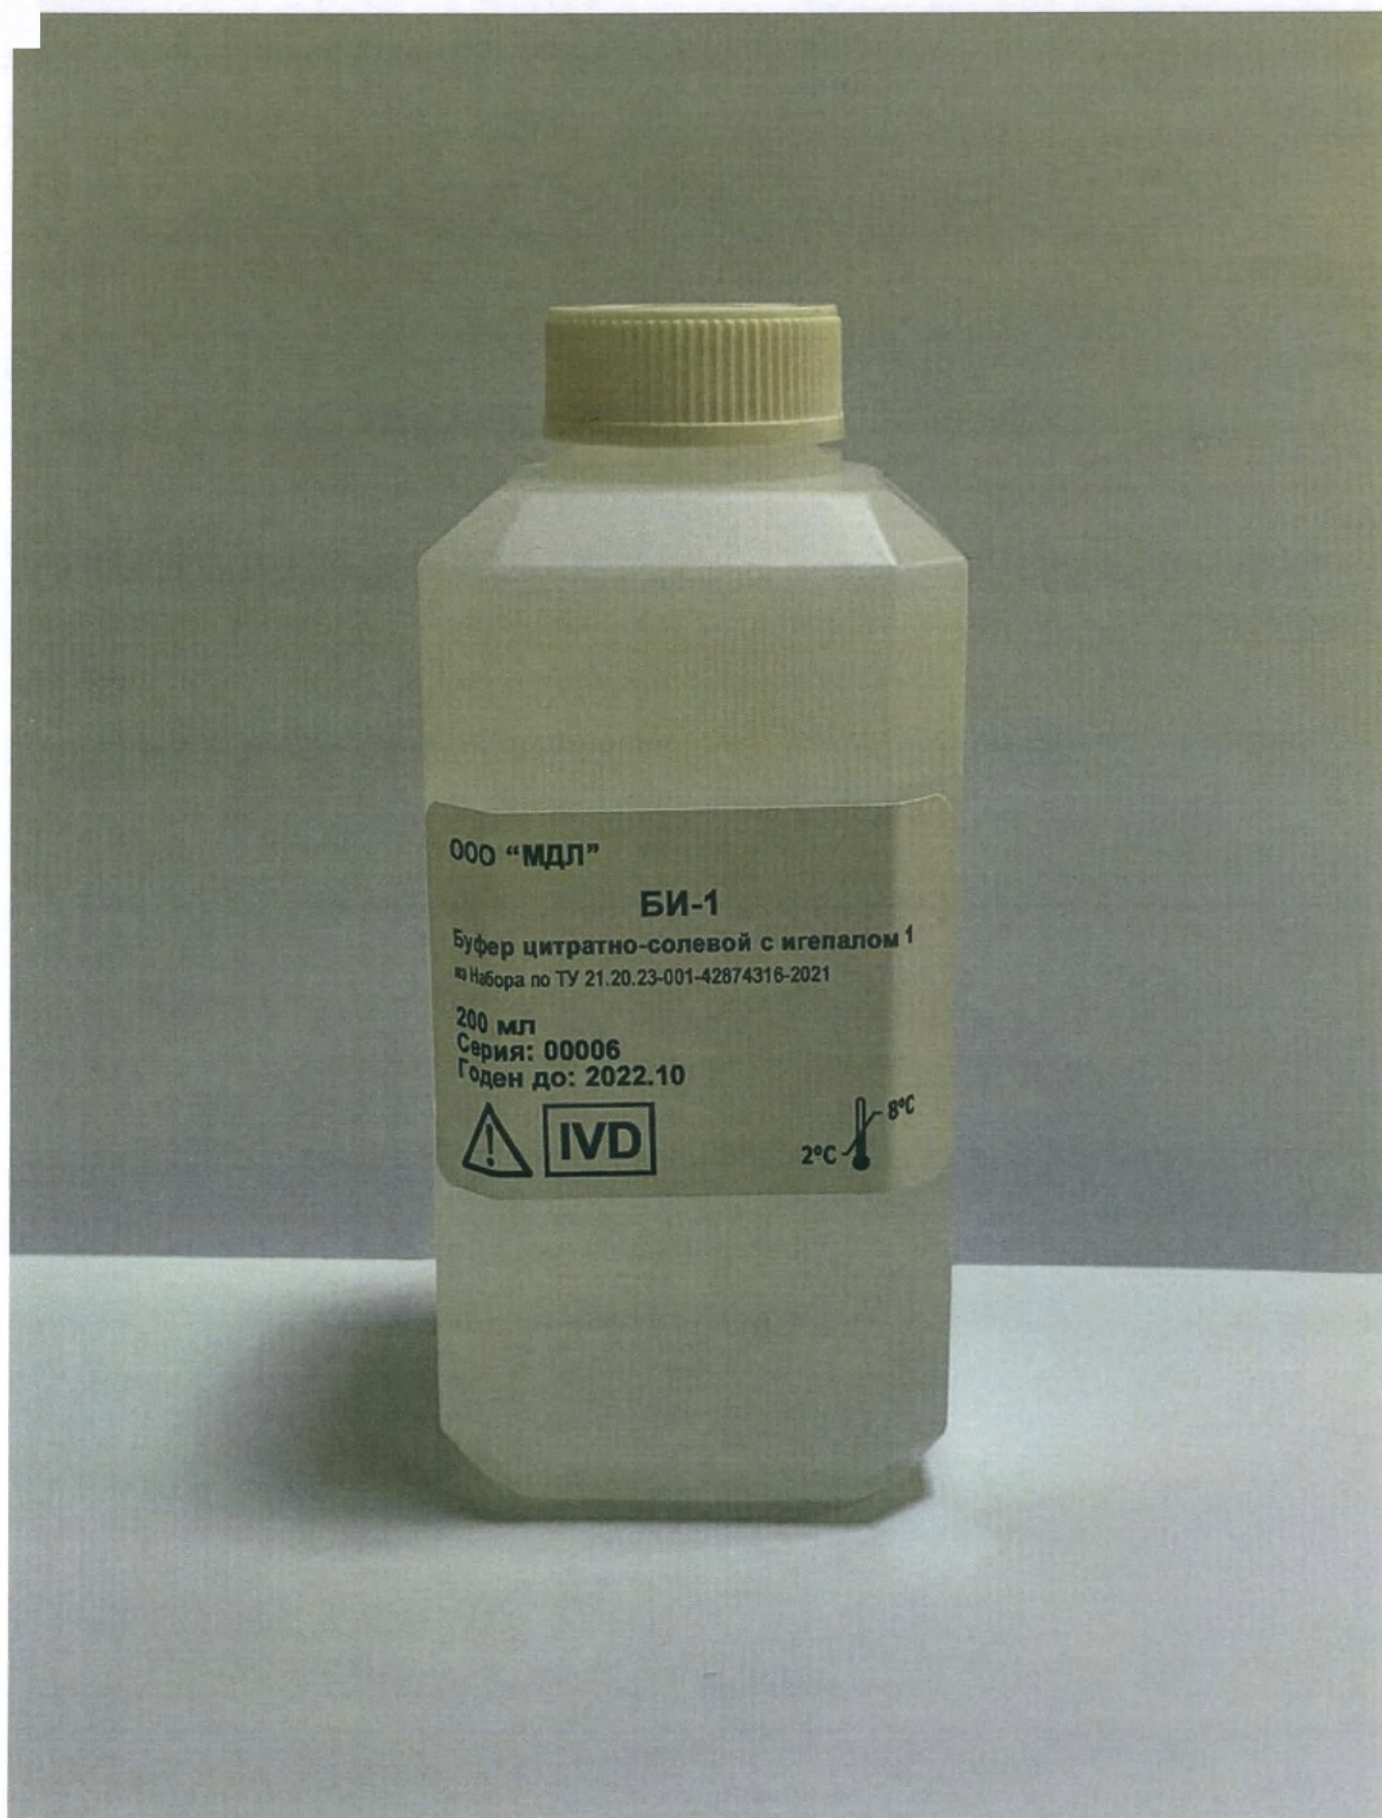


Фотографическое изображение 15 – Буфер цитратно-солевой с игепалом 1 (БИ-1), 1 флакон (200 мл), комплектующее

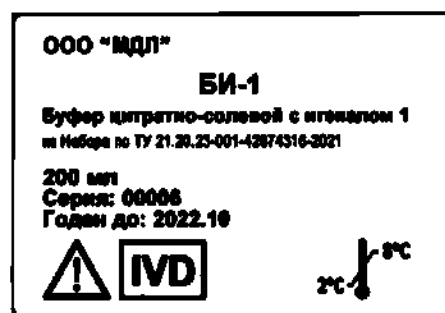


Фотографическое изображение 16 – Макет этикетки Буфер цитратно-солевой с изопалом 1 (БИ-1)

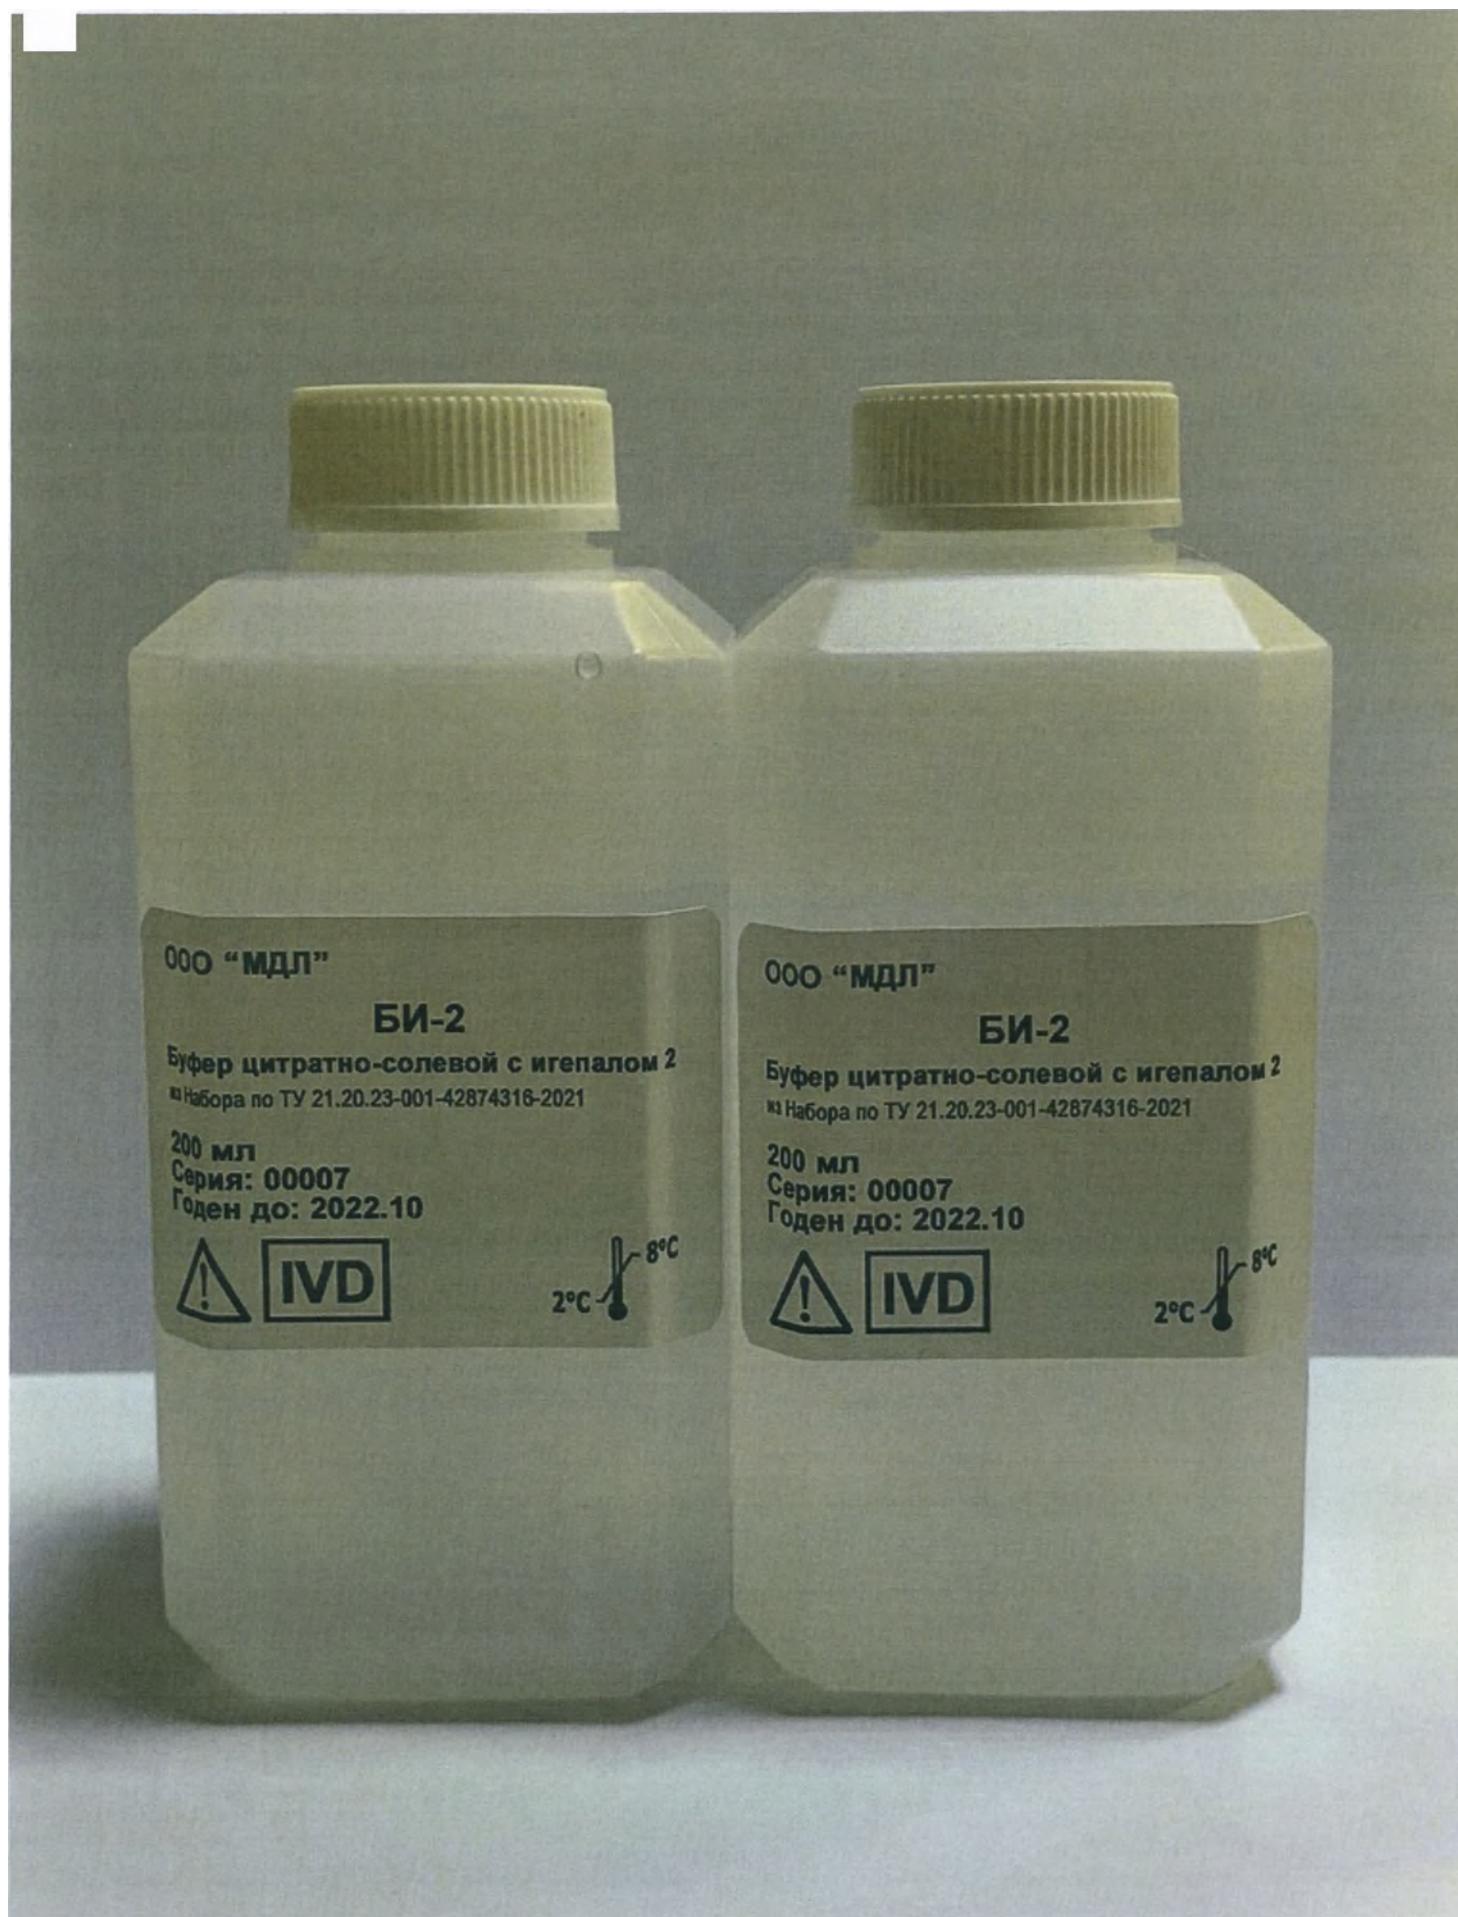

Фотографическое изображение 17 – Буфер цитратно-солевой с игепалом 2 (БИ-2), 2 флакона (по 200 мл), комплектующее

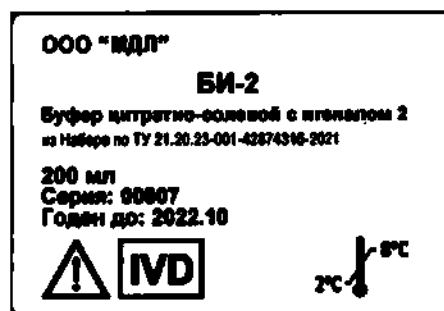


Фотографическое изображение 18 – Макет этикетки Буфер цитратно-солевой с ипепалом 2 (БИ-2)

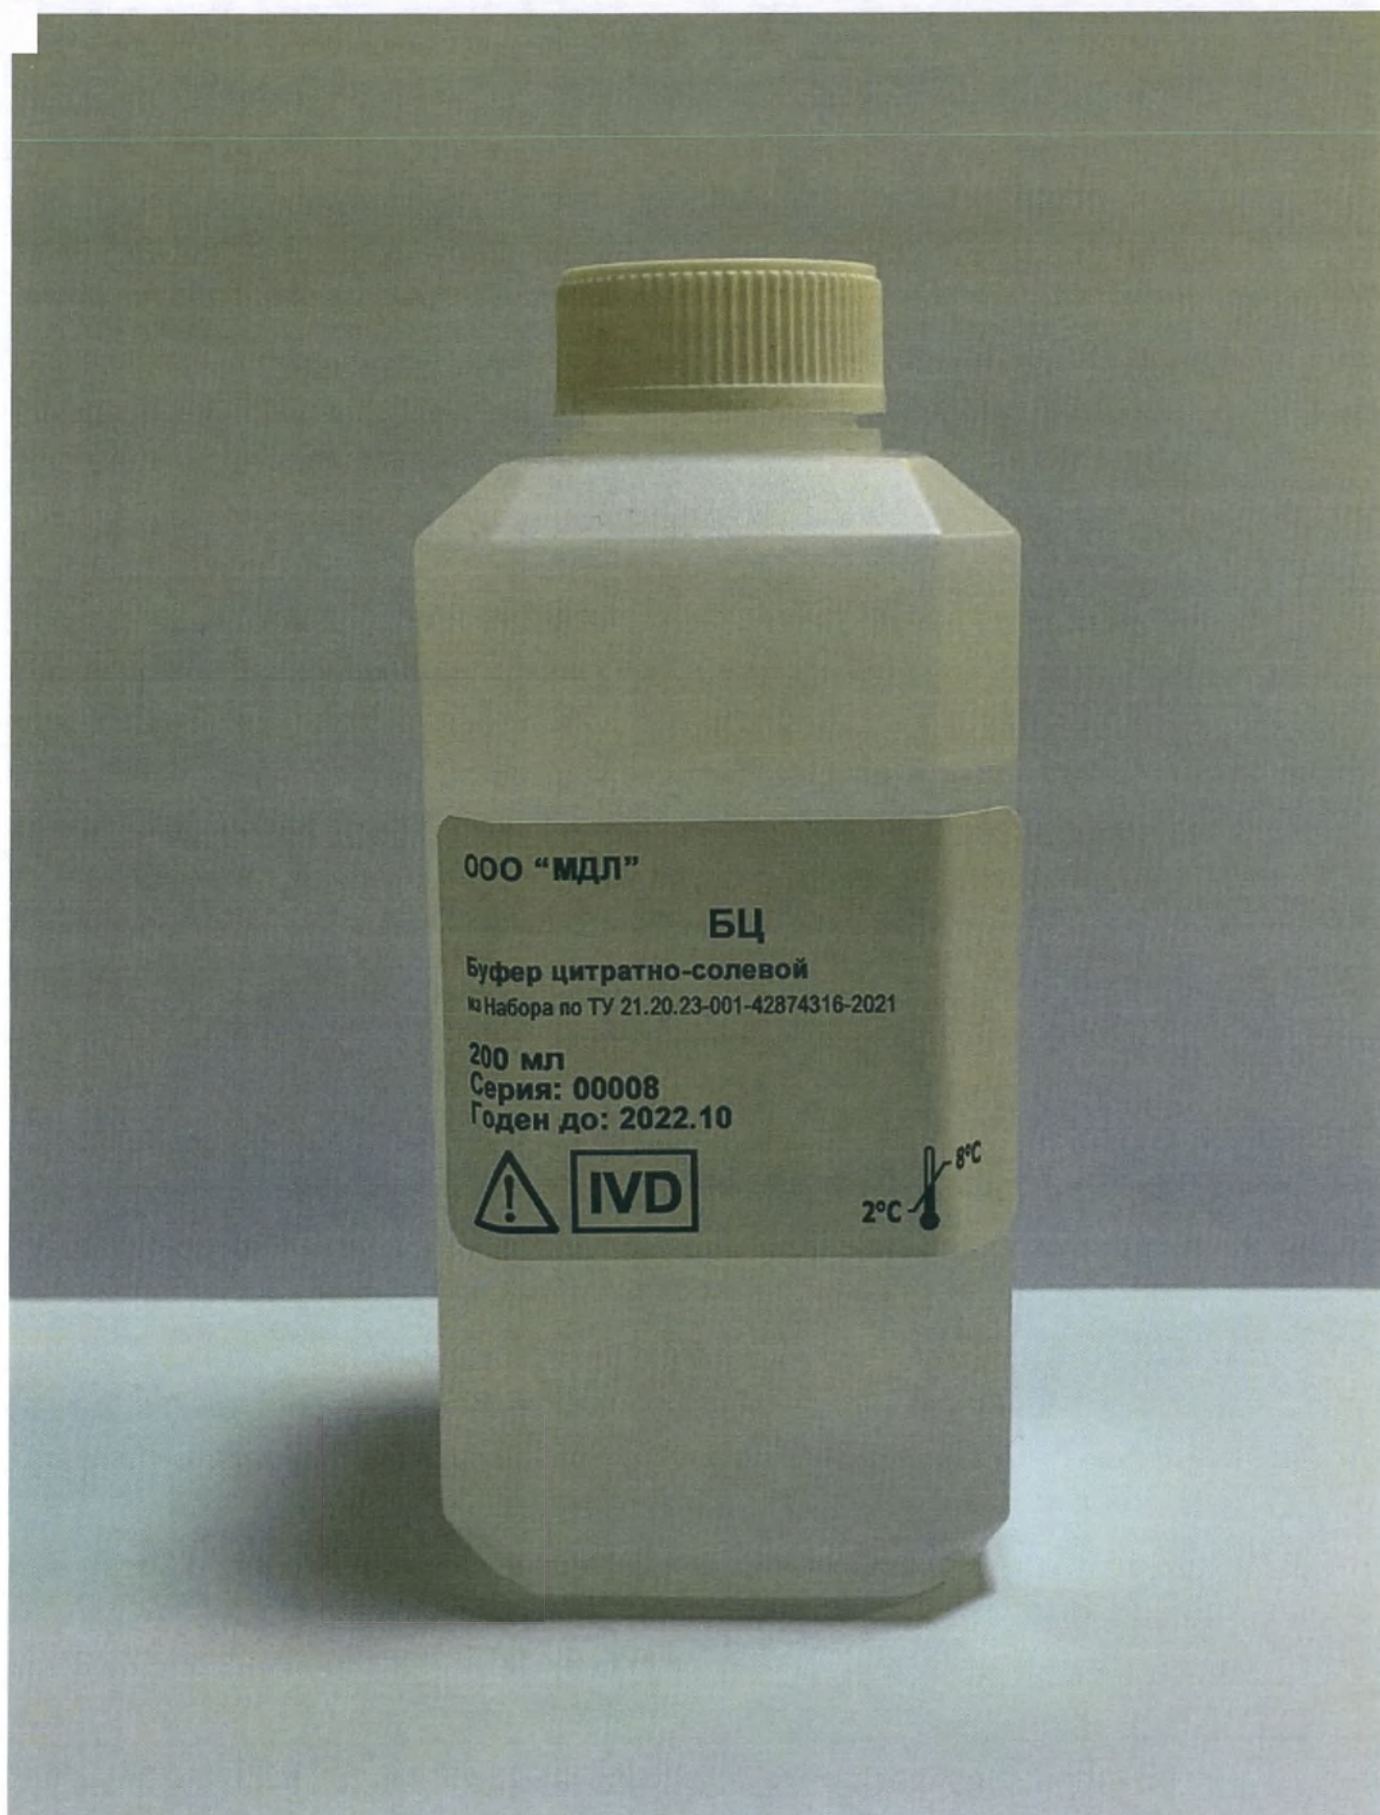


Фотографическое изображение 19 – Буфер цитратно-солевой (БЦ), 1 флакон (200 мл), комплектующее




Фотографическое изображение 20 – Макет этикетки Буфер цитратно-солевой (БЦ)

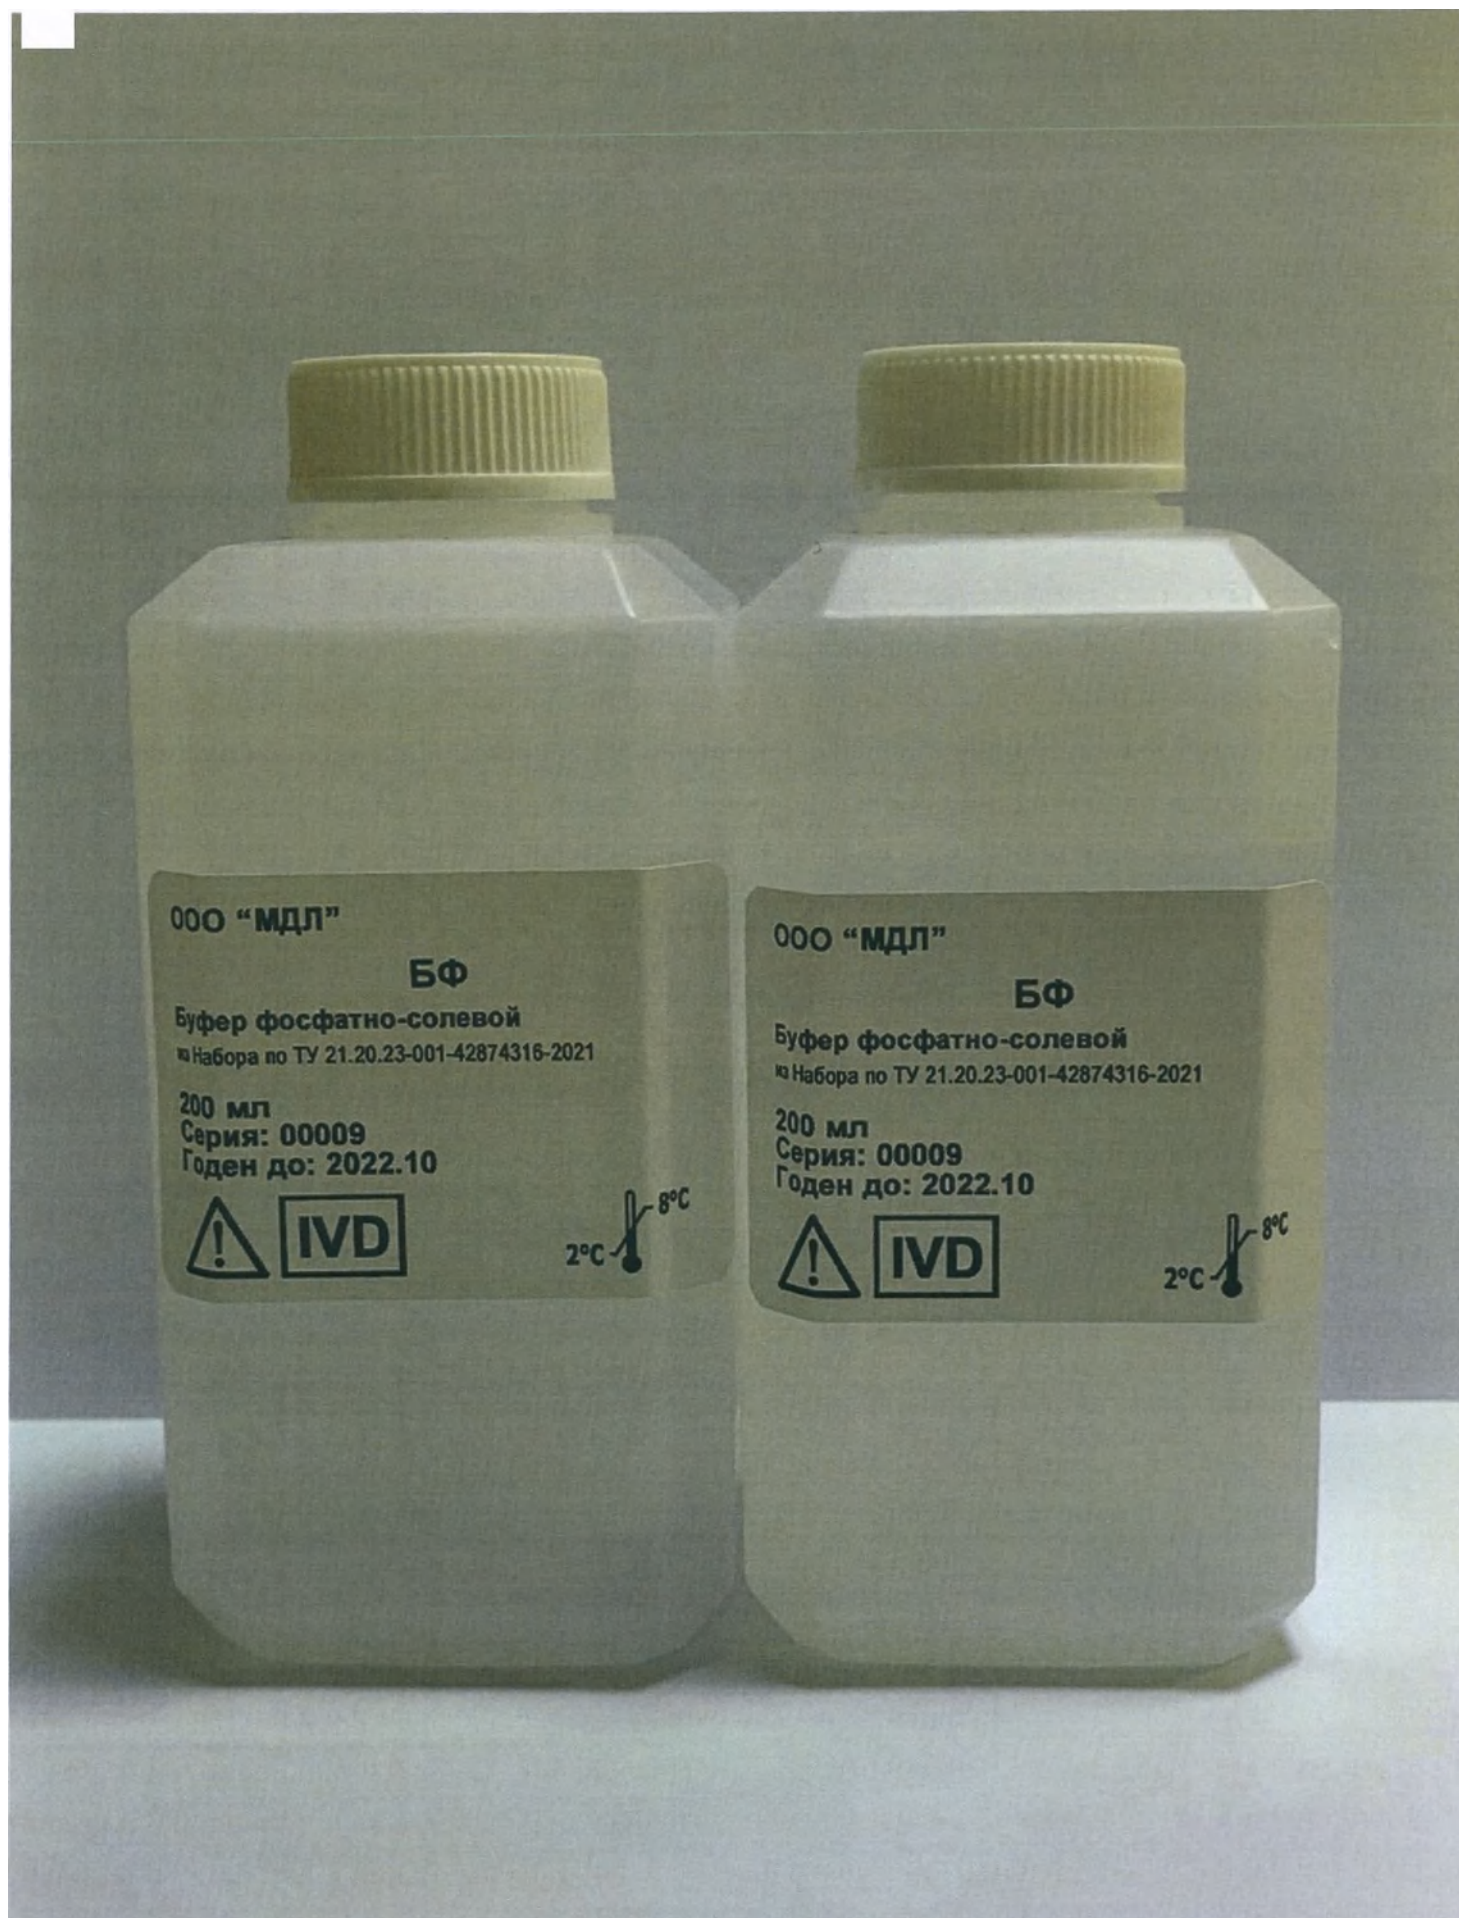


Фотографическое изображение 21 – Буфер фосфатно-солевой (БФ), 2 флакона (по 200 мл), комплектующее

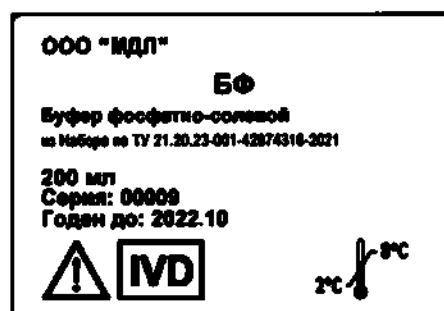


Фотографическое изображение 22 – Макет этикетки Буфер фосфатно-солевой (БФ)

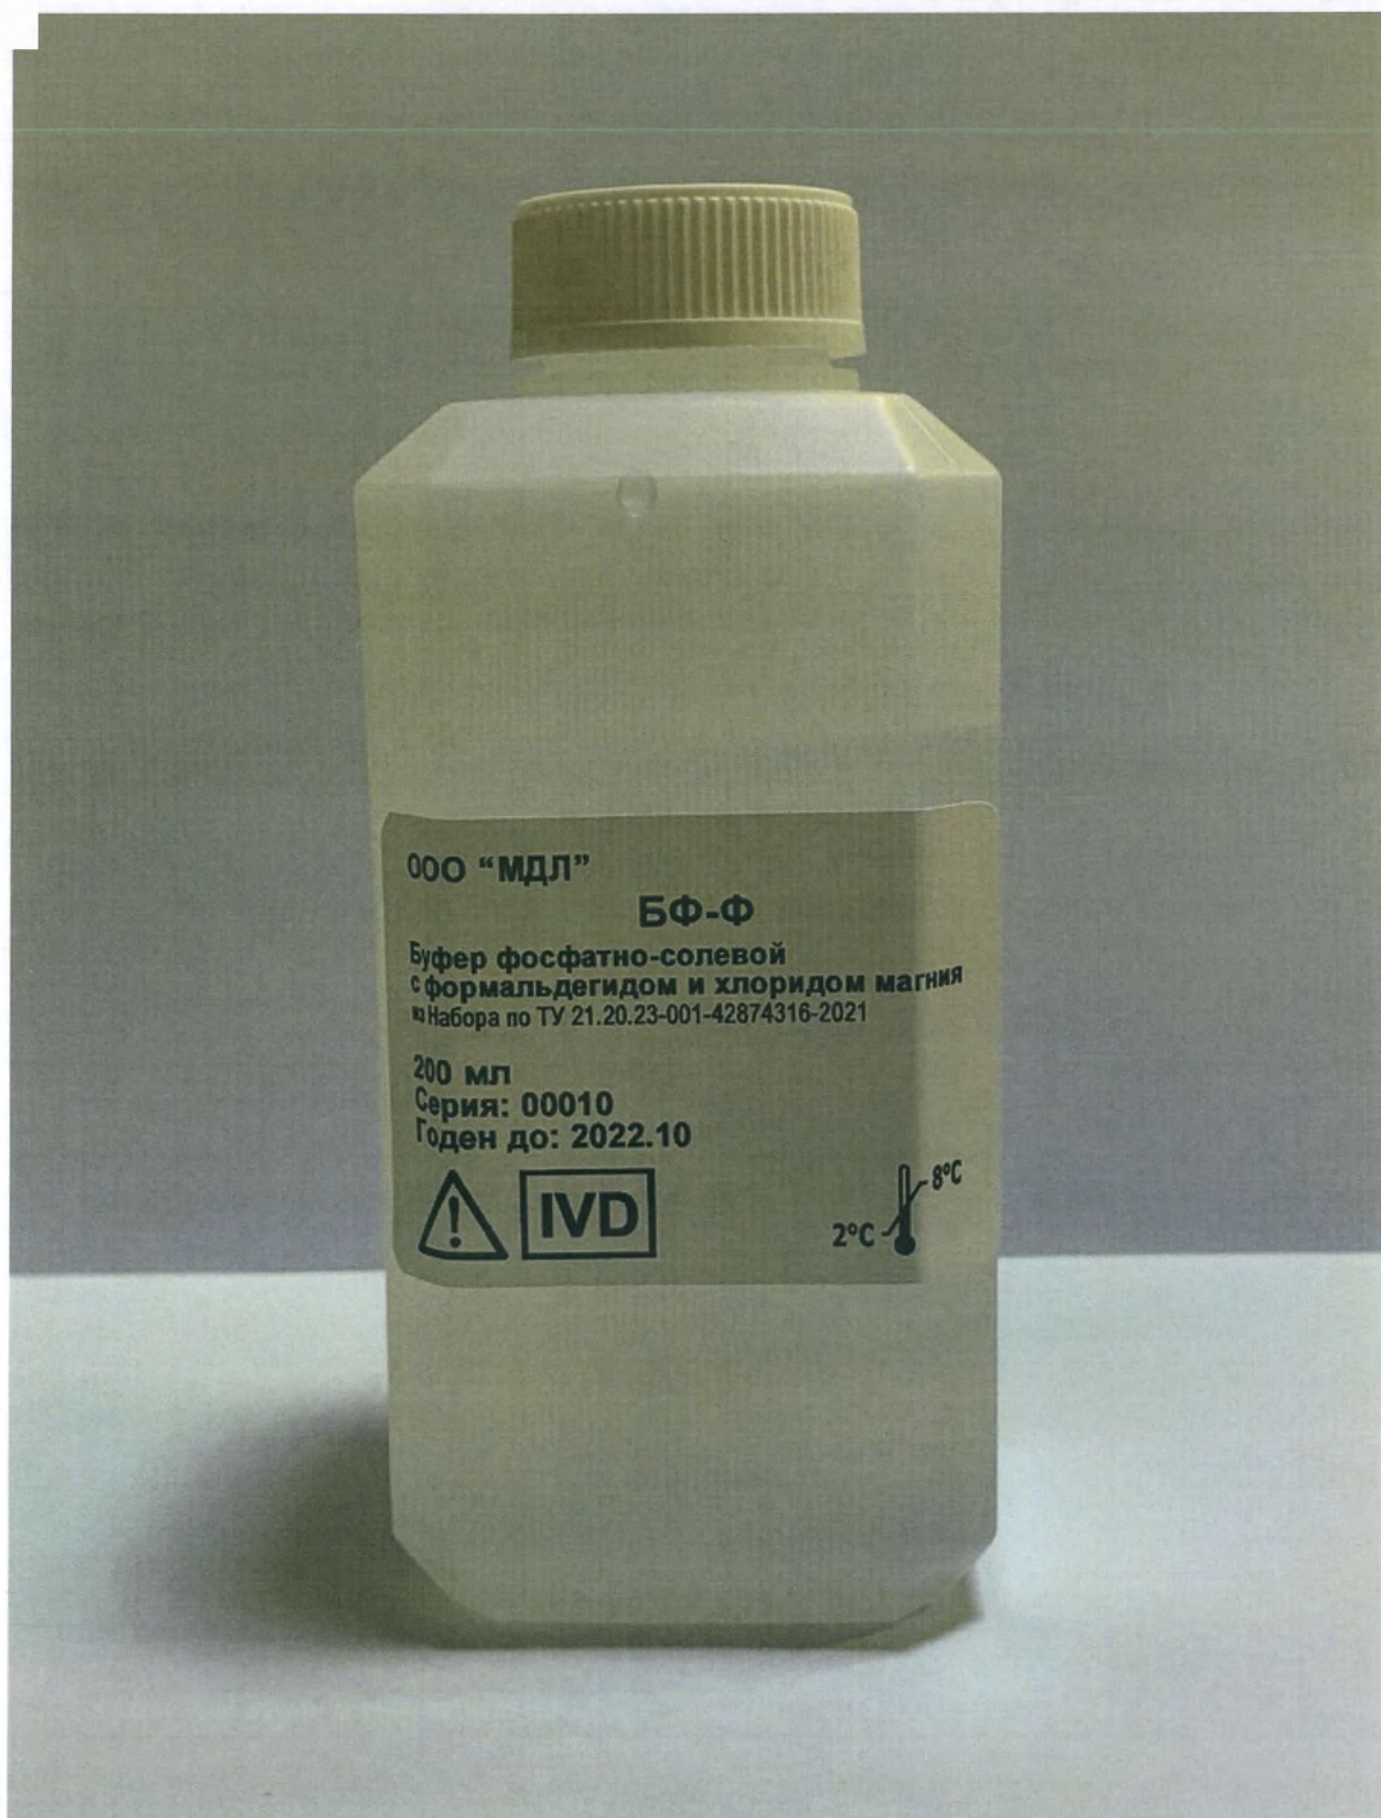


Фотографическое изображение 23 – Буфер фосфатно-солевой с формальдегидом и хлоридом магния (БФ-Ф),
1 флакон (200 мл), комплектующее

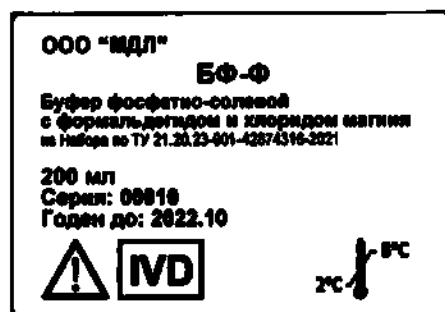


Фотографическое изображение 24 – Макет этикетки Буфер фосфатно-солевой с формальдегидом и хлоридом магния (БФ-Ф)

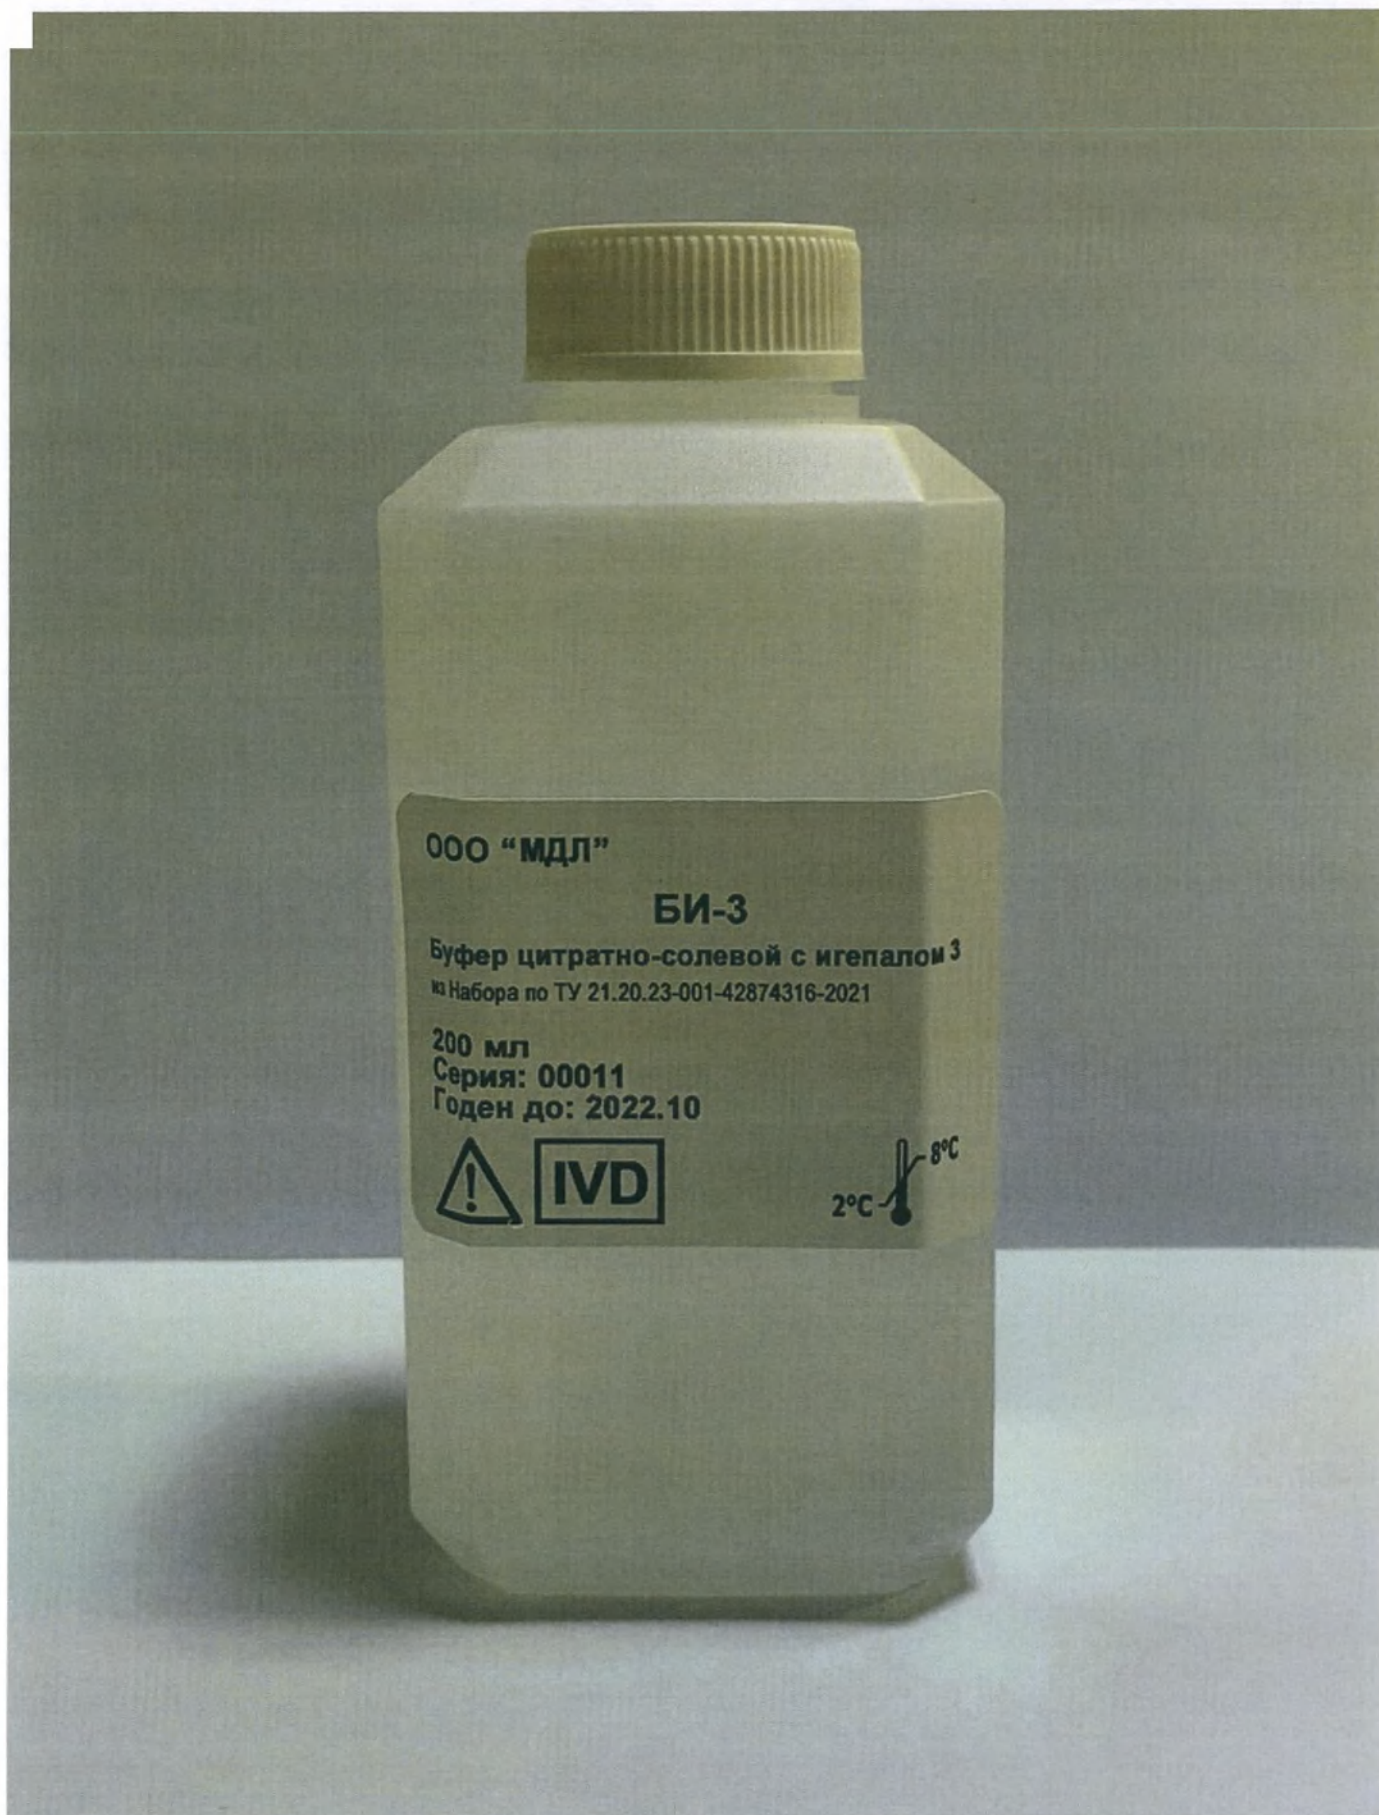

Фотографическое изображение 25 – Буфер цитратно-солевой с игепалом 3 (БИ-3), 1 флакон (200 мл), комплектующее

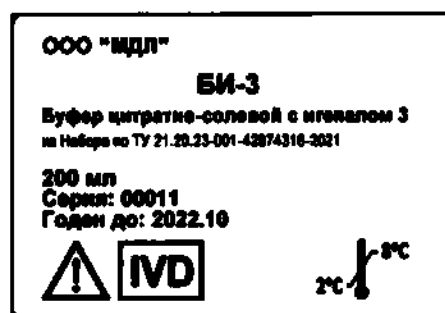

Фотографическое изображение 26 – Макет этикетки Буфер цитратно-солевой с изопалом 3 (БИ-3)

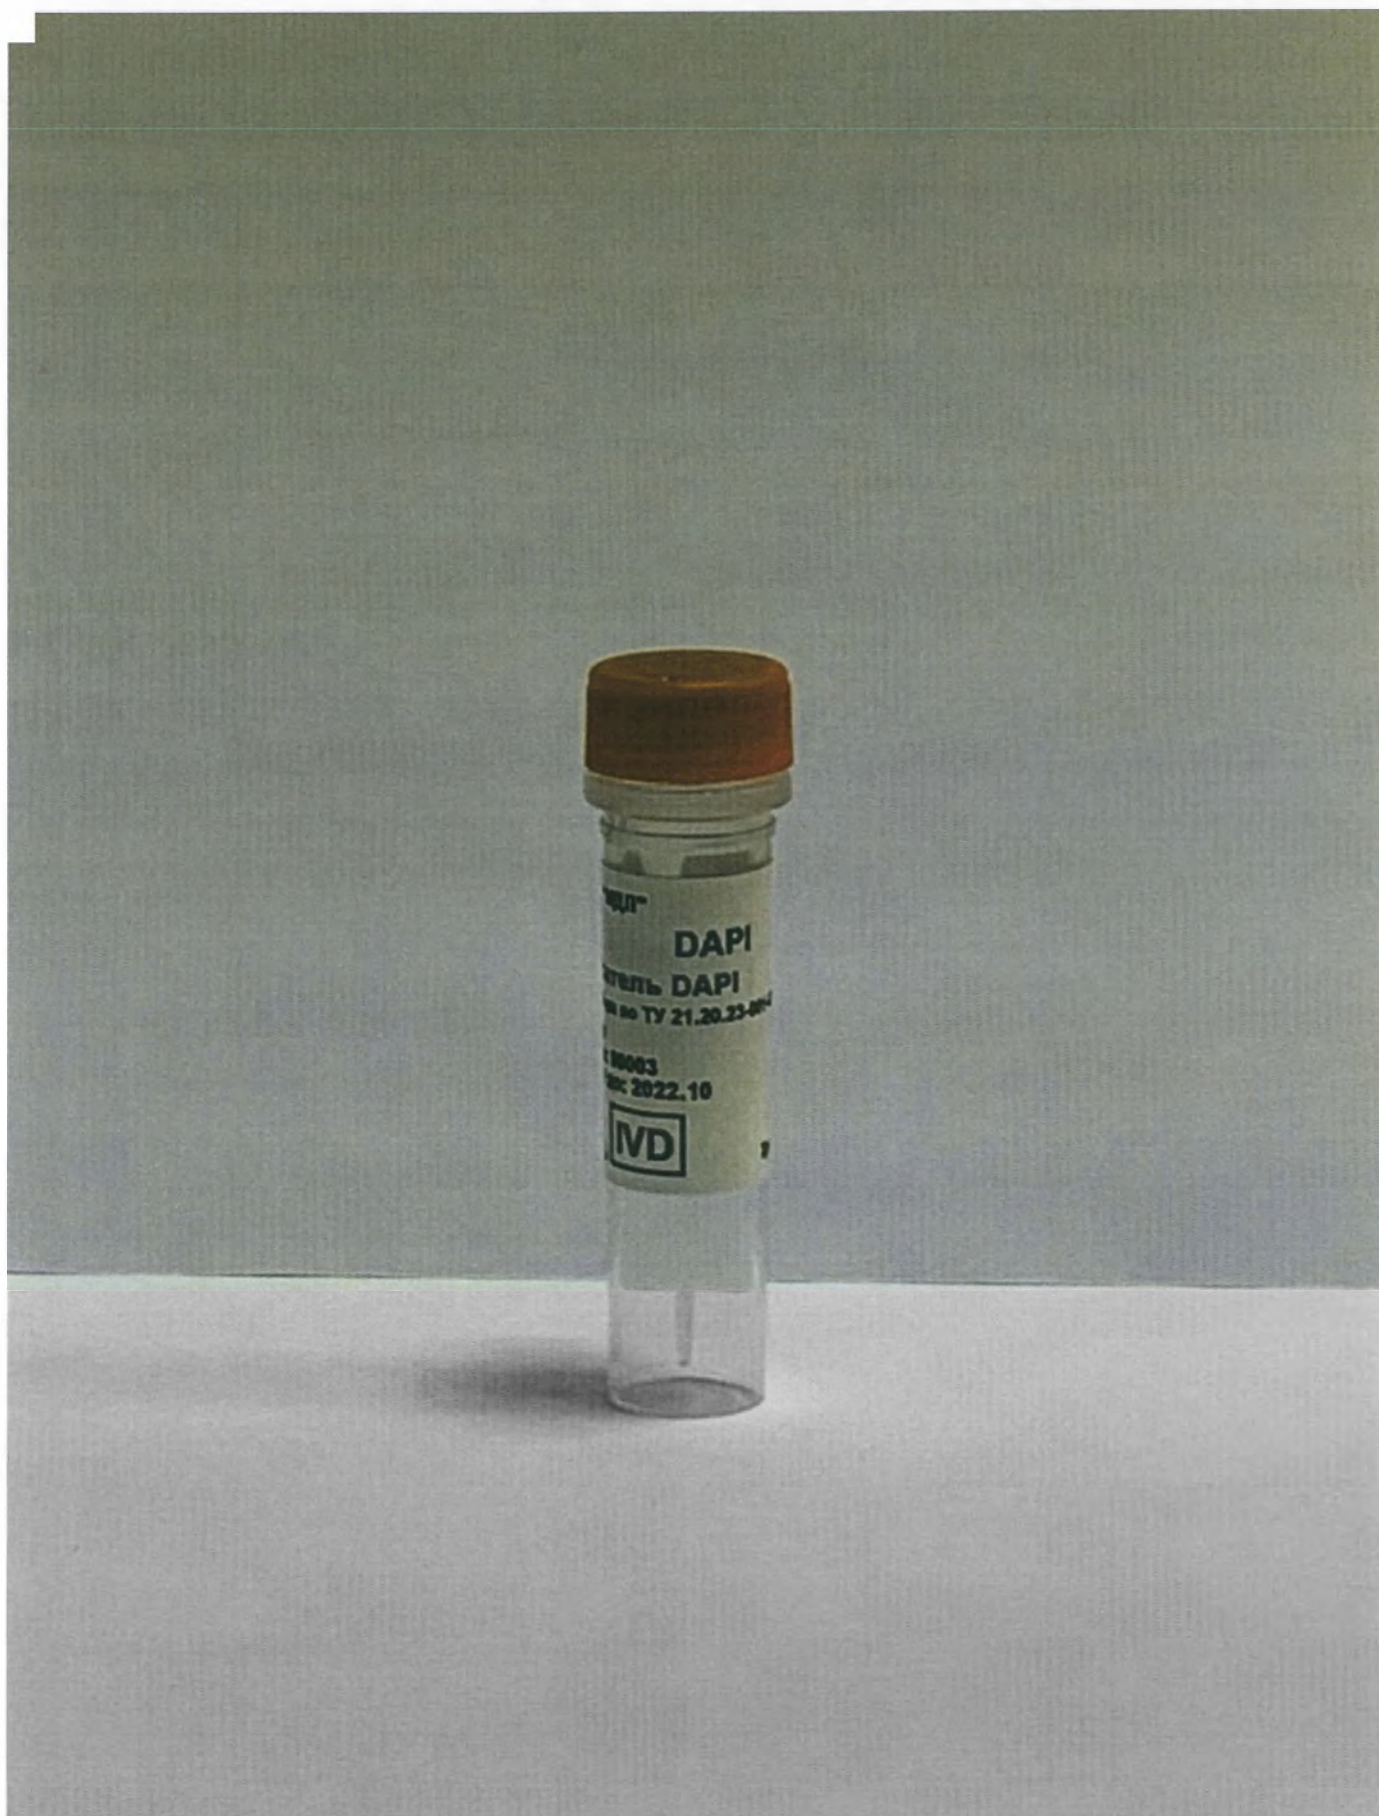

Фотографическое изображение 27 – Общий вид упаковки и маркировки медицинского изделия, включающих 1 пробирку.

ООО "МДЛ"


ДНК-зонды (13/21), 1 пробирка (100 мкл), Серия 00001
ДНК-зонды (18/X^Y), 1 пробирка (100 мкл), Серия 00002
из Набора по ТУ 21.20.23-001-42874316-2021

Годен до: 2022.10




-25°C  -15°C


Фотографическое изображение 28 – Общий вид упаковки и маркировки медицинского изделия, включающих 2 пробирки

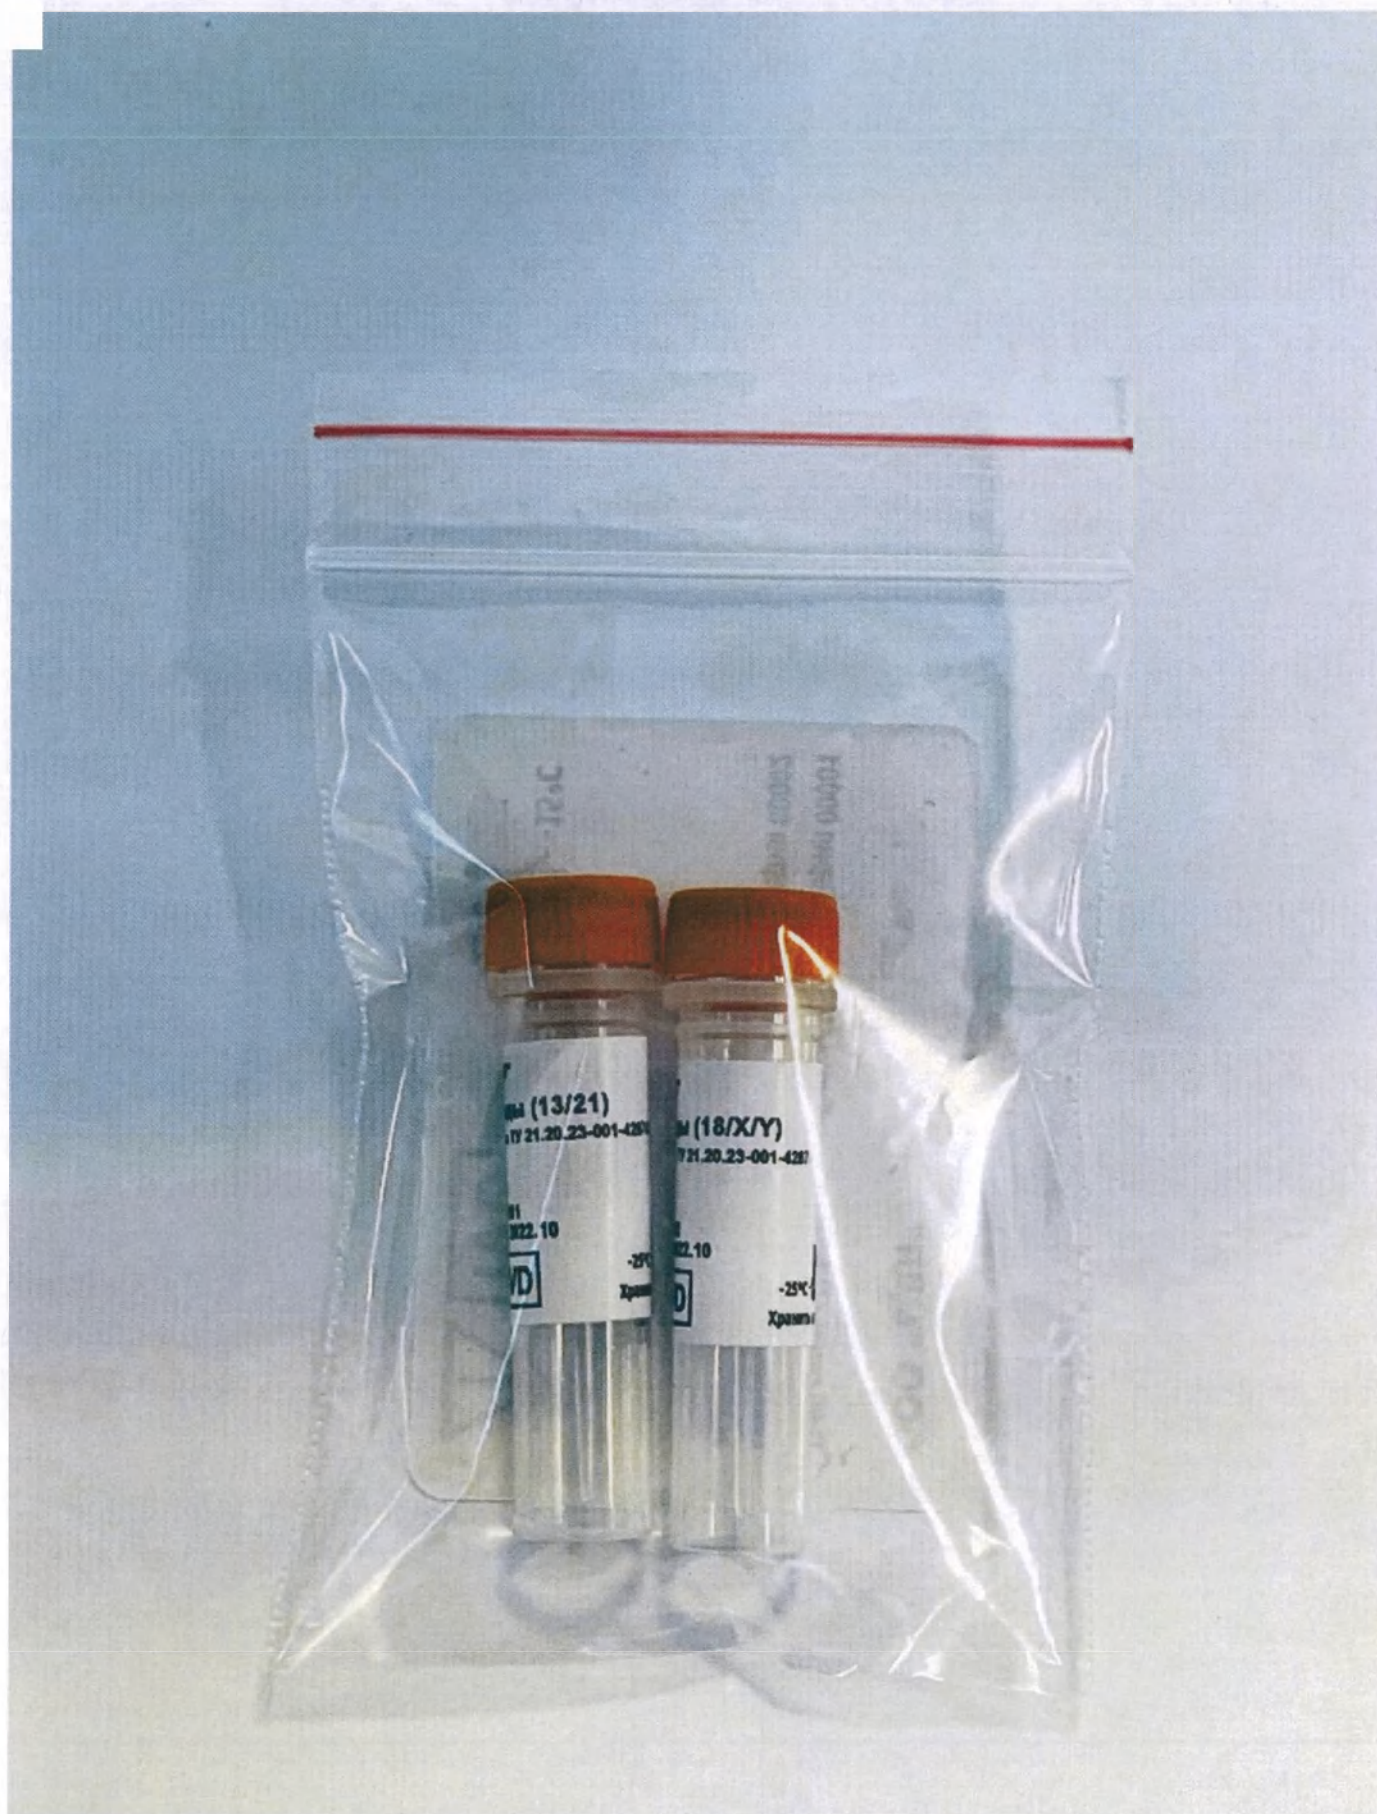


Фотографическое изображение 29 – Вид изнутри упаковки медицинского изделия, включающих 2 пробирки.

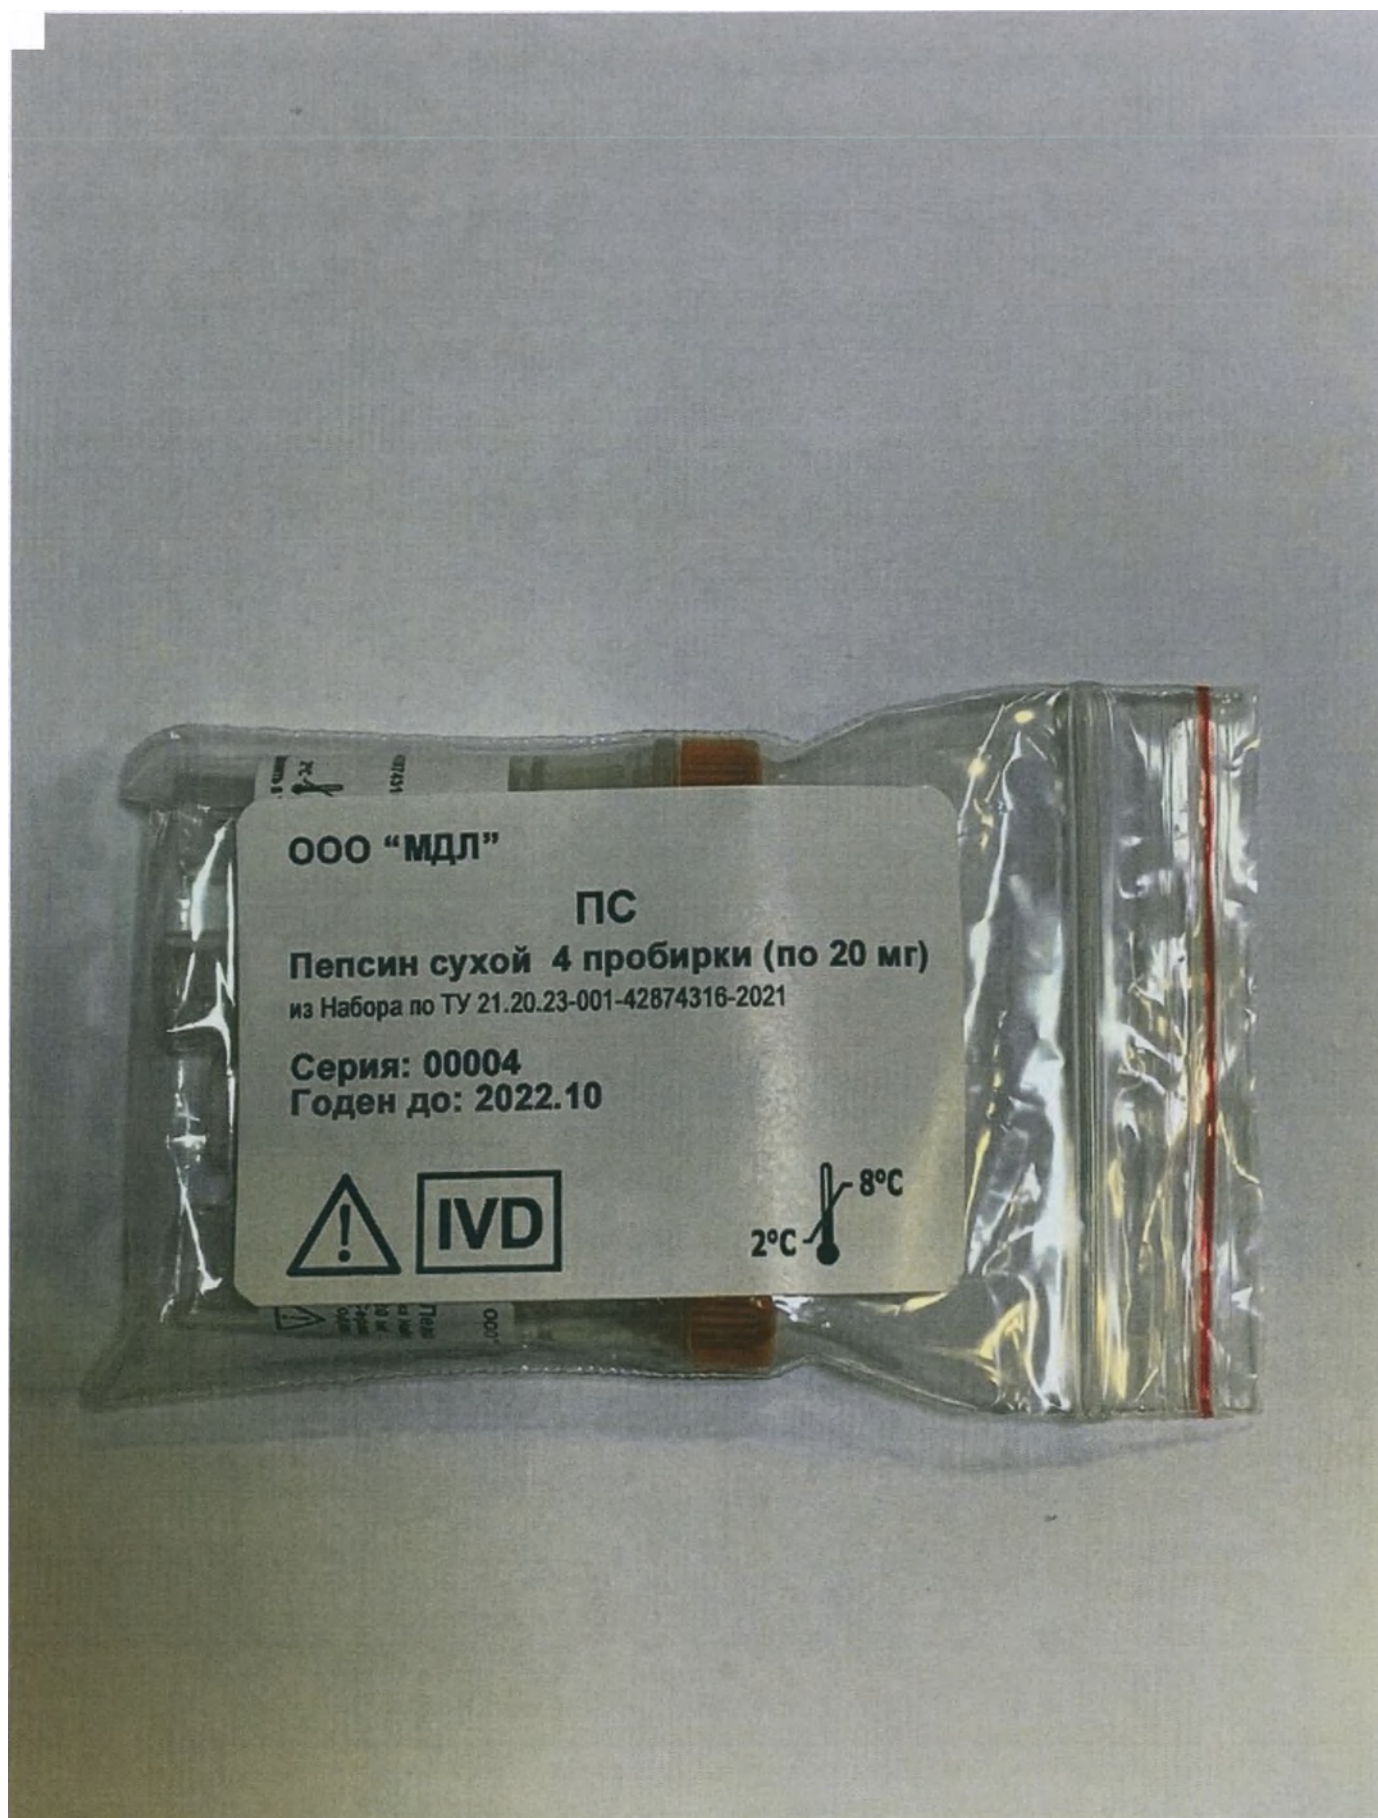

Фотографическое изображение 30 – Общий вид упаковки и маркировки медицинского изделия, включающих 4 пробирки.

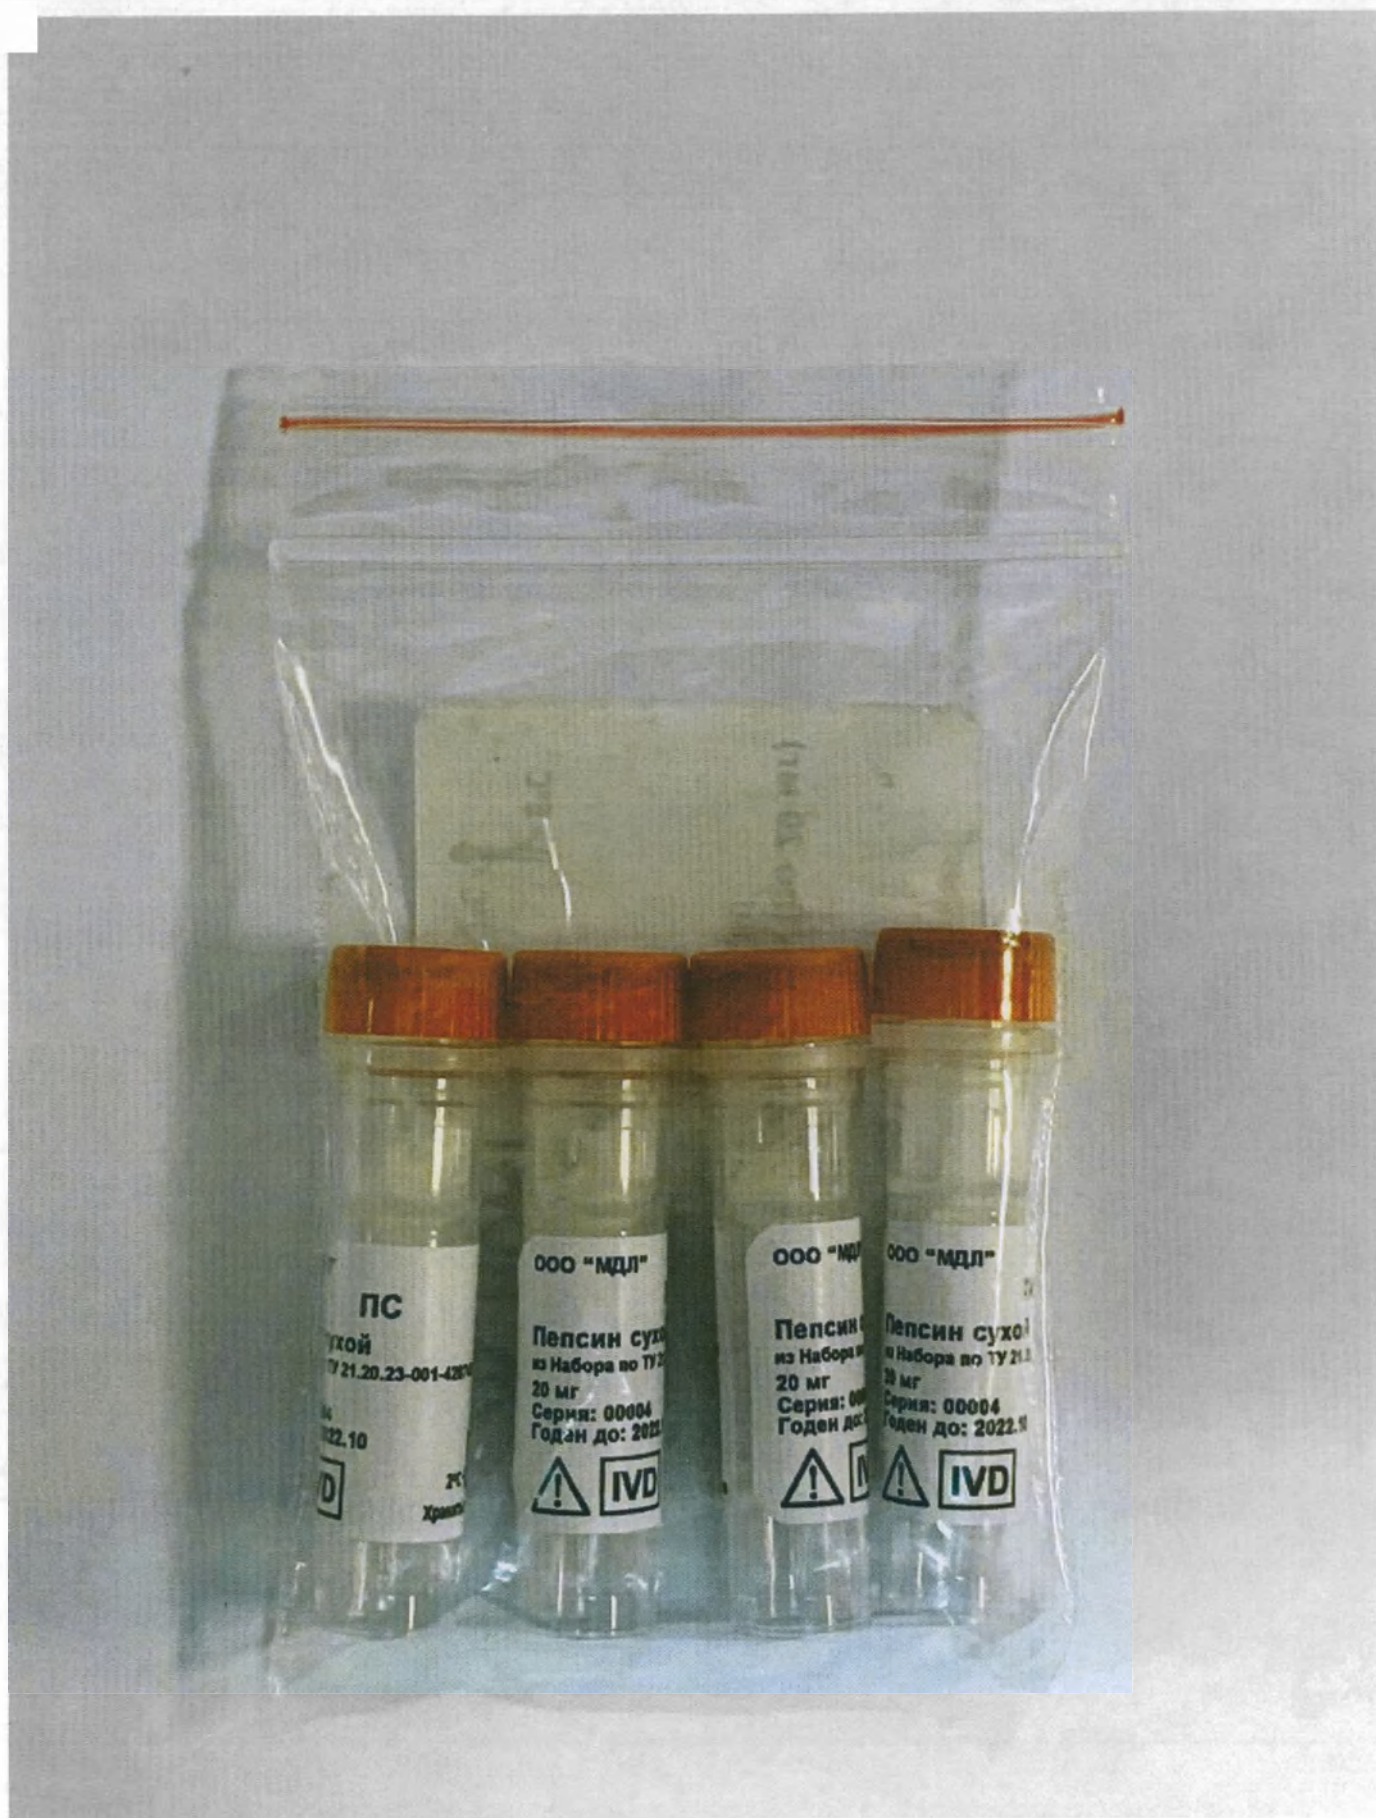

Фотографическое изображение 31 – Вид изнутри упаковки медицинского изделия, включающих 4 пробирки.

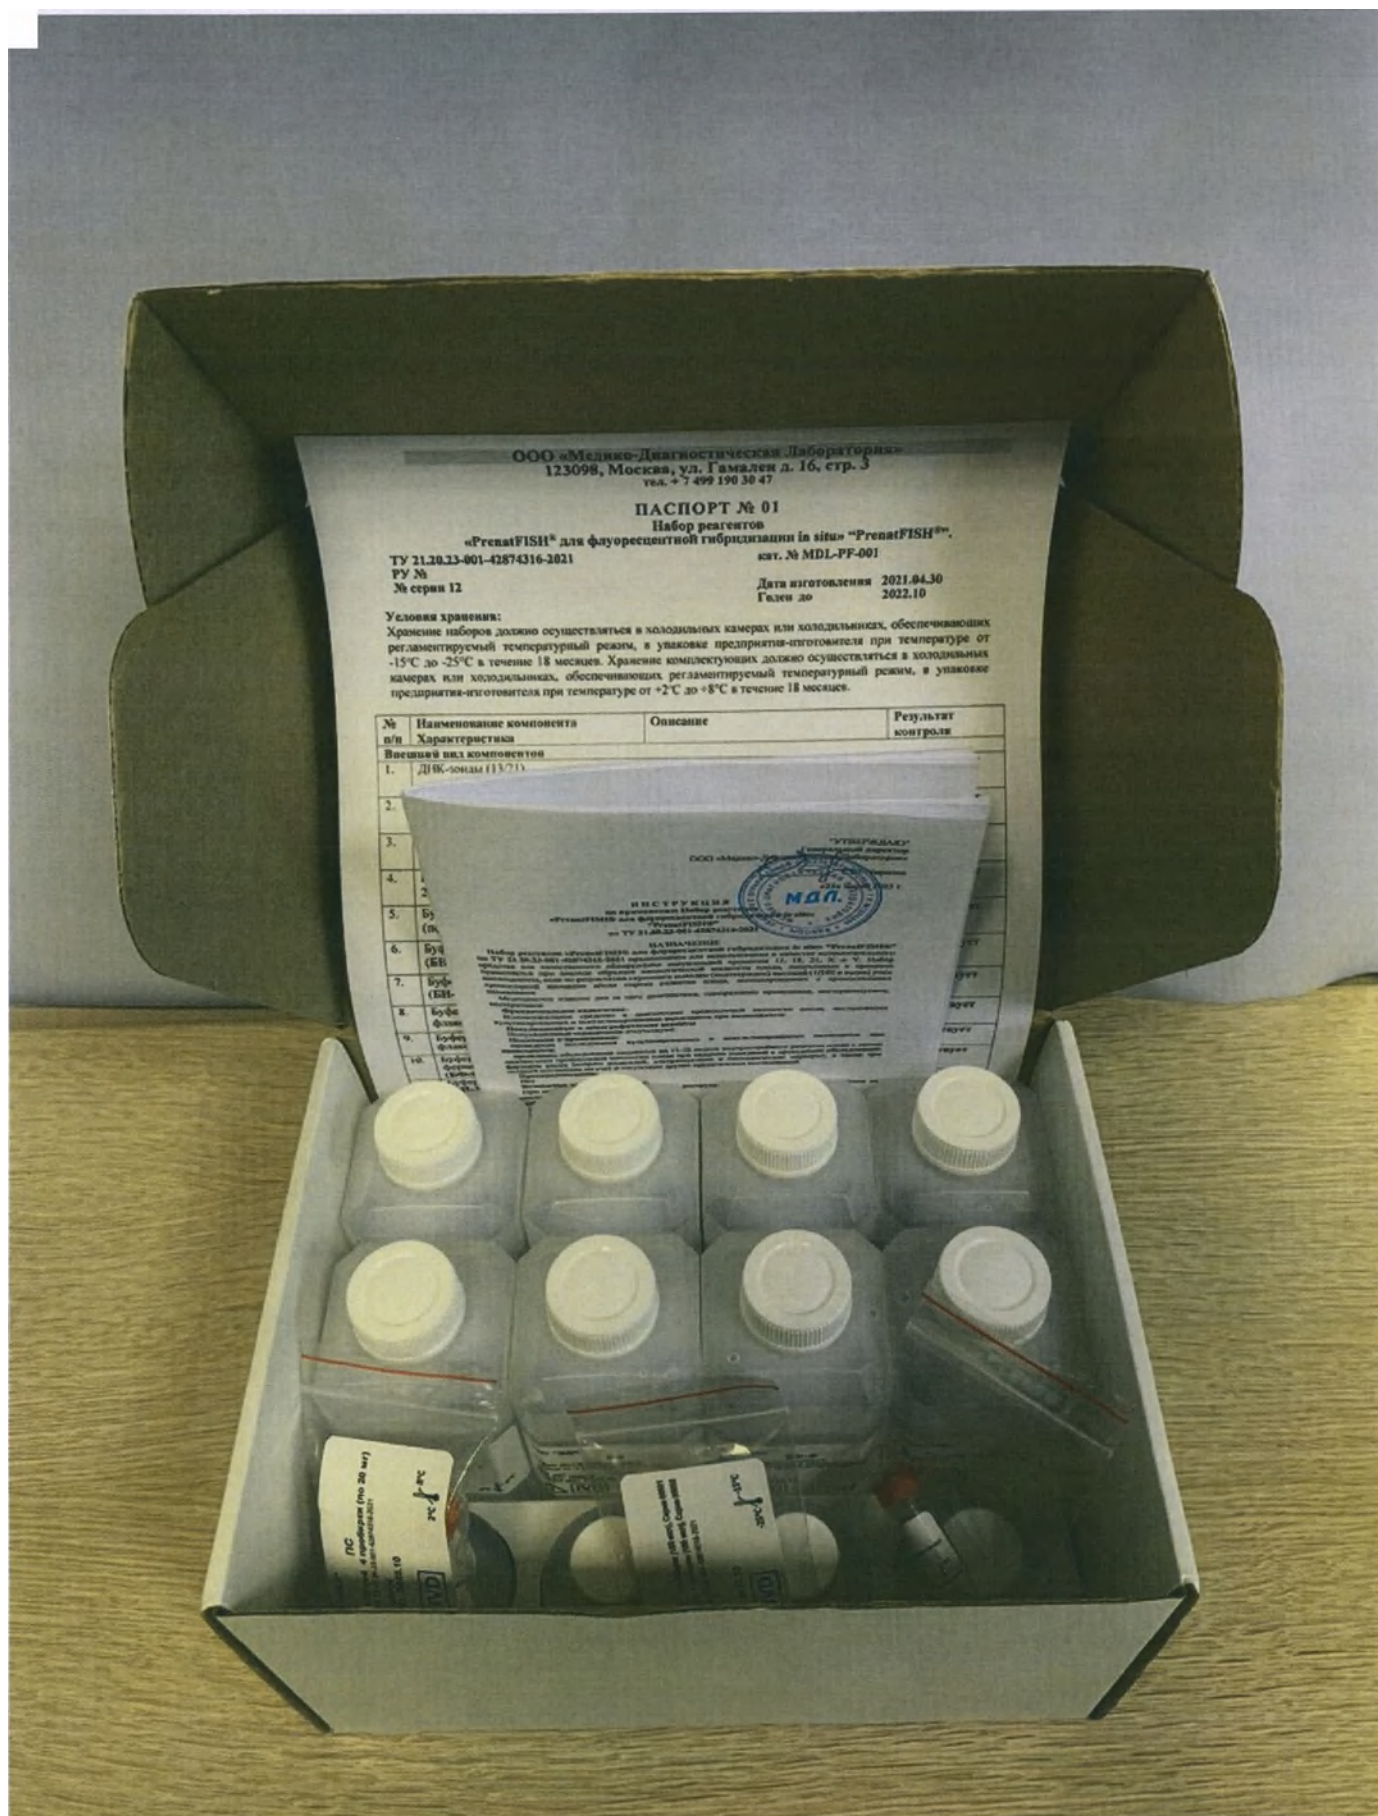


Фотографическое изображение 32 – Набор реагентов «PrenatFISH®» для флуоресцентной гибридизации in situ «PrenatFISH®» по ТУ 21.20.23-001-42874316-2021, вид изнутри



Фотографическое изображение 33 – Набор реагентов «PrenatFISH® для флуоресцентной гибридизации in situ»
 "PrenatFISH®" по TY 21.20.23-001-42874316-2021, состав набора

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УПАКОВКЕ И ЭТИКЕТКАХ

	Для диагностики in vitro
	Температурный диапазон
	Изготовитель
	Логотип
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 32 ЛИСТОВ
«23» марта 2023 год

Ген. Директор
ООО «МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ»
Чиркова Е.Ю.

