



ООО «ВАТЕК КОРП.»
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 17, стр. 1-2
тел.: + 7 (495) 967-90-55
info@vatechrussia.com
ИНН 7725284049 КПП 772801001

VATECH CORP, LLC
17, build. 1-2, Nauchnyy proezd,
Moscow, 117246
phone: + 7 (495) 967-90-55
info@vatechrussia.com
INN 7725284049 KPP 772801001

Фотографический файл

«Устройство обработки рентгеновского изображения, модели: 1717WCC, 1012WCC, 1717SCV»



rayence

RAYENCE 3000 Series C-Panel 75 Samsung 12.1" High Resolution LED Backlight Assembly		rayence	
Model: 1717NCC (Medical Image Processing Unit)			
Rating: 24V AC CAUTION: Use Only with RAYENCE is or Battery or RAYENCE Power Supply		Serial Number 1717NCC-1	
Barcode 1717NCC-1		CE Mark CE 1639	
IP66		IP66	



MANUFACTURER Rayence Co.,Ltd.
14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea / www.rayence.com

rayence

Model : 1717WCC (Medical Image Processing Unit)

Rating : 24V

CAUTION : Use Only with RB37WHA
(Li-ion Battery) or RP003A
(Power Supply)

Prudence : N'utilisez qu'avec
RB37WHA(batterie) ou RP003A
(Circuit d'alimentation)



Date of Manufacture
2021.11.11



Serial Number
1717WCC_S



(01)08800018600504
(11)211111
(21)1717WCC_S

FCC ID : QIIRYRWM001A


This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

IC : 10742A-RWM001A

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
5151-5250MHz is indoor use only.



VATECH Global France SARL
51 Quai de Dion Bouton 92800, Puteaux, France
Tel : +33 1 64 11 43 30 Fax : +33 1 64 11 43 39



R011-170018





CE1639


IP66


Made in Korea

Rev.04

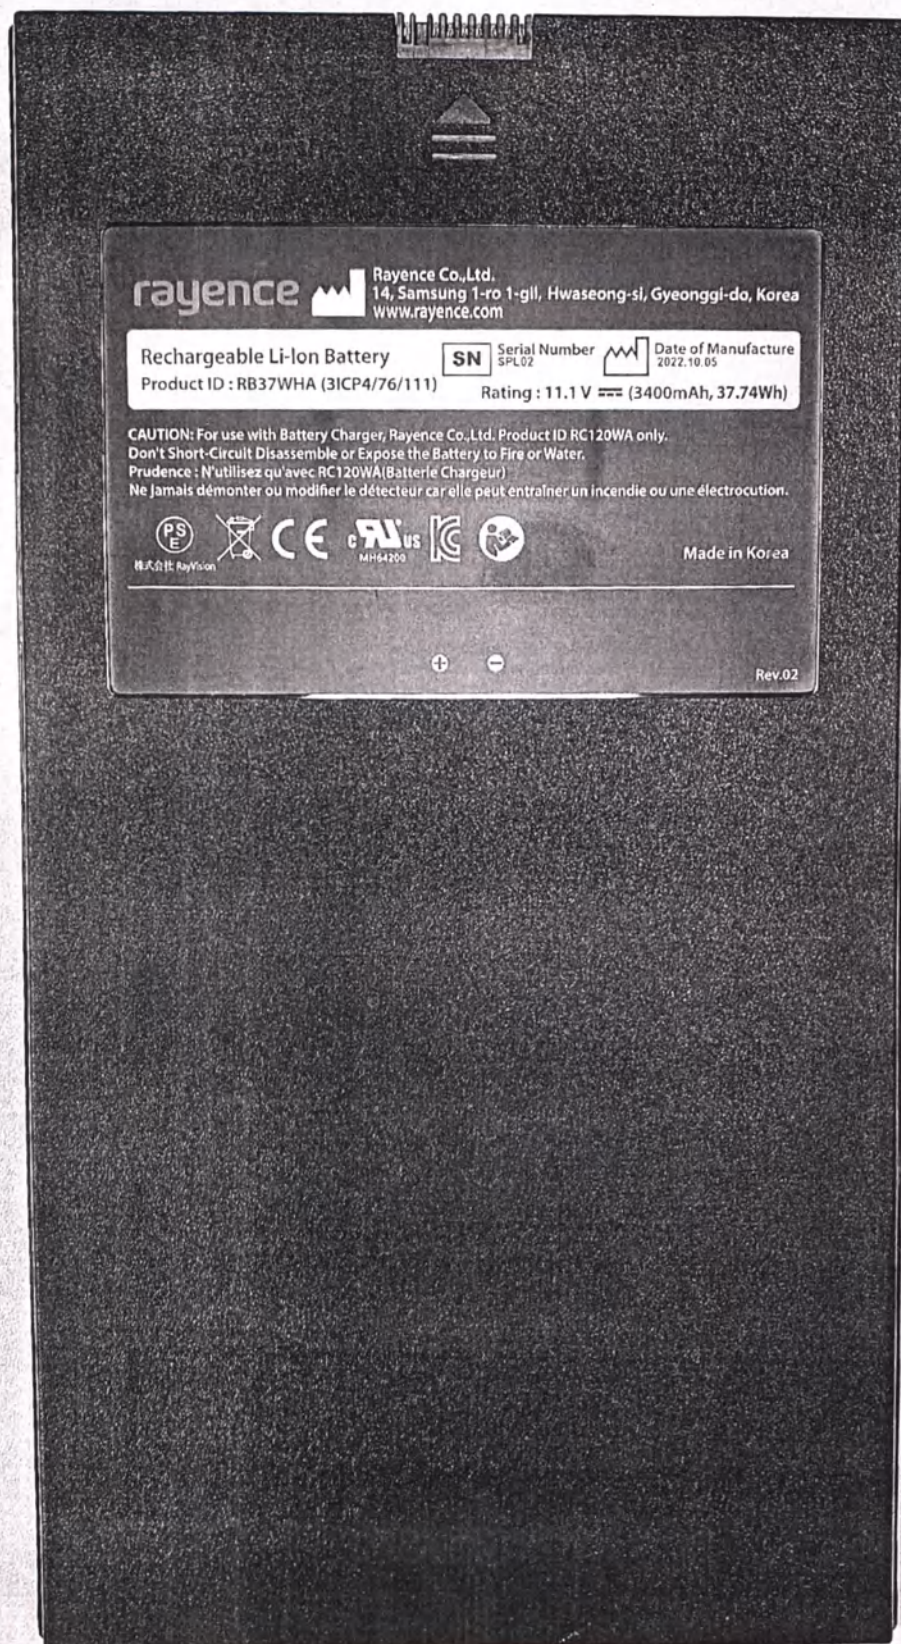

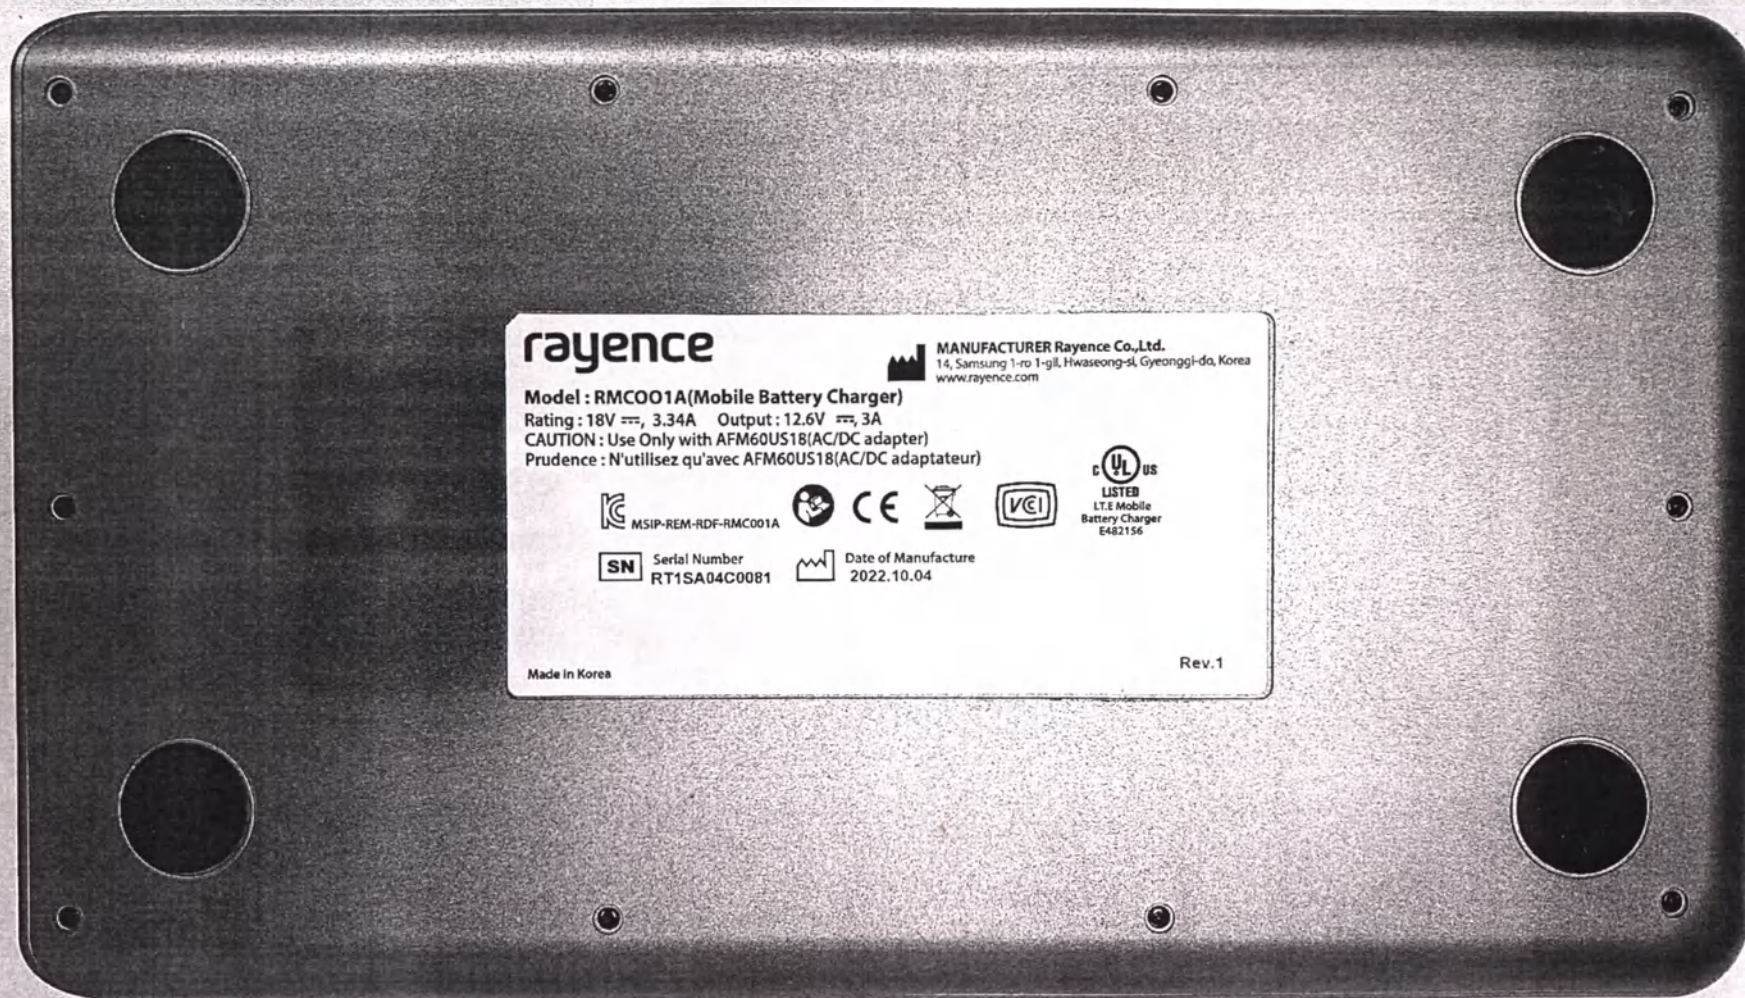

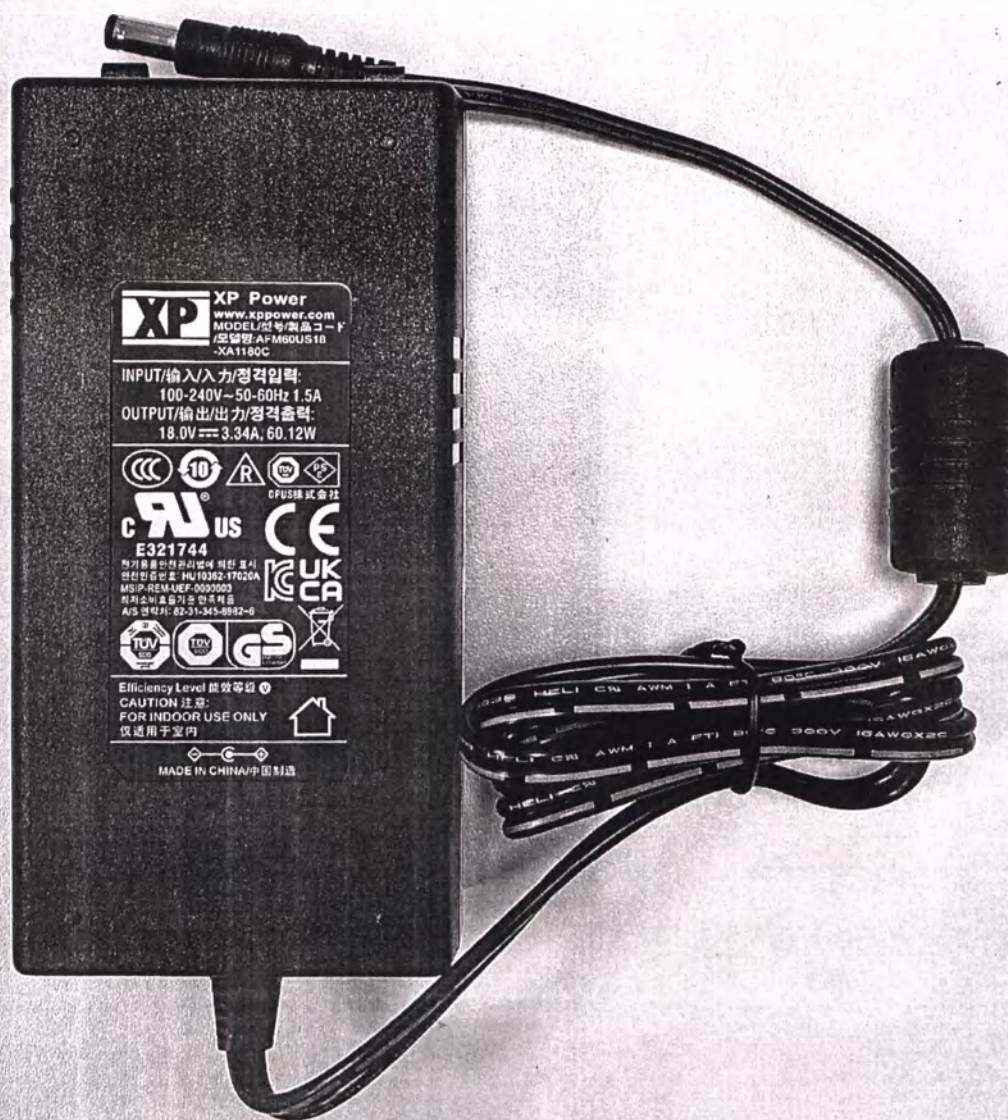

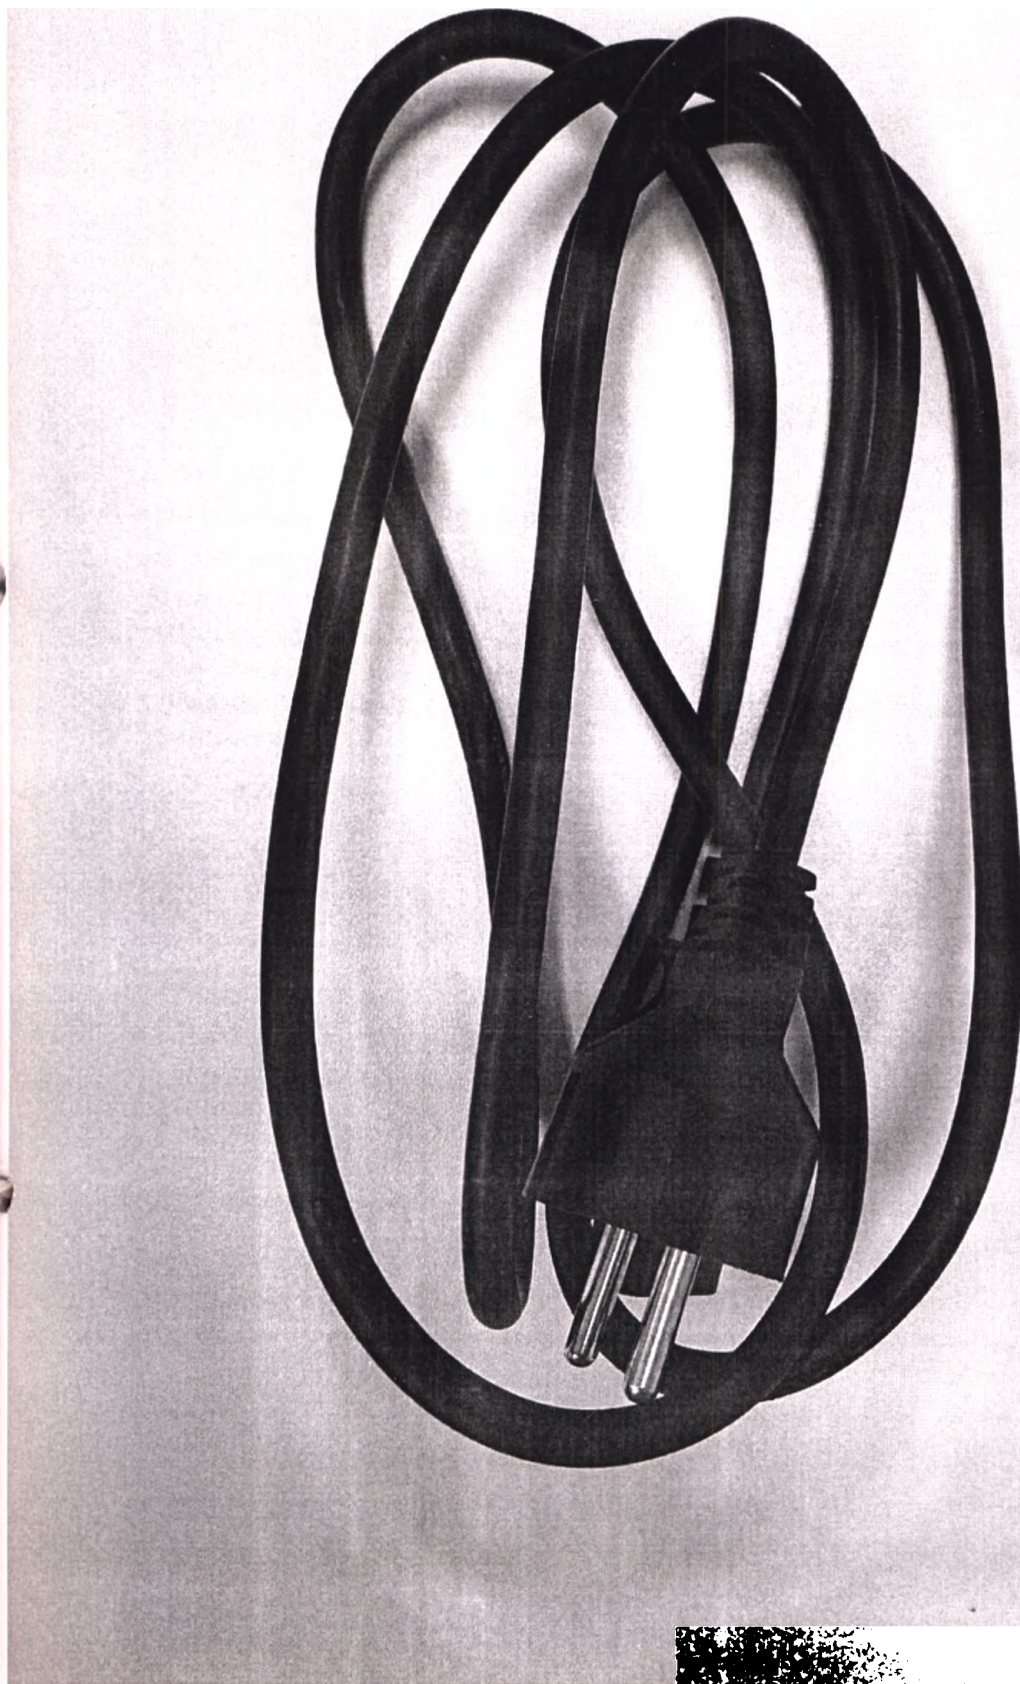

Устройство обработки рентгеновского изображения, модель 1717WCC

Руководство по эксплуатации и установке

- Русский

I hereby certify accuracy,
correctness and reliability
of this document
translated into Russian

«Подтверждаю точность,
правильность и достоверность
содержания текста перевода на
русский язык»

«УТВЕРЖДАЮ»/“APPROVE”

Rayence Co., Ltd.

CEO

(должность/position)

Mr. Seo Jae Jeong

(имя/name)

(подпись/signature)

М.П. /
Stamp



rayence

XmaruView V1

Do Not Illegally Use, Lend,
or Copy this Disc

© 2011 Rayence Co., Ltd.
and Its Licensors.
All rights reserved.
Made in Korea

rayence
www.rayence.com

USB-накопитель установочный с программным обеспечением Xmaru Pro



Xmaru Pro

Руководство пользователя для ПО

• Русский

*«Подтверждаю точность,
правильность и достоверн
ость содержания текста
перевода на русский язык»*

УТВЕРЖДАЮ»/“APPROVE”

Rayence Co., Ltd.

CEO


(должность/position)

Mr. Seo Jae Jeong

(имя/name)

(подпись/signature)

М.П. / Stamp

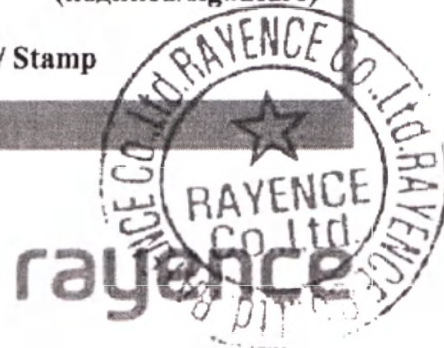


XmaruView V1

Руководство пользователя и
Руководство по установке

• Русский

rayence

Блок питания, модель RP003A

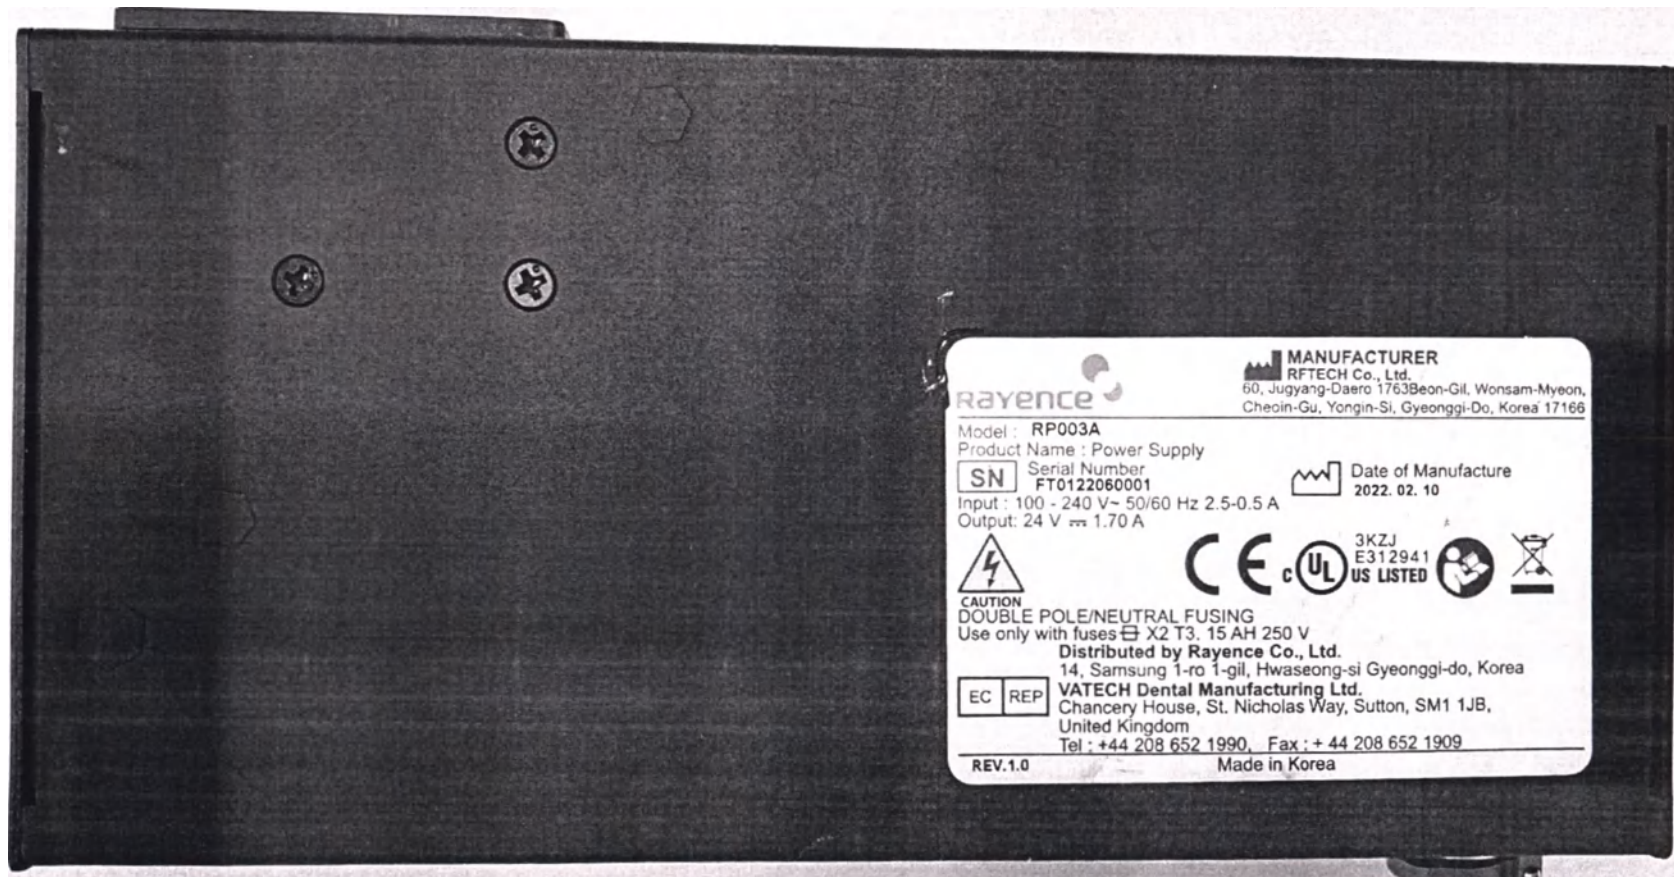

Rayence  **MANUFACTURER**
RFTECH Co., Ltd.
60, Jugyang-Daero 1763Beon-Gil, Wonsam-Myeon,
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea 17166

Model : **RP003A**
Product Name : Power Supply

SN Serial Number
FT0122080001

Date of Manufacture
2022. 02. 10


Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 2.5-0.5 A
Output: 24 V  1.70 A


 **CAUTION**
DOUBLE POLE/NEUTRAL FUSING
Use only with fuses  X2 T3. 15 AH 250 V

  **3KZJ**
E312941
US LISTED  

EC **REP** **Distributed by Rayence Co., Ltd.**
14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si Gyeonggi-do, Korea
VATECH Dental Manufacturing Ltd.
Chancery House, St. Nicholas Way, Sutton, SM1 1JB,
United Kingdom
Tel : +44 208 652 1990, Fax : + 44 208 652 1909

REV.1.0 **Made in Korea**

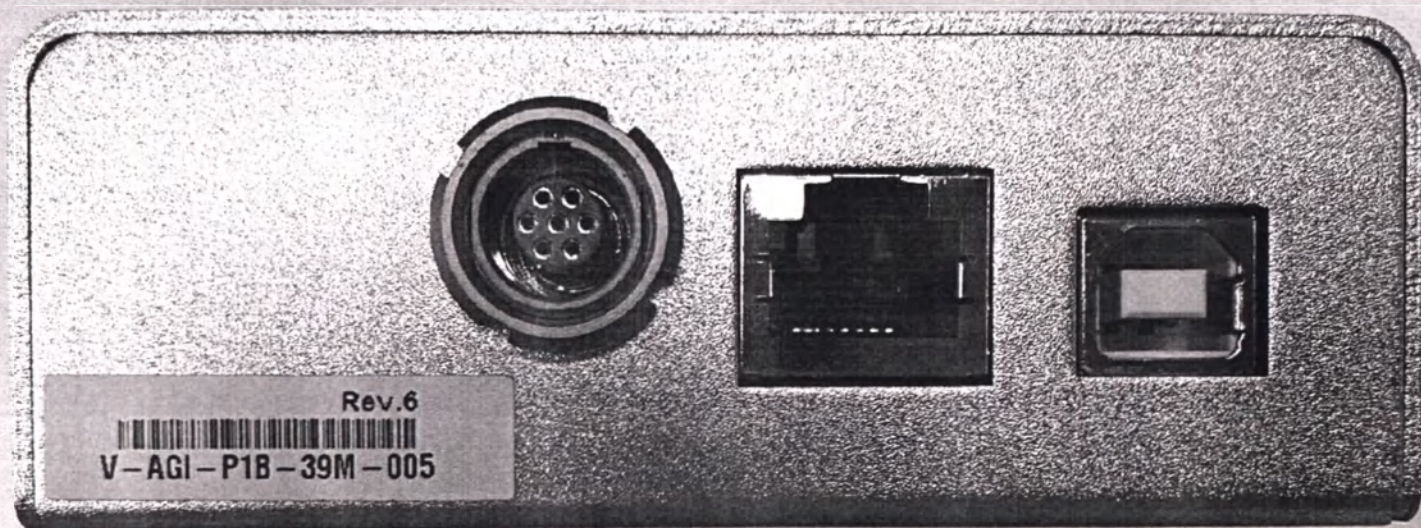

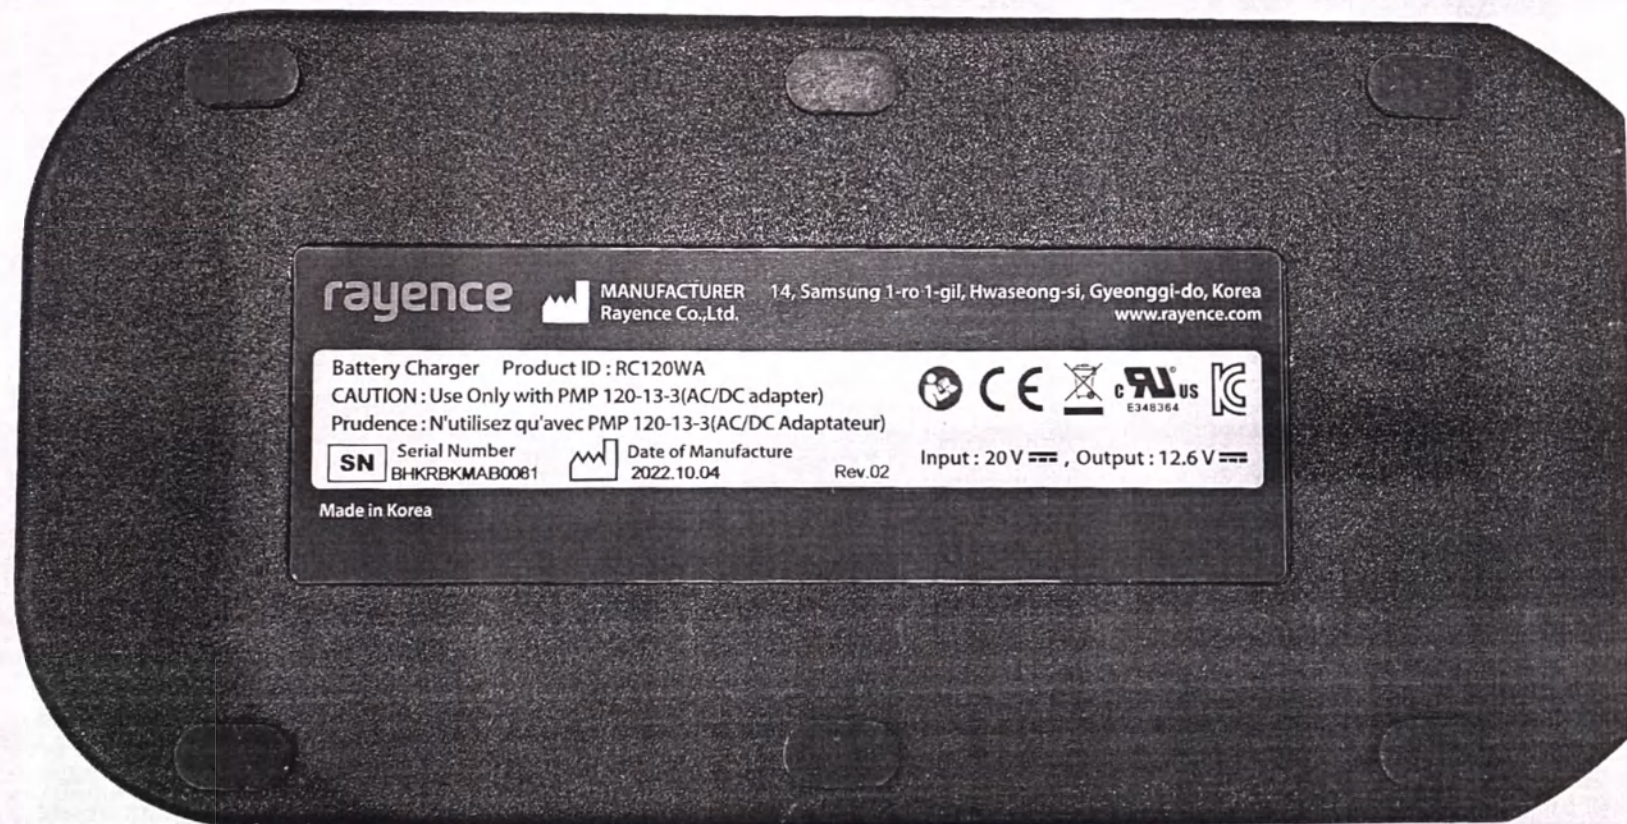

rayence



MANUFACTURER
Rayence Co.,Ltd.

14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
www.rayence.com

Battery Charger Product ID : RC120WA

CAUTION : Use Only with PMP 120-13-3(AC/DC adapter)

Prudence : N'utilisez qu'avec PMP 120-13-3(AC/DC Adaptateur)



SN

Serial Number
BH-KRBKMA00081




Date of Manufacture
2022.10.04


Rev.02


Input : 20 V  , Output : 12.6 V 


Made in Korea




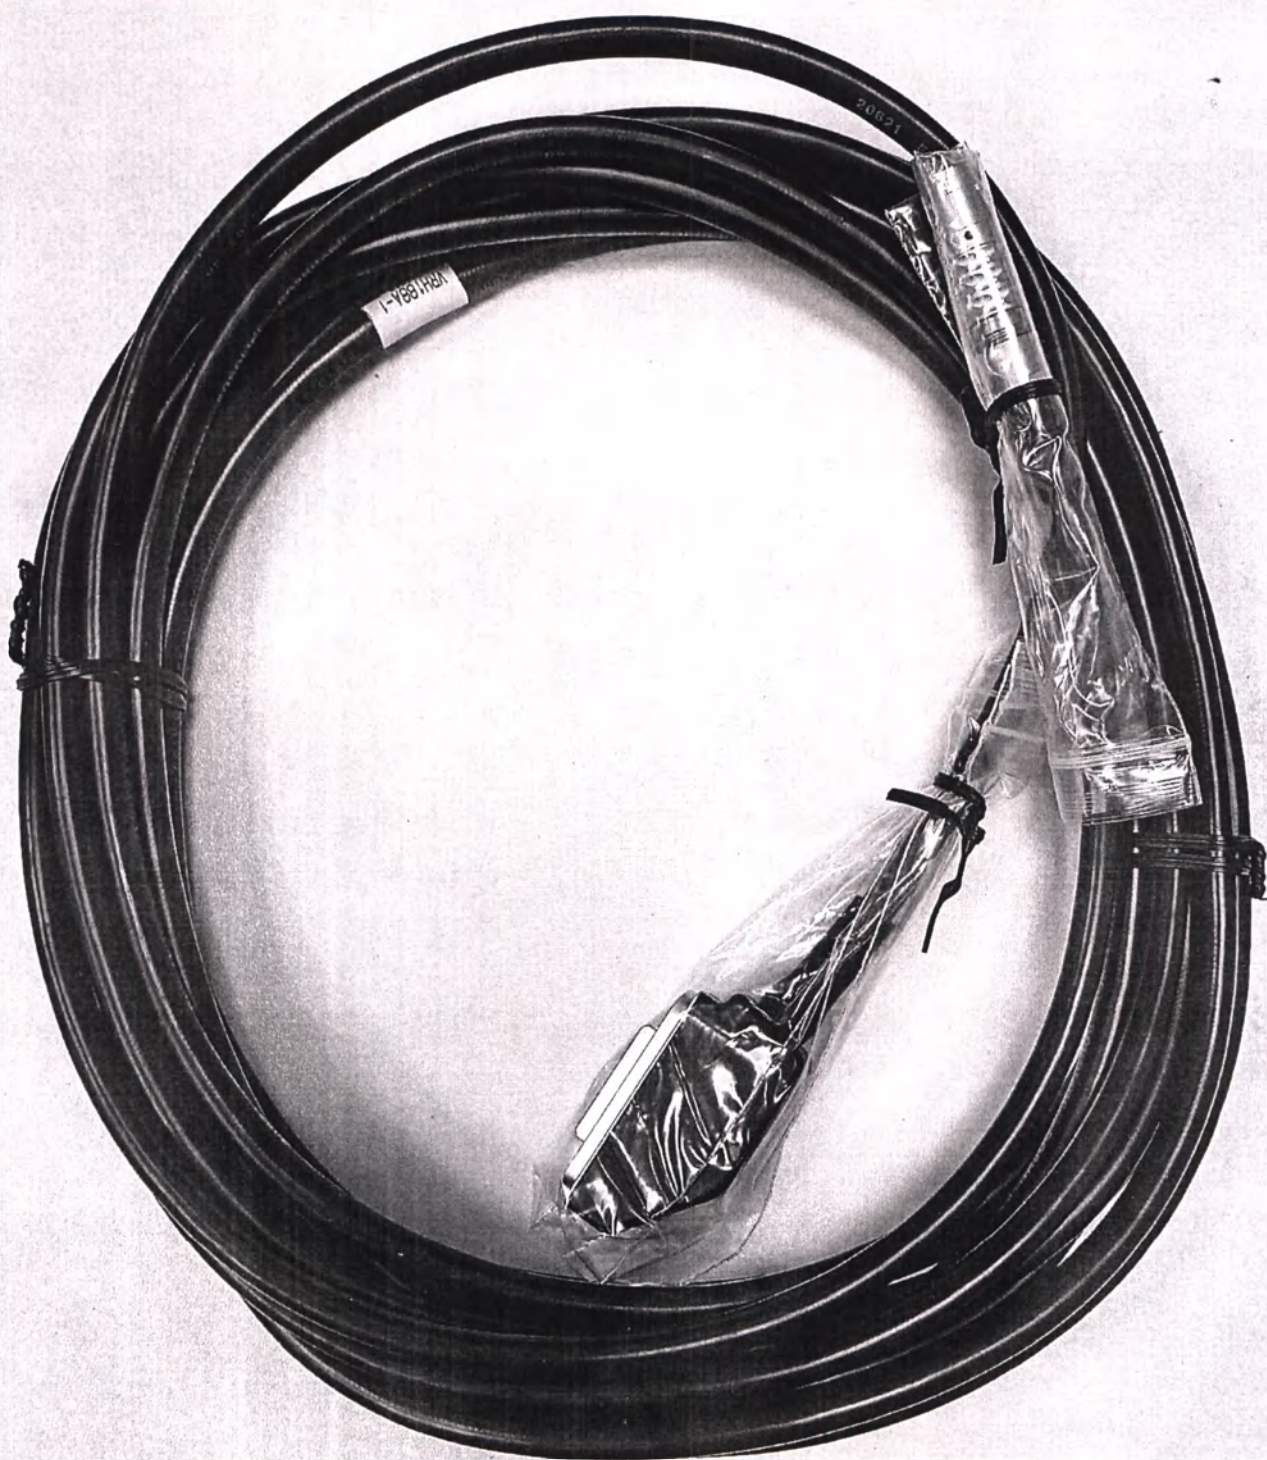

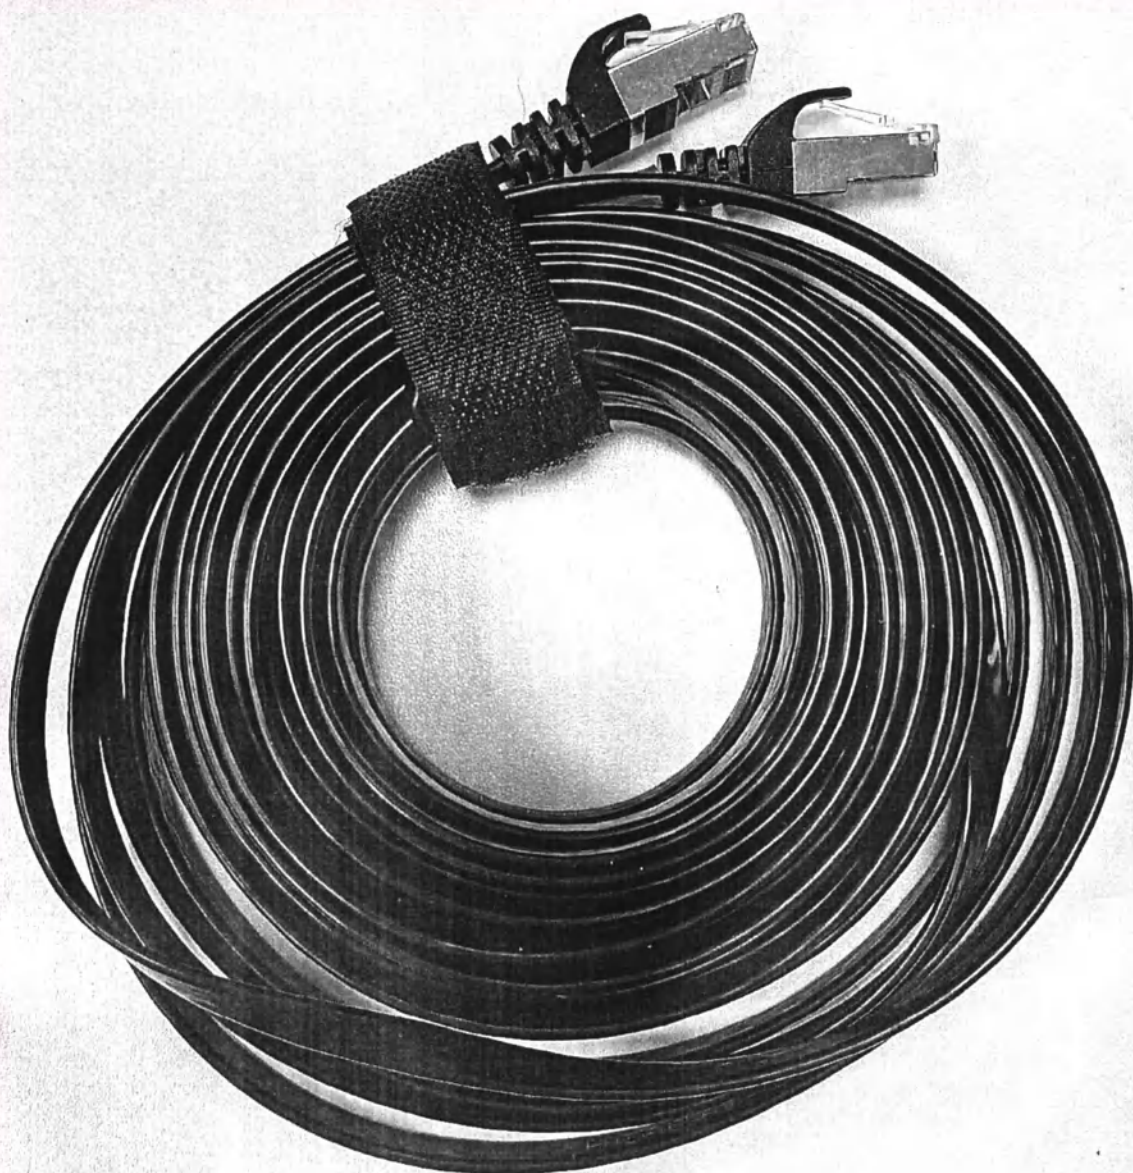

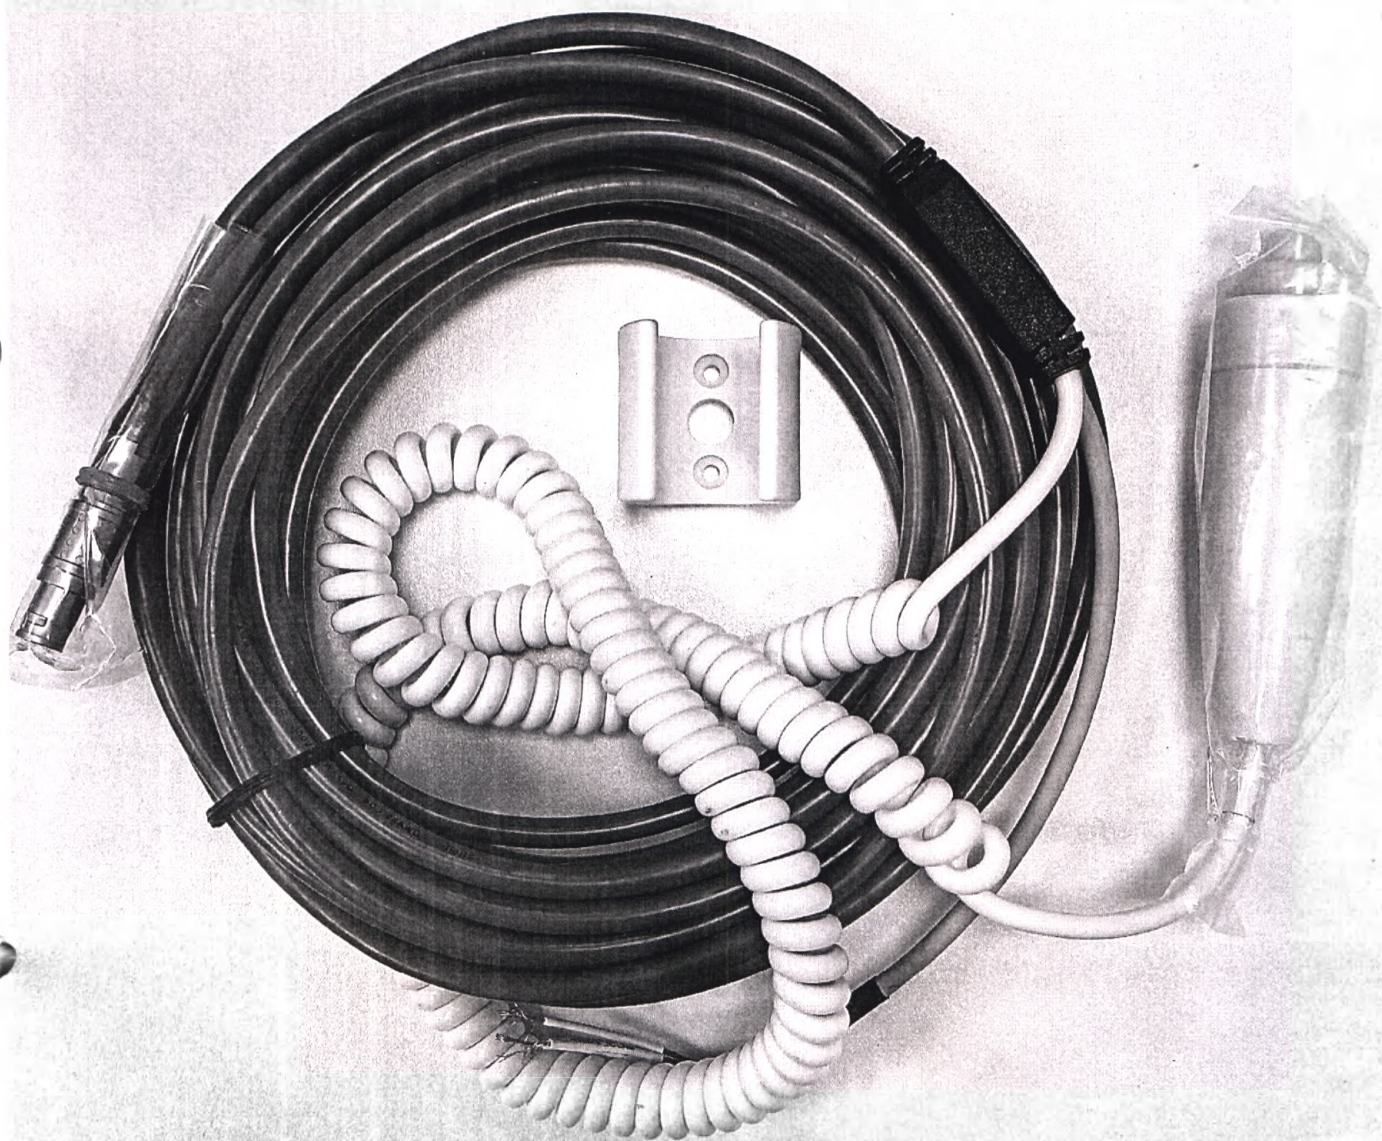

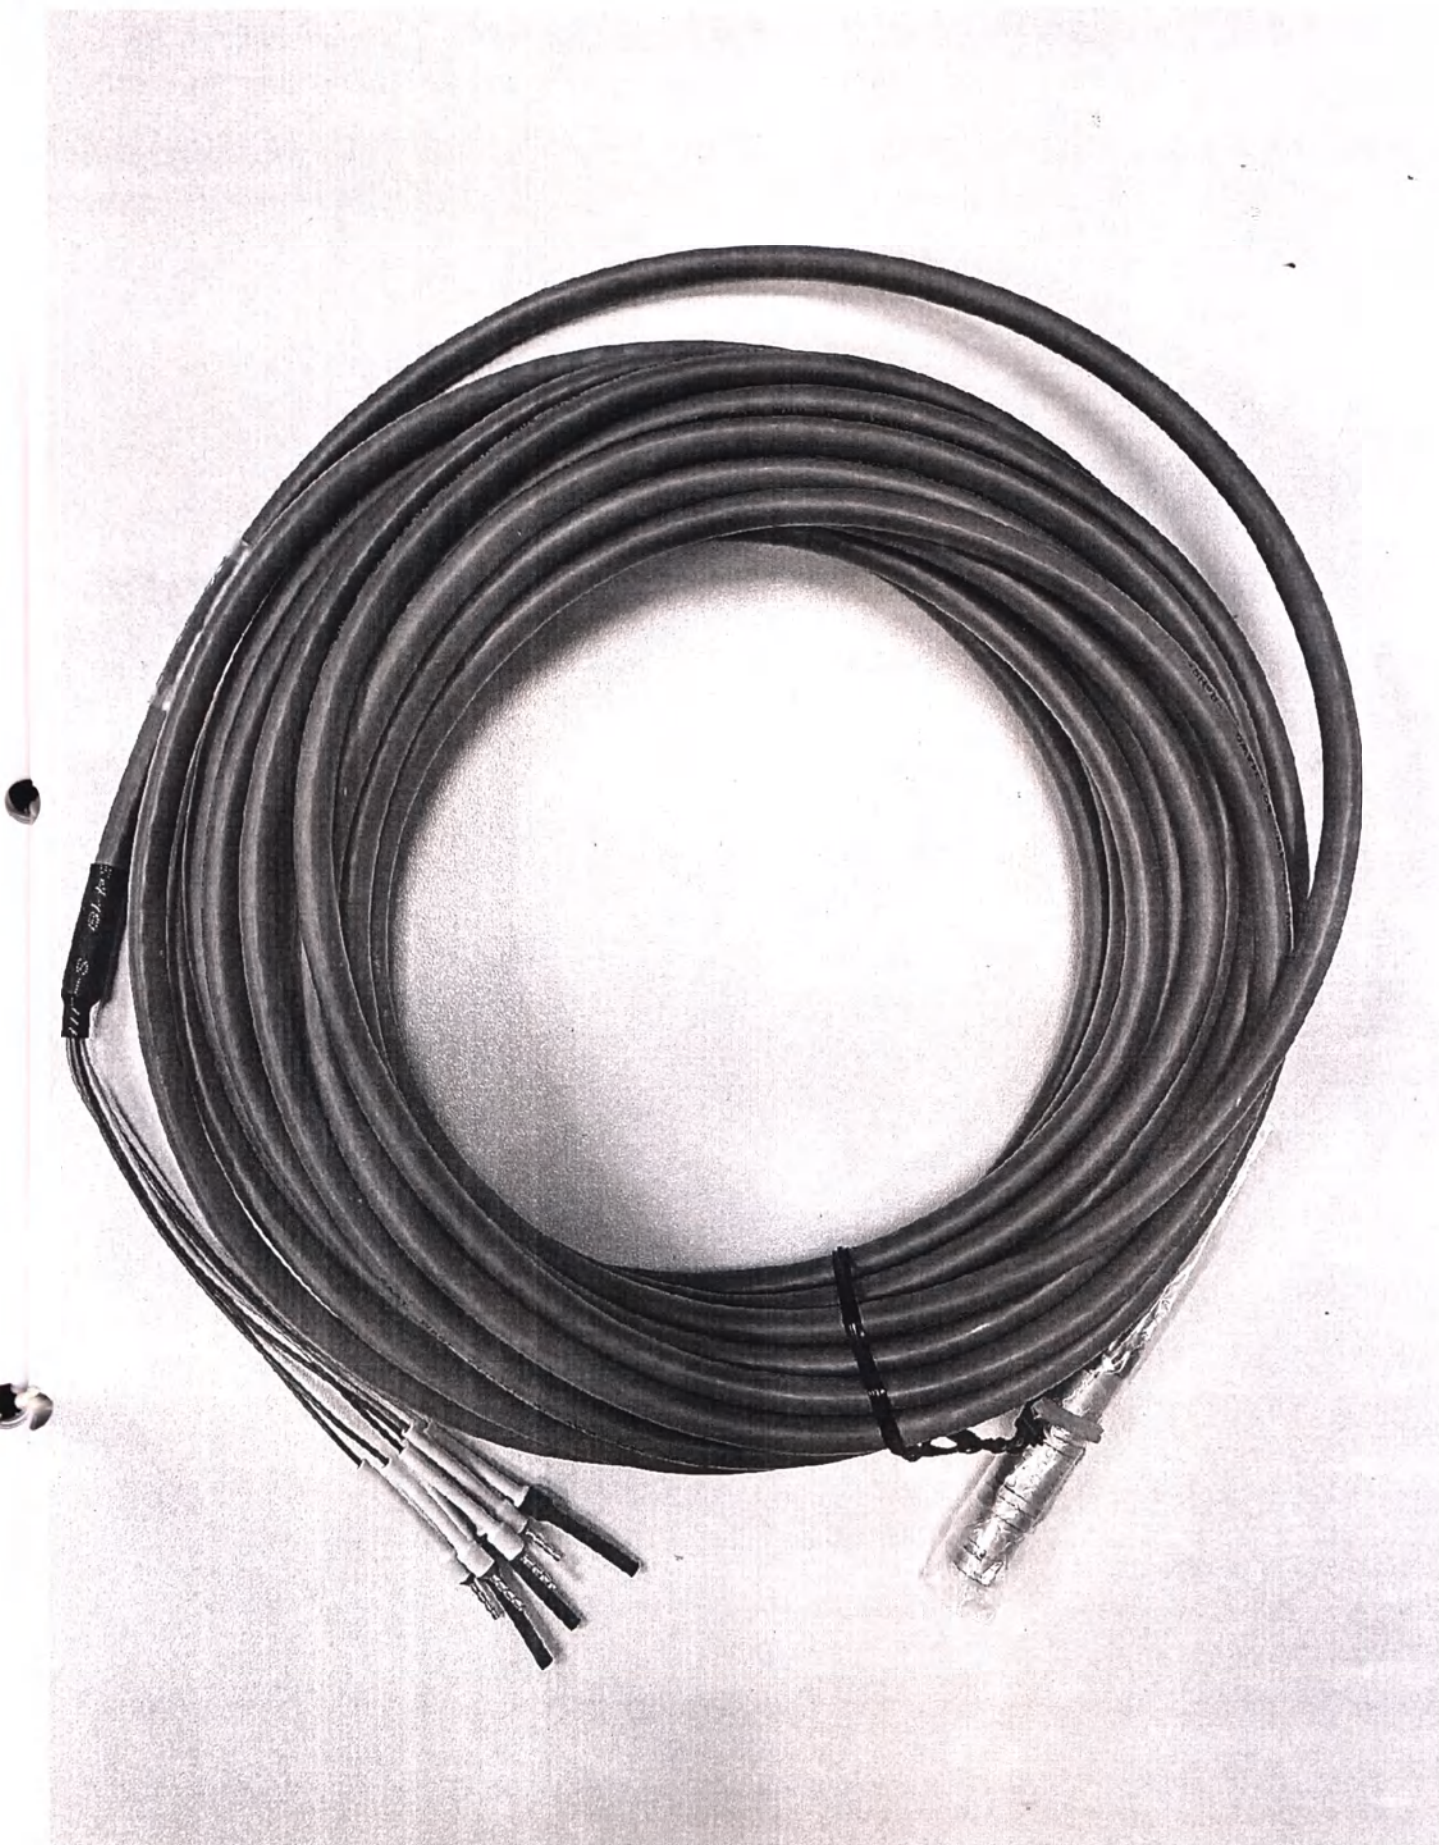

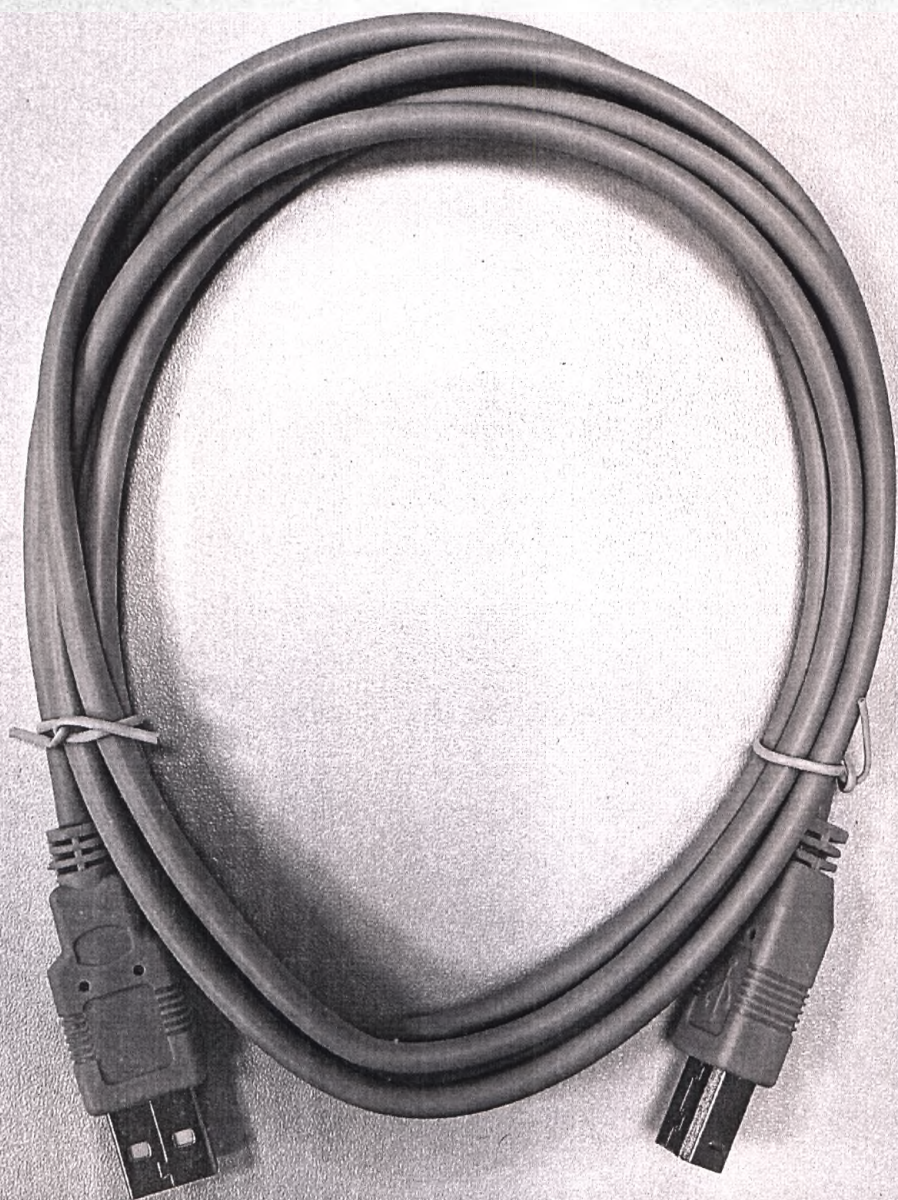



Rayence Co., Ltd. (Рэйенс Ко., Лтд.)
14, Samsung 1-ro 1-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Korea (КОРЕЯ) www.rayence.com

rayence

Устройство обработки рентгеновского изображения

Модель: 1717WCC

24 В постоянного тока

ВНИМАНИЕ! Только для использования с RB37WHA (литий-ионный аккумулятор) или с RP003A (источник питания)

CE1639 IP66



Дата производства:



Серийный номер:




Уполномоченный представитель производителя: (ООО «ВАТЕК КОРП.»)

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, стр. 1-2, Россия

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН _____ от _____

Сделано в КОРЕЯ

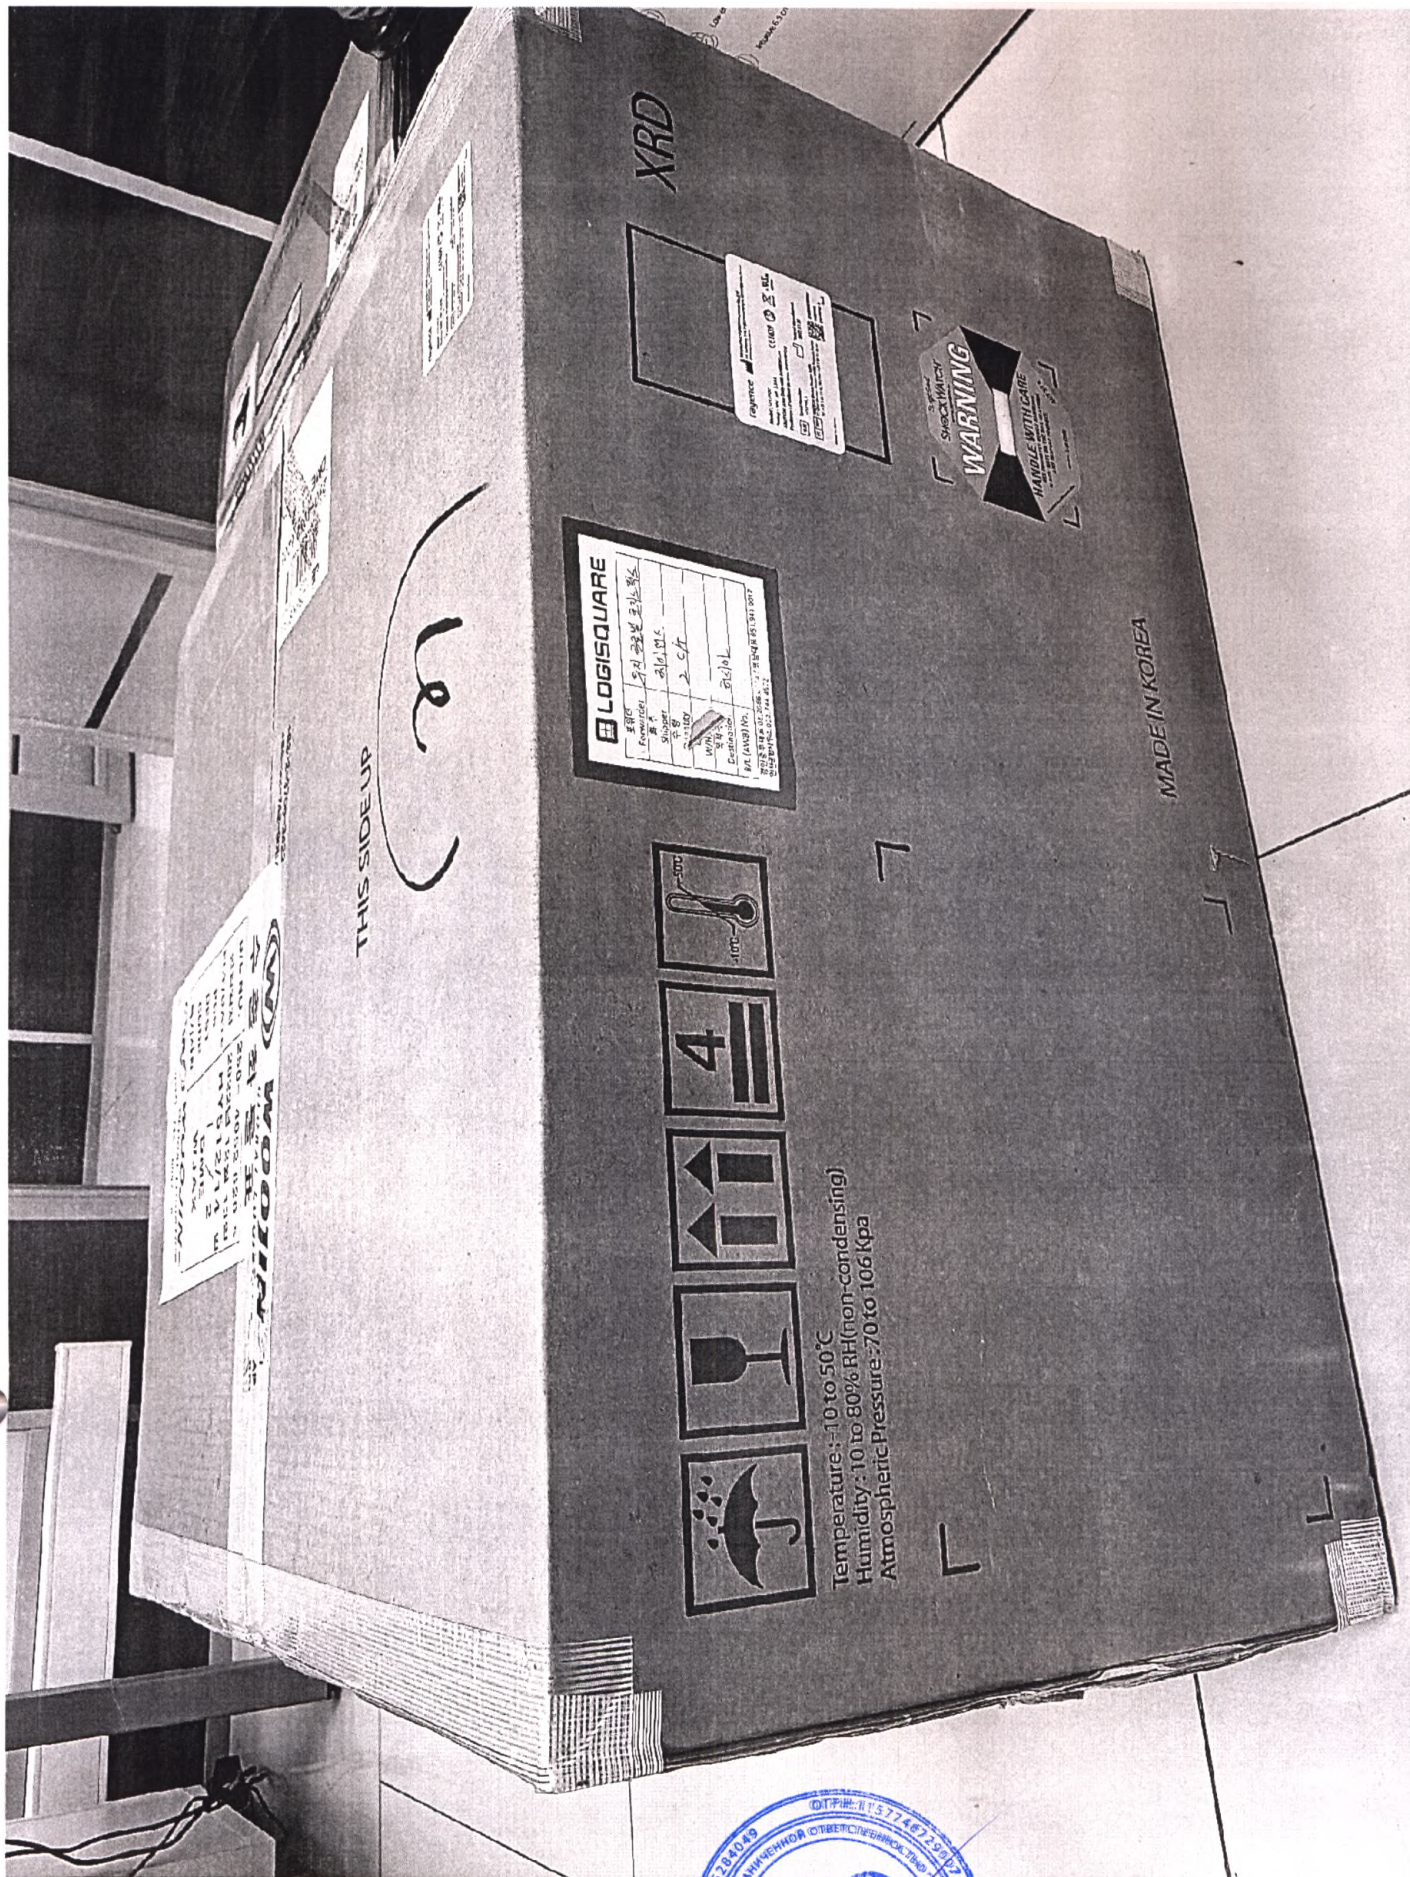

Генеральный директор



Ким Хёнхи



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 24
_____ листах