

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания Пушинские лаборатории»
Школьная Л.А.
01. 2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Камеры морозильные низкотемпературные Meiling
с принадлежностями**

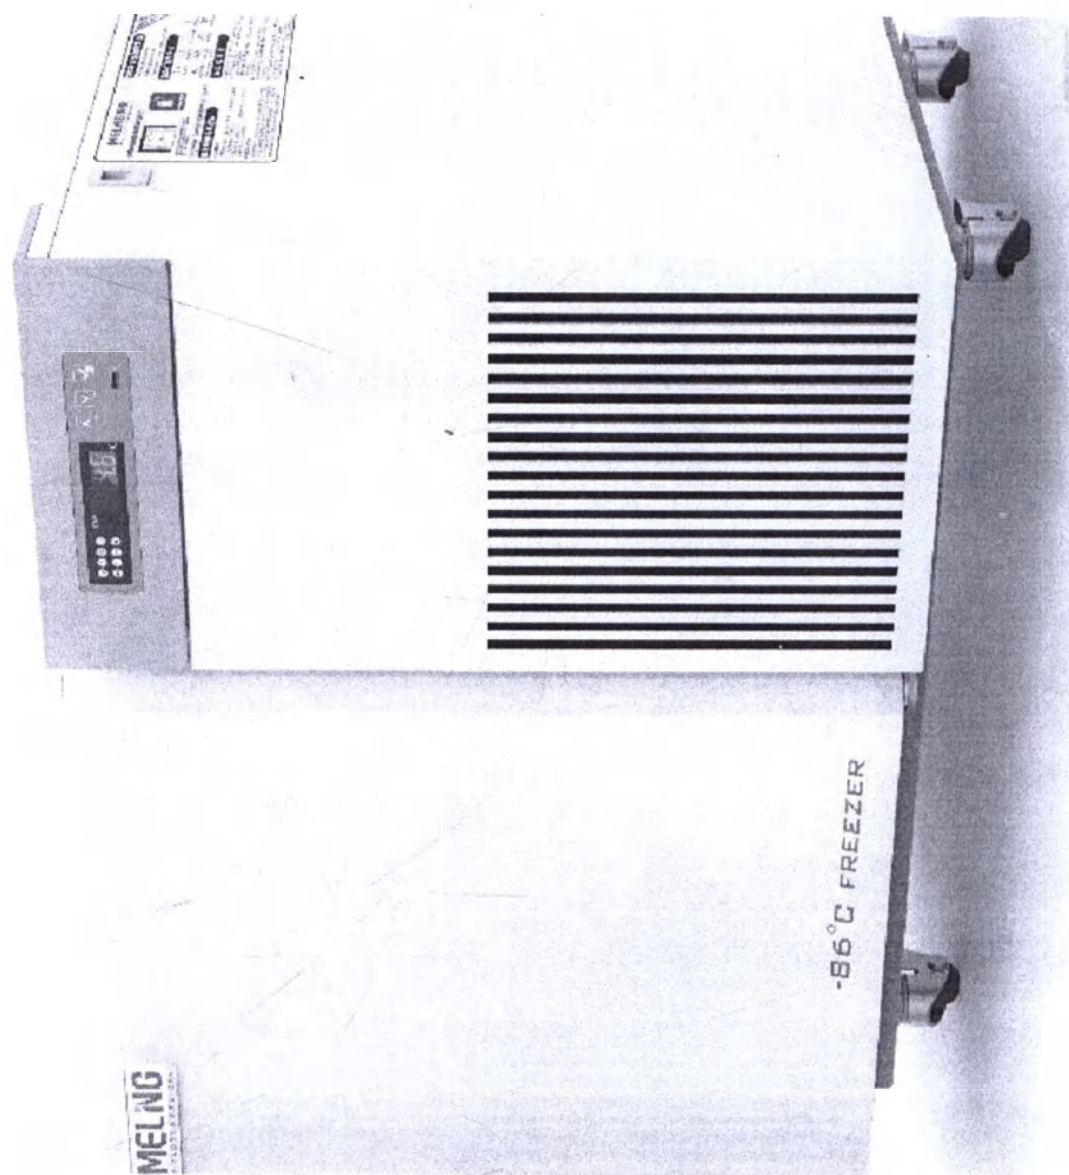


Рисунок 1 – Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL50HC

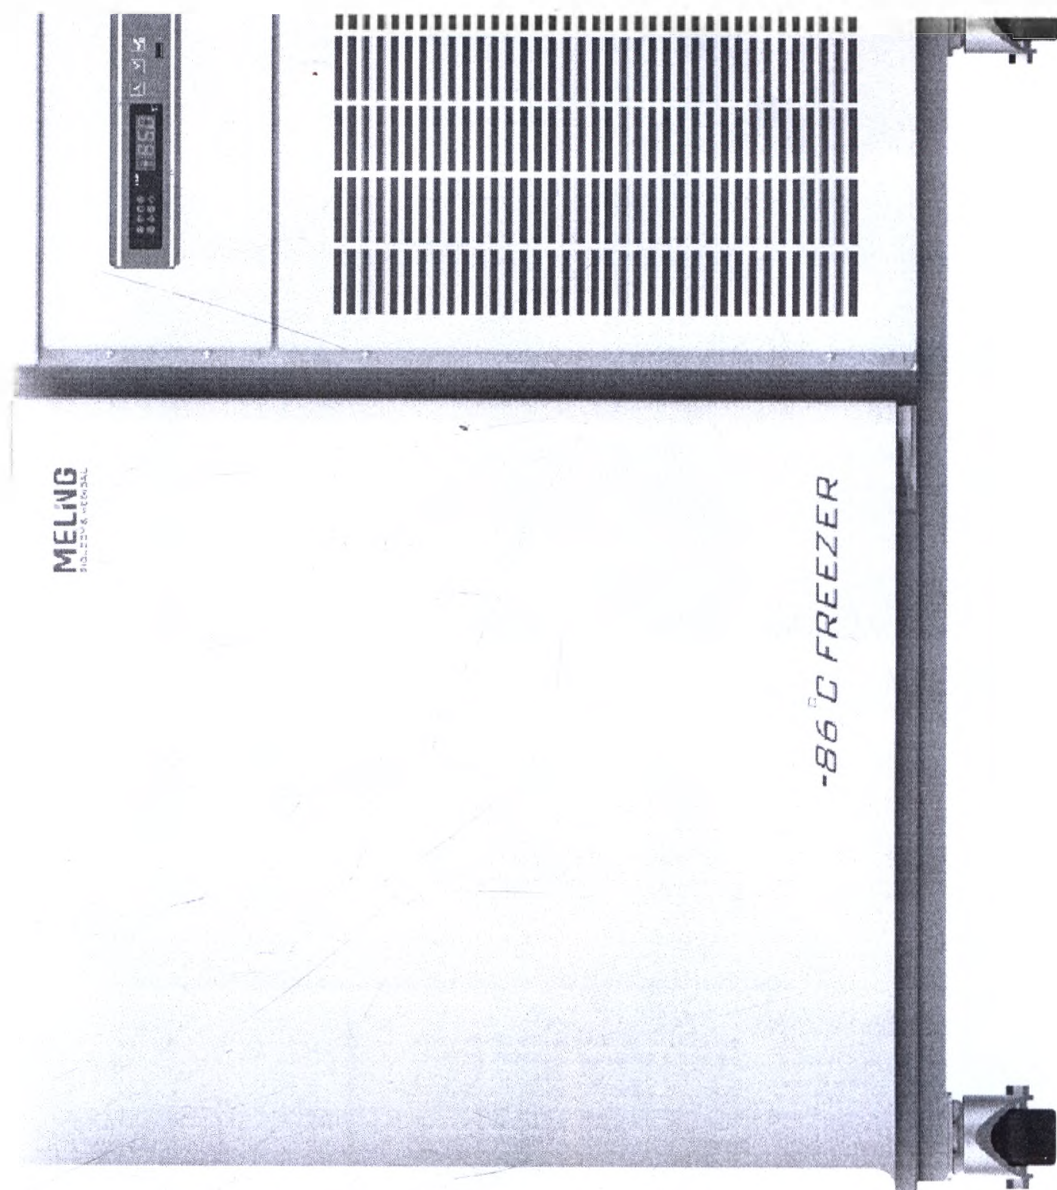


Рисунок 2 – Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная
Meiling модель DW-HL100HC

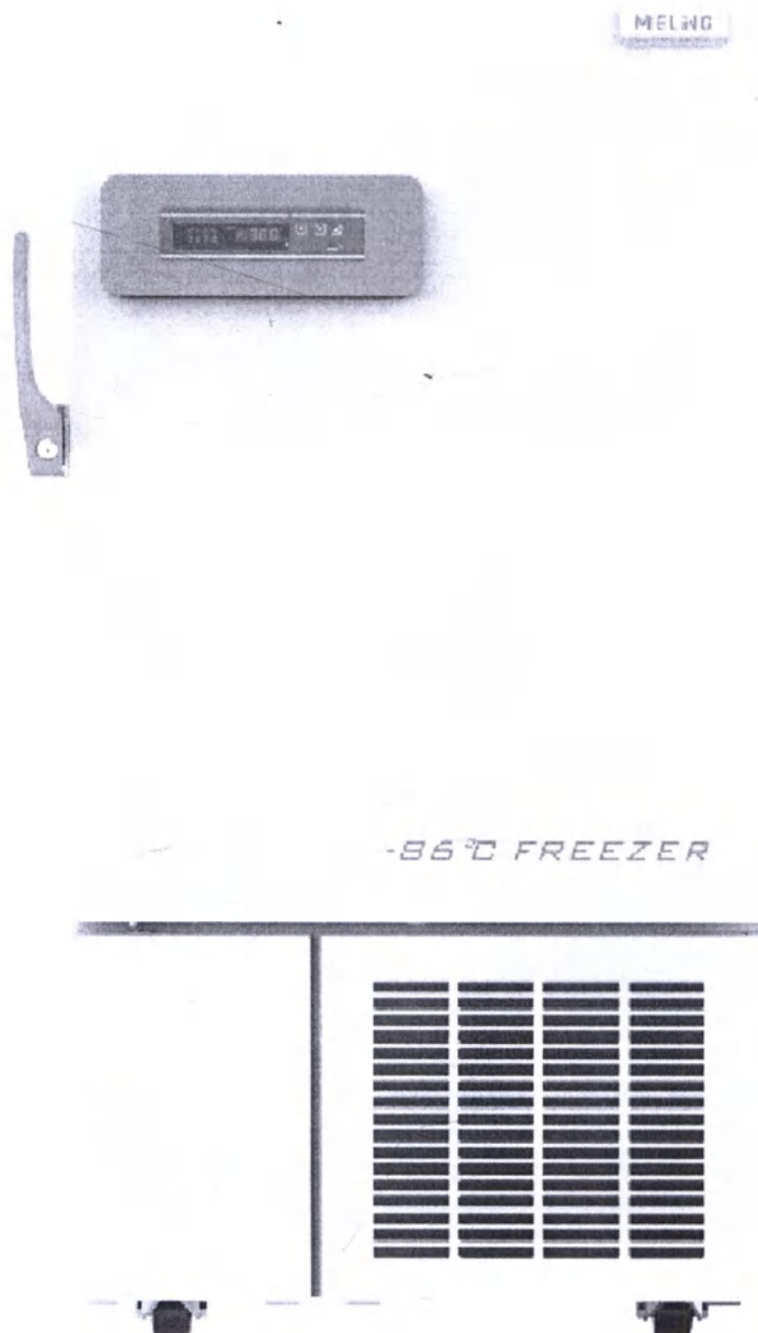


Рисунок 3 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL218



Рисунок 4 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL340

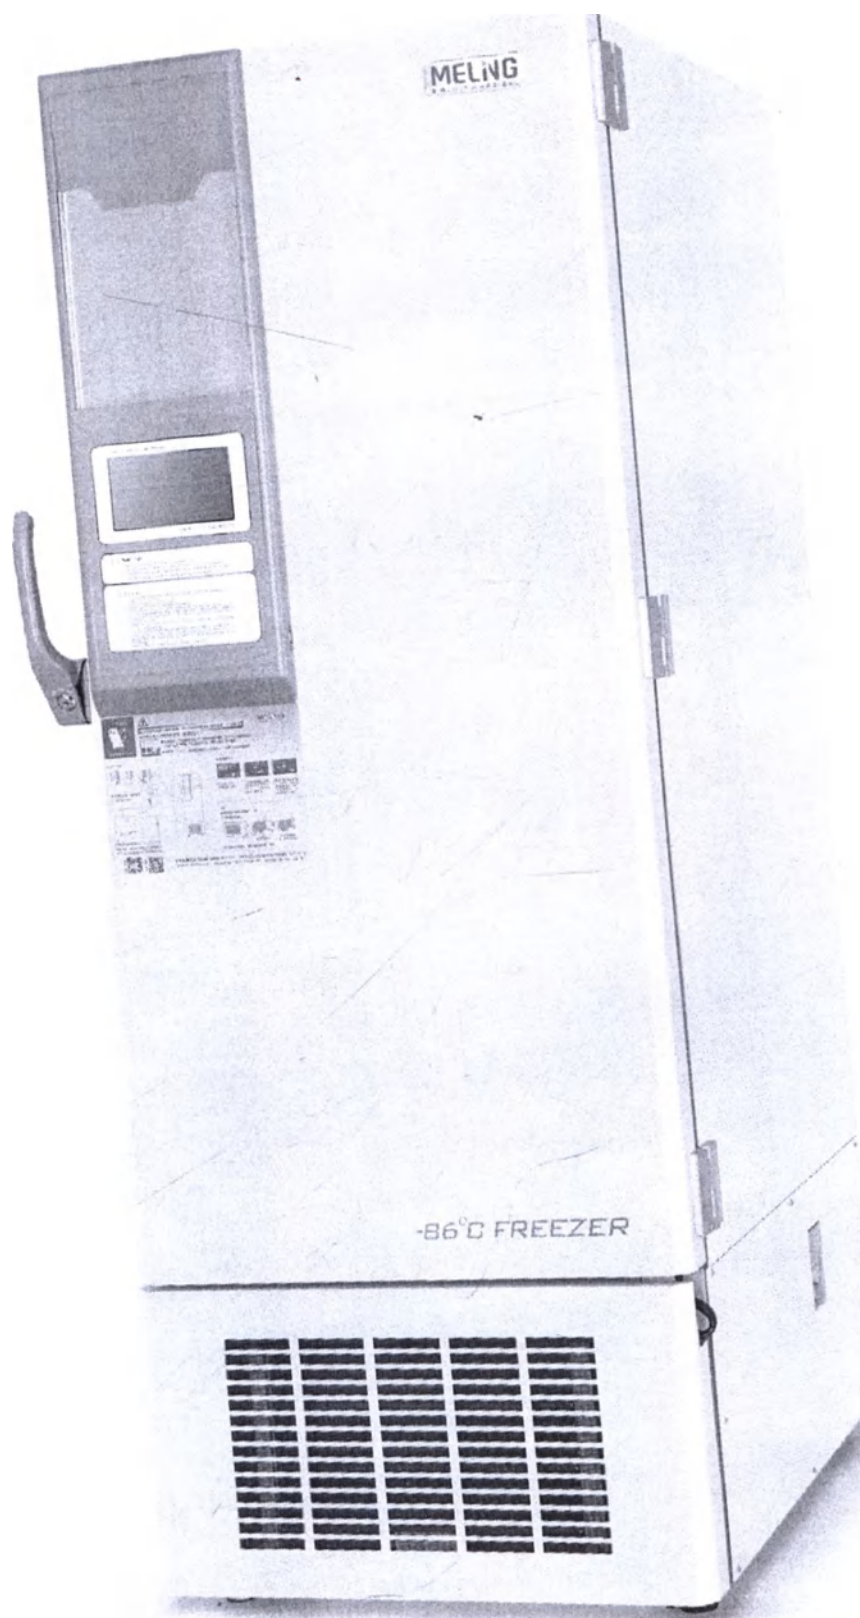


Рисунок 5 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL398SA

Страница 6 из 22

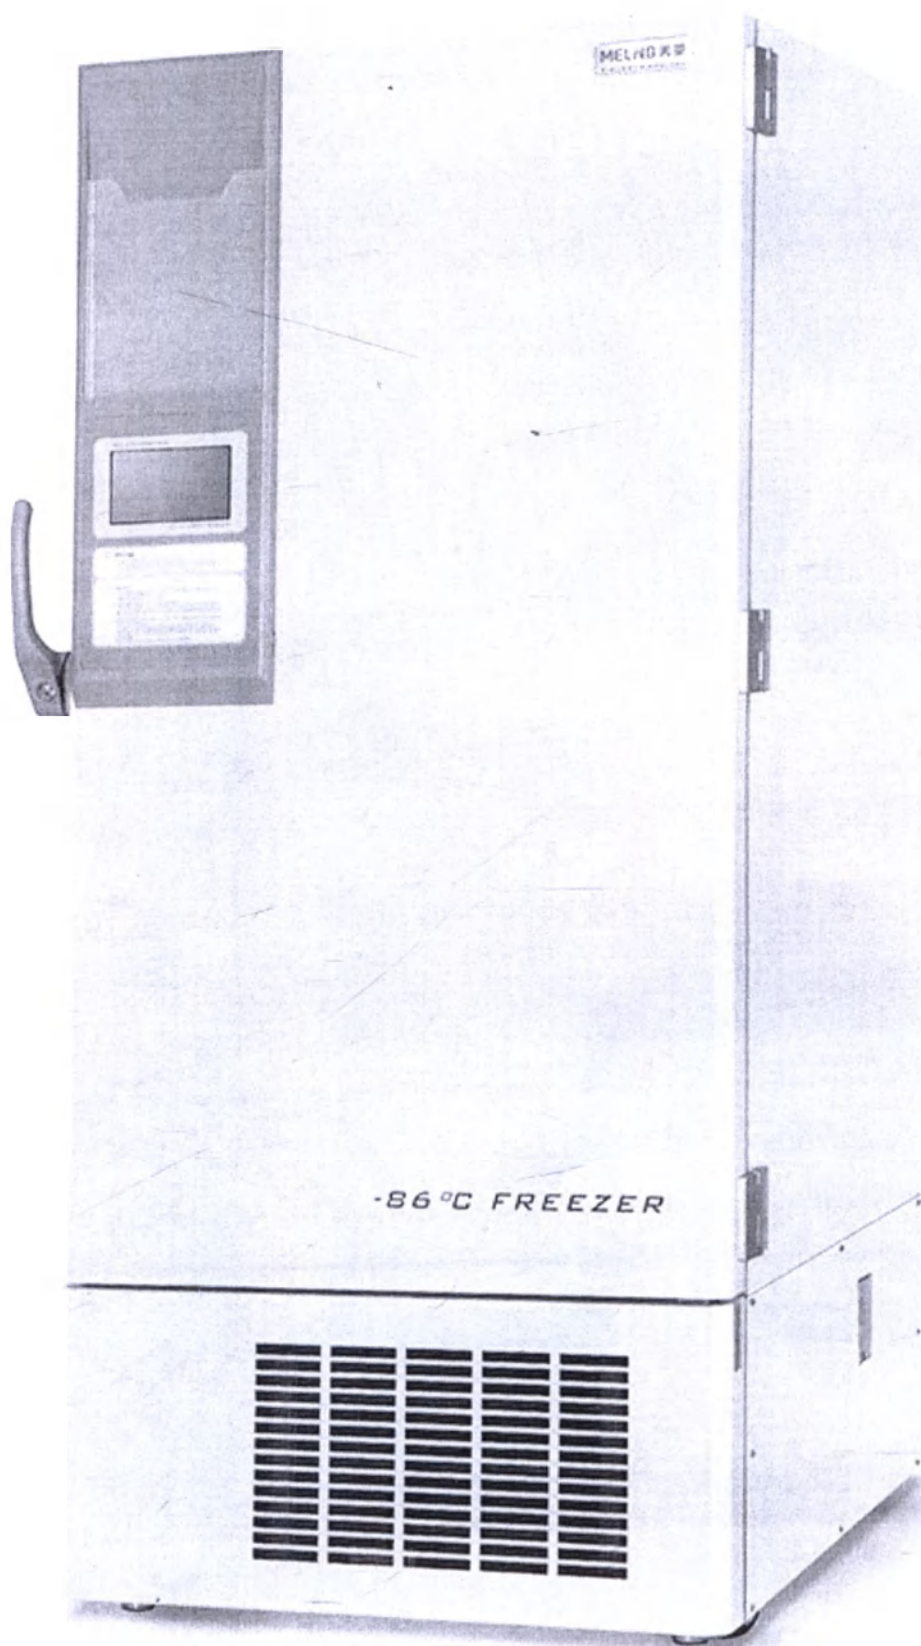


Рисунок 6 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL528SA

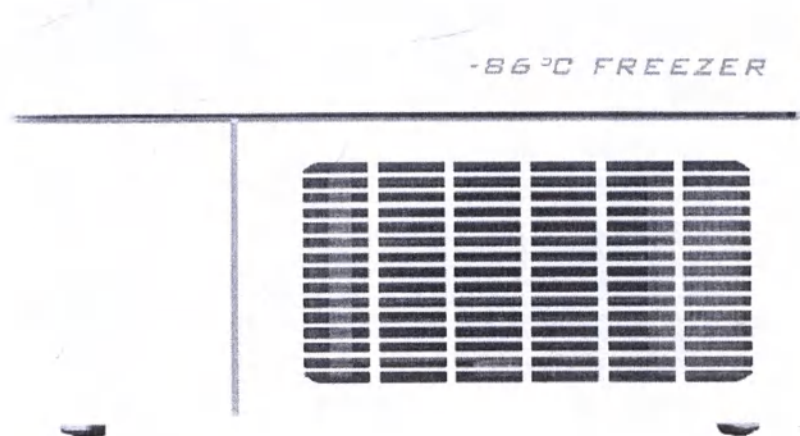


Рисунок 7 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная
Meiling модель DW-HL678SA

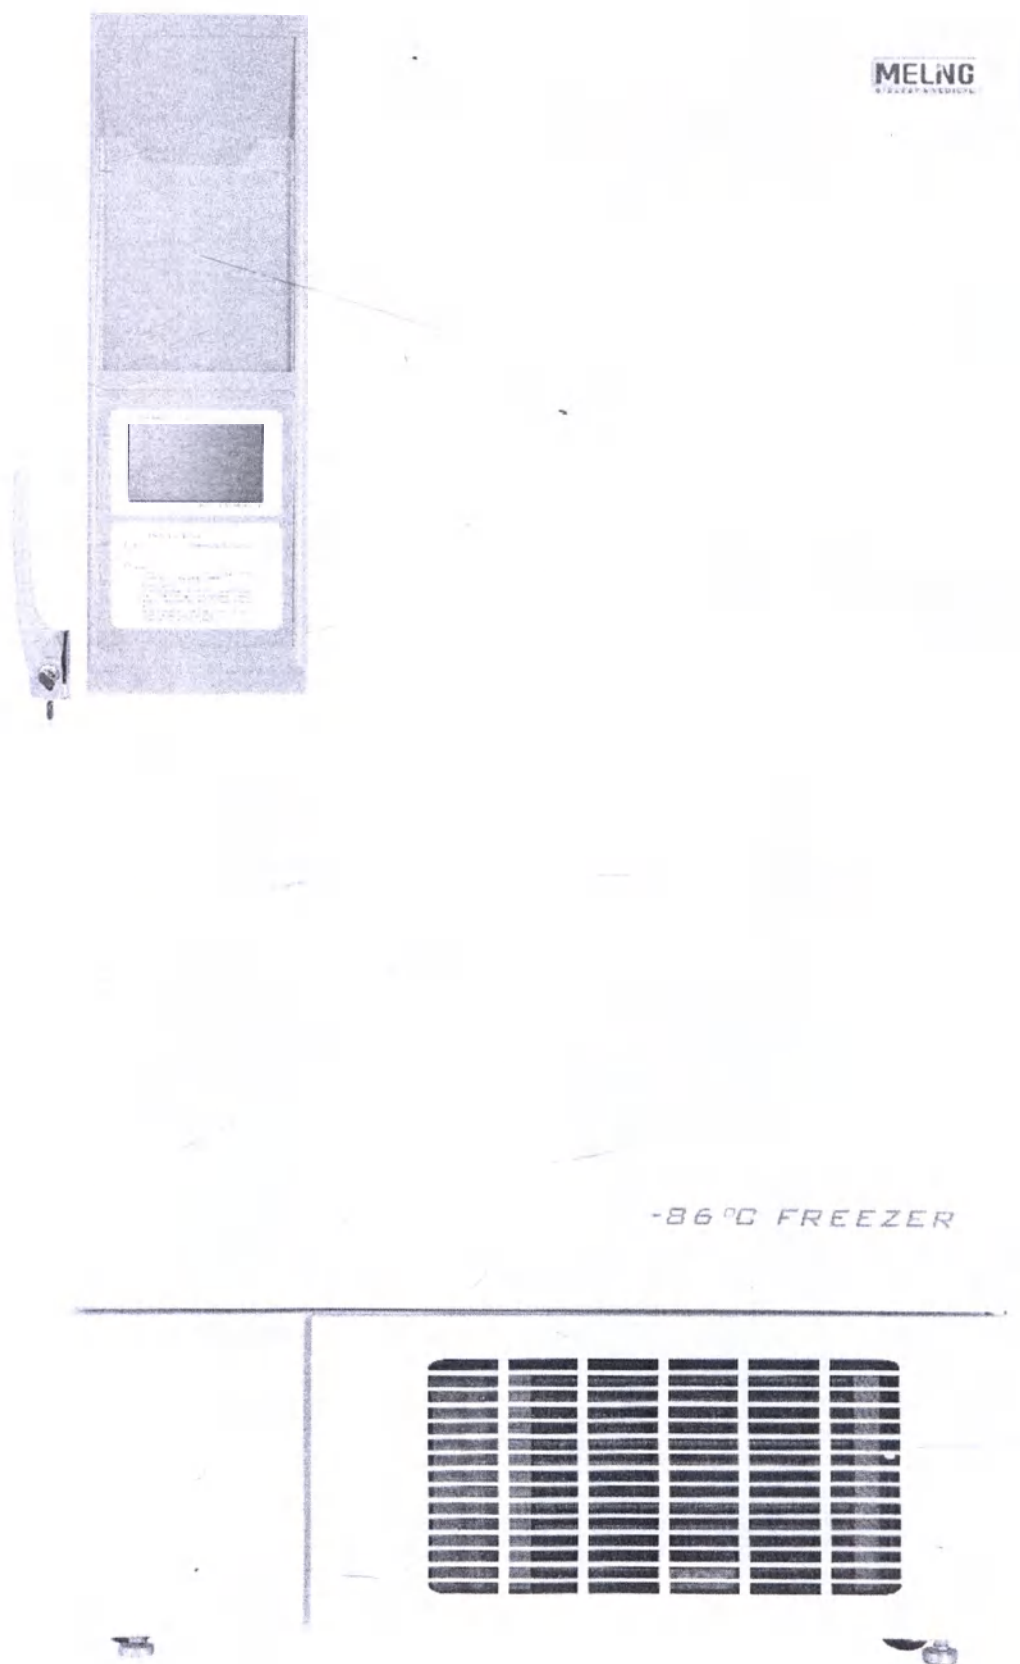


Рисунок 8 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная
Meiling модель DW-HL778SA



Рисунок 9 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная
Meiling модель DW-HL858SA

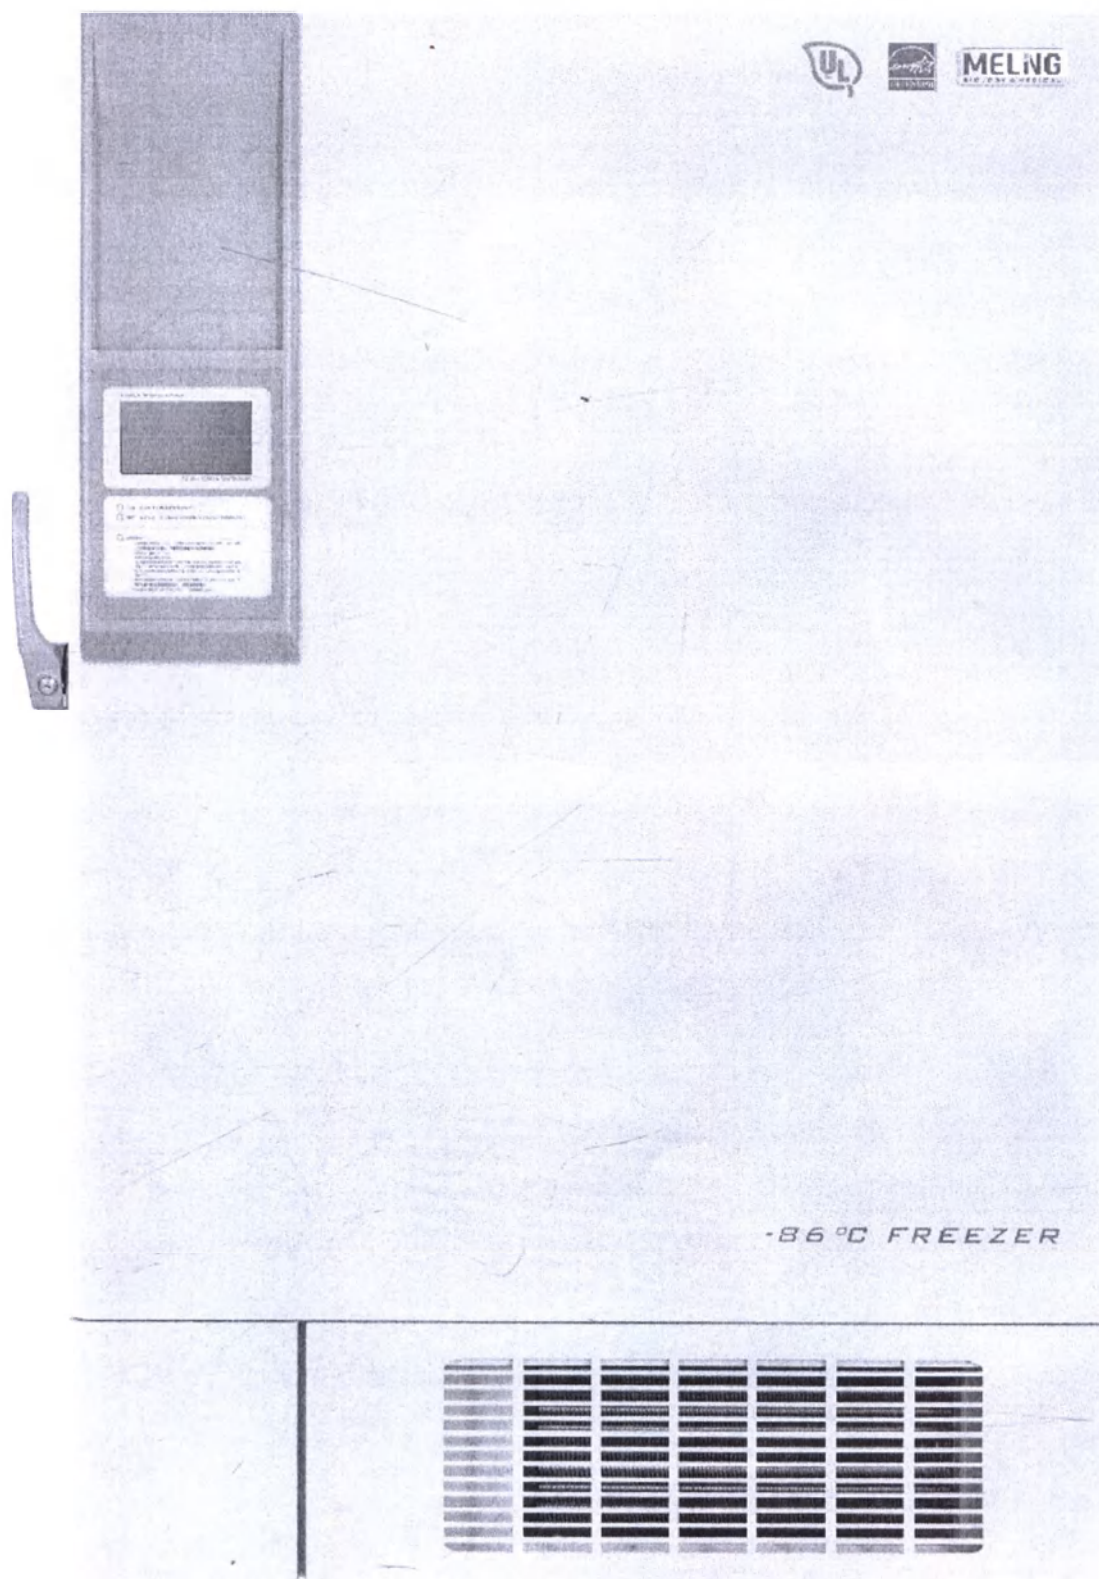


Рисунок 10 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL1008SA

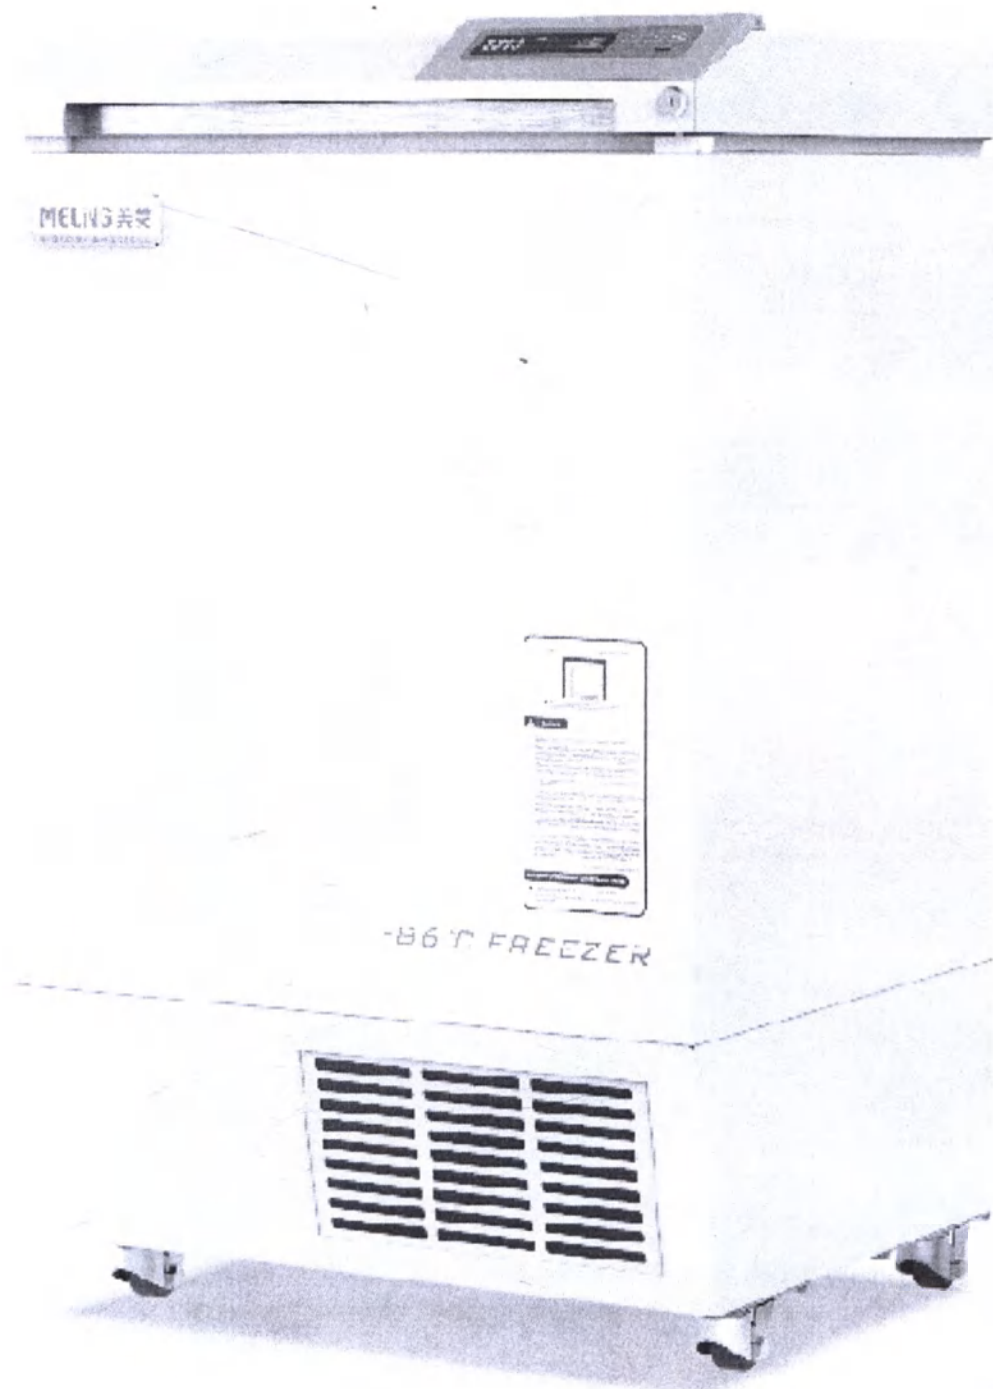
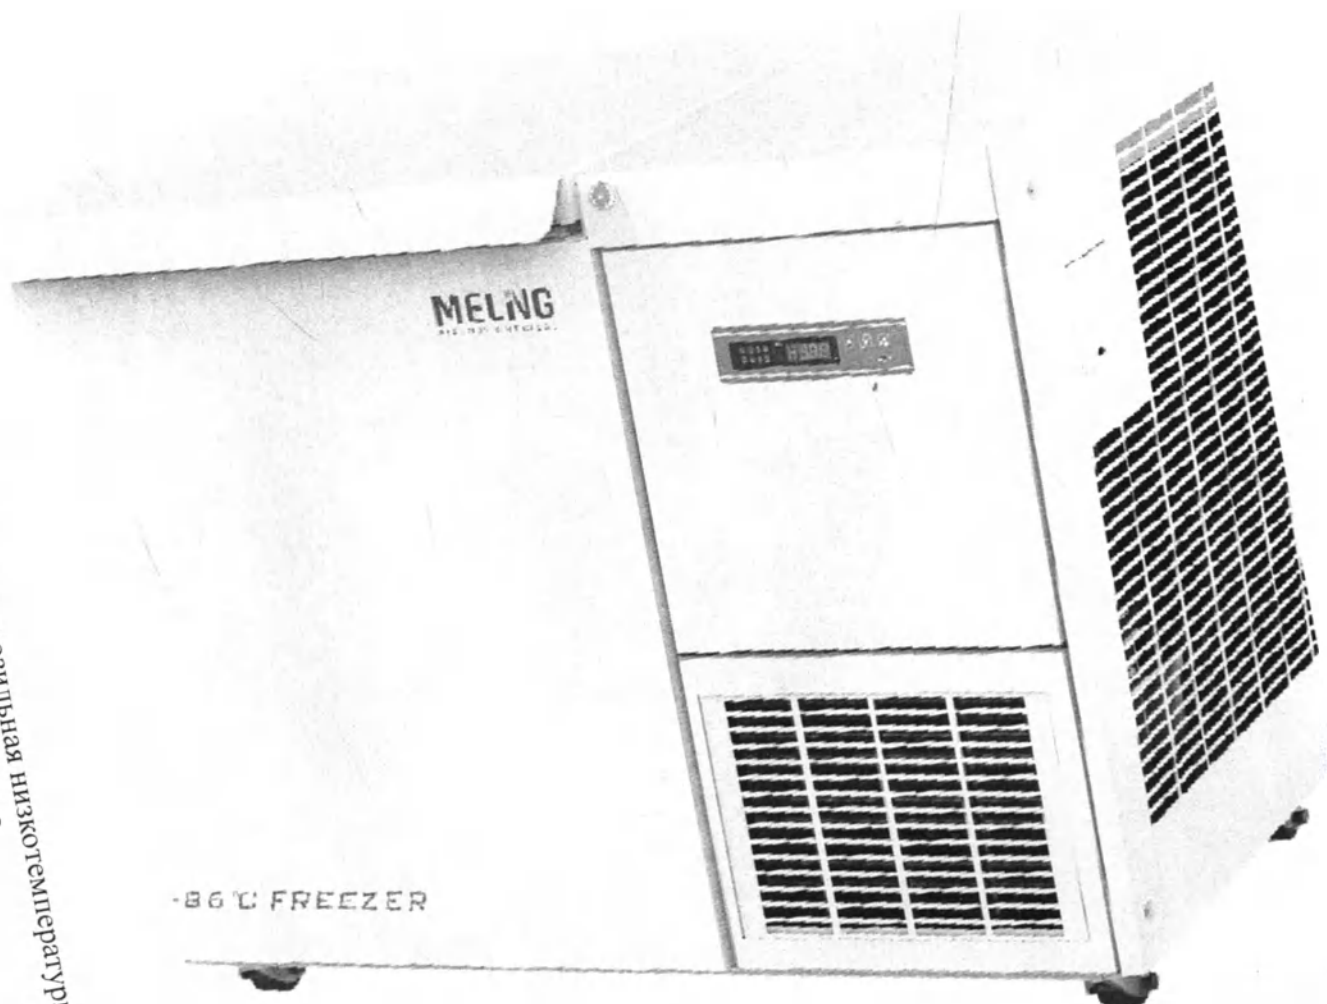


Рисунок 11 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная горизонтальная Meiling модель DW-HW50HC

Рисунок 12 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная
горизонтальная Meling модель DW-HW138



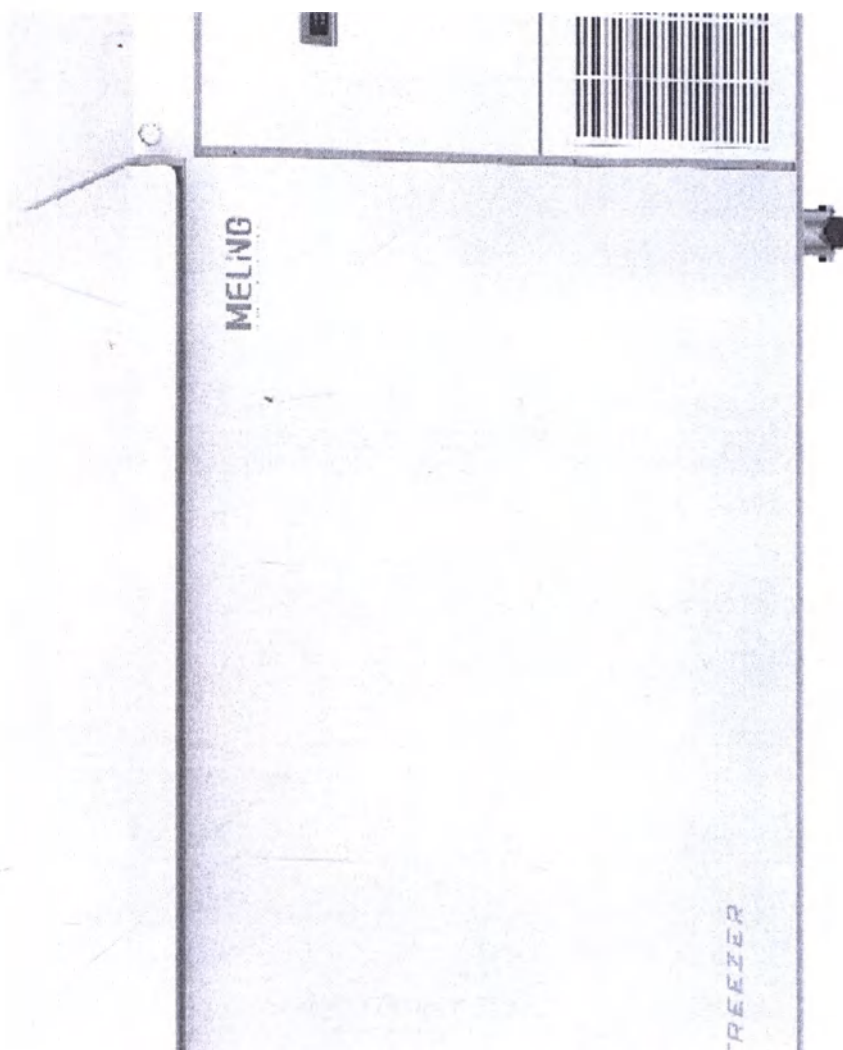


Рисунок 13 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная горизонтальная Meiling модель DW-HW328

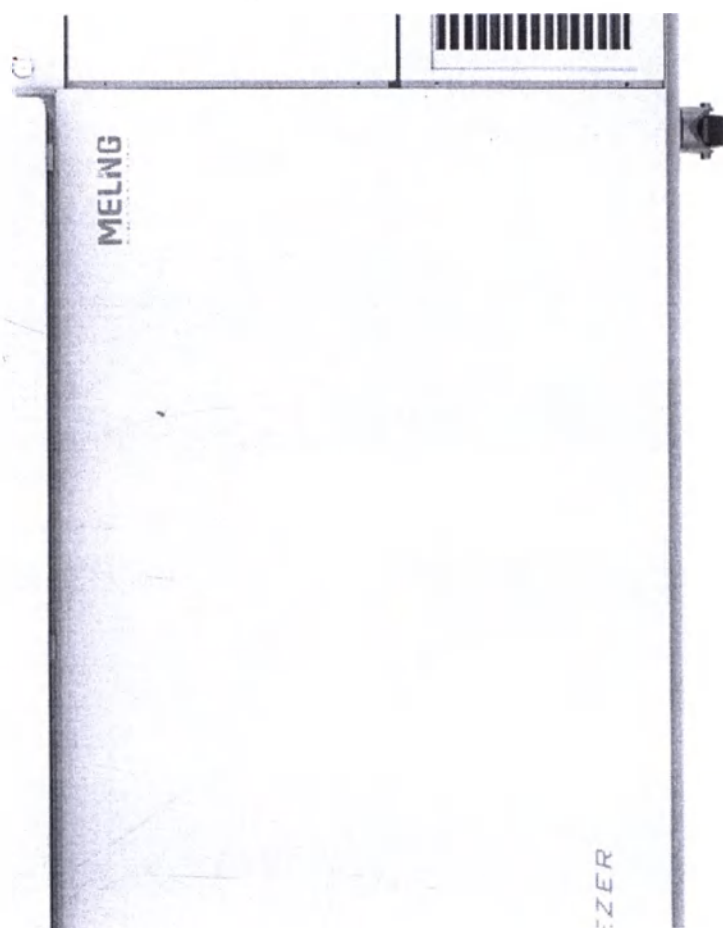


Рисунок 14 - Внешний вид модели Камера морозильная низкотемпературная горизонтальная Meiling модель DW-HW668

MELING
BIOMEDICAL

Камеры морозильные низкотемпературные



Модель: DW-HL398SA

Объём: 398л

Номинальное значение напряжения: 230В

Масса: 237кг

Номинальное значение тока: 5.46А

Масса хладагента: 420г

Номинальное значение частоты: 50Гц

Хладагент: R14/40% R245fa/30% R170/11% R290/10% N2/9%



20.04.2022



20.04.2032

LOT



ПУ № от

Zhongke Meiling Cryogenics Company Limited

No.1862 Zishi Road, Economic&Technological Development Zone, 230601, Hefei, China

Рисунок 15 – Макет маркировки медицинского изделия

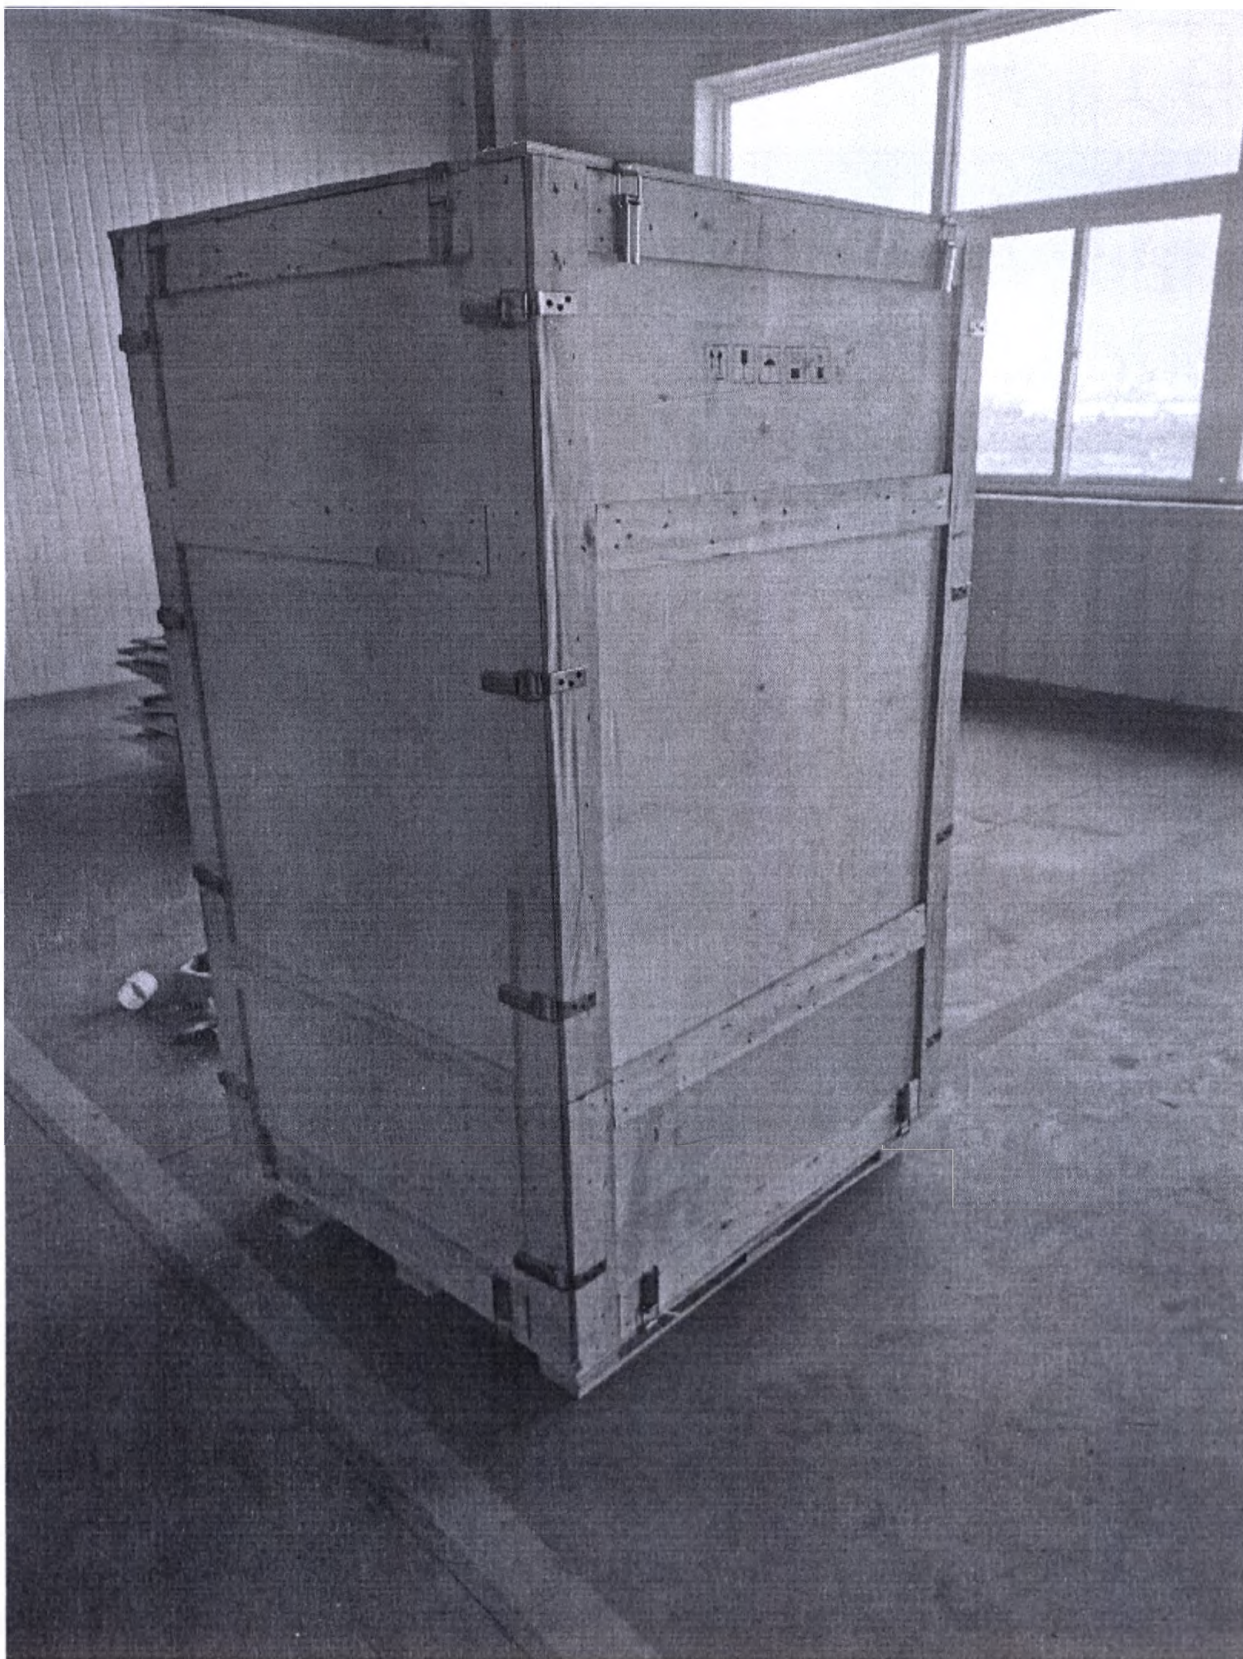


Рисунок 17 – Пример транспортной упаковки

MELING
BIOMEDICAL

Камеры морозильные низкотемпературные



Модель: DW-HL398SA

20.04.2022 0.04.2032 LOT



РУ № ОТ

Zhongke Meiling Cryogenics Company Limited

No.1862 Zishi Road, Economic&Technological Development Zone, 230601, Hefei, China

Рисунок 16 – Макет транспортной маркировки

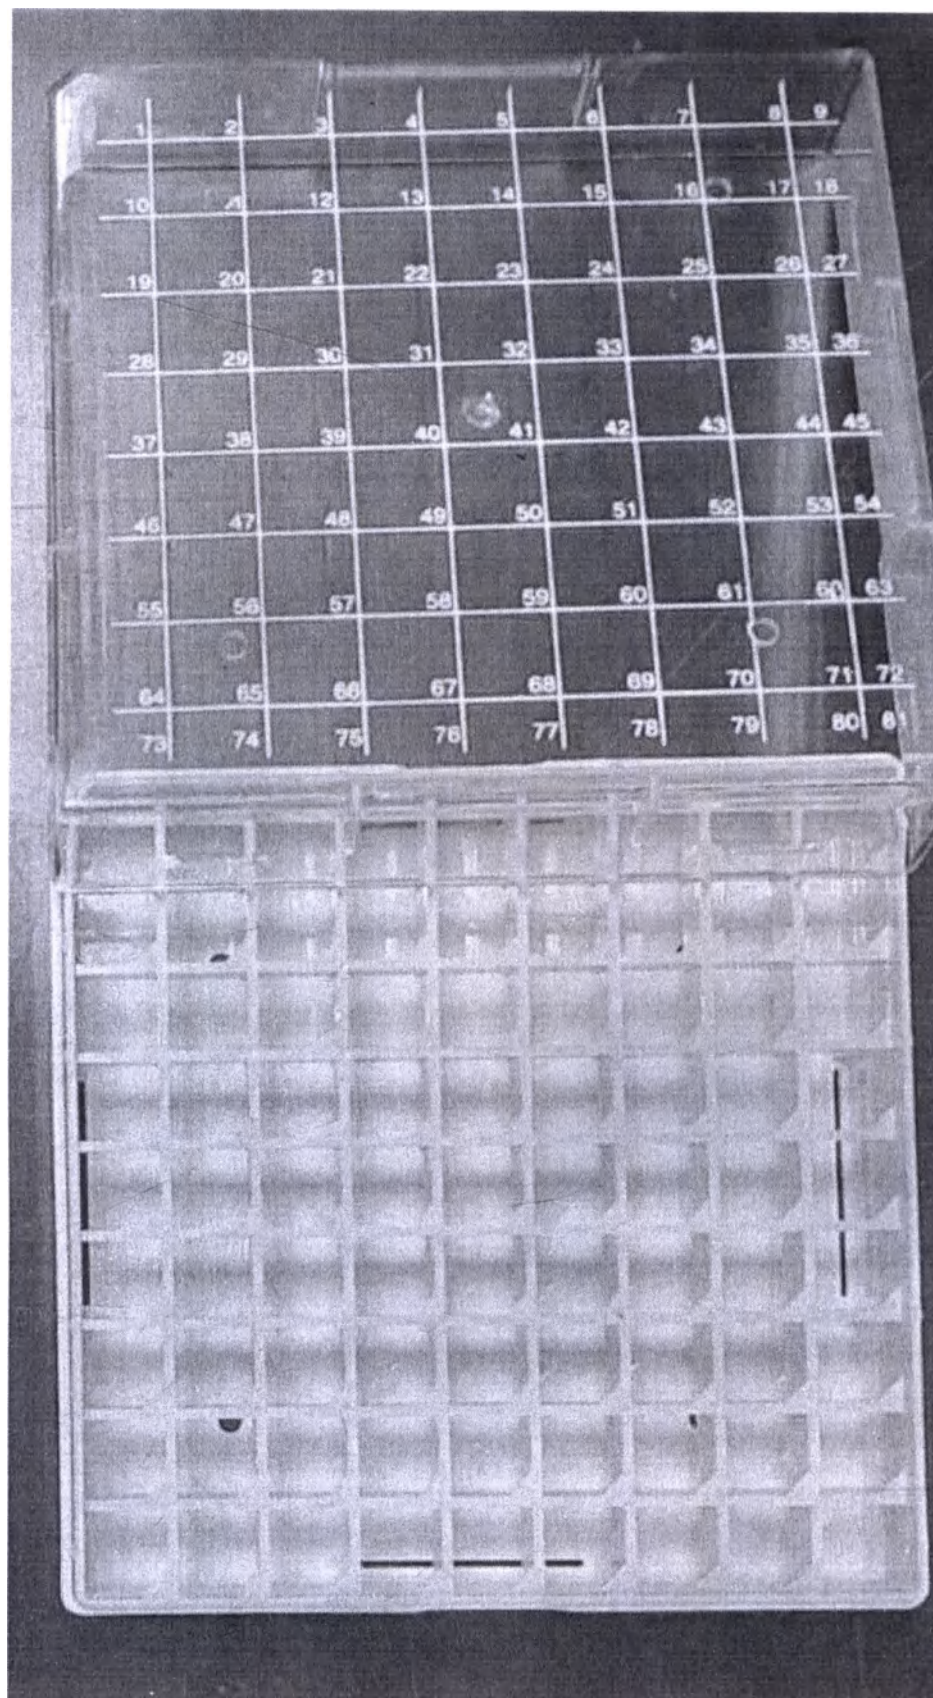


Рисунок 17 – Бокс морозильный пластиковый 133*133 мм

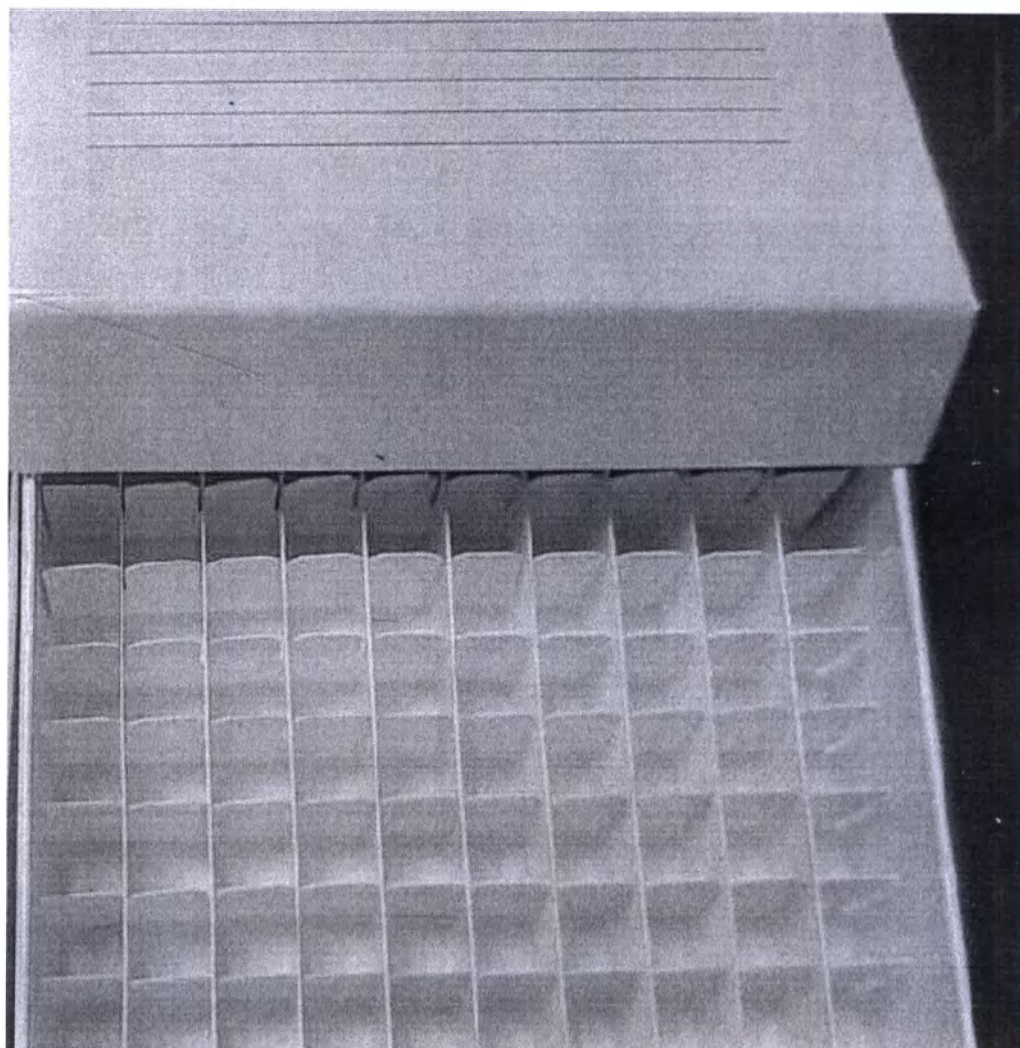


Рисунок 18 – Бокс морозильный картонный 133*133 мм

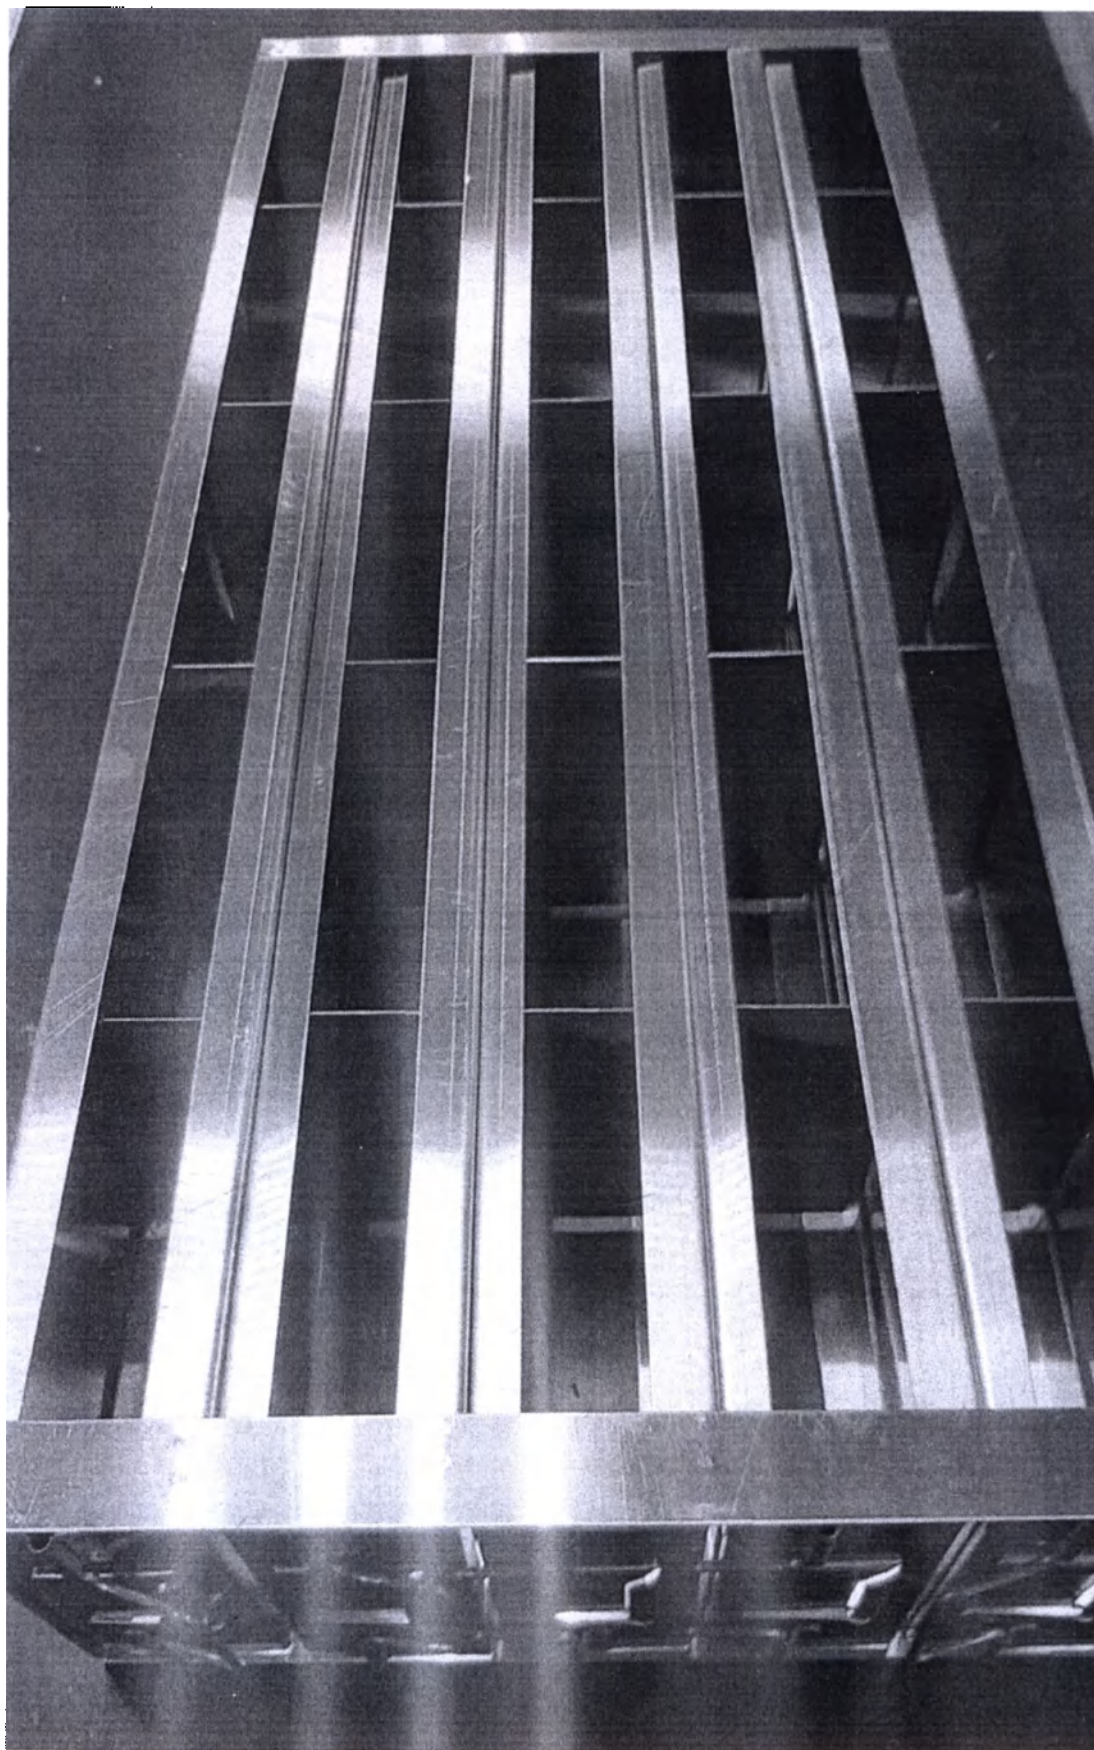


Рисунок 19 – Стеллажи для морозильных боксов

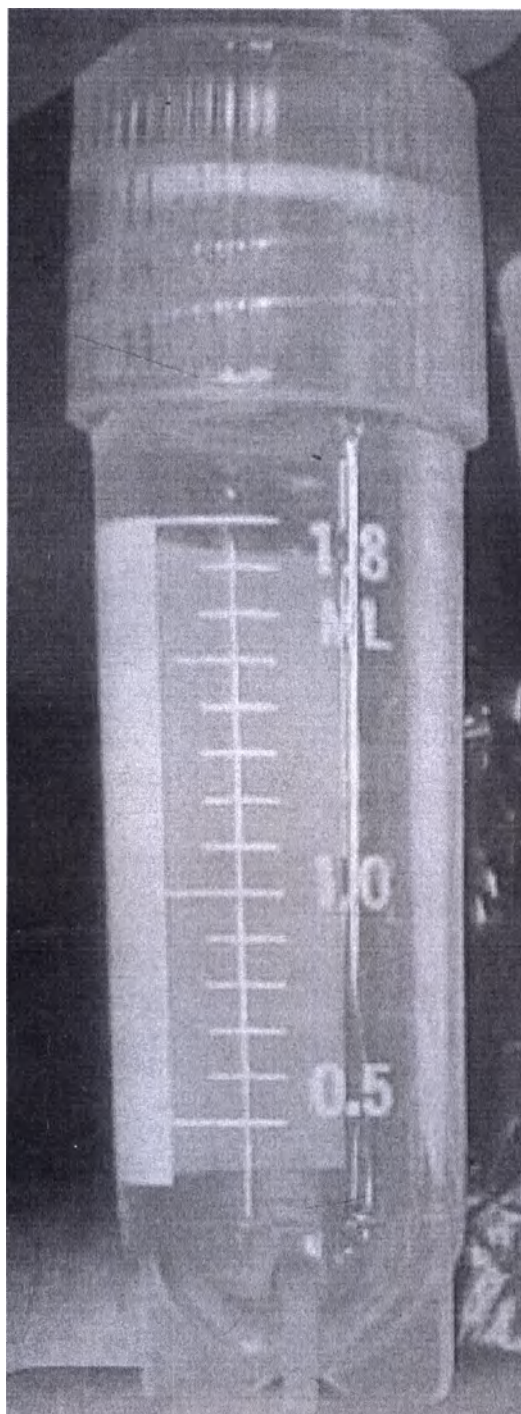


Рисунок 20 – 4. Пробирки пластиковые для хранения медицинских образцов при температурах от - 40 до - 86 градусов

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 22 лист(ов)

Генеральный директор ООО
«Компания Пущинские лаборатории»
Школьная Л.А. Л.А. Школьная

«___»

2022 г.

