

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «СИЭЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ»

Болтали́на К.Н.
«17» апреля 2023 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ГЕЛЬ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ГИАЛУРОНОВЫЙ ЭРИОН (ARION)
ПО ТУ 32.50.22-001–35050891–2022**

Вариант исполнения:

ЭРИОН ГИДРО (ARION HYDRO) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ГИДРО (ARION HYDRO) 2,0 мл в шприце стеклянном - 1 шт.,
- игла инъекционная 32G (0,23 x 13 мм) или 32G (0,23 x 12 мм) или 32G (0,26 x 13мм) – 2 шт.,
- инструкция по применению – 1 шт.,
- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.

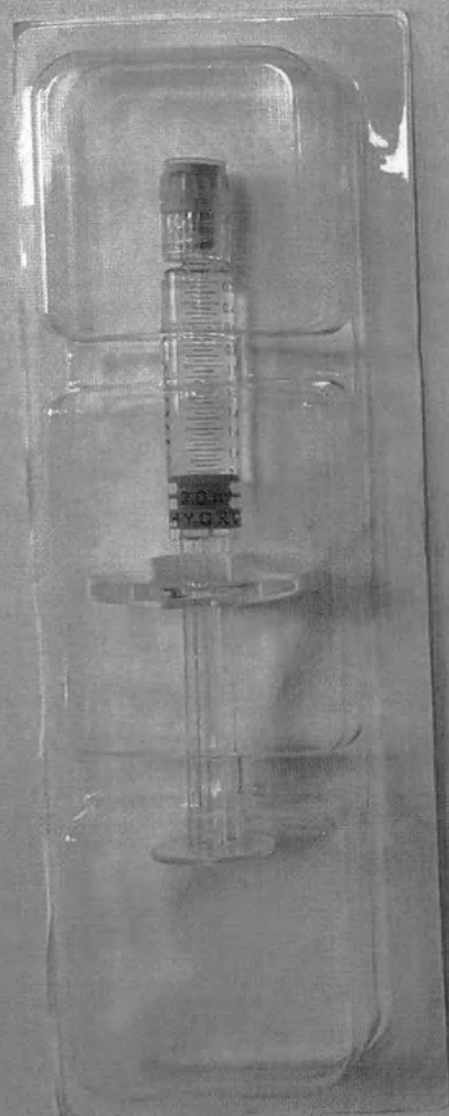

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Пептидные кислоты несовместимы с солями четвертичных аммониев, такими, например, как хлорид бензалкония. Не следует допускать контакт имплантата с любыми соединениями, в частности с местными антисептиками, в состав которых входит хлорид бензалкония.
У лиц, принимающих цитостатики, глюкокортикоиды, L-пероксин, ферментные препараты, сроки биодеградации имплантата увеличатся.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Условия хранения изделия в упаковке, предпринятые производителем, в закрытом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80%. Изделие следует хранить в чистом, сухом месте. Предохранить от солнечного света. Не замораживать. Изделия транспортируют любым видом крытого транспорта при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 80%.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам на протяжении срока годности при соблюдении правил хранения и транспортирования, указанных в инструкции по применению.
Срок годности изделия — 18 месяцев с даты стерилизации.
Сведения о неблагоприятных событиях и претензии по качеству продукции направляются в адрес производителя.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При изготовлении, транспортировании, использовании, утилизации изделия не представляется опасности для окружающей среды, не подвергается биологической и химической трансформации.


УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация осуществляется согласно СанПин 2.1.3684-21, производственный брак, изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой, а также упаковочные материалы утилизируют во классу опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО); использованные изделия (шприц с иглой, остатки продукции) утилизируют по классу опасности Б (эпидемиологически опасные отходы).

Arion hydro 2.0 ml

Lot №:
Партия №: ARH2 00306-0122
MFG Date:
Произведено: 21.06.2022
Exp. Date:
Использовать до: 21.12.2023

Arion hydro 2.0 ml

Lot №:
Партия №: ARH2 00306-0122
MFG Date:
Произведено: 21.06.2022
Exp. Date:
Использовать до: 21.12.2023

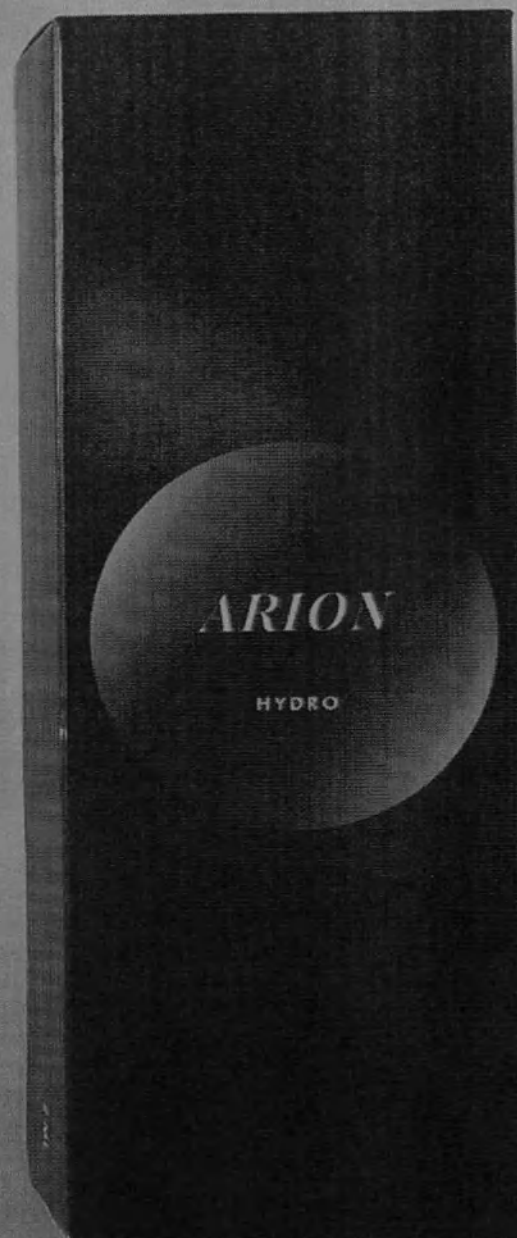

Arion hydro

2.0 ml

Хранить в закрытом помещении при температуре

от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Не замораживать! Предохранять от солнечного света! Стерильно! В случае нарушения целостности блистерной упаковки использовать запрещено!

Только для однократного применения! Выполняйте требования инструкции по применению! Разрешено к применению только квалифицированным врачом!

Lot №

Партия № ARH2 00306-0122

MFG Date:

Произведено: 21.06.2022

Exp Date:

Использовать до: 21.12.2023


Маркировка блистерной упаковки



Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

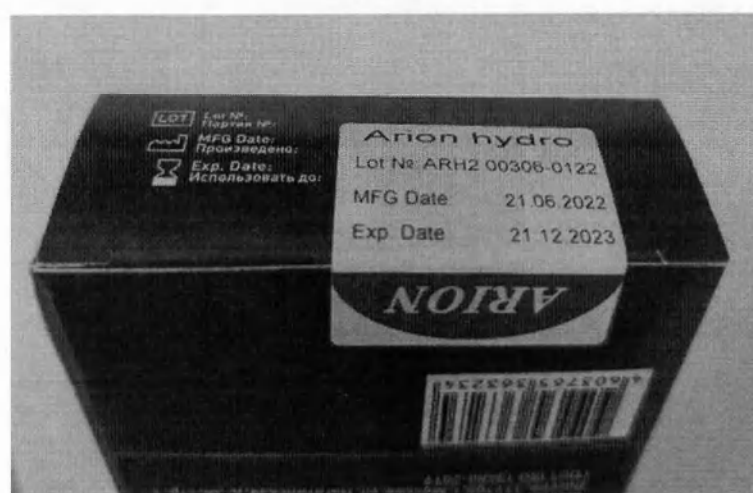

Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)

Вариант исполнения:

ЭРИОН ЛАЙТ ТАЧ (ARION LIGHT TOUCH) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ЛАЙТ ТАЧ (ARION LIGHT TOUCH) 1,0 мл
в шприце стеклянном

- 1 шт.,


- игла инъекционная 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) - 1 шт.,

- игла инъекционная 30G (0,3 x 12 мм) или 30G (0,3 x 13 мм) - 1 шт.,

- инструкция по применению – 1 шт.,

- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.

ЭРИОН ЛАЙТ ТАЧ (ARION LIGHT TOUCH)

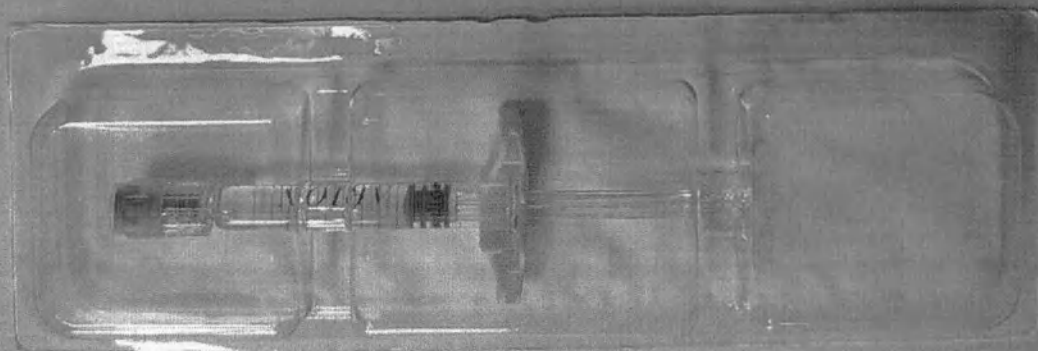

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАСТВОРАМИМИ СУБСТАНЦИЯМИ
 Взаимодействие с растворами лекарственных средств (ЛС) и других веществ, содержащихся в растворах, не изучено. Не рекомендуется смешивать с растворами ЛС и других веществ, содержащихся в растворах, не изучено. Не рекомендуется смешивать с растворами ЛС и других веществ, содержащихся в растворах, не изучено.

Условия хранения и транспортировки
 Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не замораживать. Транспортировать при температуре от +5°C до +25°C. Не замораживать.

Срок годности
 Срок годности — 18 месяцев с даты изготовления. Срок годности — 18 месяцев с даты изготовления. Срок годности — 18 месяцев с даты изготовления.

Требования к условиям хранения
 Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не замораживать. Транспортировать при температуре от +5°C до +25°C. Не замораживать.

Требования к условиям транспортировки
 Транспортировать при температуре от +5°C до +25°C. Не замораживать. Транспортировать при температуре от +5°C до +25°C. Не замораживать.

Требования к условиям использования
 Использовать для инъекций. Не использовать для инъекций. Не использовать для инъекций.

Упаковка
 Упаковка — 10 шт. Упаковка — 10 шт. Упаковка — 10 шт.

Arion light touch 1.0 ml

Lot №
Партия № ARLT1 00406-0122
MFG Date
Произведено: 22.06.2022
Exp. Date
Использовать до: 22.12.2023

Arion light touch 1.0 ml

Lot №
Партия № ARLT1 00406-0122
MFG Date
Произведено: 22.06.2022
Exp. Date
Использовать до: 22.12.2023



Гель инъекционный галуроновый ЭРИОН (ARION)
по ТУ 32.50.22-001-30508971-2022

ЭРИОН ЛАЙТ ТАЧ (ARION LIGHT TOUCH) в составе:
 - гель инъекционный галуроновый
 - ипериол-стеклопластик — 1 шт.,
 или инъекционная 270 (0,4 x 12 мм)
 или 270 (0,4 x 13 мм) — 1 шт.,
 или инъекционная 306 (0,3 x 12 мм)
 или 306 (0,3 x 13 мм) — 1 шт.,
 инструкция по применению — 1 шт.,
 стикер-воздушка для карты пациента — 2 шт.

Стеклопластик (полиэтилен-сшитый BOREI)
матрица галуронат 1,5%

Для внутрисуставного введения

Разрешено к применению только
квалифицированным врачом

Условия хранения в ампулах: температура при
температуре от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха до 80%. Не замораживать!
Предохранять от солнечного света!



RU-R

Общество с ограниченной ответственностью
«СИЗЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ»

1000 «СИЗЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ»
 Россия, 109544, г. Москва, ул. Рязанский Вал,
 д. 4, стр. 1, пом. 2, пом. 2А
 тел. +7 (800) 600-75-37
 e-mail: office@vetrog.ru

Место производства: ООО «СИЗЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ»
 Россия, 117145, г. Москва, ул. Негинская, д. 2А, стр. 1
 GOST ISO 13485:2017

стр. 1



Arion light touch

1.0 ml

Хранить в закрытом помещении при
температуре

от +5°C до +25°C и относительной
влажности воздуха до 80%.

Не замораживать! Предохранять от
солнечного света! Стерильно! В случае
нарушения целостности блистерной
упаковки использовать запрещено!

Только для однократного применения!
Выполняйте требования инструкции по
применению! Разрешено к применению
только квалифицированным врачом!

Lot №

Партия №: ARLT1 00406-0122

MFG Date:

Произведено: 22.06.2022

Exp. Date:

Использовать до: 22.12.2023


Маркировка блистерной упаковки



Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

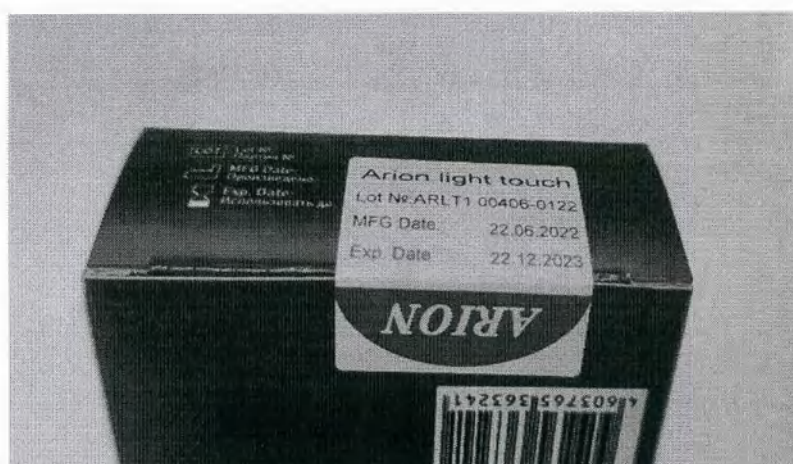

Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)


Вариант исполнения:

ЭРИОН ДИВЕРС (ARION DIVERSE) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ДИВЕРС (ARION DIVERSE) 1,0 мл – 1 шт.,
- игла инъекционная 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) - 2 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.

Arion
diverse 1.0 ml

Lot No.	ARD1 00506-0122
Exp. Date	23.06.2022
Exp. Date	23.12.2023
Идентификац. А.О.	

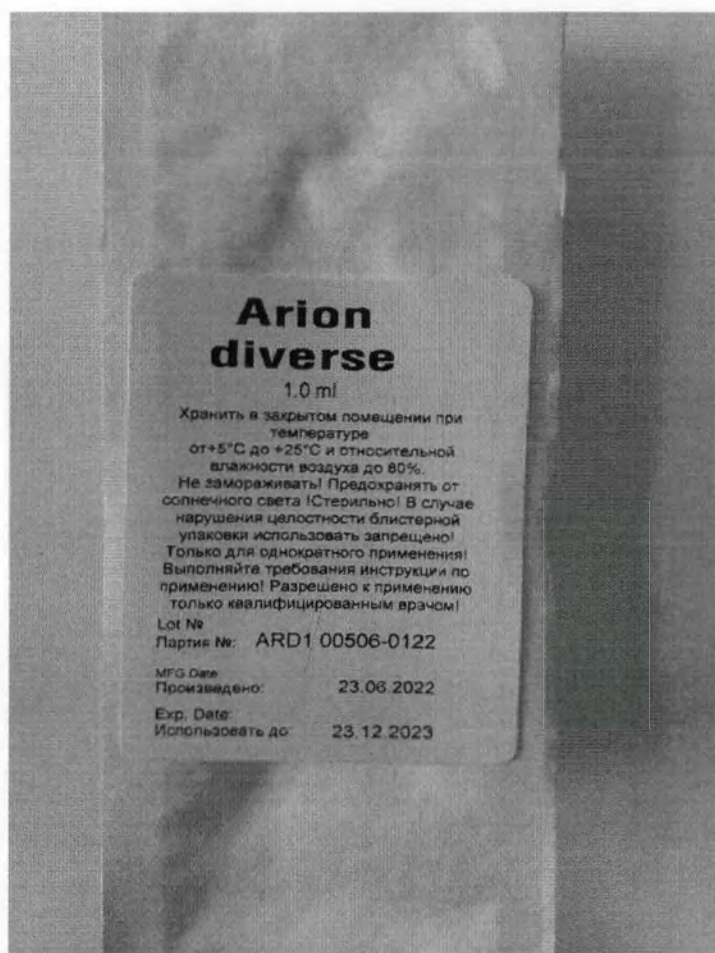


Маркировка блистерной упаковки



Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

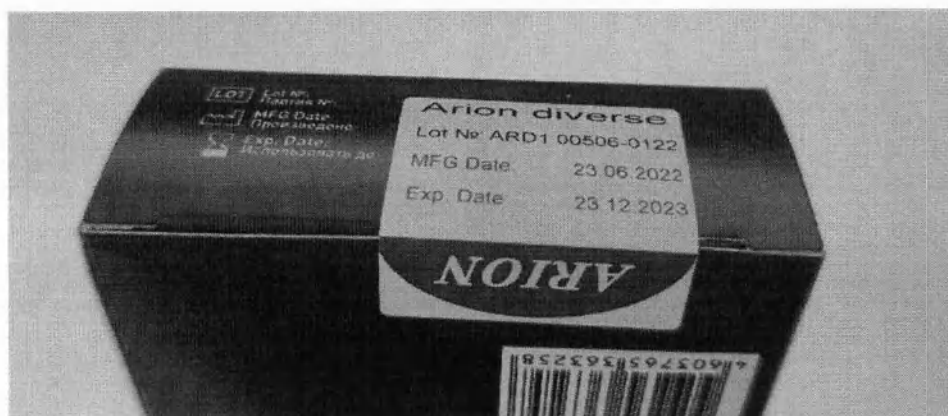


Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)

Вариант исполнения:


ЭРИОН ДИВЕРС (ARION DIVERSE) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ДИВЕРС (ARION DIVERSE) 2,0 мл – 1 шт.,
- игла инъекционная 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) - 2 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.

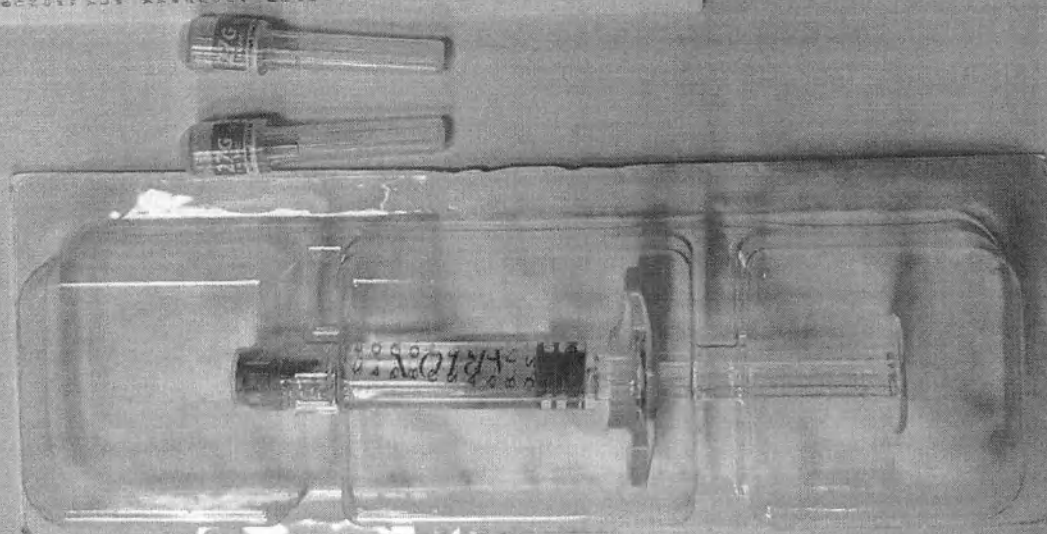

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЭРИОН ДИВЕРС (ARION DIVERSE)

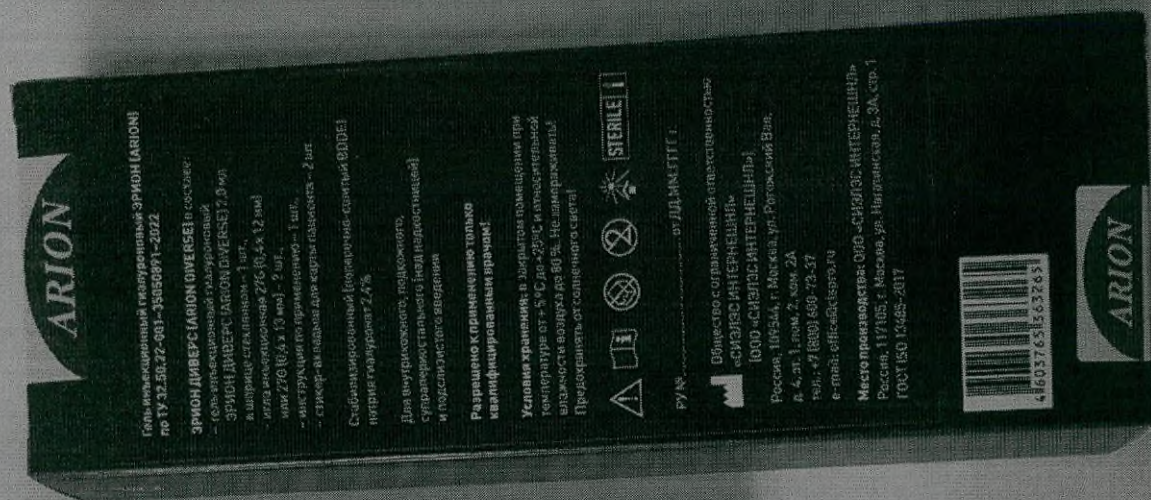


КАРДИОПРОТЕКТОР С ПЕКАРТЕВЫМИ МИКРОДРАГАМИ
 Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида. Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида. Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида.

КАРДИОПРОТЕКТОР С ПЕКАРТЕВЫМИ МИКРОДРАГАМИ
 Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида. Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида.

КАРДИОПРОТЕКТОР С ПЕКАРТЕВЫМИ МИКРОДРАГАМИ
 Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида. Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида.

КАРДИОПРОТЕКТОР С ПЕКАРТЕВЫМИ МИКРОДРАГАМИ
 Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида. Кардиопротектор с пекартевыми микродрагами (ЭРИОН ДИВЕРС) предназначен для внутривенного введения. Он содержит 20% раствор пекартевых микродраг в изотоническом растворе натрия хлорида.

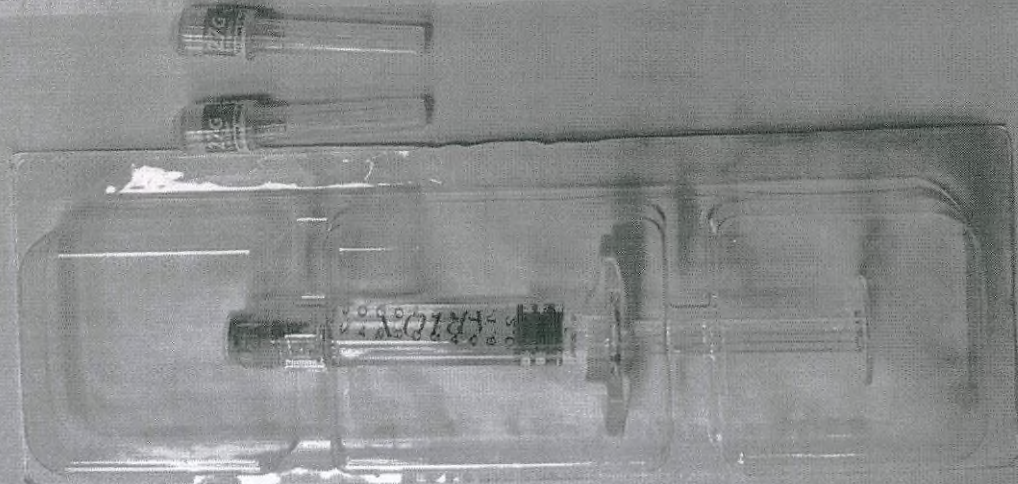

Arion
 diverse 2.0 ml

Lot №
 Партия № ARD2 00108-0122
 MFG Date 20.06.2022
 Exp. Date 20.12.2023
 Использовать до 20.12.2023

Arion
 diverse 2.0 ml

Lot №
 Партия № ARD2 00108-0122
 MFG Date 20.06.2022
 Exp. Date 20.12.2023
 Использовать до 20.12.2023




Макет блистерной упаковки



Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

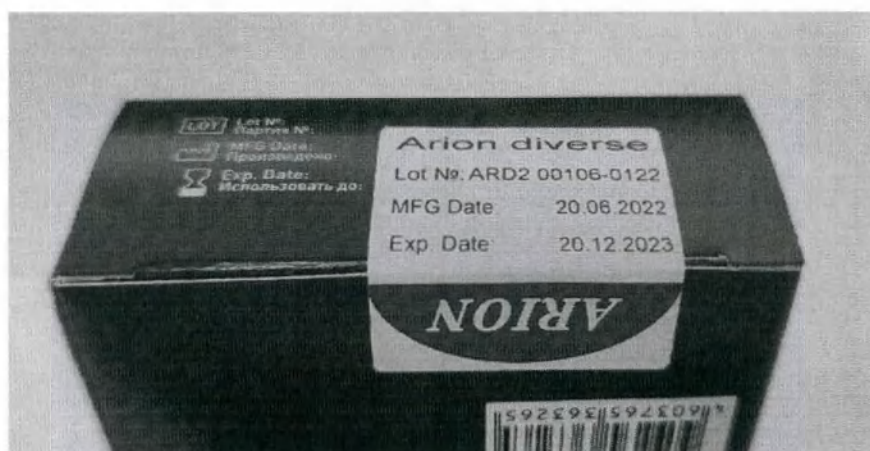

Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)

Вариант исполнения:

ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME) 1,0 мл в шприце стеклянном - 1 шт.,
- игла инъекционная 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) - 2 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.

ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME)



Arion volume
1.0 ml

Хранить в закрытом помещении при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%. Не замораживать! Предотвратить от солнечного света! Стерильно! В случае нарушения целостности блистерной упаковки использовать запрещено! Только для однократного применения! Выполняйте требования инструкции по применению! Разрешено к применению только квалифицированным врачом!

Lot №
Партия № ARV1 00206-0122

MFG Date:
Произведено: 20.06.2022

Exp. Date:
Использовать до: 20.12.2023



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Гидролизная кислота несовместима с сильными окислителями, перманганатом, перекисью, хлором, бензальдегидом. Не допускать контакта ампул с другими лекарственными средствами, в частности с метилсалицилатом, в состав которых входит кислота бензойная.

и р-н, принимающих, цитостатич., глюкокортикоиды, Литеросин, ферментные препараты, сроки годности которых не сокращаются.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Хранить изделие в упаковке предприятия-производителя в закрытом помещении при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%. Изделие следует хранить в сухом, темном месте. Предотвратить от солнечного света! Не замораживать! Изделие транспортируется любым видом сухопутного транспорта при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам на протяжении срока годности при соблюдении правил хранения и транспортирования, указанных в инструкции по применению.

Срок годности изделия — 18 месяцев с даты стерилизации. События с неблагоприятными событиями и претензии по качеству продукции направляются в адрес производителя.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При изготовлении, транспортировании, использовании, хранении изделие не представляет опасности для окружающей среды, не поддается биологической и химической трансформации.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация осуществляется согласно СанПин 2.1.3.684-71, производственный брак, изделия с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой, а также упаковочные материалы утилизируются по классу опасности А (биологическая безопасность: отходы, по составу приближенные к ТБО), использованные изделия утилизируются с иглой, остаток продукции утилизируются по классу опасности В (биологический опасный отход).

Arion volume 1.0 ml

Lot №
Партия № ARV1 00206-0122

MFG Date:
Произведено: 20.06.2022

Exp. Date:
Использовать до: 20.12.2023

Arion volume 1.0 ml

Lot №
Партия № ARV1 00206-0122

MFG Date:
Произведено: 20.06.2022

Exp. Date:
Использовать до: 20.12.2023

ARION

Гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН (ARION) по ТУ 32.50.22-001-35050891-2022

ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME) 1,0 мл
- шприцы стеклянные — 1 шт.
- иглы инъекционные 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) — 2 шт.
- инструкция по применению — 1 шт.
- степер-акладный для карты пациента — 2 шт.

Стабилизированный (поперечно-сшитый ВДОО) натрия гиалуронат 2,5%

Для внутримышечного, подкожного и супрапериостального (наднадкостничной) введения.

Разрешено к применению только квалифицированными врачом!

Условия хранения: в закрытом помещении при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%. Не замораживать! Предотвратить от солнечного света!


РУМР: от ДД.ММ.ГГГГ.г.

Общество с ограниченной ответственностью «СИЭЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ» (ООО «СИЭЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ») Россия, 109544, г. Москва, ул. Рагожский Вил, д. 4, эт. 1, пом. 2, каб. 2А тел.: +7 (800) 600-73-37 e-mail: office@clspro.ru


Место производства: ООО «СИЭЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ» Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 1 ГОСТ ISO 13485-2017

4603765363272

ARION

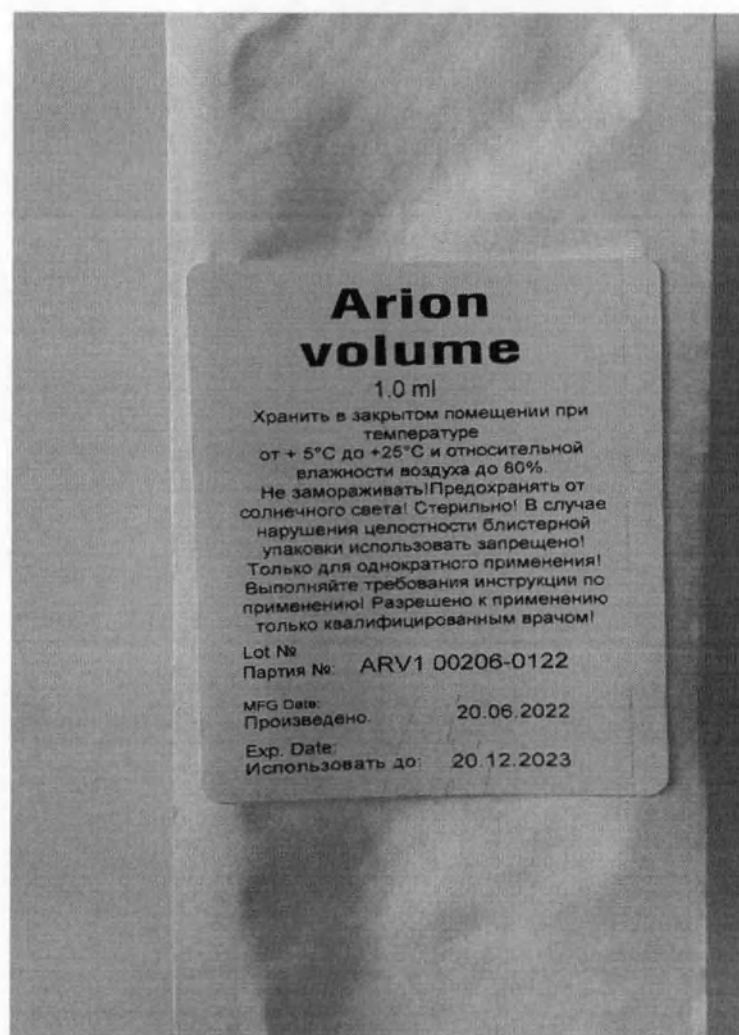


Маркировка блистерной упаковки

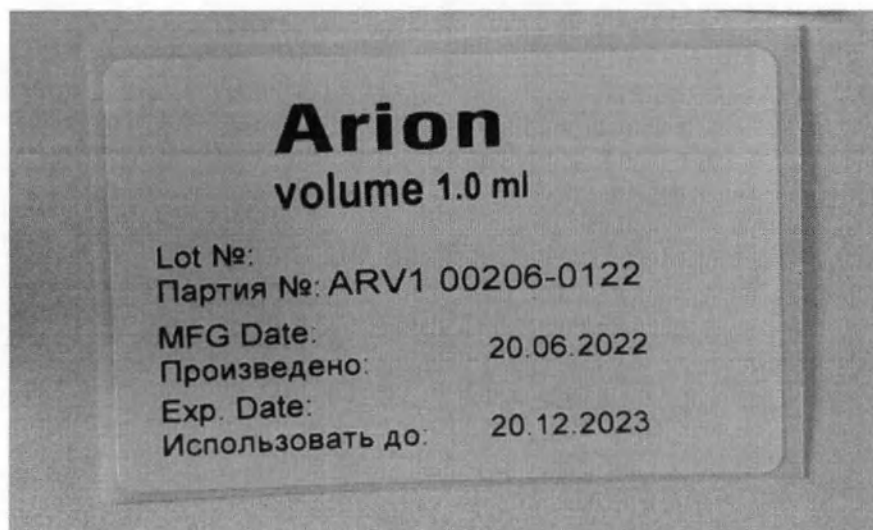

Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

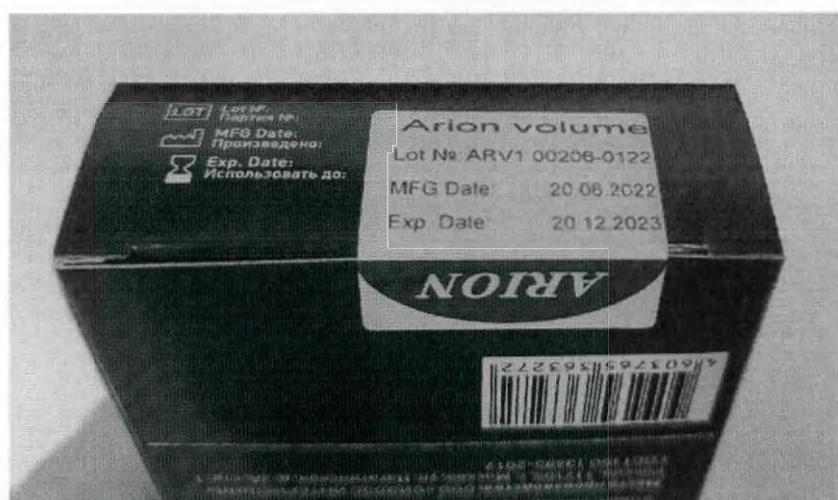

Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)

Вариант исполнения:

ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME) 1,0 мл в шприце стеклянном - 2 шт.,
- игла инъекционная 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) - 4 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.



ЭРИОН ВОЛЮМ (ARION VOLUME)






Маркировка блистерной упаковки



Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

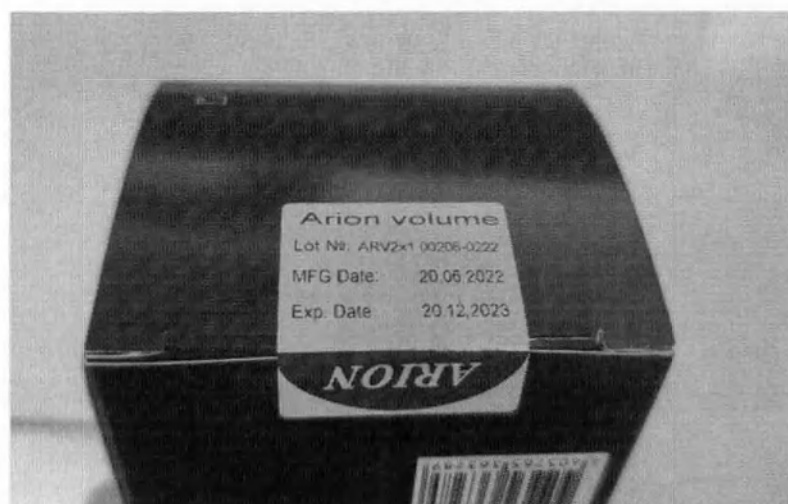


Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)

Вариант исполнения:

ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ (ARION GENITAL) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ (ARION GENITAL) 1,0 мл в шприце стеклянном - 1 шт.,
- игла инъекционная 25G (0,5 x 25 мм) - 1 шт.,
- игла инъекционная 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) - 1 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.

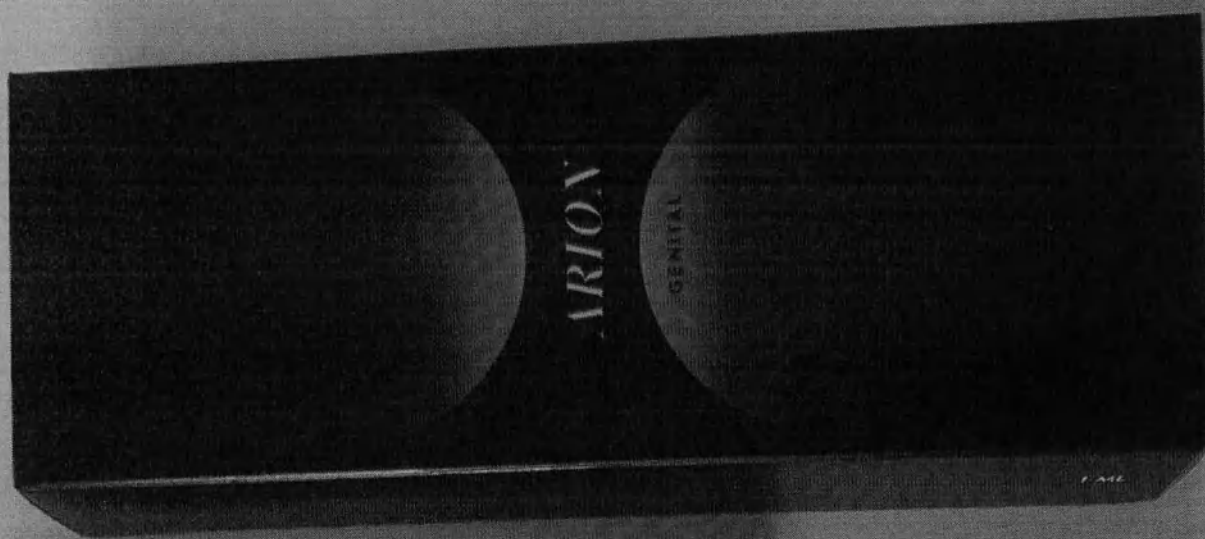

ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ

ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ — это средство для дезинфекции и антисептики. Оно предназначено для использования в гинекологии, урологии, дерматологии и других областях медицины. Средство эффективно борется с бактериями, вирусами и грибками. Оно также обладает обезболивающим эффектом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
 Средство должно храниться в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Не допускать заморозки. Срок годности — 18 месяцев с даты изготовления.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 Производитель гарантирует соответствие средства заявленным характеристикам. При нарушении условий хранения и транспортировки производитель не несет ответственности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 Средство не содержит вредных веществ и не наносит вреда окружающей среде. Оно безопасно для использования в домашних условиях.


УТИЛИЗАЦИЯ
 Средство утилизируется в соответствии с требованиями законодательства. Не выбрасывать в мусорный бак.

Arion
genital 1.0 ml

Lot №:
Партия №: ARG1-00606-0122
MFG Date:
Произведено: 24.06.2022
Exp. Date:
Использовать до: 24.12.2023

Arion
genital 1.0 ml

Lot №:
Партия №: ARG1-00606-0122
MFG Date:
Произведено: 24.06.2022
Exp. Date:
Использовать до: 24.12.2023

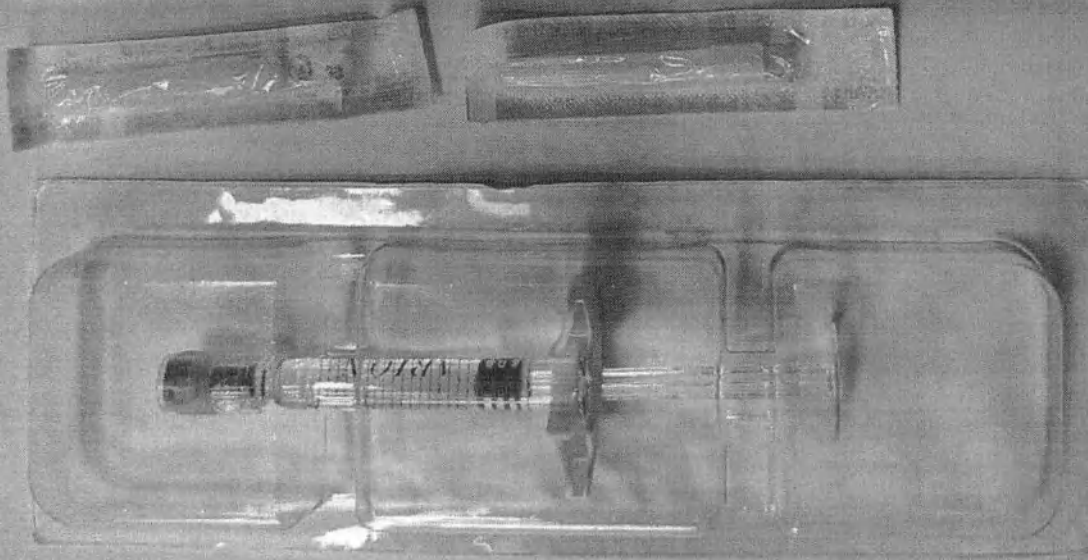

ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ (ARION GENITAL)


УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация осуществляется согласно СанПиН 2.1.3684-21 производственный брак, изделия с истекшим сроком годности с поврежденными упаковкой, а также упаковочные материалы утилизируют по классу опасности А (эпидемиологически безопасным) способом, по составу приближенному к ТБО, а использованные изделия (шприцы с иглой, остатки производимых инъекций) утилизируют по классу опасности Б (эпидемиологически опасным) способом.

Lot No:
Партия №: ARG1 00606-0122
MFG Date
Произведено: 24.05.2022
Exp. Date
Использовать до: 24.12.2023


Место производства: ООО «СИЗЛЭС ИНТЕРНЕШНЛ»
Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 1
ГОСТ ISO 13485-2017



ARION

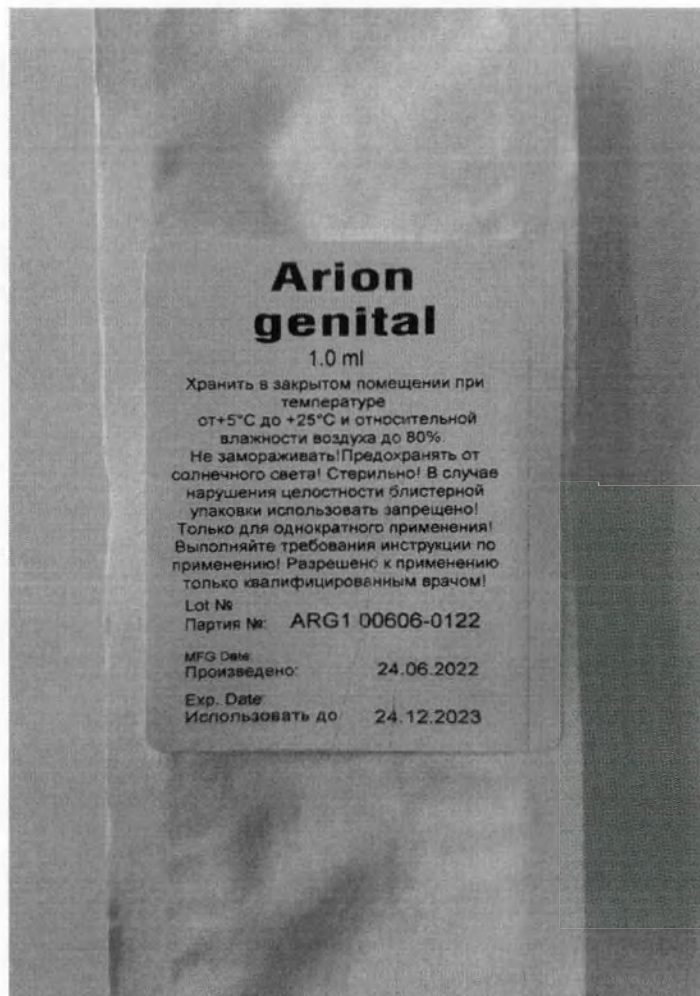


Маркировка блистерной упаковки

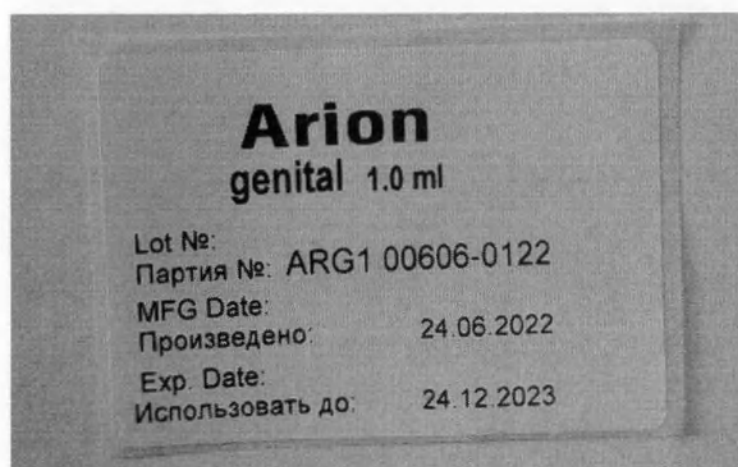

Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

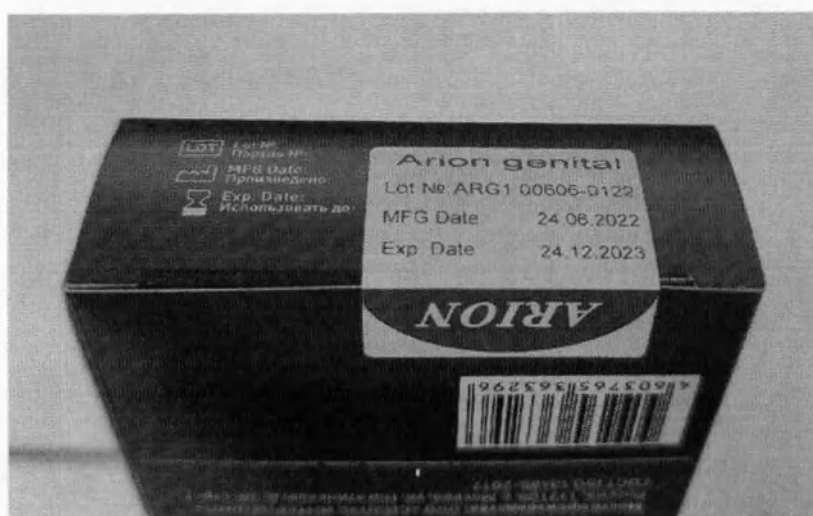


Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)

Вариант исполнения:

ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ (ARION GENITAL) в составе:

- гель инъекционный гиалуроновый ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ (ARION GENITAL) 2,0 мл в шприце стеклянном - 1 шт.,
- игла инъекционная 25G (0,5 x 25 мм) - 1 шт.,
- игла инъекционная 27G (0,4 x 12 мм) или 27G (0,4 x 13 мм) - 1 шт.,
- инструкция по применению - 1 шт.,
- стикер-вкладыш для карты пациента - 2 шт.

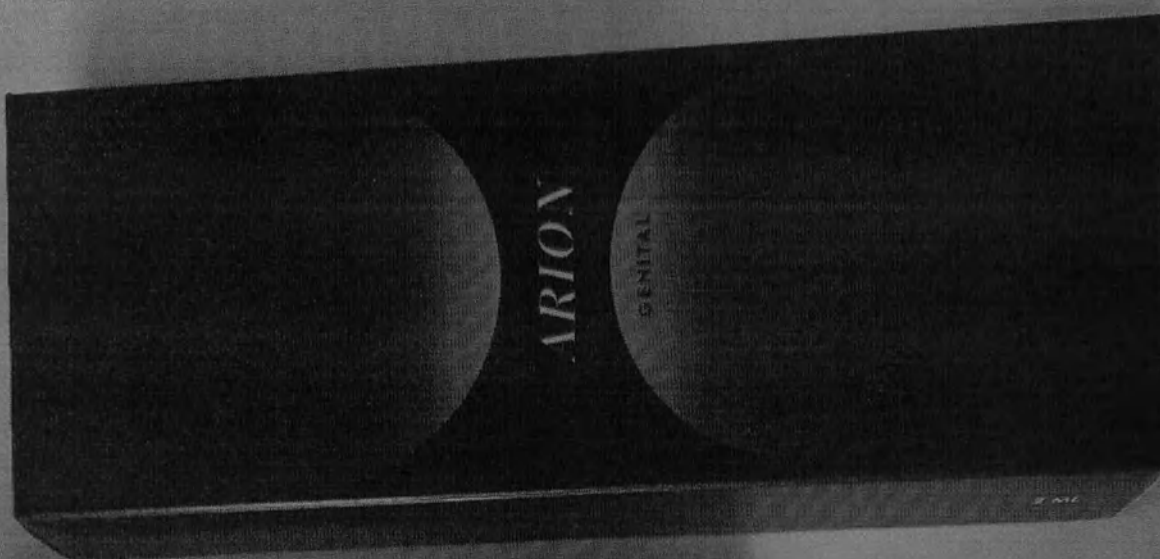

КАТЕГОРИЯ СРЕДСТВ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ
 Данное средство предназначено для дезинфекции и антисептики слизистых оболочек и кожи в области наружных половых органов и промежности. Средство эффективно против широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, грибы, вирусы и простейшие. Средство не содержит агрессивных компонентов, не вызывает раздражения и аллергии. Средство применяется в виде раствора для орошения и смазывания пораженных участков. Средство имеет приятный запах и легко смывается водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
 Средство хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25°C. Средство не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Средство не смешивать с другими средствами. Средство использовать в течение 12 месяцев со дня изготовления. Средство не применять по истечении срока годности.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 Производитель гарантирует, что данное средство соответствует требованиям, указанным в инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием средства. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием средства в целях, не предусмотренных инструкцией.


УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ИНТЕРЕСОВ
 Данное средство является товаром, который охраняется законом. Использование средства без разрешения производителя является нарушением закона. Использование средства с целью нанесения вреда здоровью или имуществу является уголовно наказуемым деянием.

Arion
 genital 2.0 ml

Lot №
 Партія № ARG2 00706-0122
 MFG Date 24.06.2022
 Exp Date 24.12.2023
 Исползовать до

Arion
 genital 2.0 ml

Lot №
 Партія № ARG2 00706-0122
 MFG Date 24.06.2022
 Exp Date 24.12.2023
 Исползовать до

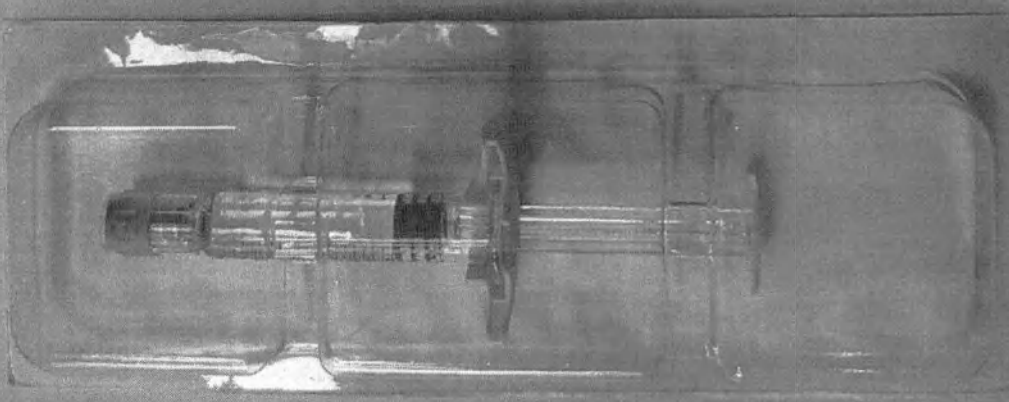

ЭРИОН ДЖЕНИТАЛ (ARION GENITAL)

Arion genital

2.0 ml

Хранить в закрытом помещении при температуре

от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Не замораживать! Предохранять от солнечного света! Стерильно! В случае нарушения целостности блистерной упаковки использовать запрещено!

Только для однократного применения! Выполняйте требования инструкции по применению! Разрешено к применению только квалифицированным врачом!

Lot №

Партия №: ARG2 00706-0122

MFG Date:

Произведено: 24.06.2022

Exp. Date:

Использовать до: 24.12.2023


Маркировка блистерной упаковки



Маркировка стикера-вкладыша для карты пациента



Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (верхний клапан)

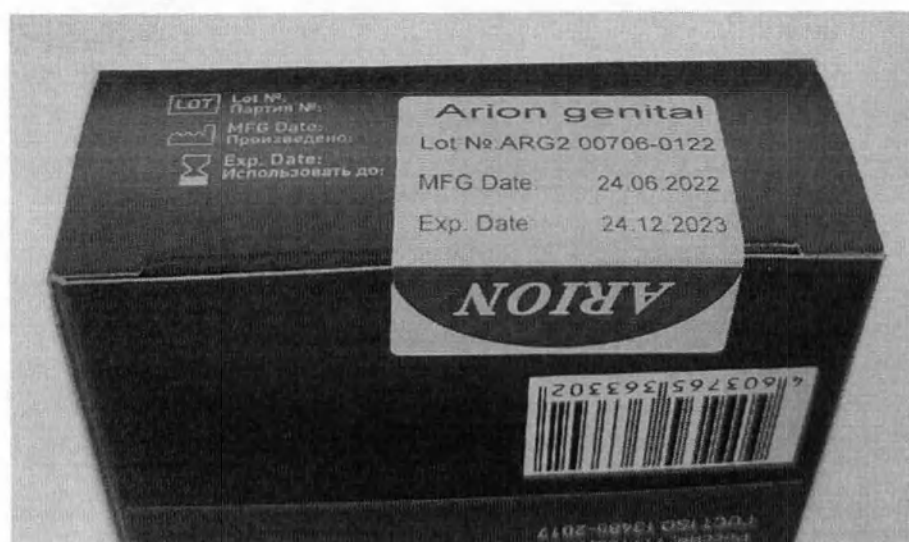

Маркировка самоклеящегося стикера контроля вскрытия потребительской упаковки (нижний клапан)

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 41

(серия 045678)

листа(ов). Подпись М.И.Маслов

ФИО Волтаица К.Н.

«___» _____ 20___ г. М.П.



УТВЕРЖДАЮ



**Генеральный директор
ООО «СИЭЛЭС ИНТЕРНЕСИЛ»**

Болталиня К.Н.


«17» апреля 2023 г.

**МАКЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ГЕЛЬ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ГИАЛУРОНОВЫЙ ЭРИОН (ARION)
ПО ТУ 32.50.22-001-35050891-2022**






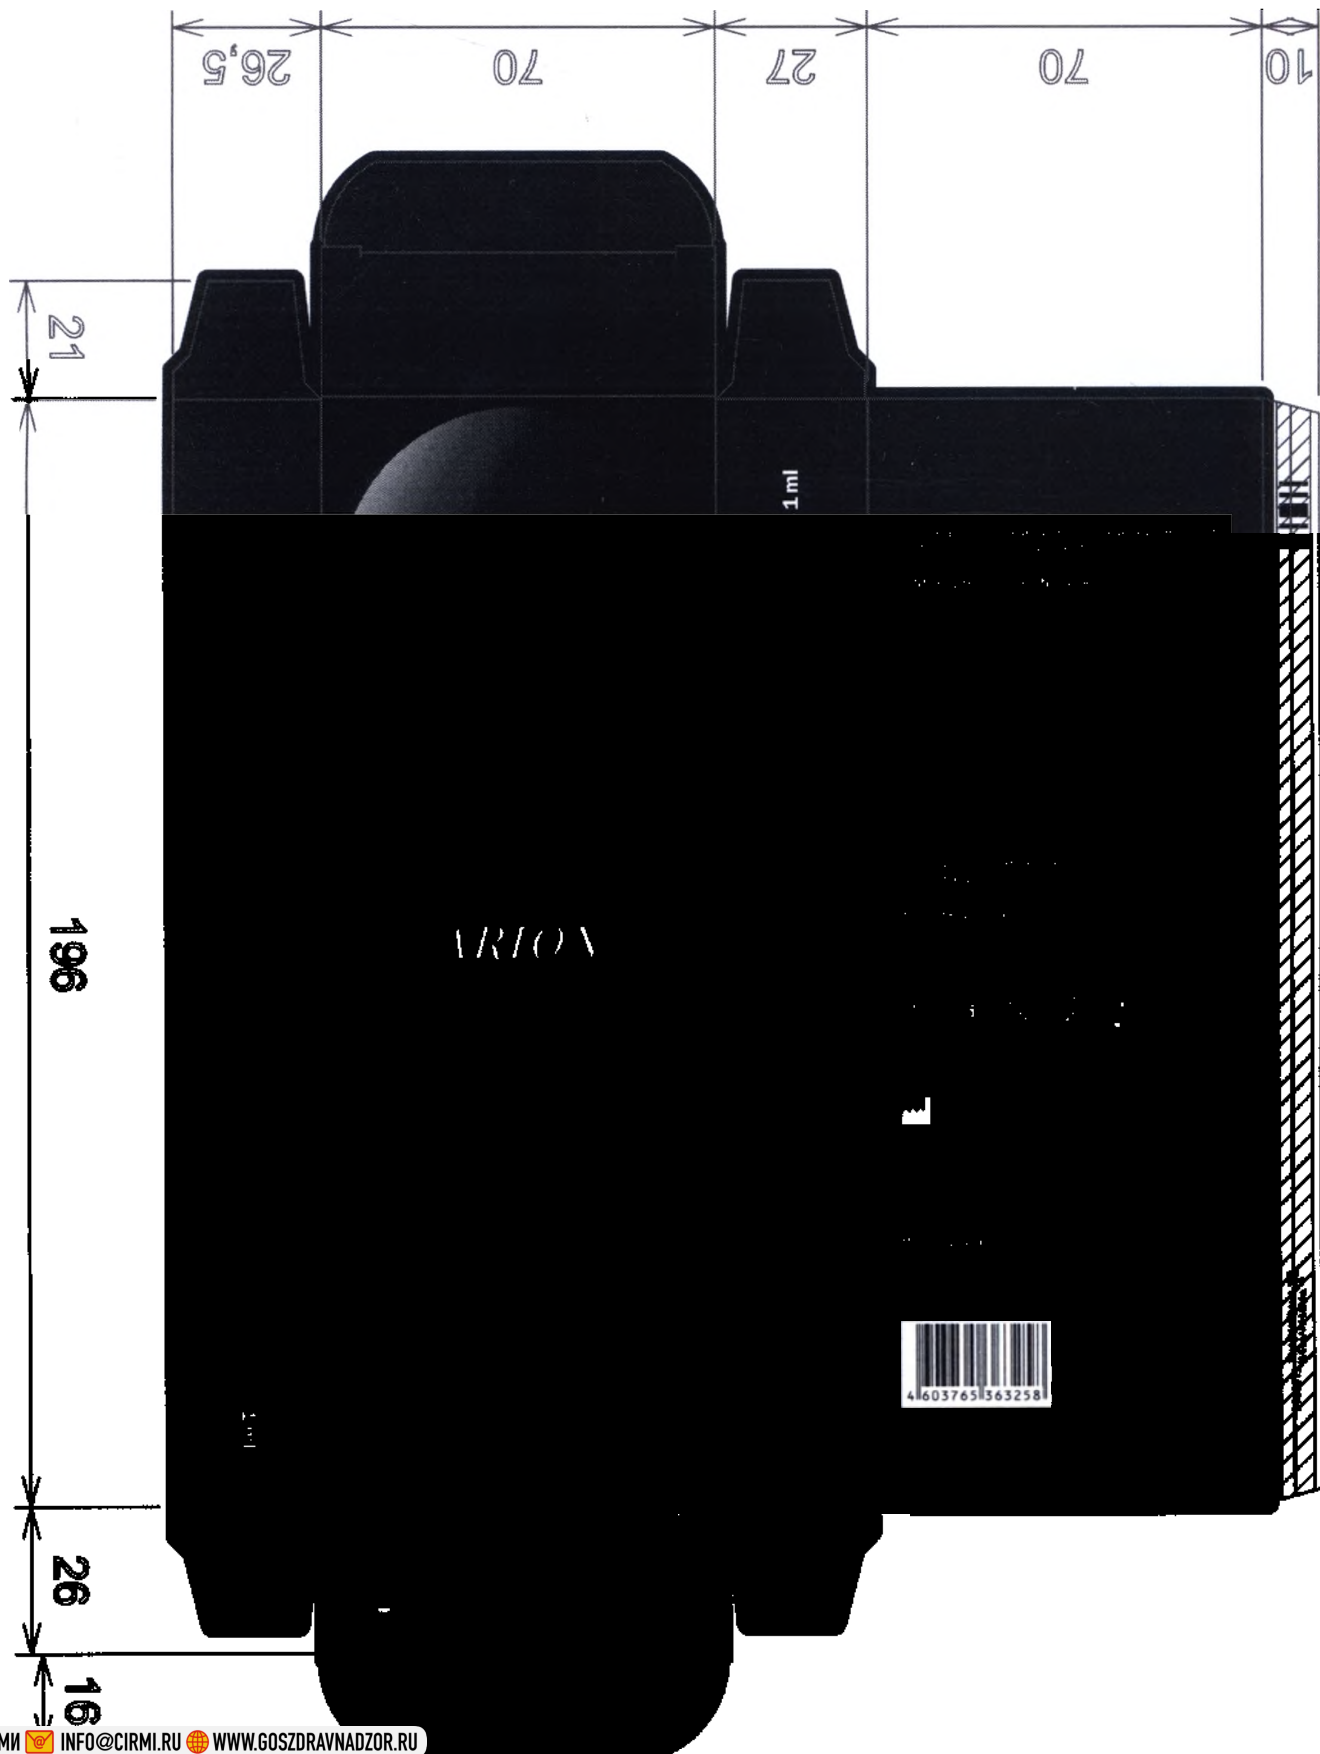







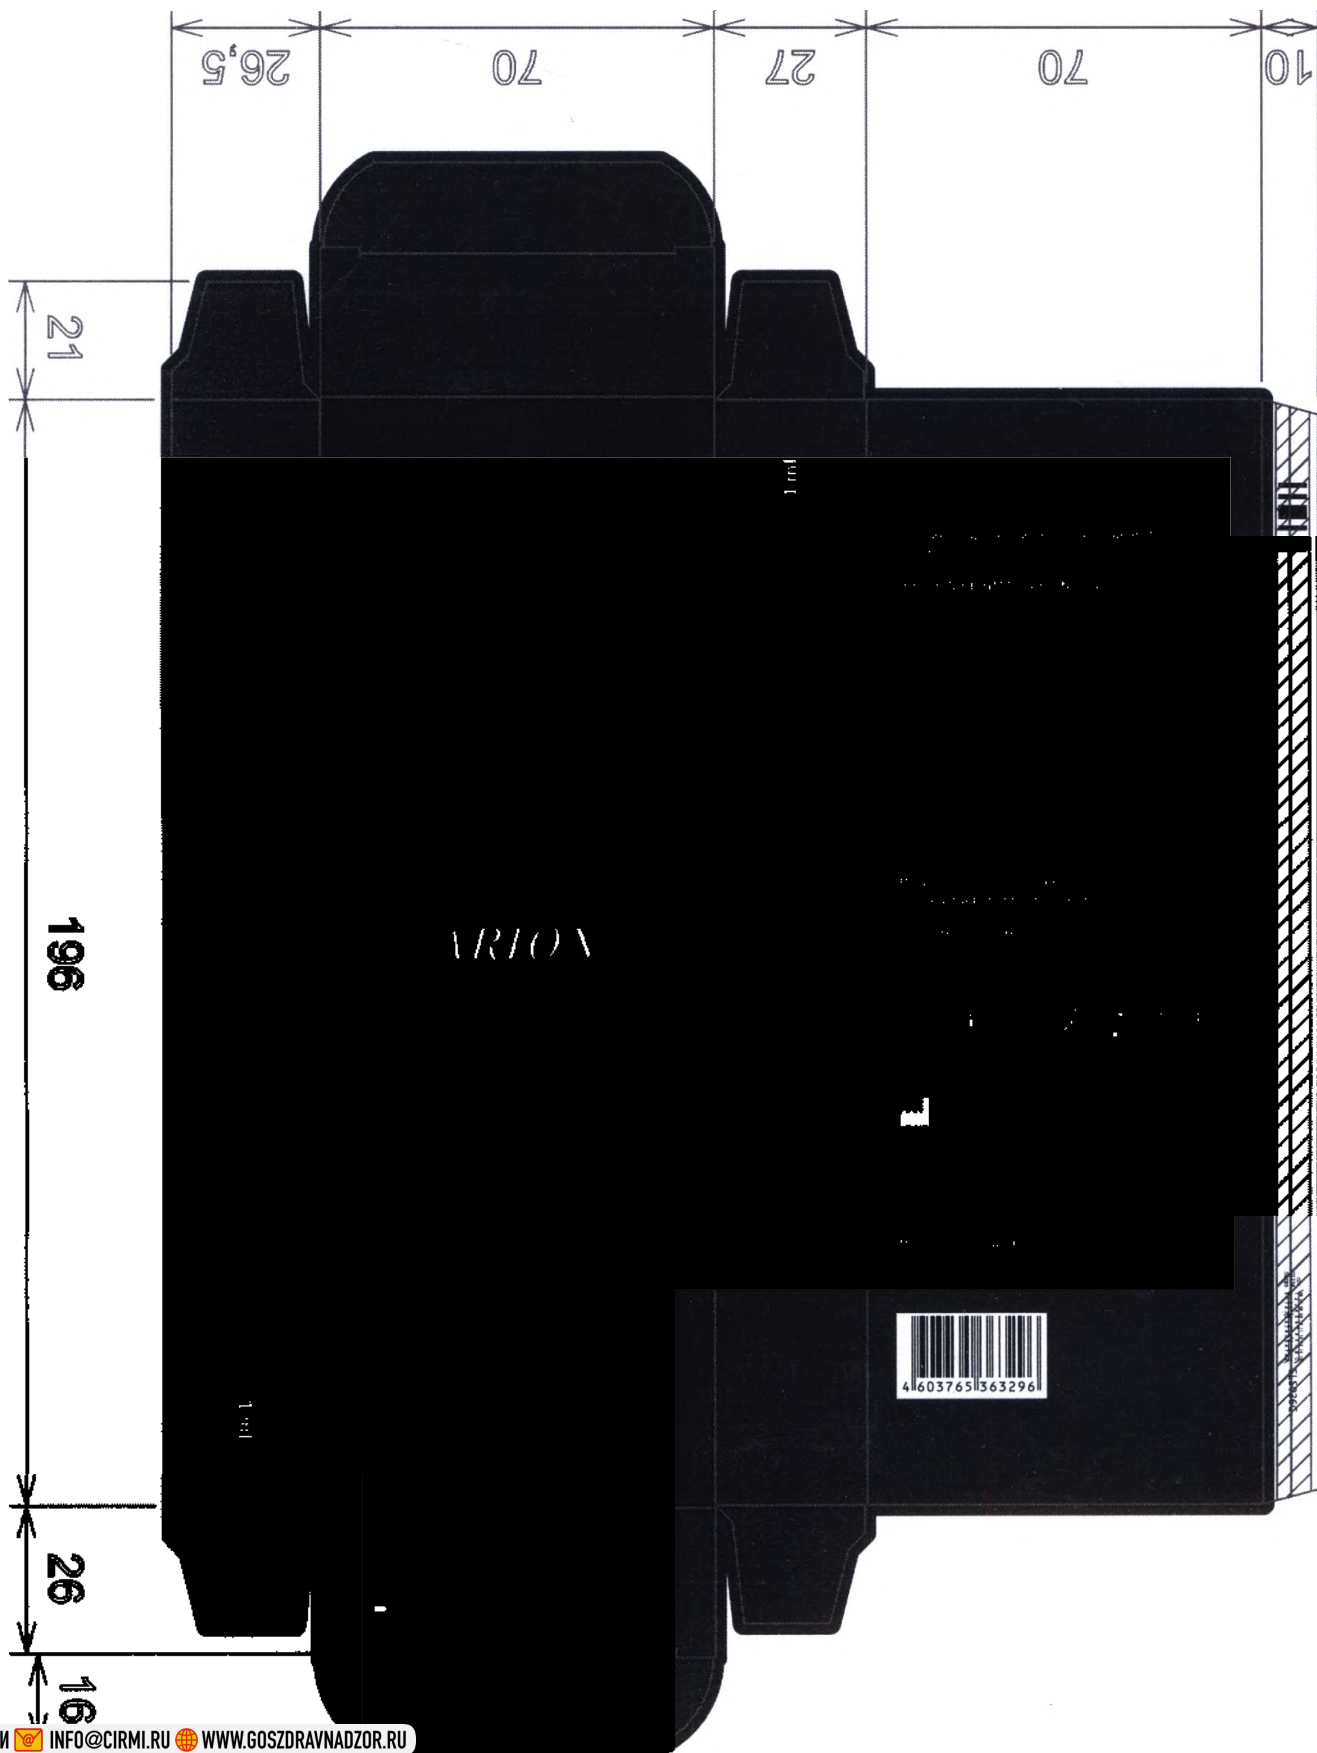



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 9

(девятъ)
листа(ов). Подпись [подпись]
ФИО Болтакина К.Н.

« ____ » _____ 20 ____ г. М.П.

