



МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, варианты исполнения, производства DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ»

Список символов

Следующие символы содержатся на маркировке.

Расшифровка символов на упаковке:

Символ	Значение
	Логотип производителя Био-Рад
	Изготовитель
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Предел температуры (от 18°C до 25°C)
	Код партии
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Использовать до
	Номер по каталогу
	Обратитесь к инструкции по применению
	Осторожно!
	Верх
	Упаковка пригодна для вторичной переработки
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Крюками не брать
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
Bio-Rad Laboratories	Био-Рад Лабораториез

Макет маркировки первичной упаковки

Макет маркировки





Маркировка первичной упаковки содержит следующую информацию:

- наименование, адрес и логотип изготовителя;
- наименование медицинского изделия;
- моноклональные антитела;
- сыворотки, содержащие Анти-А и Анти-В антитела: A, B, AB, DVI-, cti, DAT;
- компоненты состава микропробирок Anti-IgG+C3d
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»;
- условия хранения - символ «Предел температуры»;
- маркировка соответствия требованиям CE;
- штрих-код;
- код партии;
- срок годности - символ «Использовать до»;
- двумерный матричный штрих-код.

Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка)


Макет маркировки

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.:

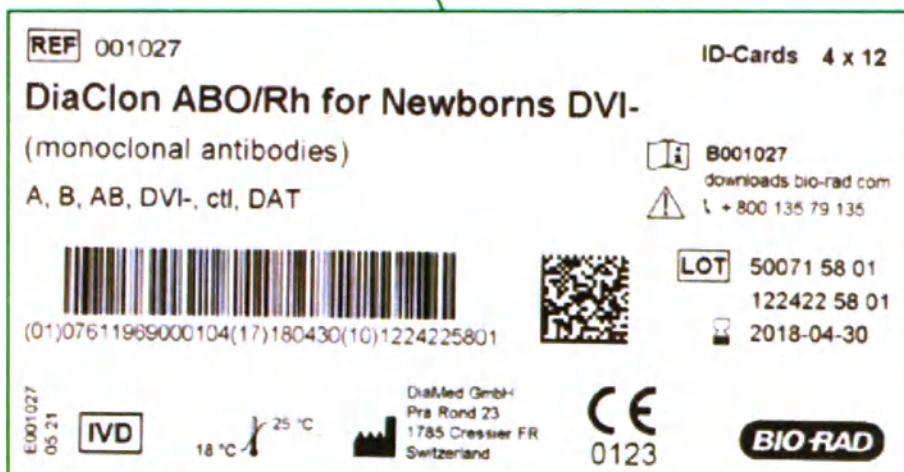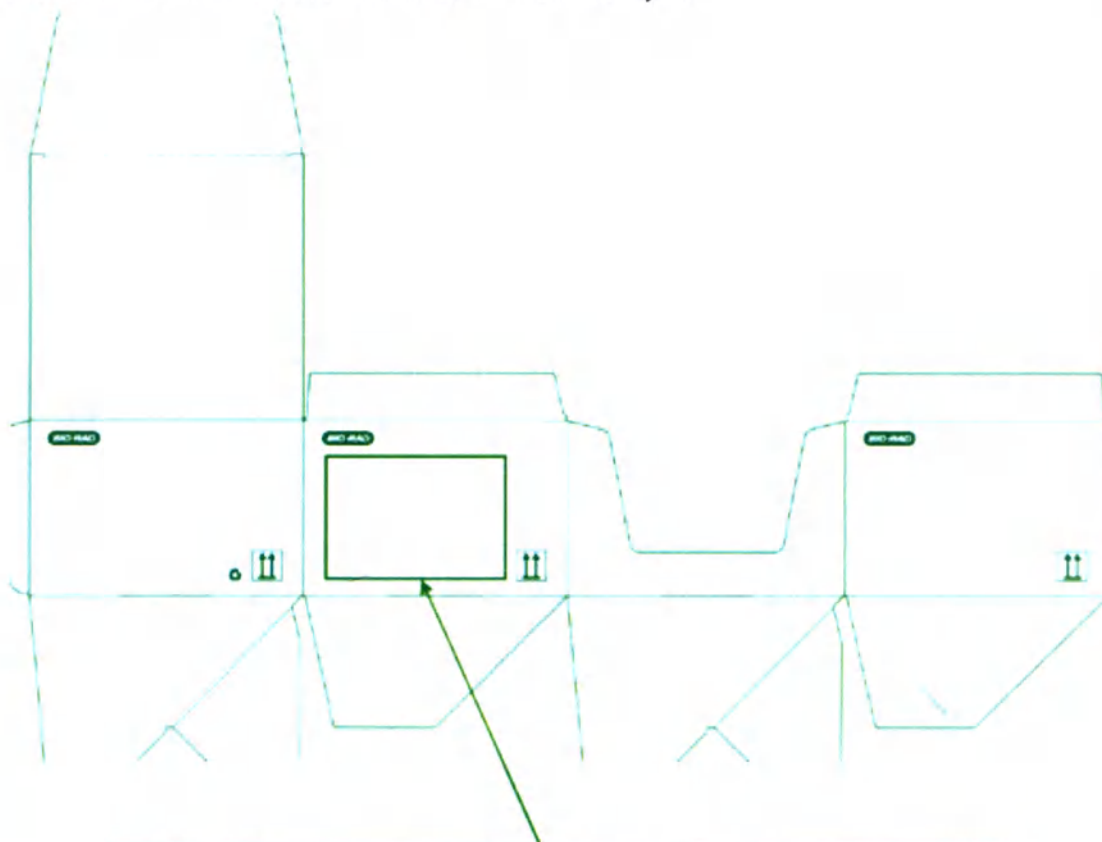

BIO-RAD

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.

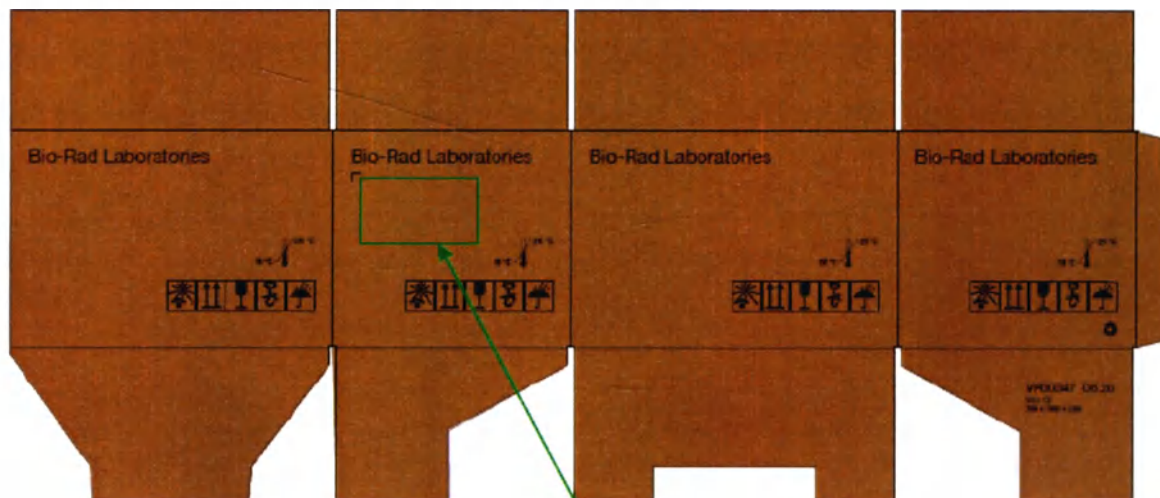

E001030

REF 001030**ID-Cards 24 x 12****DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-**

(monoclonal antibodies)

A, B, AB, DVI-, cti, DAT

**B001027**

downloads bio-rad.com



t + 800 135 79 135

LOT 50071 29 08
465442 29 08
 2021-01-31

(01)07611969009893(17)210131(10)4654422908


E001030
05 21**IVD**

18 °C 25 °C

DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland**CE**
0123**BIO-RAD**

BIO-RAD

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.

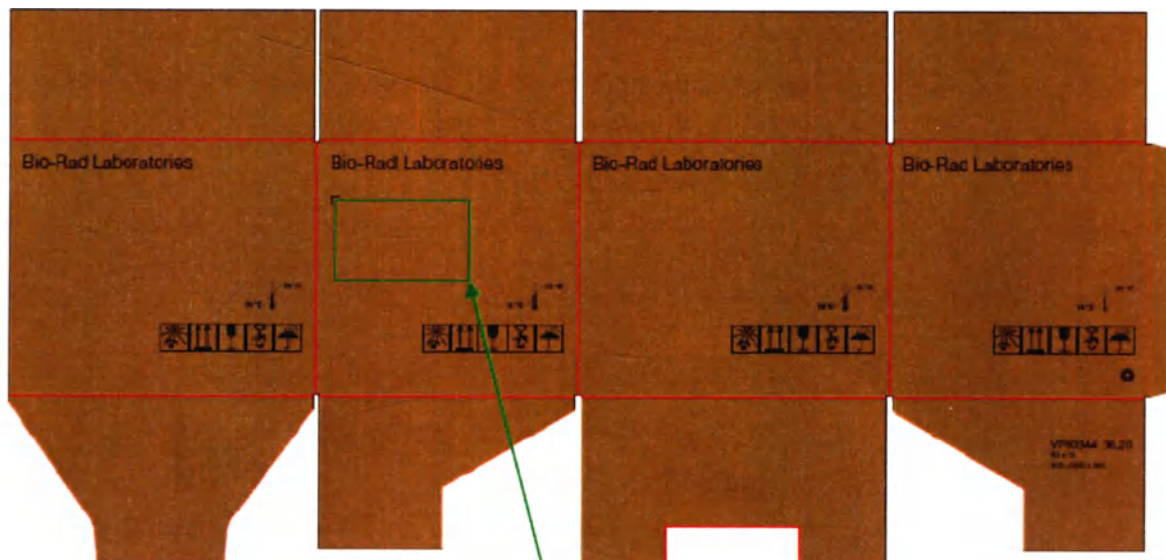**E001028****REF** 001028**ID-Cards 60 x 12****DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-**

(monoclonal antibodies)

A, B, AB, DVI-, cti, DAT

**B001027**

downloads bio-rad.com



+ 800 135 79 135

LOT 50071 29 06
465402 29 06

2021-01-31




(01)07611969000111(17)210131(10)4654022906

E001028
05 21

18 °C 25 °C

DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland**CE**
0123**BIO-RAD**

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 112 × 12 мм./1 уп.

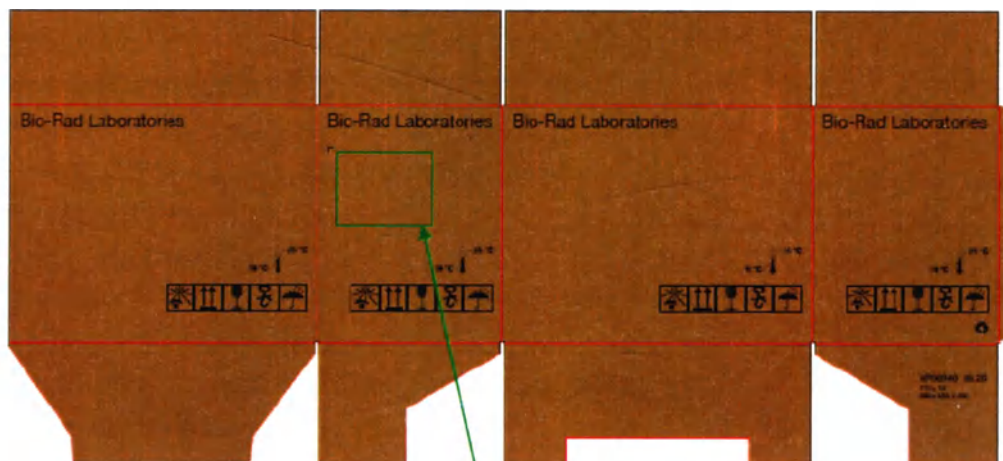

E001029

REF 001029 **ID-Cards 112 x 12**

DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-
(monoclonal antibodies)
A, B, AB, DVI-, ctl, DAT

 **B001027**
downloads.bio-rad.com
 +800 135 79 135

LOT 50071 29 08
465418 29 08
2021-01-31




(01)07611969000128(17)210131(10)4654182908

E001029
05.21 **IVD** 18 °C 25 °C

 DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

CE
0123

BIO-RAD

Примечание: Цвет нанесения текста маркировки и его расположение на первичной и вторичной упаковках может отличаться от партии к партии при неизменности самого текста. Данные отличия не влияют на качество, безопасность и эффективность медицинского изделия.

Маркировка каждой коробки может содержать следующую информацию:

- наименование, адрес и логотип производителя;
- наименование медицинского изделия;
- номер по каталогу;
- моноклональные антитела;
- сыворотки, содержащие Анти-А и Анти-В антитела: A, B, AB, DVI-, ctl, DAT;
- символ «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- условия хранения - символ «Предел температуры»;

- маркировка соответствия требованиям СЕ;
- код партии;
- штрих-код;
- двумерный матричный штрих-код;
- срок годности - символ «Использовать до»;
- количество штук ID-карт в упаковке (в зависимости от варианта исполнения);
- символ «Осторожно!»
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»;
- символ «Хрупкое, обращаться осторожно»;
- символ «Крюками не брать»;
- символ «Верх»;
- символ «Упаковка пригодна для вторичной переработки»;
- символ «Беречь от влаги»;
- сайт для скачивания инструкции по применению;
- версия инструкции по применению;
- контактный телефон.

Макет маркировки на русском языке для обращения на территории Российской Федерации**REF 001027****IVD**

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.comwww.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

REF 001030**IVD**

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.comwww.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

REF 001028**IVD**

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

REF 001029**IVD**

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 112 × 12 шт./1 уп

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 10 листа «08»



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, варианты исполнения

производства

DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ», Швейцария

2022




Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.



Общий вид ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.



Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.

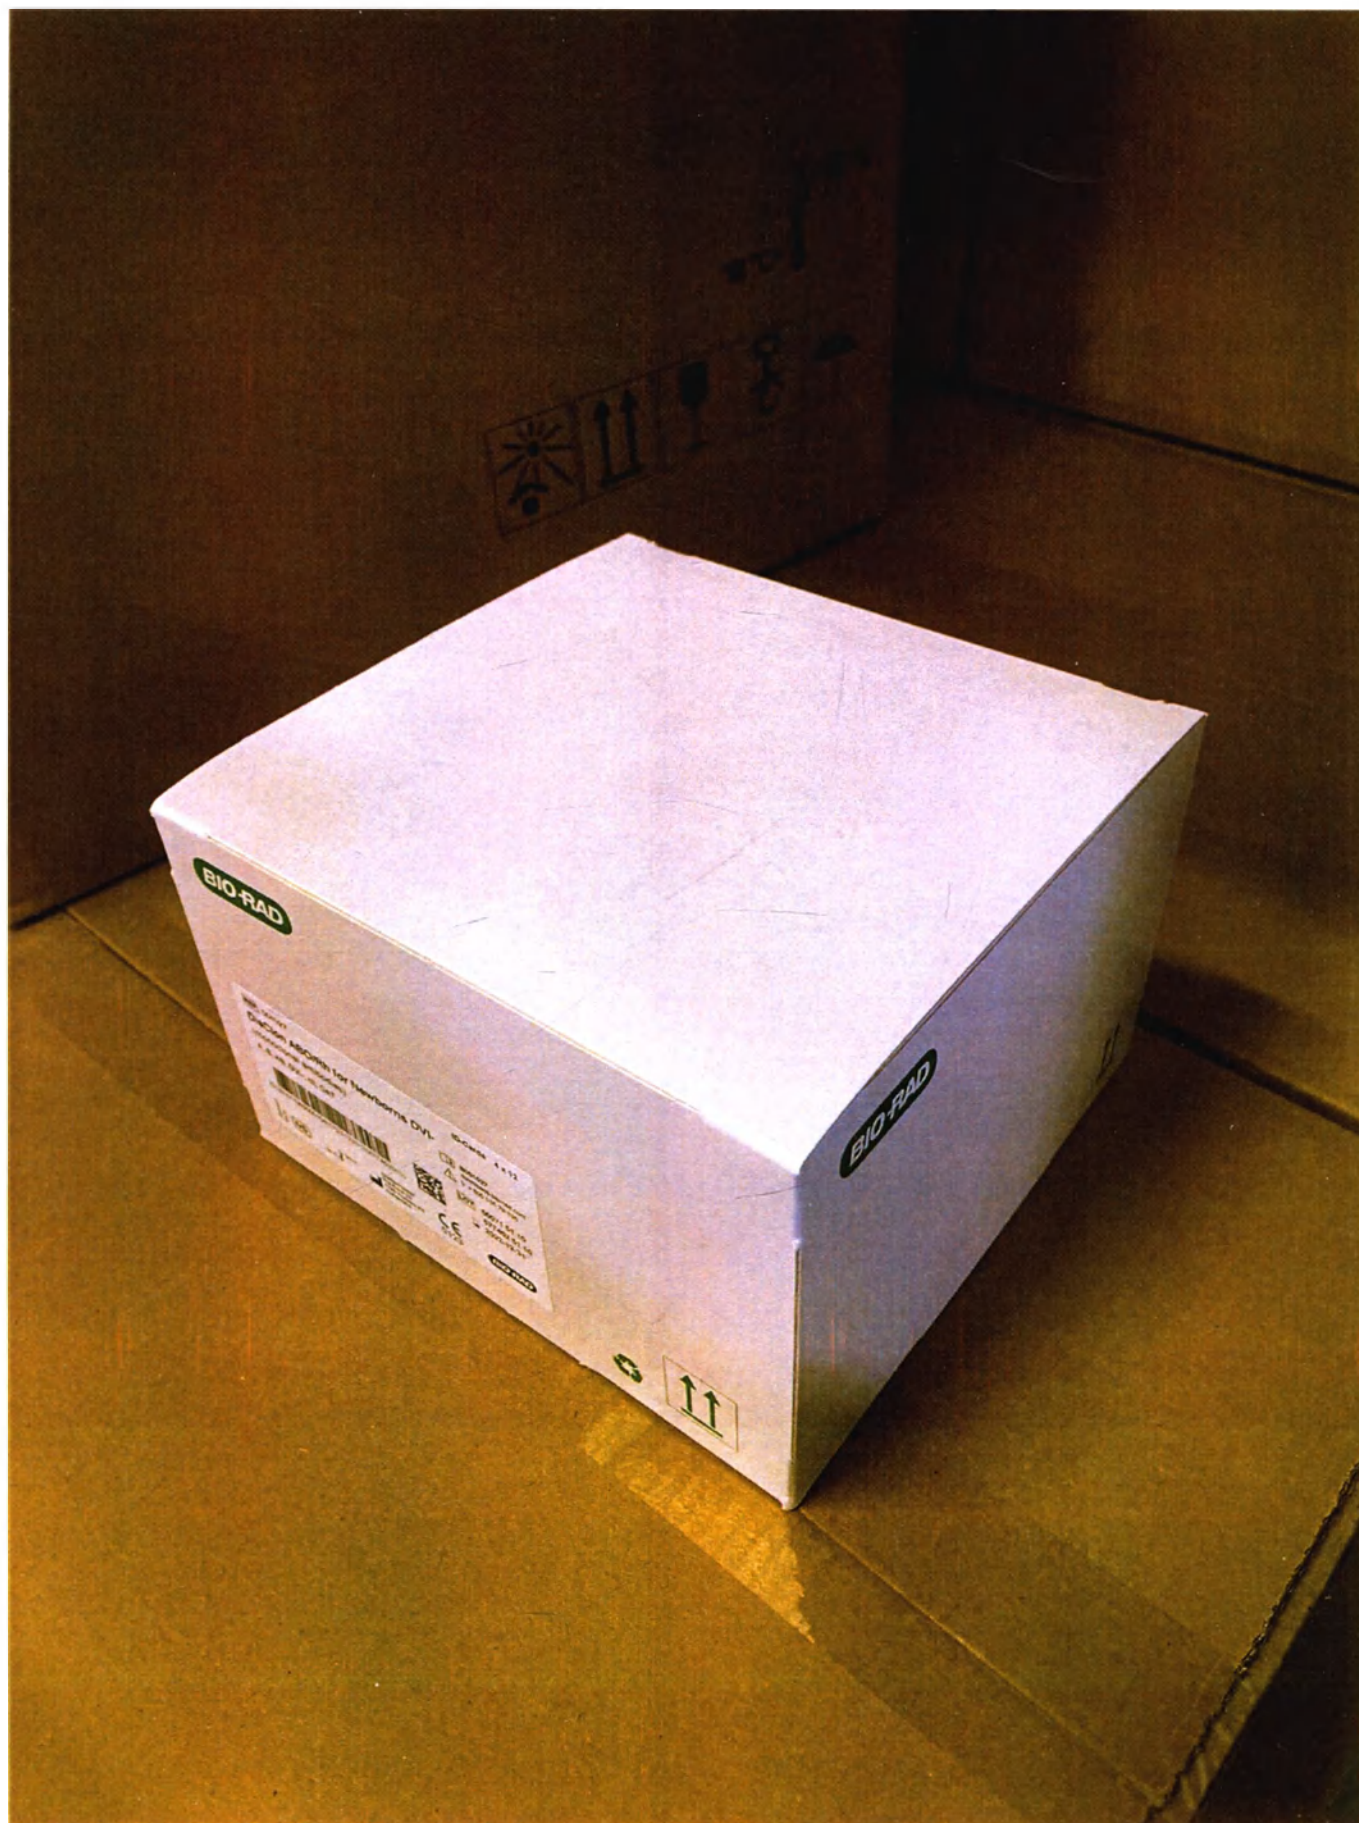

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.

BIO-RAD

REF 001027

DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-

(monoclonal antibodies)

A, B, AB, DVI-, cti, DAT

ID-Cards 4 x 12



B001027

downloads.bio-rad.com



+ 800 135 79 135



(01)07611969000104(17)230331(10)7032725413



LOT

50071 54 13

703272 54 13

2023-03-31



E001027
05.21

IVD

18 °C / 25 °C



DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

CE 0123

BIO-RAD



Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.




Общий вид ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.



Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.



Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.

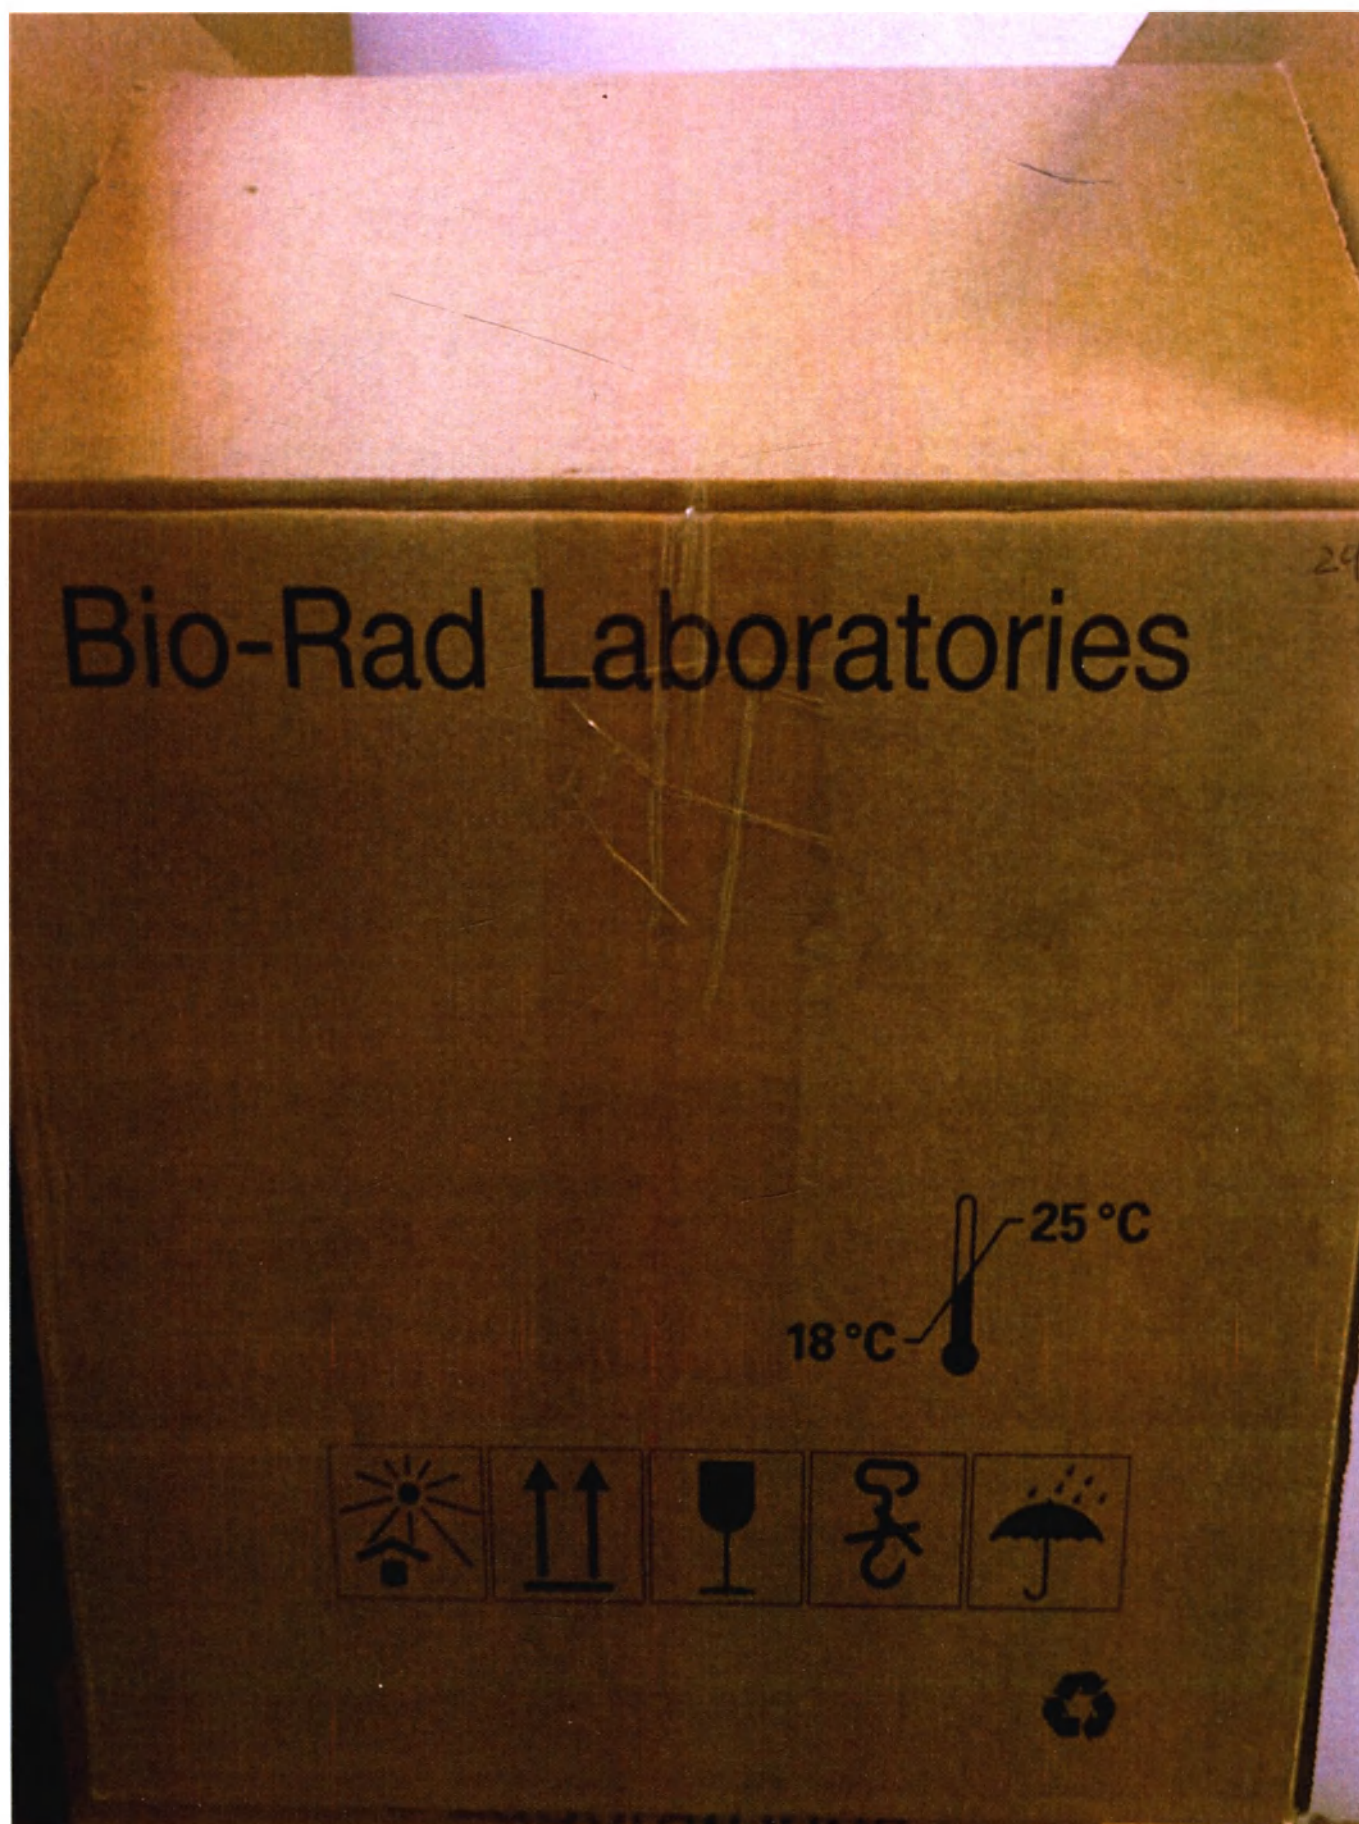

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.

Bio-Rad Labo

REF 001030

ID-Cards 24 x 12

DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-

(monoclonal antibodies)

A, B, AB, DVI-, cti, DAT

 B001027

downloads.bio-rad.com



+ 800 135 79 135

LOT 50071 53 32

716497 53 32

 2023-04-30



(01)07611969009893(17)230430(10)7164975332

E001030
05.21



18 °C  25 °C





DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland


CE
0123

BIO-RAD

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.

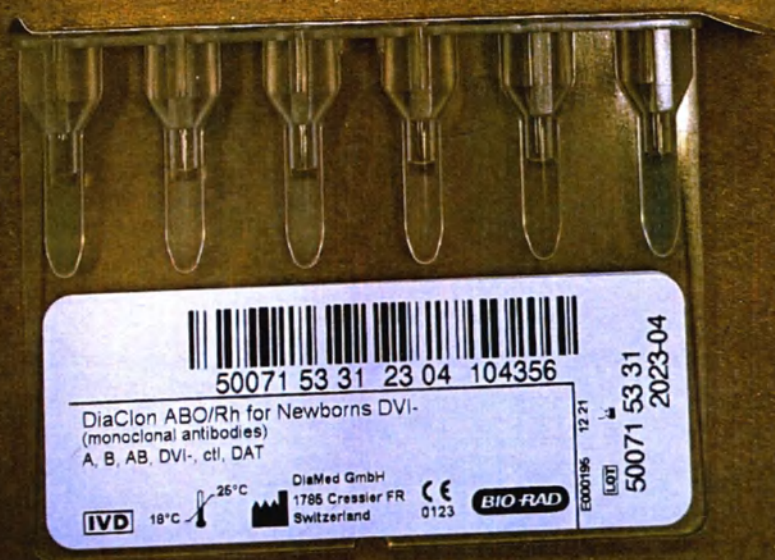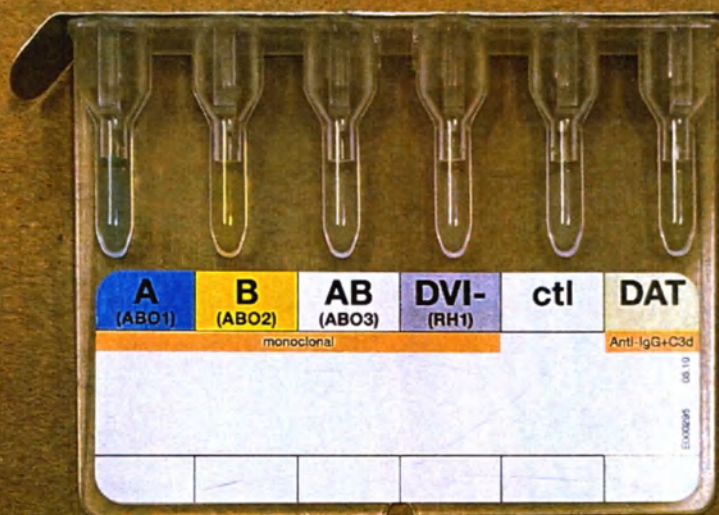


Общий вид ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.

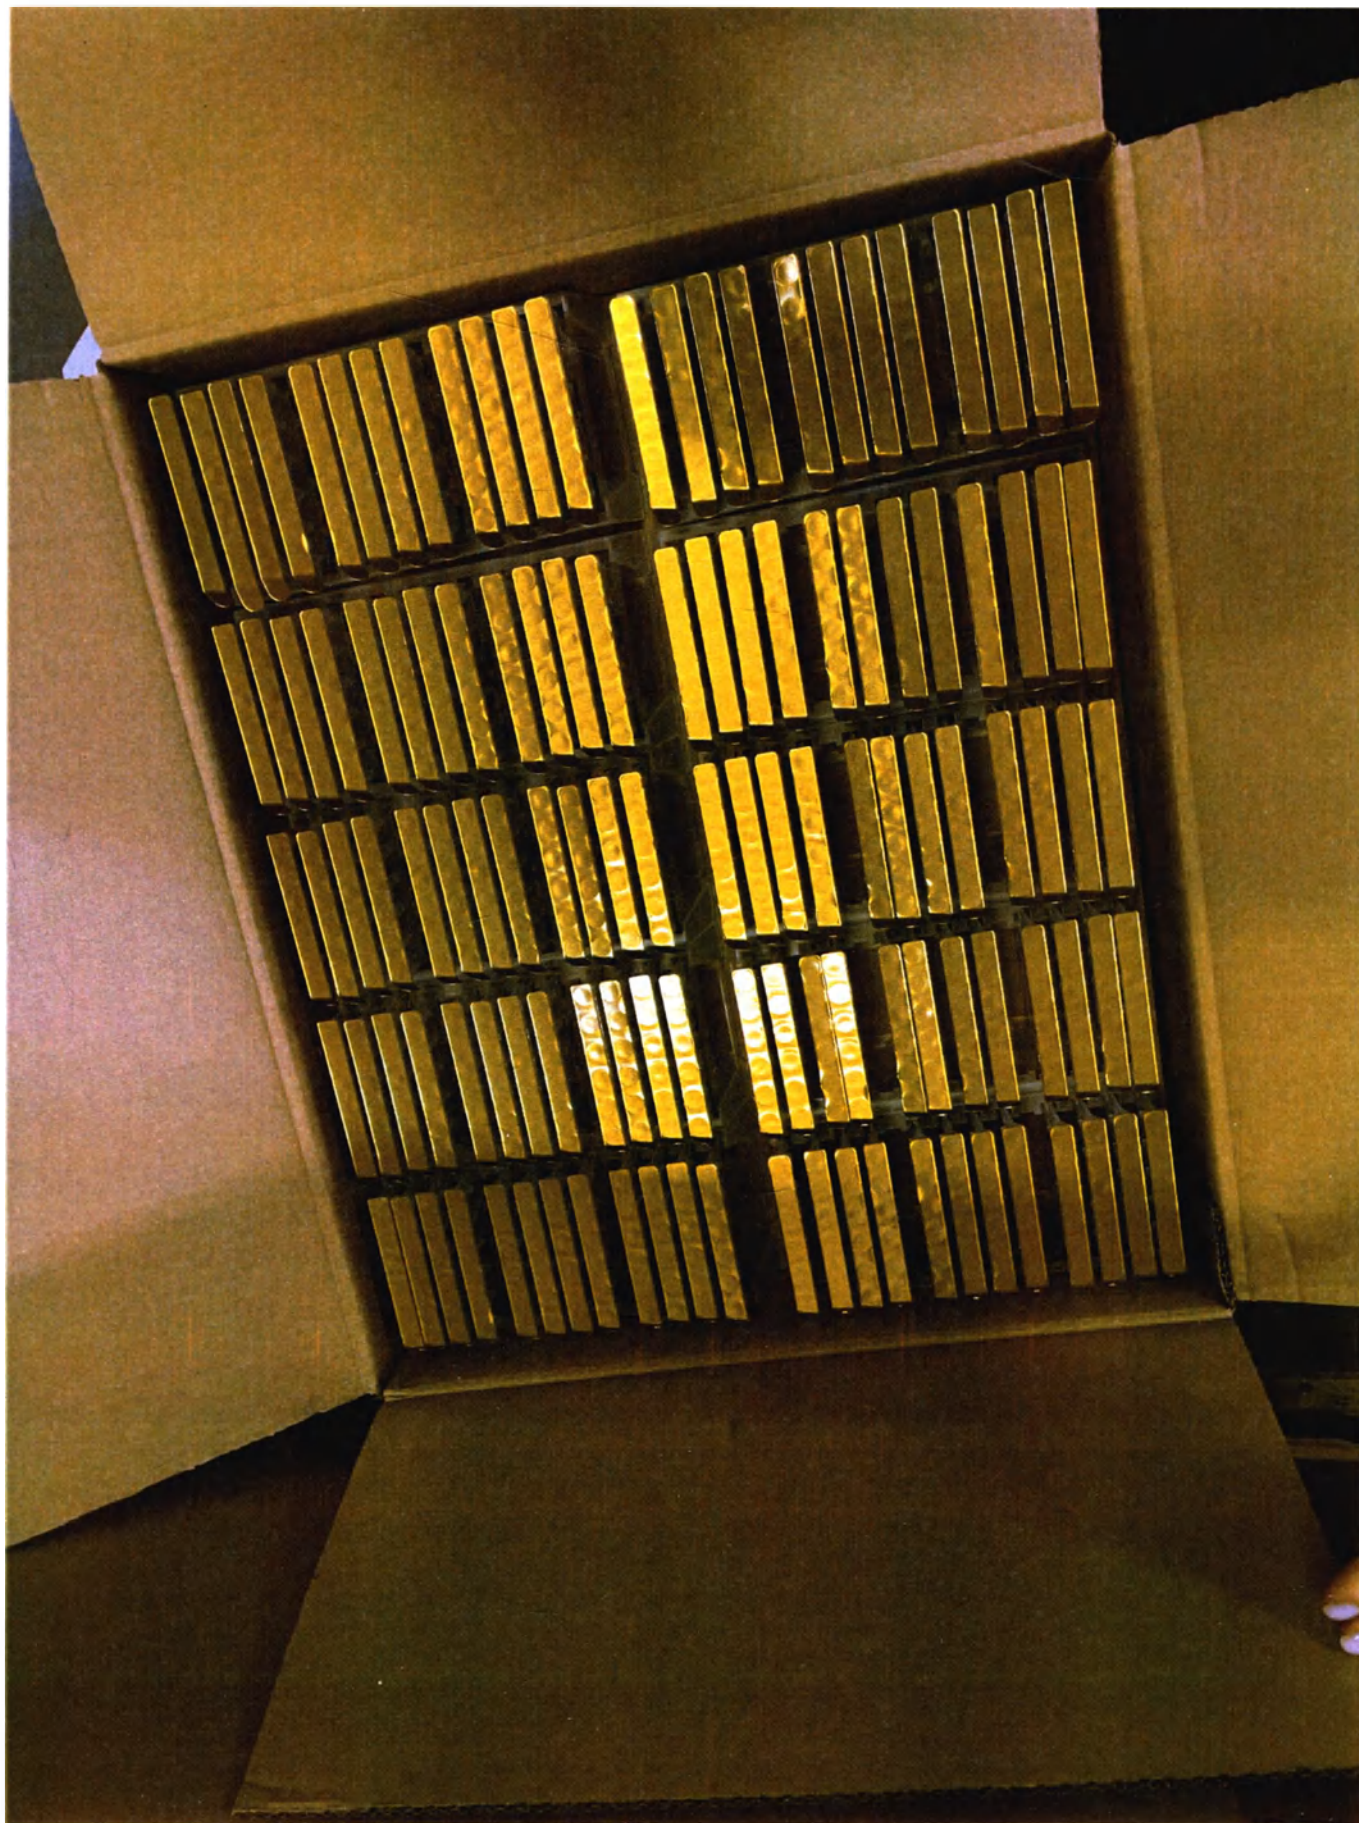


Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.

Bio-Rad Laboratories

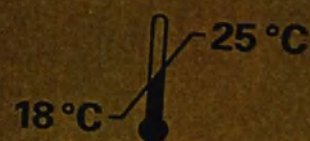


Общий вид коробки «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.

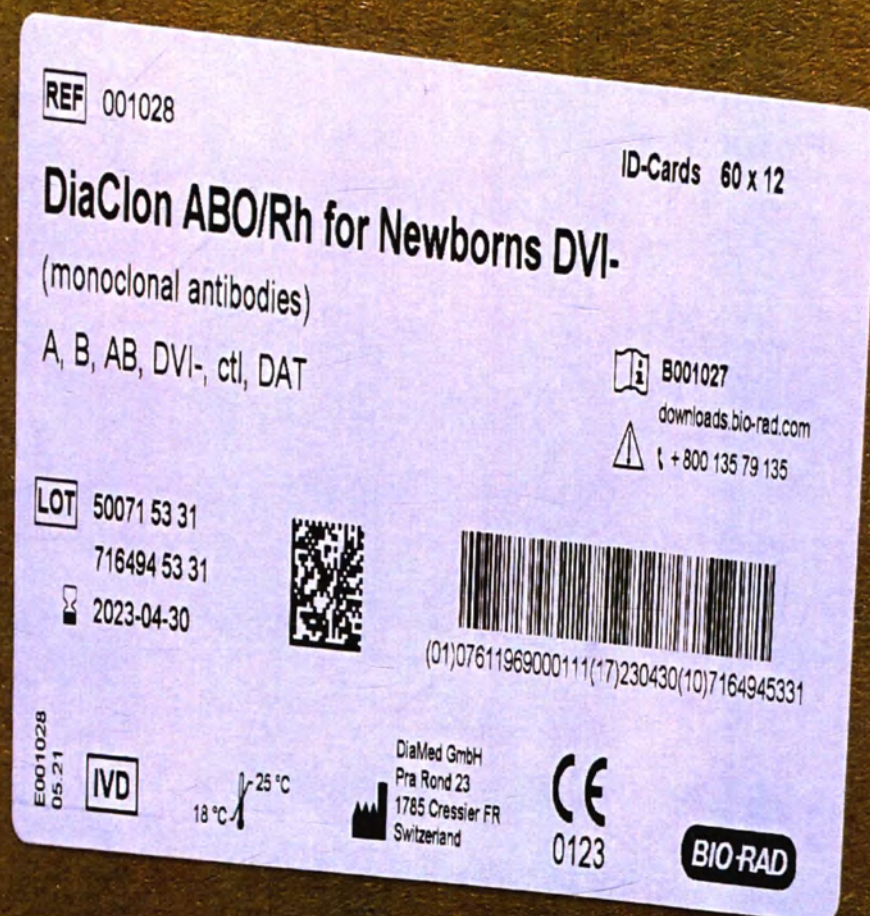

Общий вид коробки «ДиаКлон АВО/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе АВО/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.



Общий вид коробки «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.

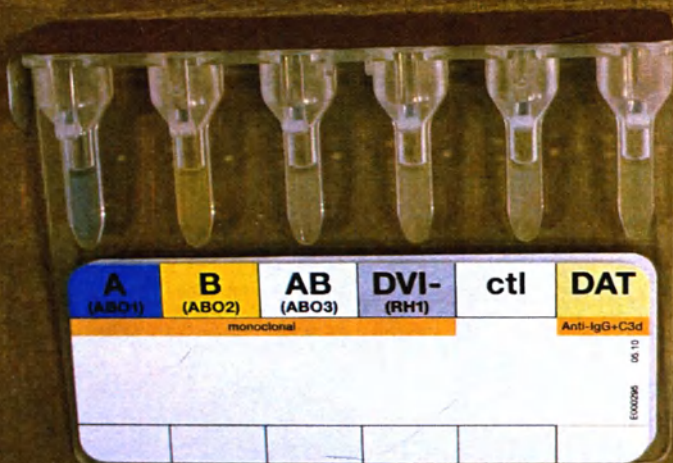

Общий вид ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 112 × 12 шт./1 уп.




Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 112 × 12 шт./1 уп.



Общий вид ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 112 × 12 шт./1 уп.

Bio-Rad Laboratories

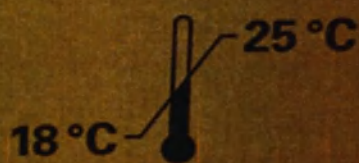

Общий вид ID-карты «ДиаКлон ABO/Rh для новорожденных DVI-» (DiaClon ABO/Rh for Newborns DVI-) для определения групп крови по системе ABO/Rh в сочетании с прямым антиглобулиновым тестом (DAT) у новорожденных для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 112 × 12 шт./1 уп.

