

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«11» мая 2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

Реагент лизирующий (Hematology Analyzer Lyse / L1) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики in vitro

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
(«Шэньчжэнь Дайминд Биотекнолоджи Ко., Лтд.»), Китай




Instruction for use


Lysing reagent (Hematology Analyzer Lyse / L1) for quantitative determination of parameters of blood cells in a clinical sample on 3-Diff and 5-Diff automatic hematology analyzers for in vitro diagnostics

Инструкция по применению

Реагент лизирующий (Hematology Analyzer Lyse / L1) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики in vitro

Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.,
("Шэньчжэнь Дайминд Биотехнологии Ко., Лтд."), Китай



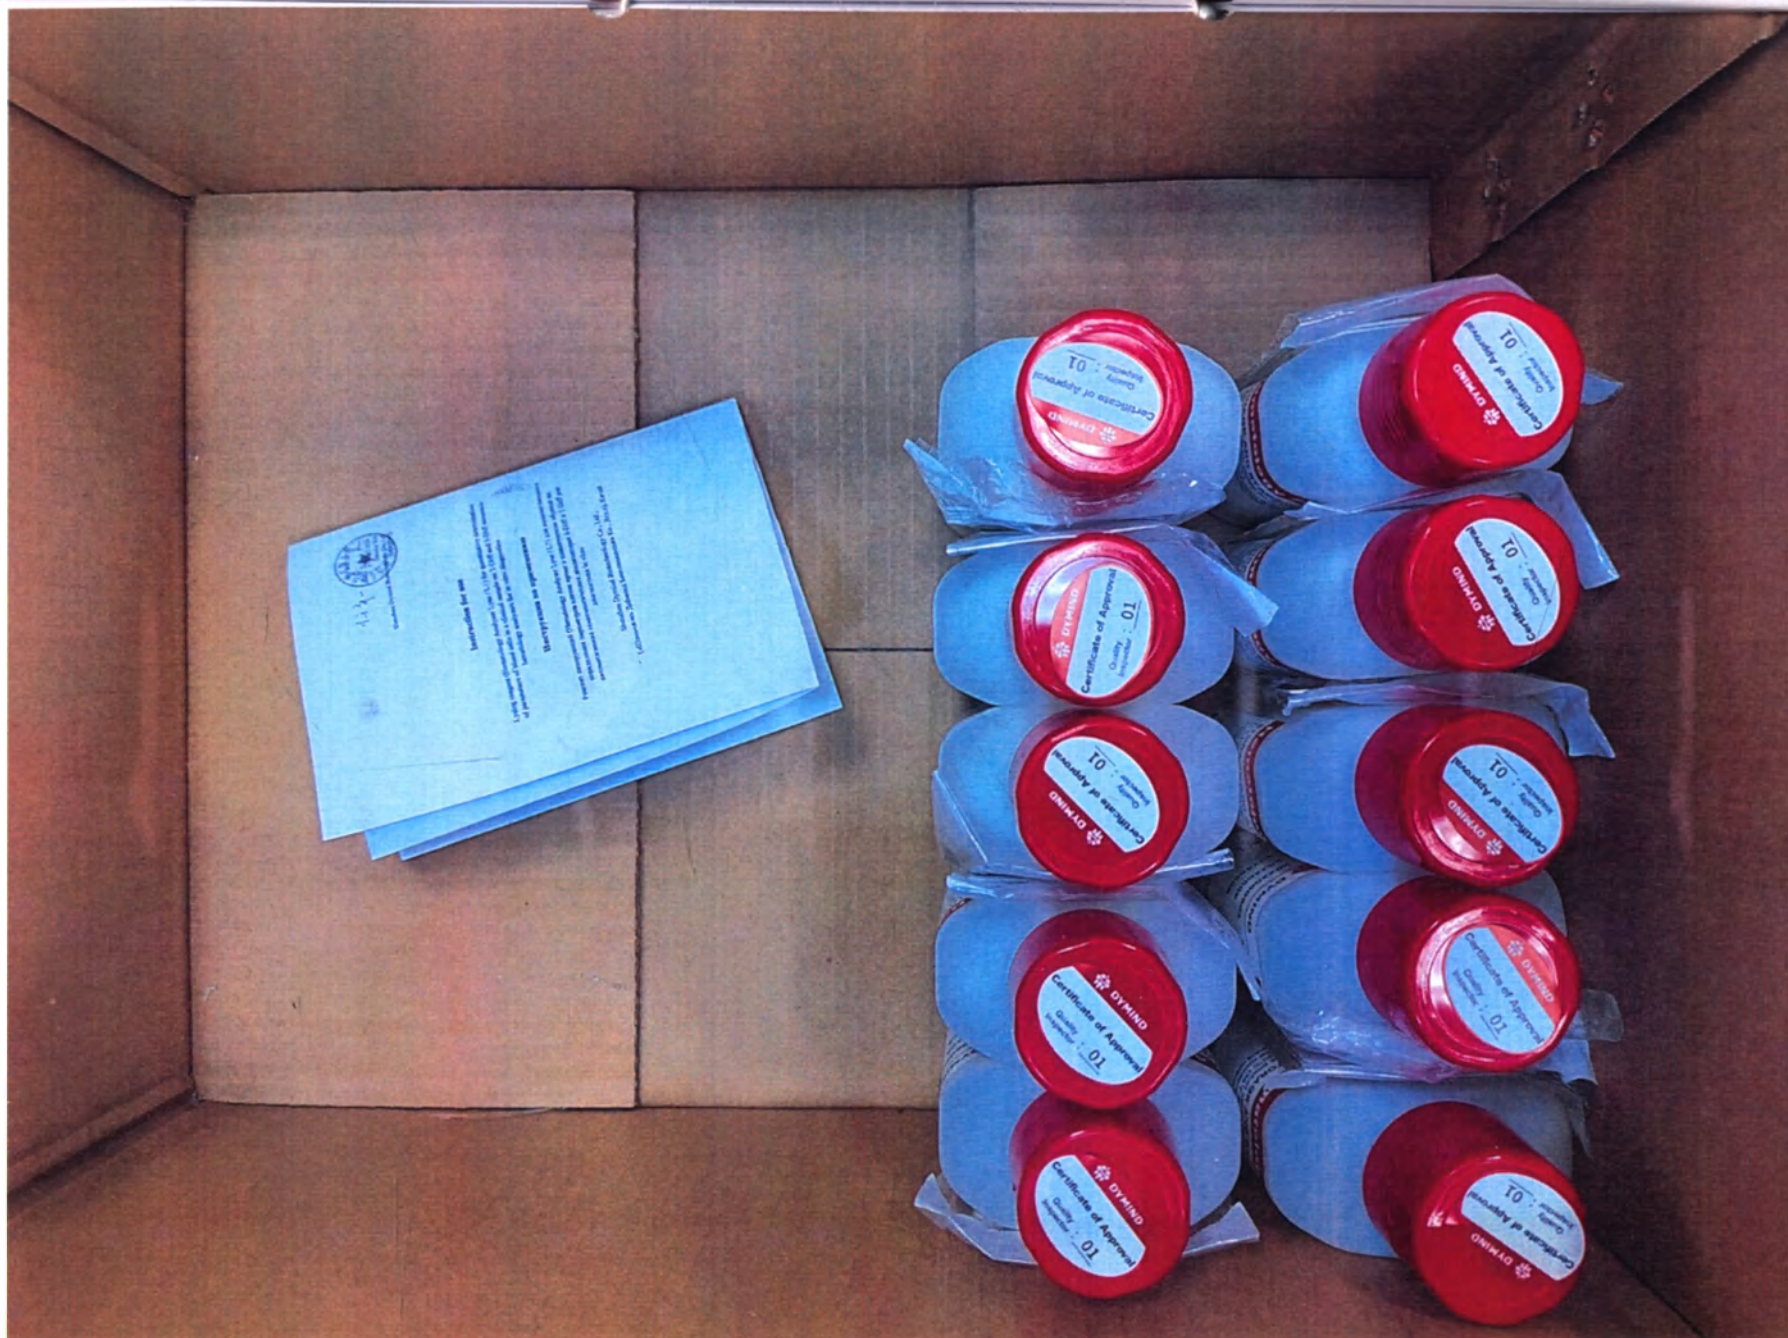

Общий вид медицинского изделия (Реагент лизирующий (Hematology Analyzer Lyse / L1) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на автоматических гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×135 мл)



Immunology Analyzer Lyse


AGE AND STABILITY:


Product will be stable for 2 years when stored at 2°C
(35°F to 86°F)
Operating environment is 15°C to 30°C (59°F to 86°F),
opened container after 60 days.

LOT



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany
Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road,
Jianliao Community, Yutang Street, Guangming District,
Shenzhen 518107, P. R. China






Реагент лизирующий (L1) (Реагент лизирующий (Hematology Analyzer Lyse / L1) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом образце на

их гематологических анализаторах 3-Diff и 5-Diff для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×135 мл)



Hematology Analyzer Lyse



List	Model	Specification	LOT	Production date	Expiry date	PCS
	L1	135mL	2022060901	09.06.2022	08.06.2024	11
	L1	135mL	2022060902	09.06.2022	08.06.2024	13



Made in China



Eunitor GmbH
Kennedydamm 5, 40476 Duesseldorf, Germany



Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd.
10th Floor, Building B, High-tech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street,
Guangming District, Shenzhen 518107, P.R.China

Потребительская (транспортная) упаковка (Реагент лизирующий (Hematology Analyzer Lyse / L1) для количественного определения параметров клеток крови в клиническом

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 8 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАЙЛО Р. В.

