

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/clabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/clabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп, 80 шт/уп.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педальнические, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см – конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педальнические с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см – конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп, 40 шт/уп

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см - конфигурации : 5шт/уп, 20 шт/уп

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 100 см - конфигурация : 5шт/уп, 20 шт/уп

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, варианты
исполнения

Boston Scientific

Radial Jaw™ 4
LARGE CAPACITY WITH NEEDLE

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de um só uso, Pince à biopsie à usage unique, Einmalgerät für den einmaligen Gebrauch, Pinza de biopsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Aóðíða Biopsíók, náczyfőrcs, Pinça de Biopsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyzerhasználatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické kliešťe, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forcepsli

With Endo-Glide™ Sheath



Contents (1)

GTIN	08714729745501	LOT	29505193
REF	MO0513310	Use By	2025-05-30

STERILE Sterilized using irradiation.

90402821-03

Internal BSC Bar Code

90543613-01G

CE 2797

Made in COSTA RICA
 2546 First Street
 Propark
 El Coyal, Alajuela COSTA RICA

Boston Scientific
 Radial Jaw™ 4
 2.8mm
 GTIN 08714729745501
 REF M00513310
 LOT 29505193


Boston Scientific
 Radial Jaw™ 4
 2.8mm
 GTIN 08714729745501
 REF M00513310
 LOT 29505193




(01)08714729745501(17)29505193(02)05193 6S1

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете

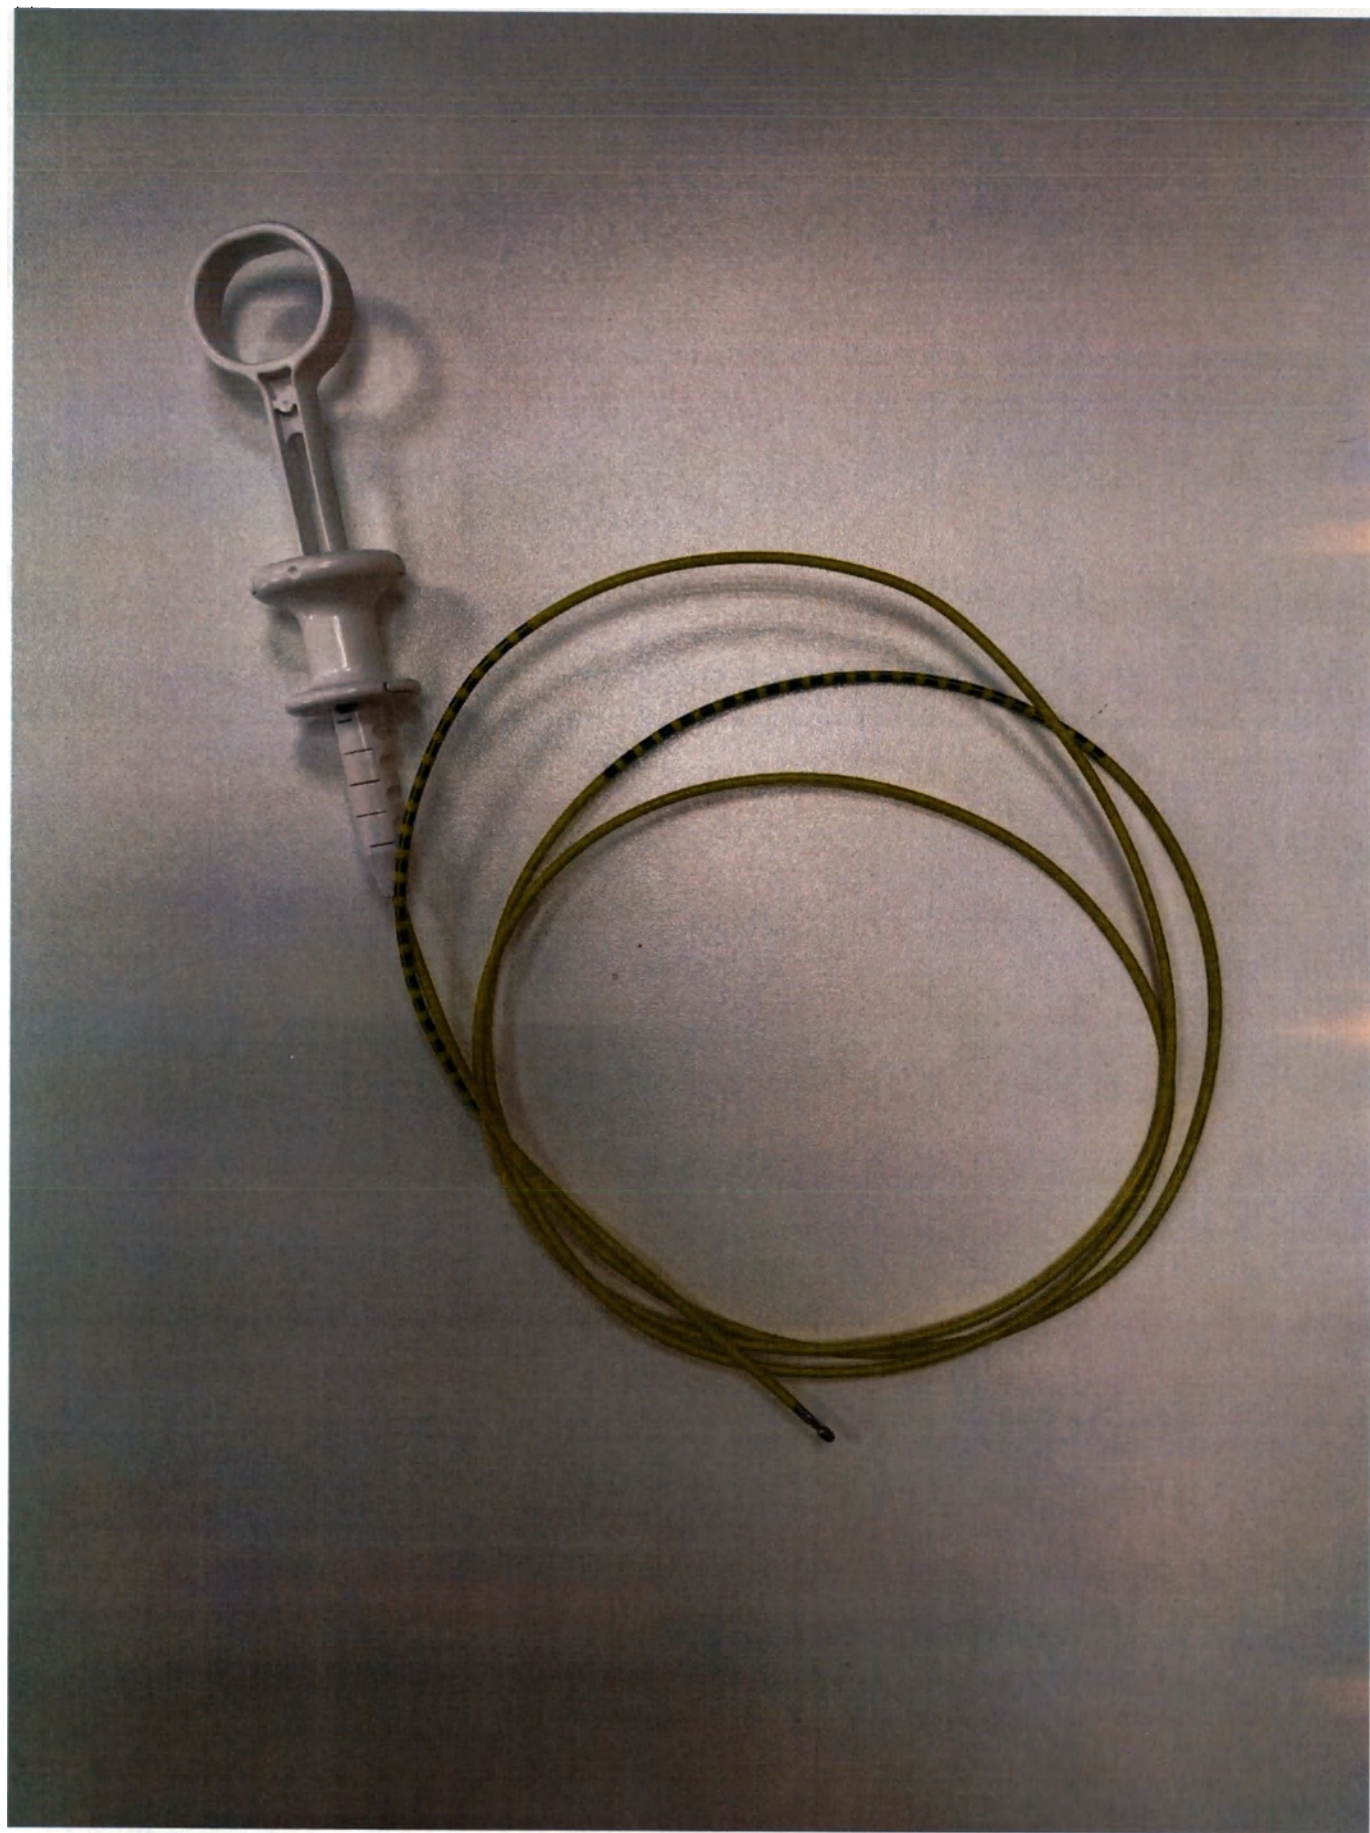

Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см»

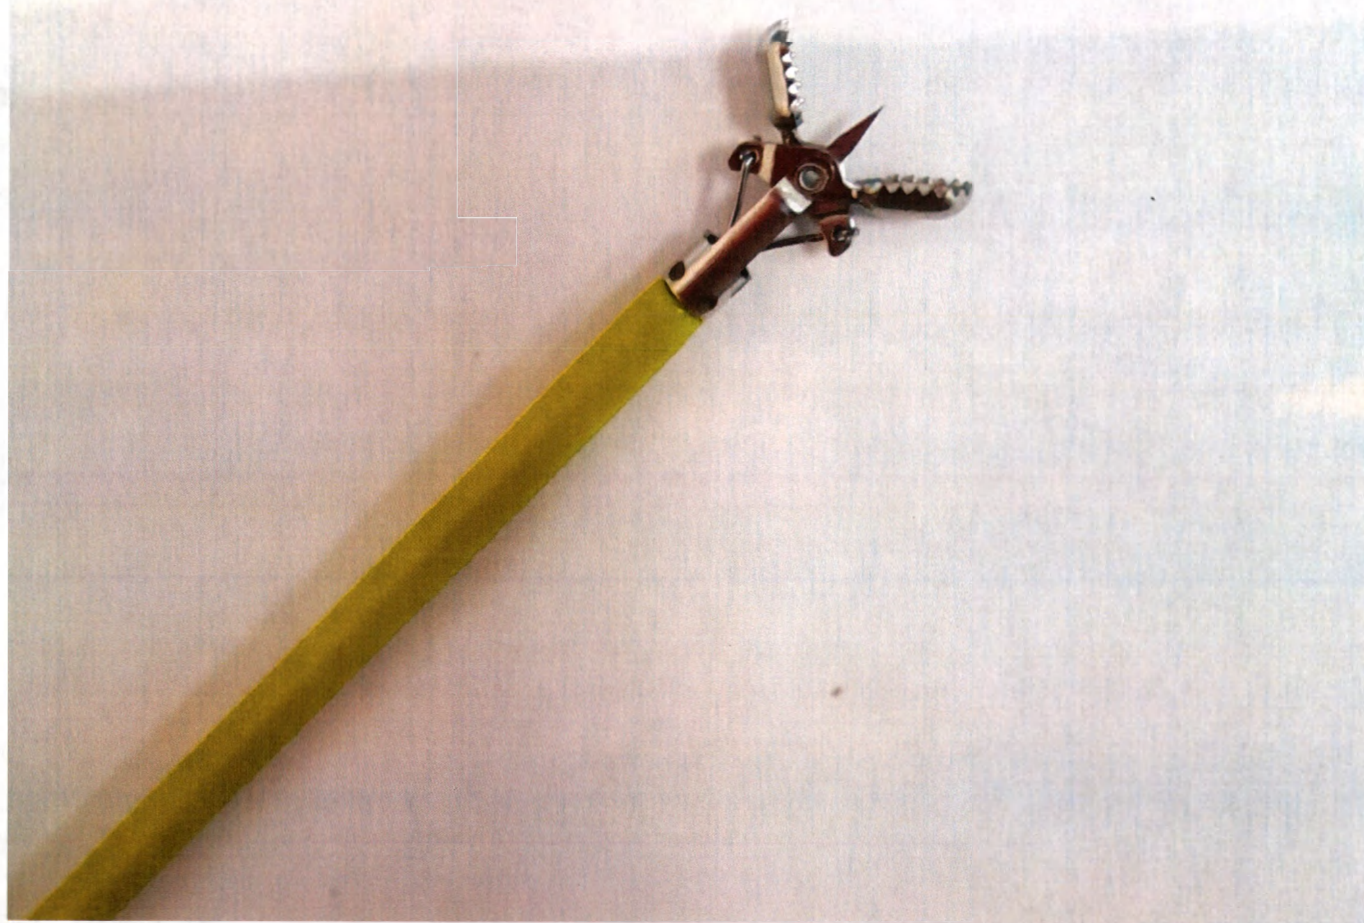

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в открытом состоянии.

**LARGE
2.8mm**

Boston
Scientific


Radial Jaw™ 4

LARGE CAPACITY WITH NEEDLE

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de uso único, Pince à biopsie à usage unique, Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch, Pince de biopsie unique, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsitang til engangsbrug, Αοβίδα βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biopsia para Uma Única Utilização, Biopsieang för engångsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopstické kleště, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbrug, Tek Kullarımık Biyopsi Forceps

 Contents (20)

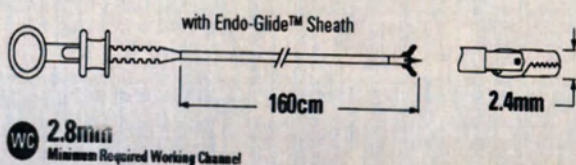

GTIN

08714729648772

LOT

29505193

REF

Usualig kit

M00513311

 Use By

2025-05-30



90701940-01

Internal BSC Bar Code

90706713-030



GS1

(01)08714729648772112505301029505193

CE 2797

Made in COSTA RICA

2546 First Street

Propark

El Coyo, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE

R

Sterilized using
irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» (сторона

1)

Boston
Scientific

STANDARD
2.8mm


Radial Jaw™ 4

STANDARD CAPACITY WITH NEEDLE

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de um só uso, Pinça à biópsia à usage unique, Biopsierange für den einmaligen Gebrauch, Pinça de biópsia monouso, Biopsieping voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsitang til engangsbrug, Λοβίδα βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsieping för engångsbruk, Biopsieping för engångsbruk, Egysezer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické kleště, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsiepmatt til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Çarpıcı

Contents (1)



2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729745679

LOT

29443956

REF

Catalog No.

M00513410

Use By

2025-05-20

STERILE R

Sterilized using
irradiation.



90402821-04

Internal BSC Bar Code

90744607-02E

CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Propark
El Coyol, Alajuela COSTA RICA

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.8mm

GTIN 08714729745679

REF M00513410

LOT 29443956

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.8mm

GTIN 08714729745679

REF M00513410

LOT 29443956



(01)08714729745679(17)25052010129443956


GS1

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см»

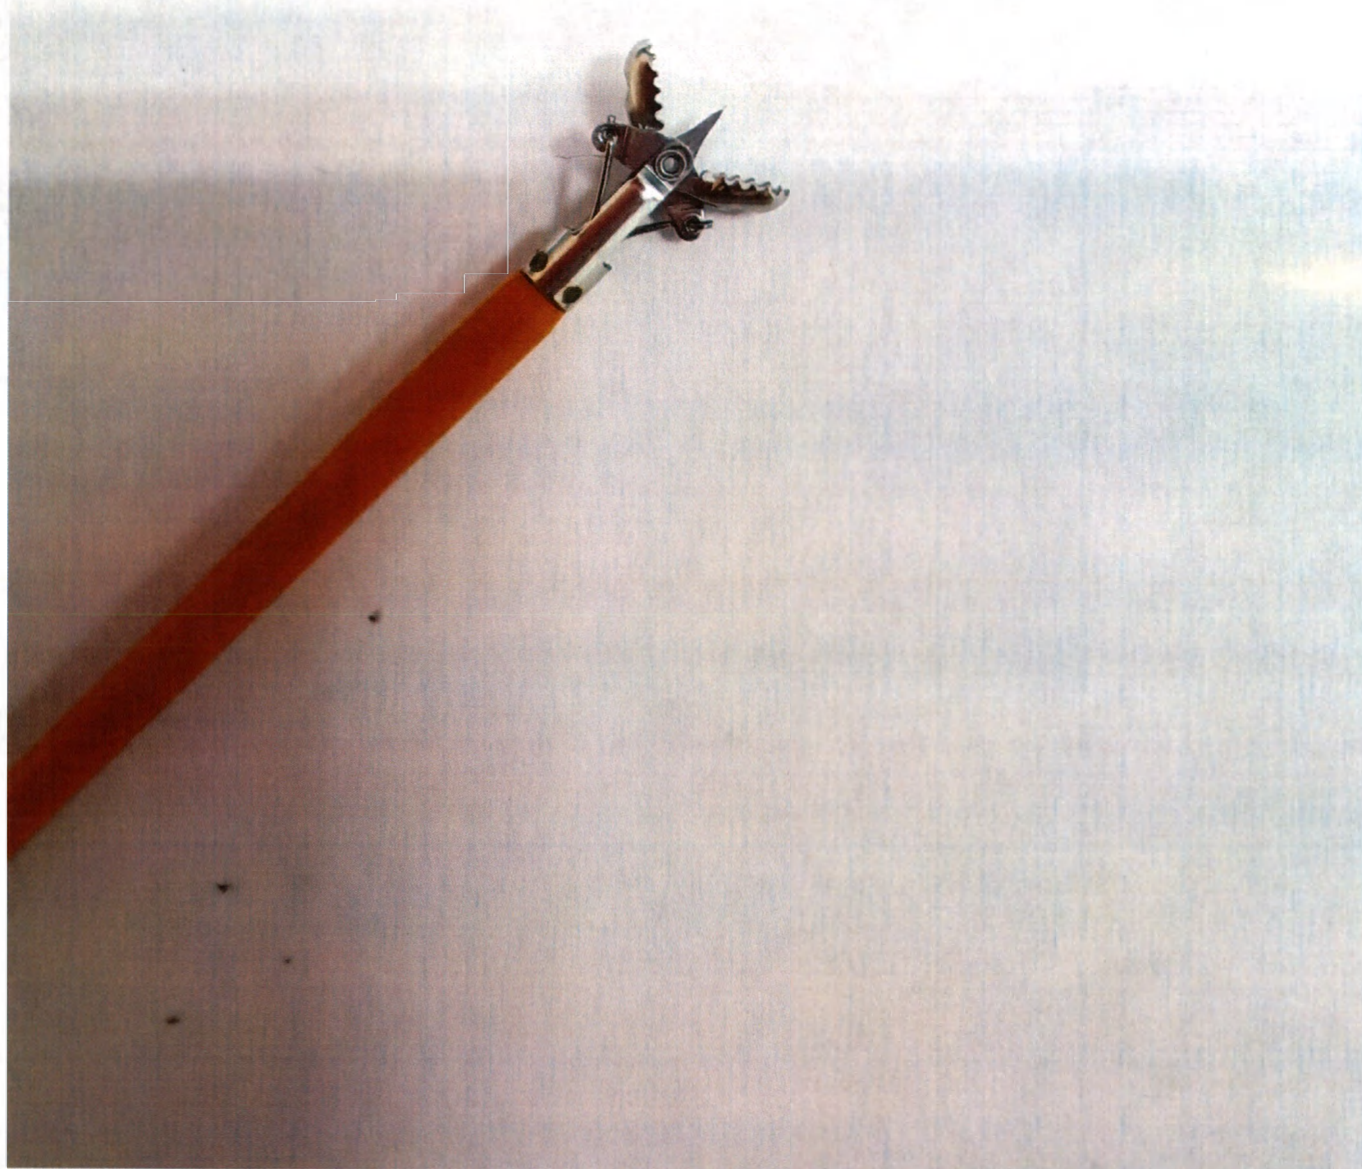

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в открытом состоянии.

STANDARD
2.8mm

Boston
Scientific


Radial Jaw™ 4

STANDARD CAPACITY WITH NEEDLE

Single-Use Biopsy Forceps

Pinzas de biopsia de un solo uso, Pince à biopsie à usage unique, Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch, Pinze da biopsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αφαιδω βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biopsia para Uma Única Utilização, Biopsietang til engangsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické kleště, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forpesi

Contents (20)



WC 2.8mm

Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729777984

LOT

29443956

REF

Catalog No.

M00513411



Use By

2025-05-20



Internal BSC Bar Code



CE 2797

Made in COSTA RICA

2546 First Street

Propark

El Coyo, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.

Patent information can be obtained at

<http://www.bostonscientific.com/patents>


STERILE

R

Sterilized using
irradiation.

Коробка «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» (сторона


1)

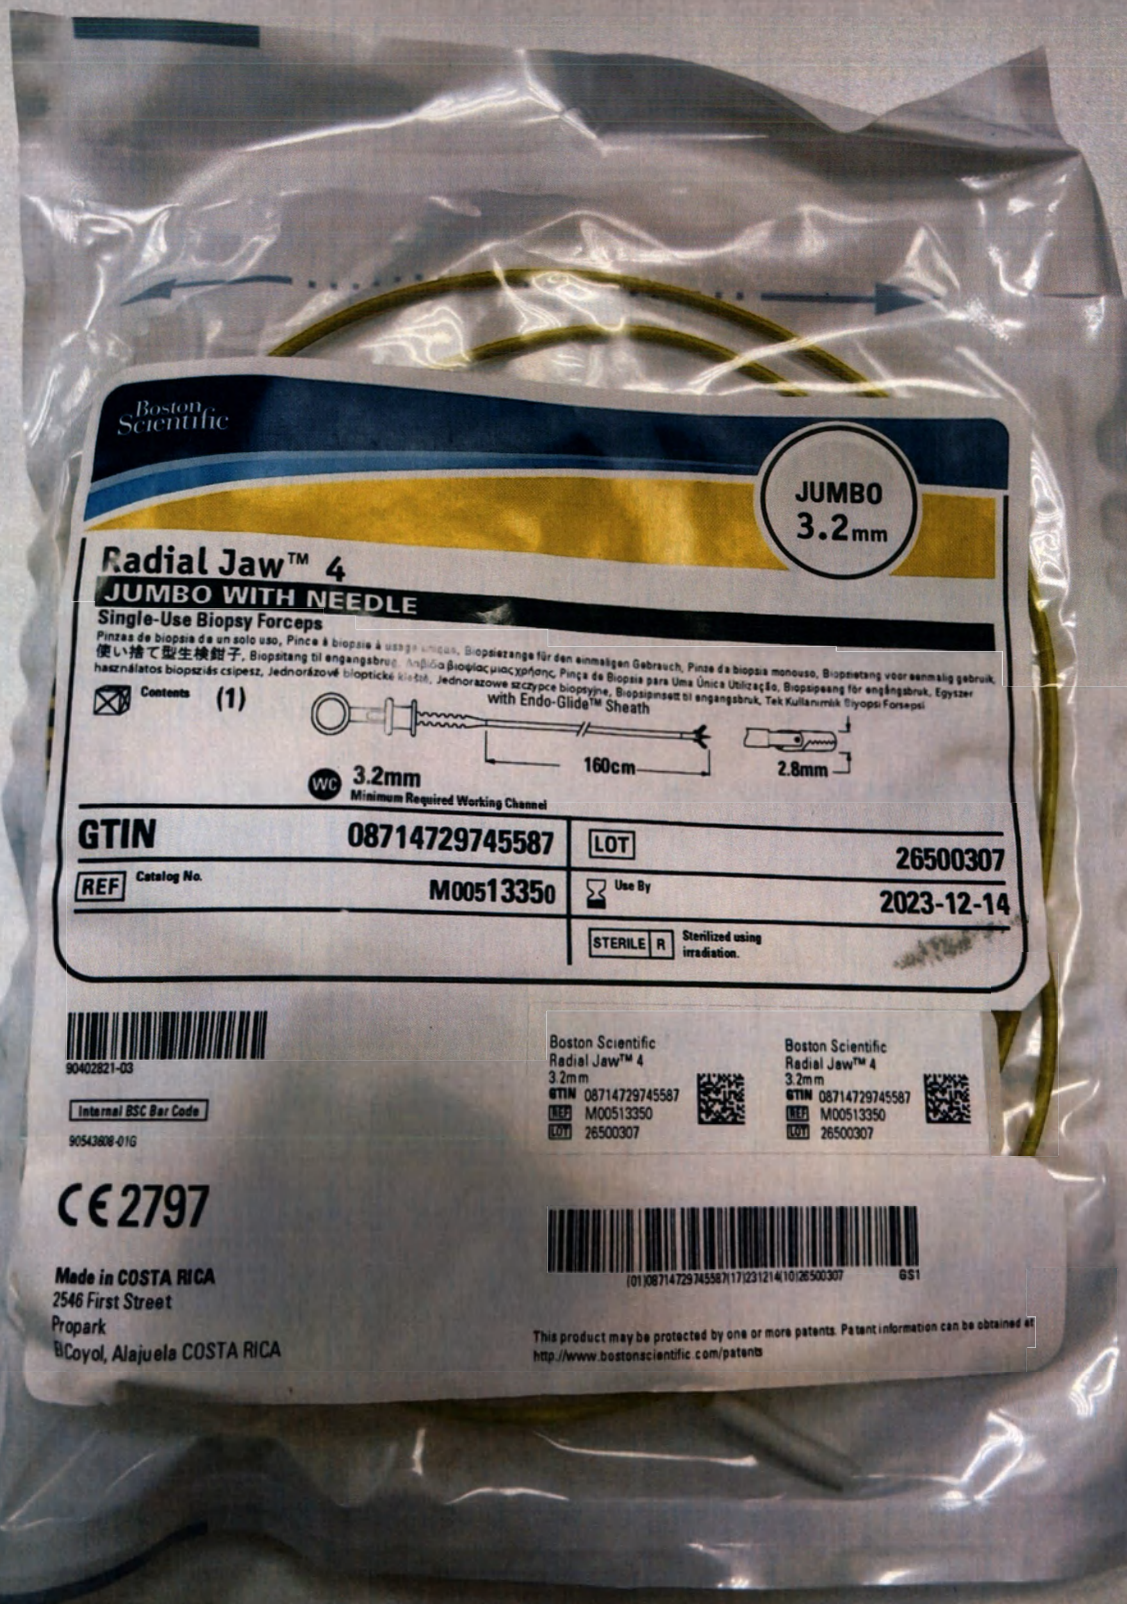

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см»

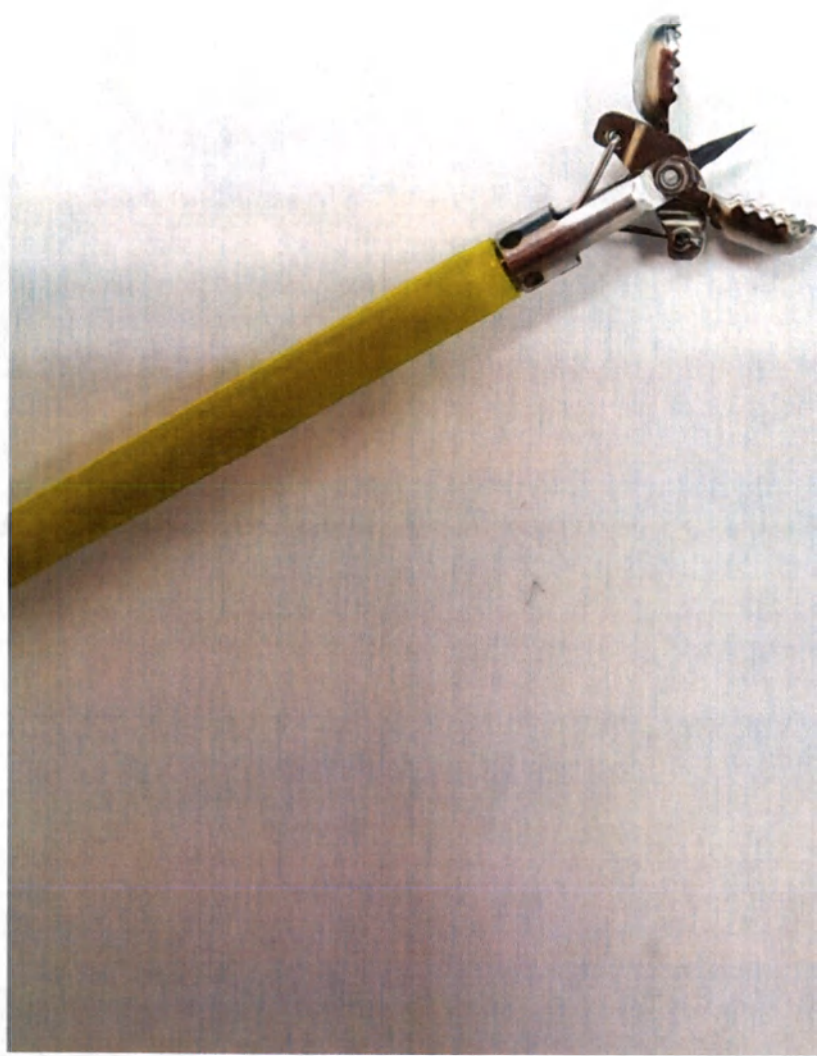

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см» в открытом состоянии.

Boston Scientific

JUMBO 3.2mm

Radial Jaw™ 4

JUMBO

Single-Use Biopsy Forceps

Access to tissue da un solo uso, Pince à biopsie à usage unique, Biopsietange für den einmaligen Gebrauch, Pince de biopsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 一次性活检钳子, Biopsietang til engangsbrug, Aqido biopsiac monocepionc, Pince de Biopsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyszer használatos biopszi csipesz, Jednorazové biopsické kliešťe, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forcepsli

☒ Contents (1)

with Endo-Glide™ Sheath

WC 3.2mm
Minimum Required Working Channel

GTIN	08714729745563	LOT	28328237
REF Catalog No.	M00513340	Use By	2024-11-04
STERILE R		Sterilized using irradiation	



89402821-03

Internal BSC Bar Code

90543808-026

CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Propark
El Coyo, Alajuela COSTA RICA

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
3.2mm

GTIN 08714729745563

REF M00513340

LOT 28328237

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
3.2mm

GTIN 08714729745563

REF M00513340

LOT 28328237




(01)08714729745563(17)241104(10)28328237


GS1

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете

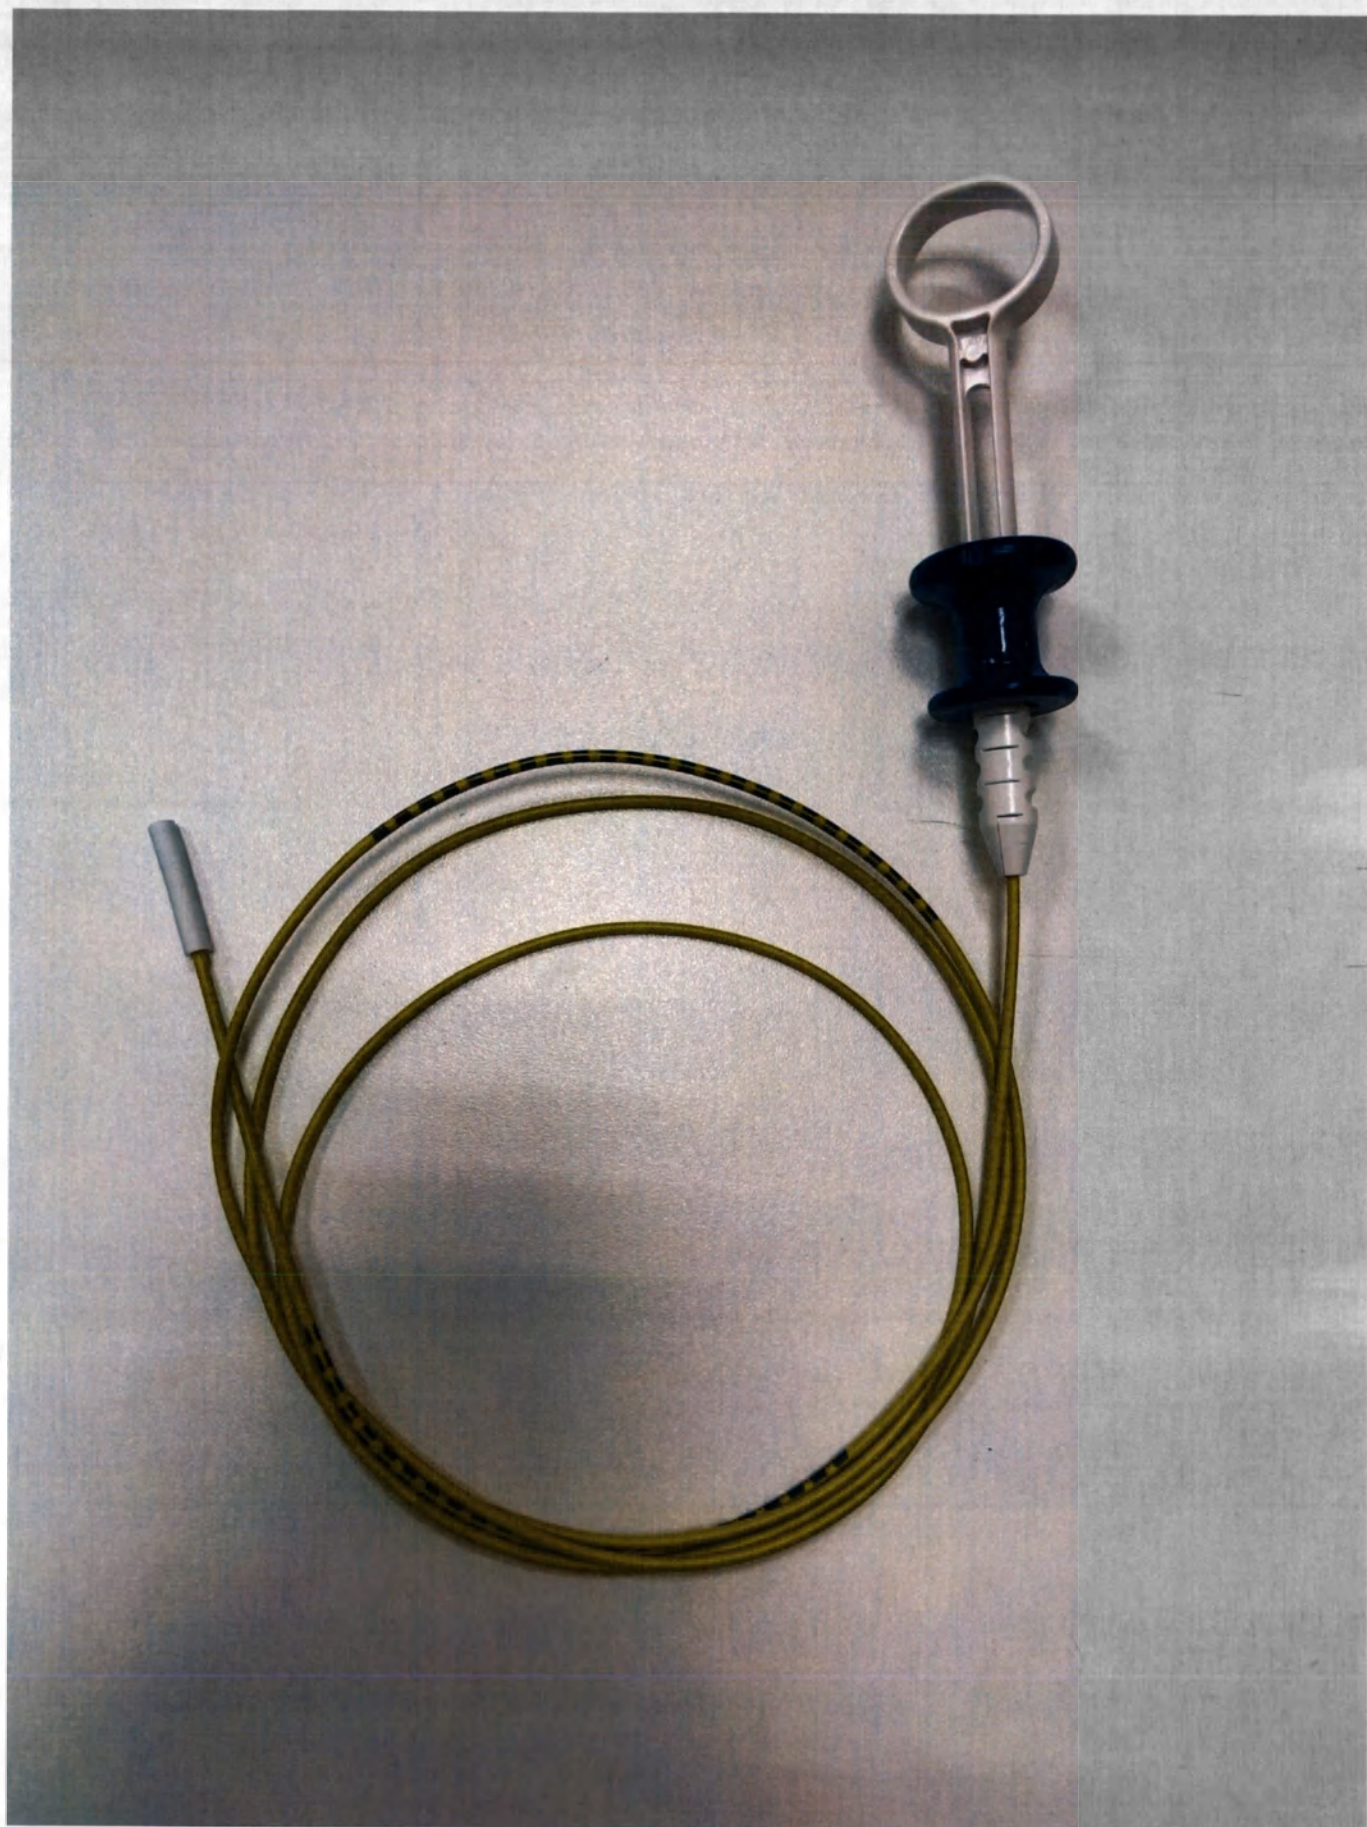

Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см»

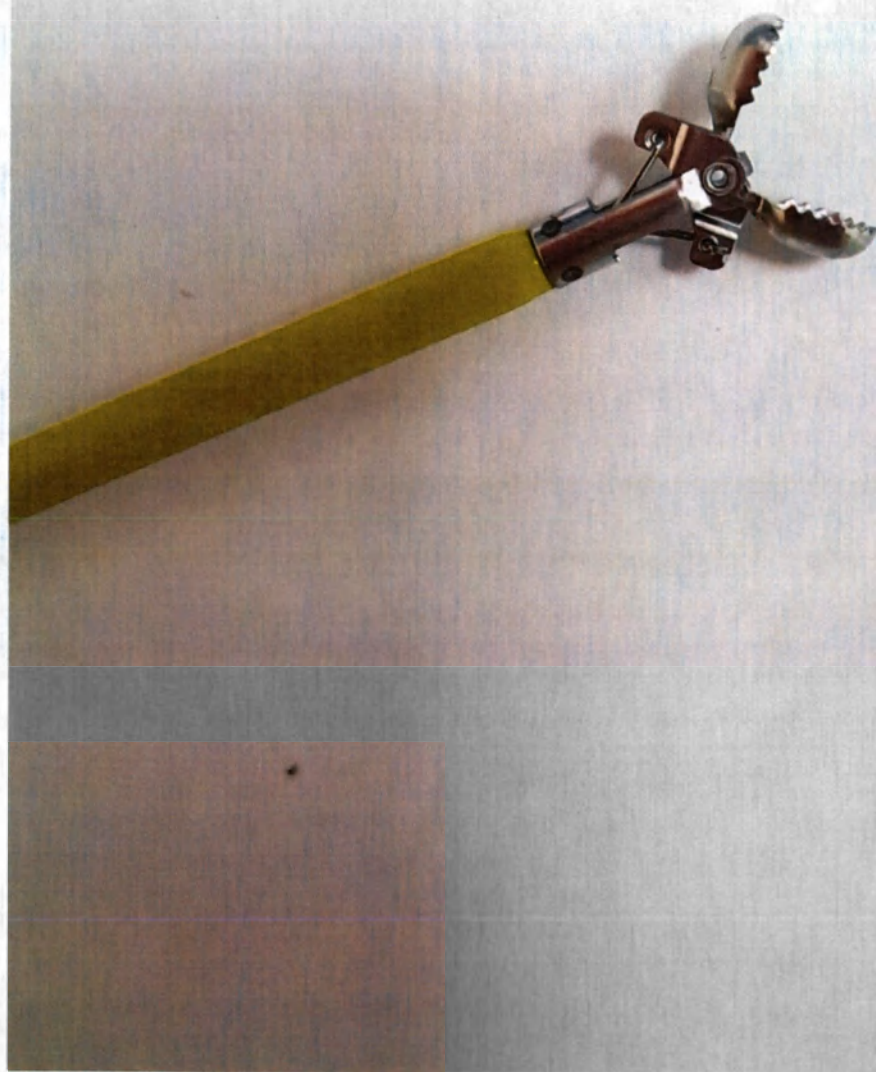

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см» в открытом виде.

Boston Scientific

JUMBO
3.2mm


Boston Scientific

Radial Jaw™ 4 JUMBO

Single-Use Biopsy Forceps


Pinzas de biopsia de un solo uso, Pince à biopsie à usage unique, Biopsierange für den einmaligen Gebrauch, Pinze da biopsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αοβίδο βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biopsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické kleště, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbrug, Tek Kullanımlık Biyopsi Forceps

 Contents (5)

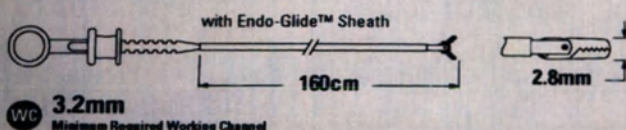

GTIN 08714729761891 **LOT** 28328237

REF Catalog No. M00513343 **Use By** 2024-11-04



90701540-01

Internal BSC Bar Code

90706801-020



(01)08714729761891(17)24110410201 3 237


CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Properk
El Coyol, Alajuela COSTA RICA


This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R Sterilized using irradiation.


Коробка . «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 160 см» (сторона 1)

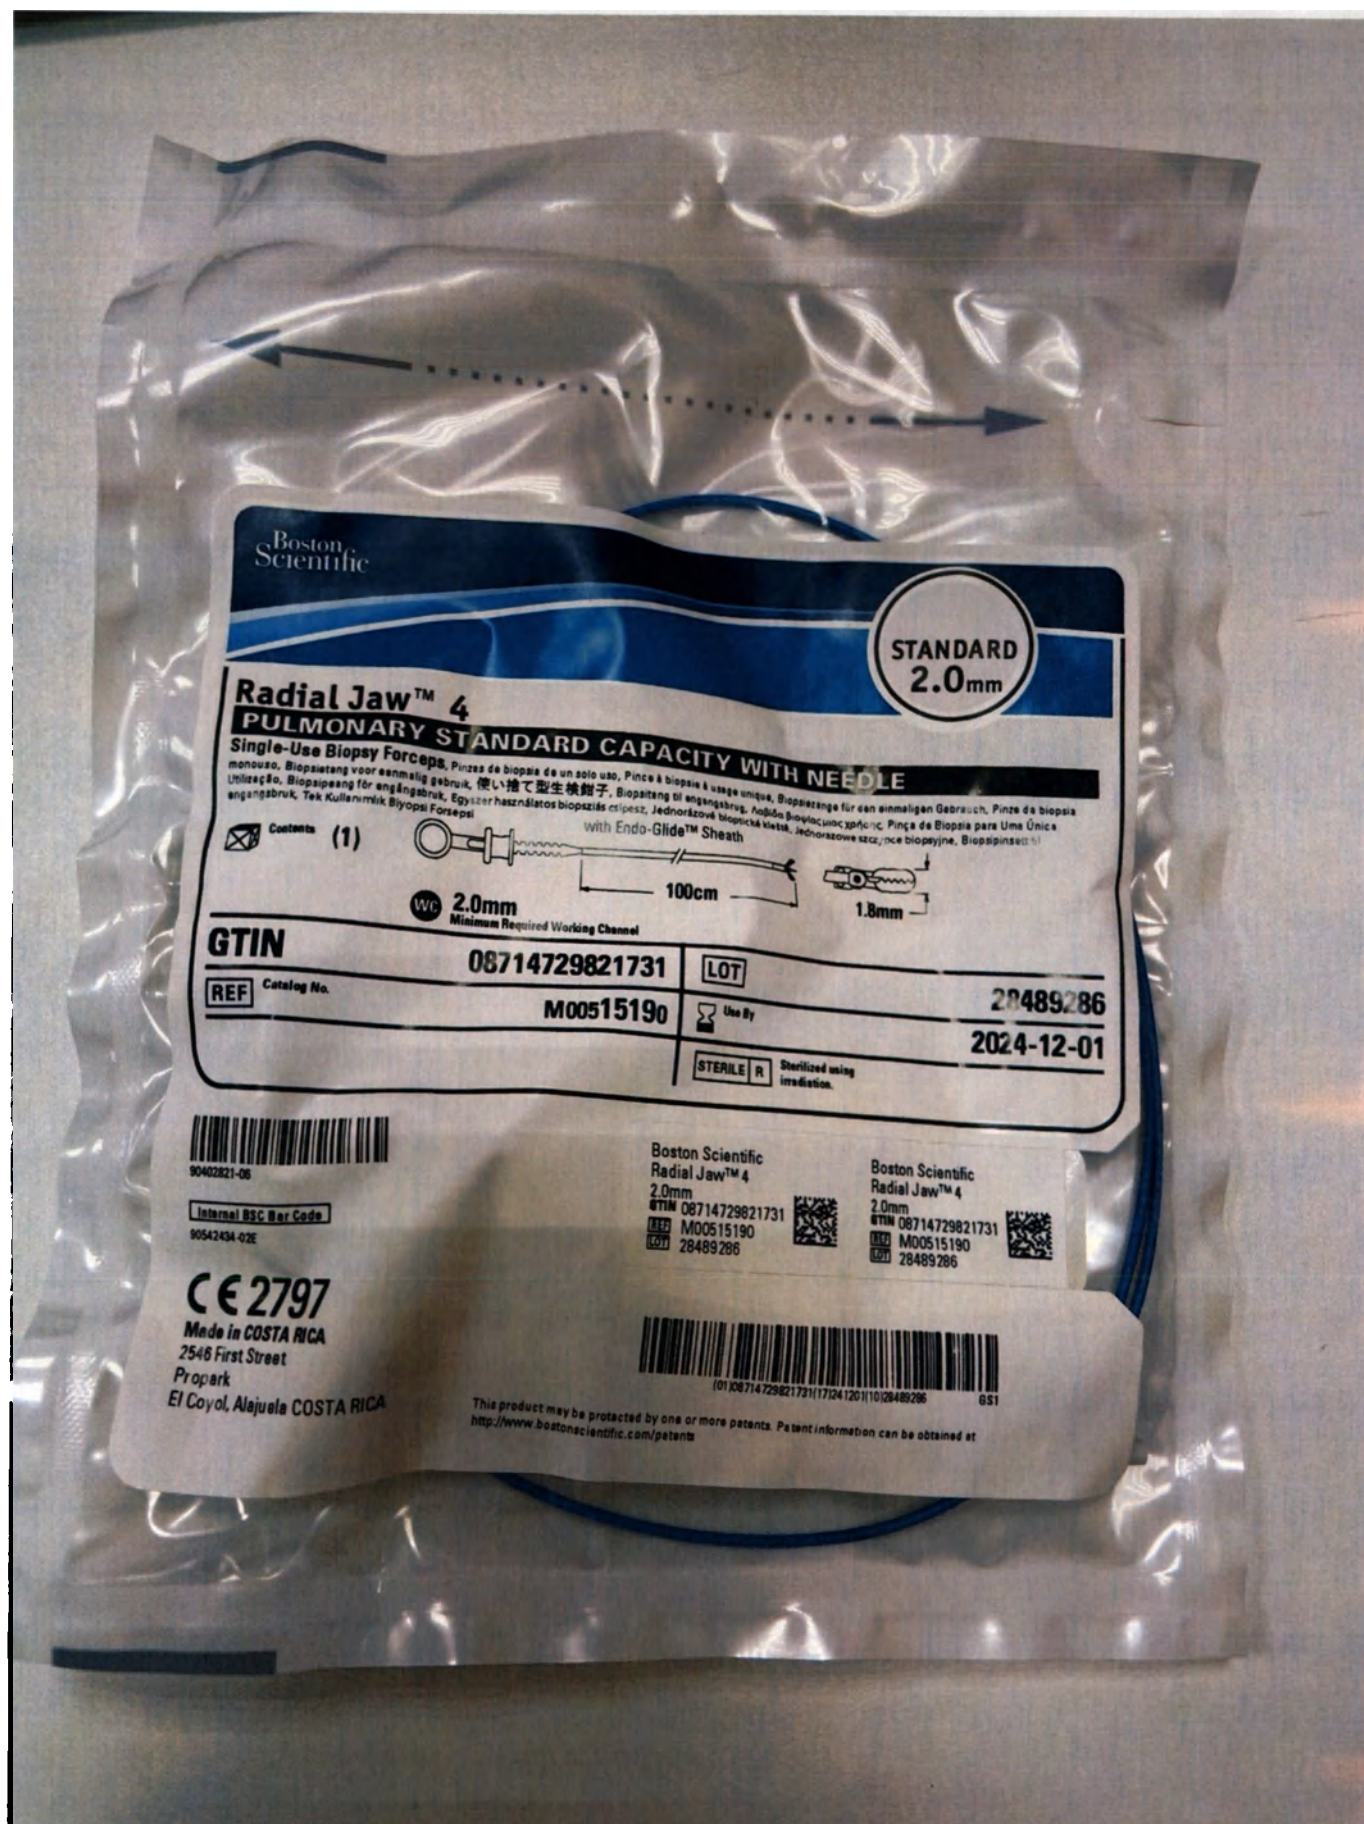



«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см» в запечатываемом пакете

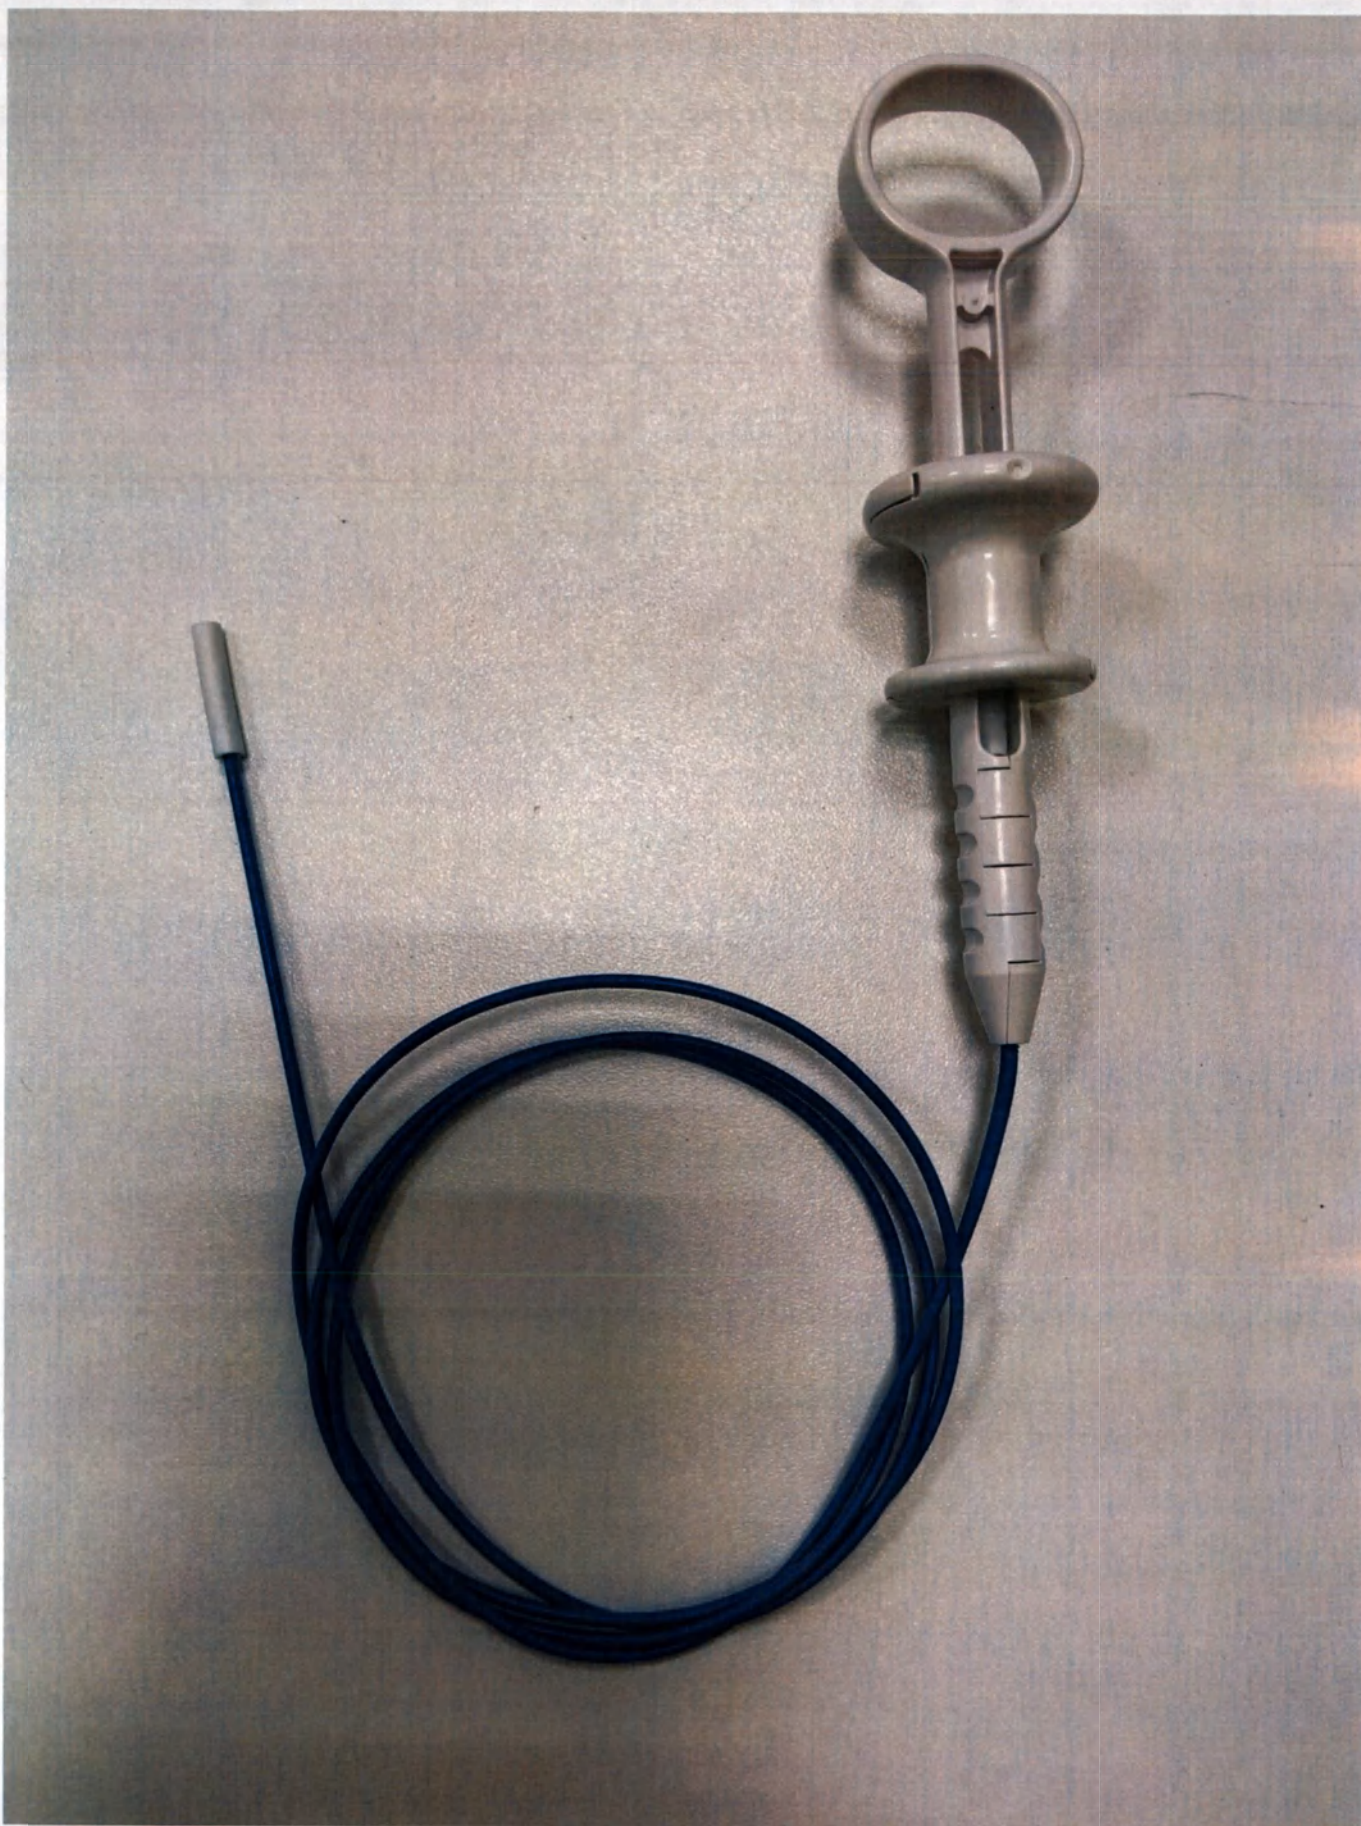

Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см»

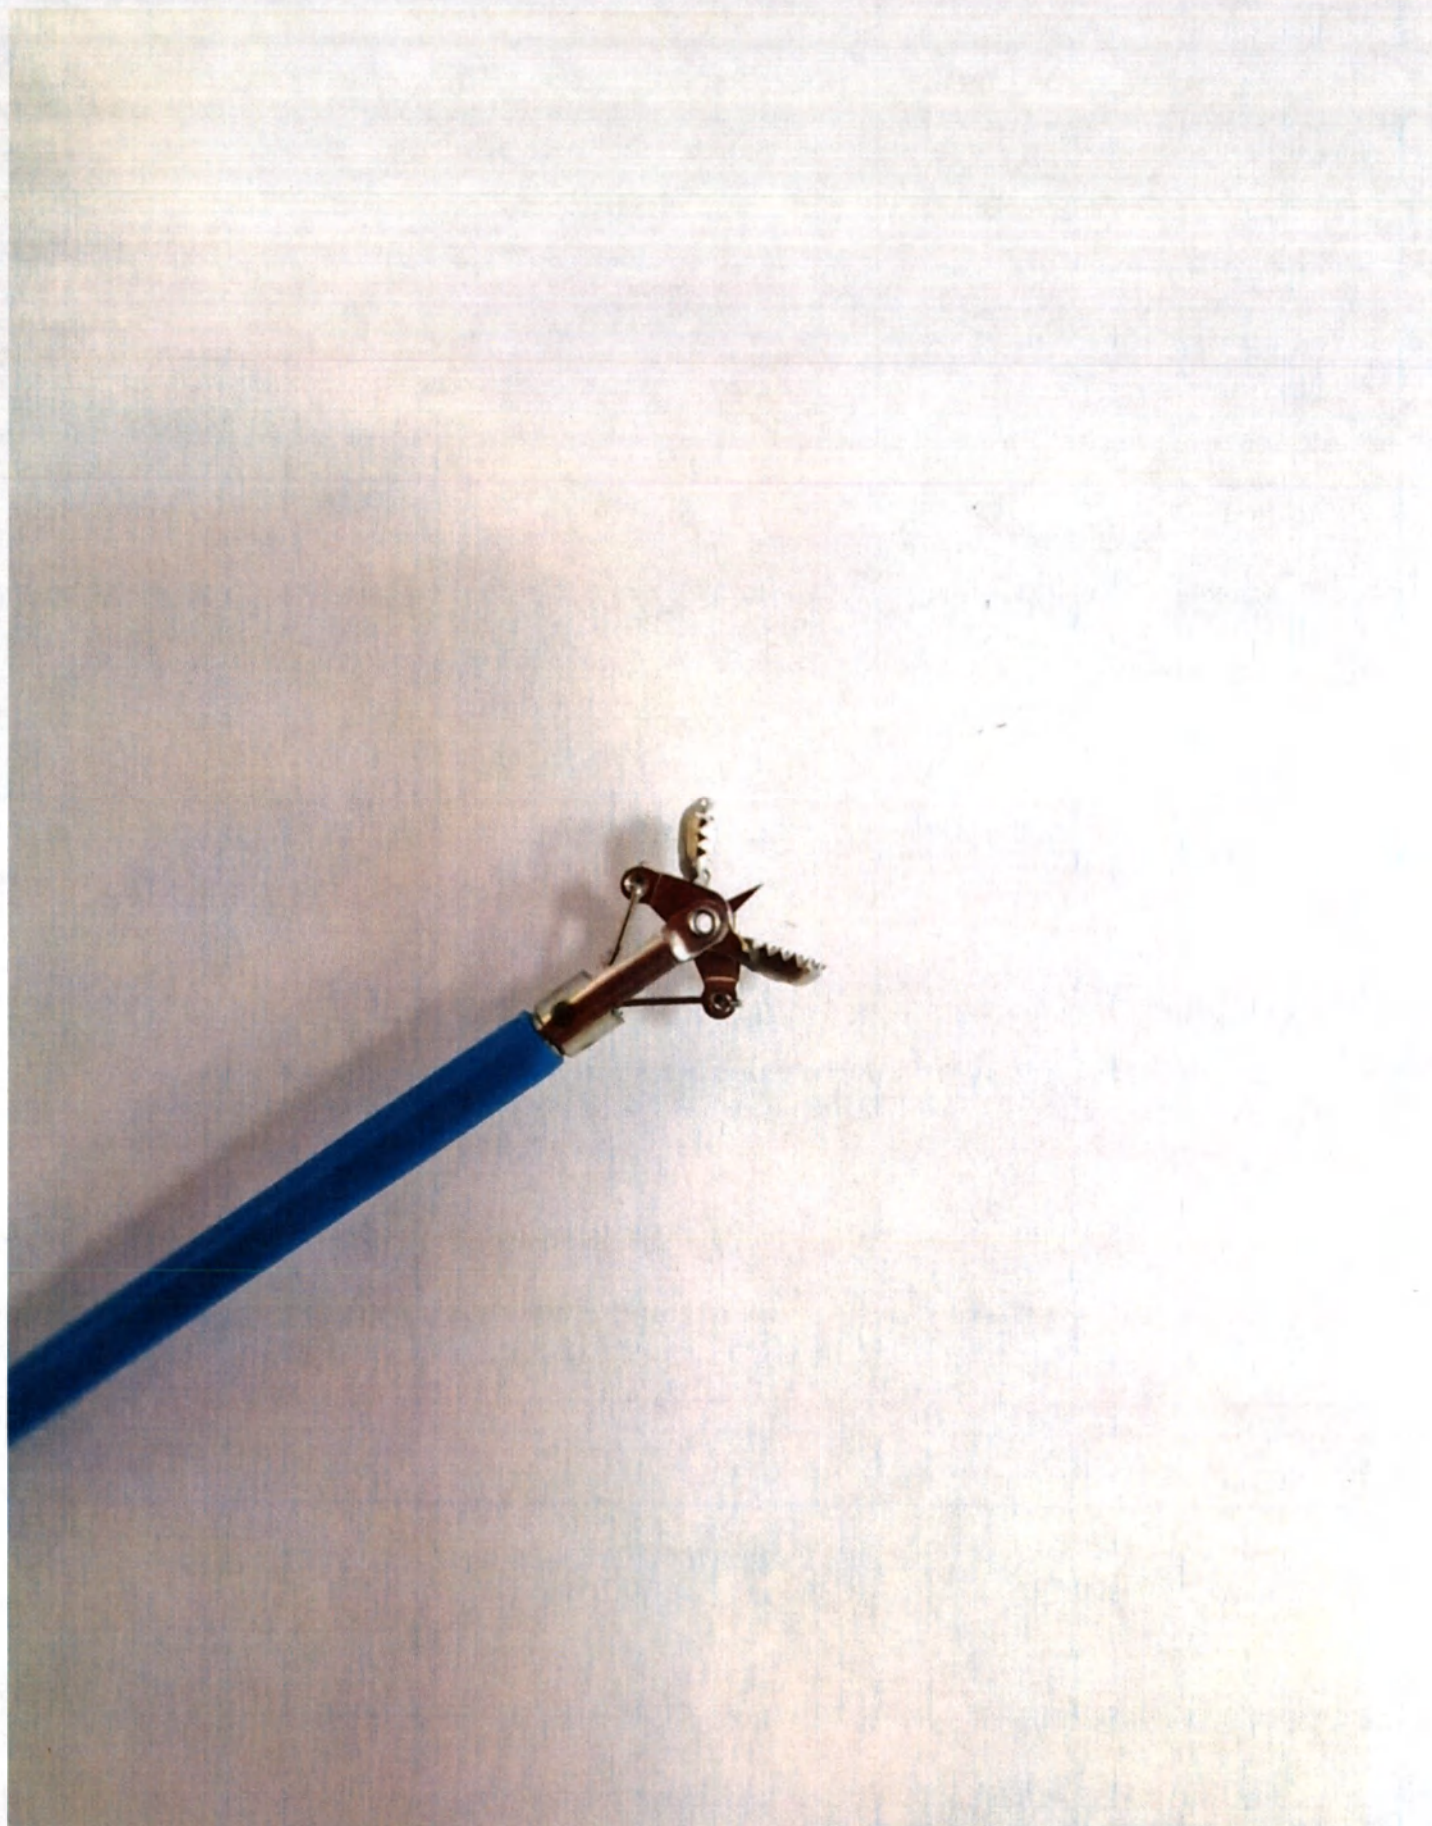

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см» в открытом виде.

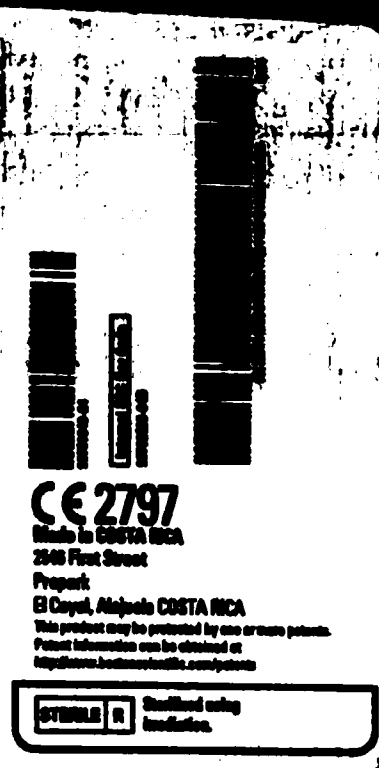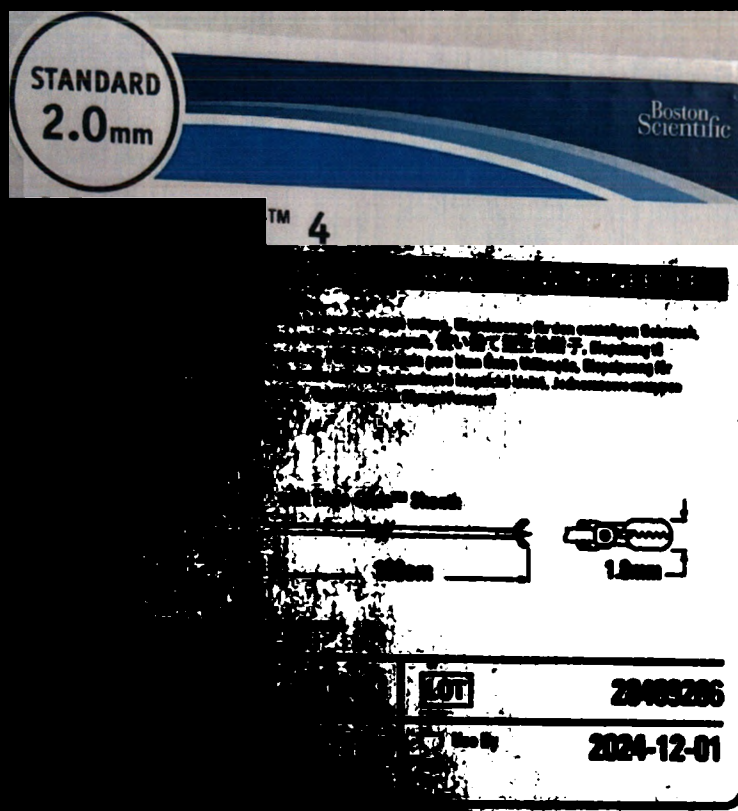

Коробка . «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см» (сторона 1)

Boston Scientific

LARGE 2.8mm

Radial Jaw™ 4
LARGE CAPACITY WITH NEEDLE
Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de uso único, Pince à biopsie à usage unique, Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch, Pinça de biópsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Auðliða biopsíocwiccupinnic, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyzetes használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické kliešťe, Jednorazowa szczypta biopsyjna, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forsepti

Contents: (1)

with Endo-Glide™ Sheath

WC 2.8mm
 Minimum Required Working Channel

240cm

2.4mm

GTIN	08714729745549	LOT	29673365
REF	Catalog No. M00513330	Use By	2025-06-27
STERILE R		Sterilized using irradiation.	



90402821-0H

Internal BSC Bar Code

90543374-01H

CE 2797

Made in COSTA RICA
 2546 First Street
 Propark
 El Coyo, Alajuela COSTA RICA

Boston Scientific
 Radial Jaw™ 4
 2.8mm

GTIN 08714729745549
 LOT M00513330
 LOT 29673365



Boston Scientific
 Radial Jaw™ 4
 2.8mm

GTIN 08714729745549
 LOT M00513330
 LOT 29673365



(01)08714729745549(17)250627(10)29673365 651

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см»



Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в открытом виде.

**LARGE
2.8mm**

Boston
Scientific


Radial Jaw™ 4

LARGE CAPACITY WITH NEEDLE

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de un solo uso, Pince à biopsie à usage unique, Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch, Pinze da biópsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αφθίκα βιοψιασ μίας χρήσης, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engangsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazová ošipčická klemě, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanılmak Biyopsi Klemesi

 Contents (20)

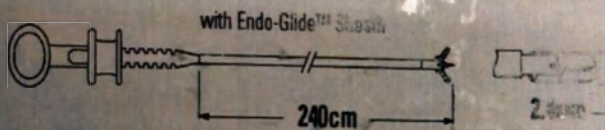

WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN 08714729648819

LOT

29673365

REF

Catalog No.

M00513331



Use By

2025-06-27



90701940-02

Internal BSC Bar Code

90706709-03D



051
(01 08 71 47296488 19 17 25 06 27 10 29 673365)

CE 2797

Made in COSTA RICA

2546 First Street

ProPark

El Ceyol, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.

Patent information can be obtained at

<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE

R

Sterilized using irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» (сторона


1)

Boston
Scientific

PEDIATRIC
2.0mm

Radial Jaw™ 4 PEDIATRIC

Single-Use Biopsy Forceps. Pinças de biópsia de um só uso. Pinça à biópsia à usage unique. Biopsietange für den einmaligen Gebrauch. Pinça de biópsia única. Biopsietang voor eenmalig gebruik. 使い捨て型生検鉗子. Biopsietang til engangsbrug. Radialbiopsietang sprått. Pinça de Biópsia para Uma Única Engastatura. Egyyszerhasználatos biopsziás csipesz. Jednorazová biopsická klemka. Jednorazowe szczypce biopsyjne. Biopsipinsett til engangsbruk. Tek Kullerumrik Biopsy Forceps.



GTIN	08714729826767	LOT	29442907
REF	Catalog No. M00513440	Use By	2025-05-19
STERILE R		Sterilized using irradiation.	



90402621-03

Internal BSC Bar Code

90501770-01F

CE 2797

Made in COSTA RICA

7546 First Street

ProPark

El Coyo, Alajuela COSTA RICA

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.0mm
GTIN 08714729826767
REF M00513440
LOT 29442907

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.0mm
GTIN 08714729826767
REF M00513440
LOT 29442907




08714729826767/17/250519/10/29442907


BS1

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете

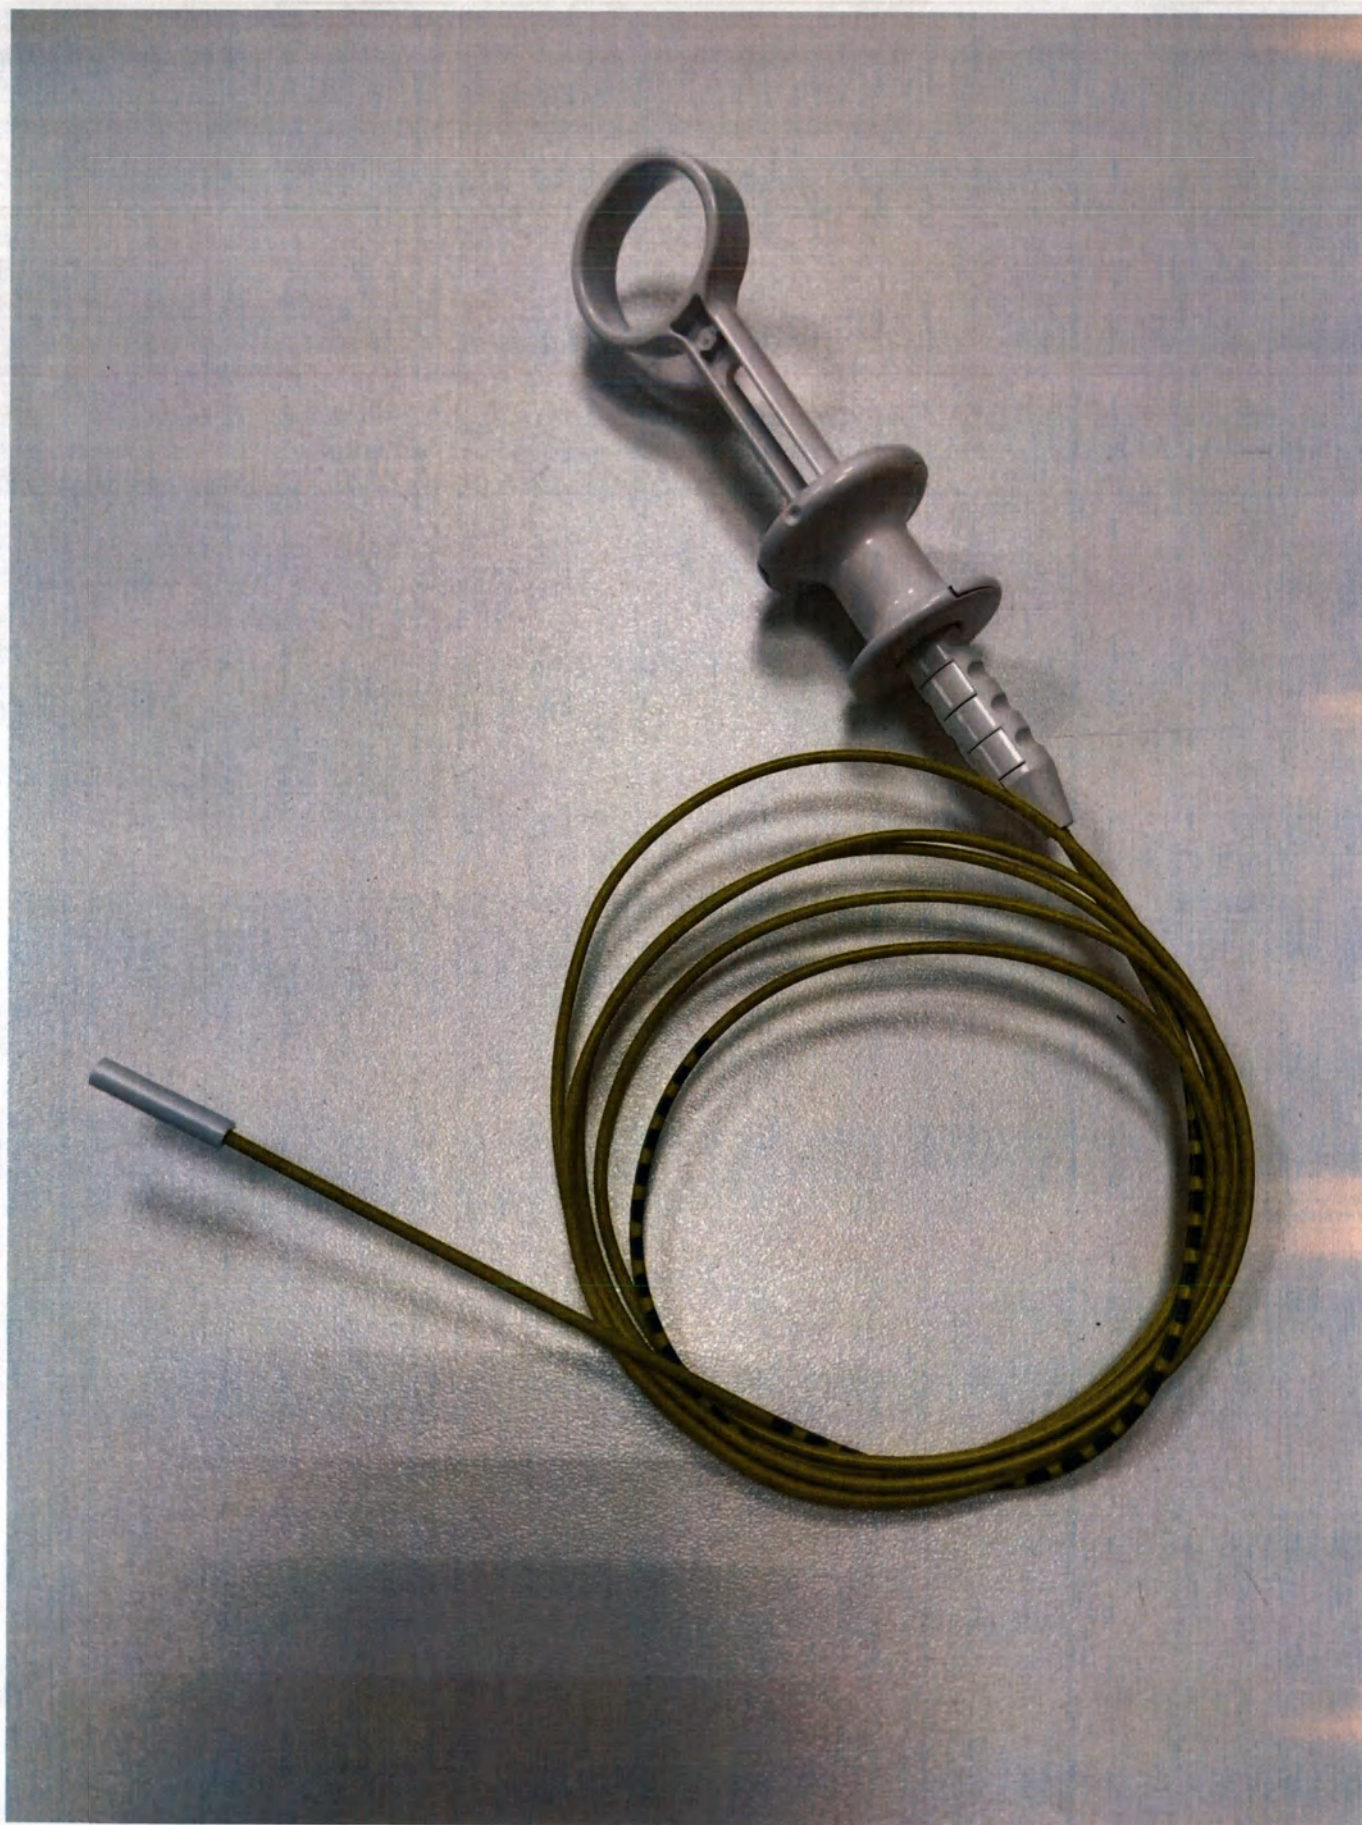

Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см»

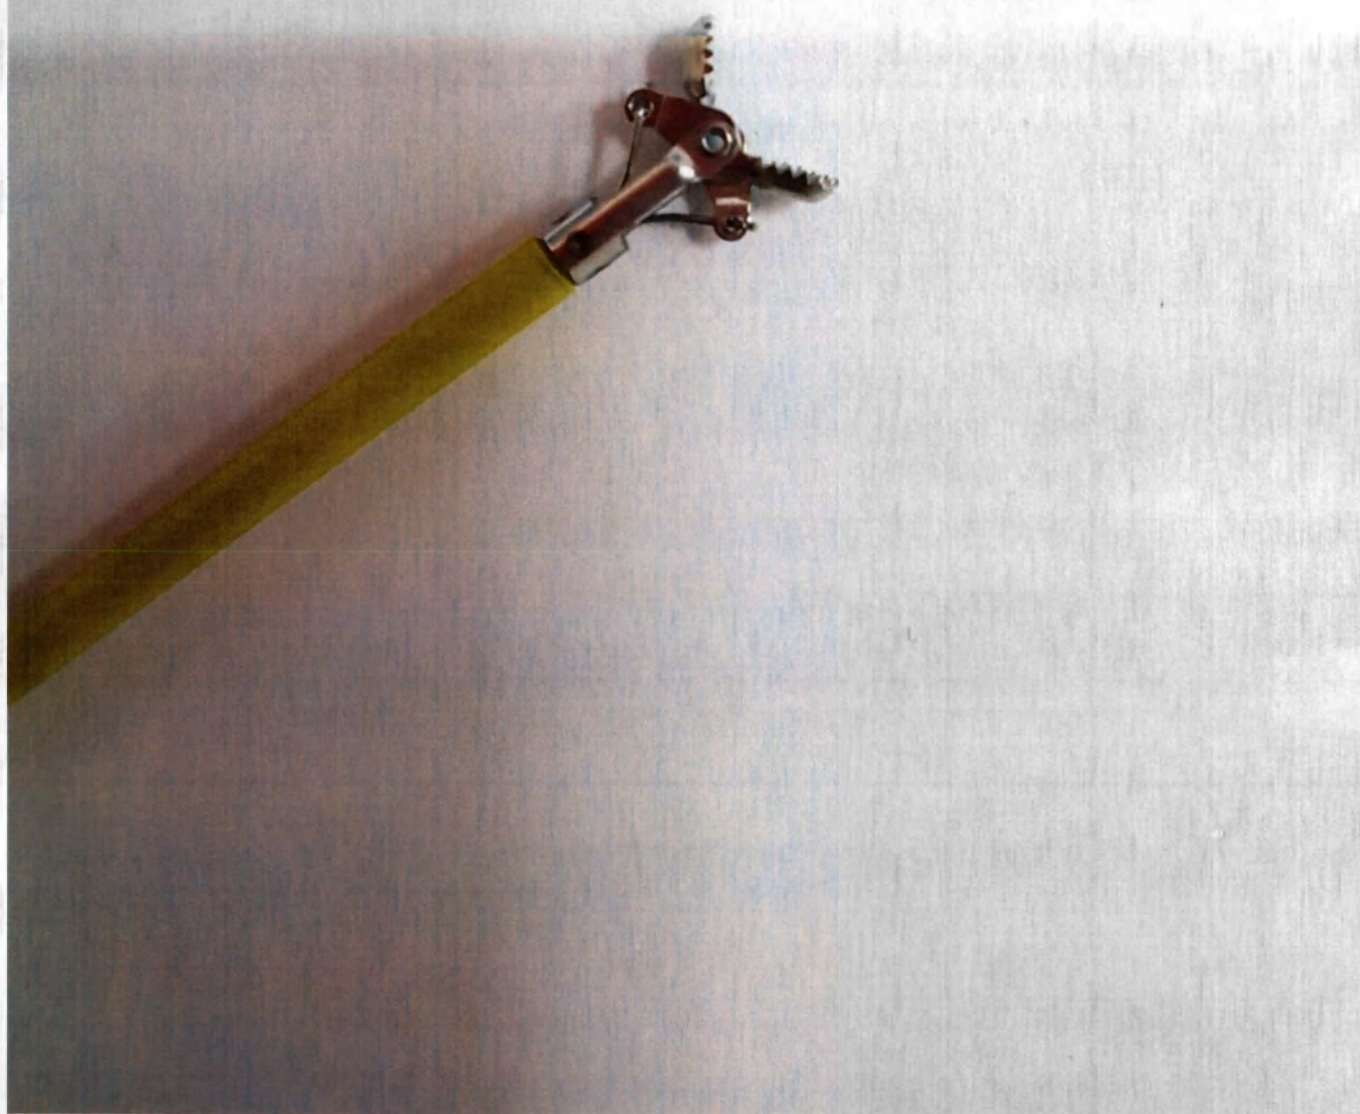

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см» в открытом виде.

**PEDIATRIC
2.0mm**

Boston
Scientific


Radial Jaw™ 4

PEDIATRIC

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biopsia de un solo uso, Pince à biopsie à usage unique, Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch, Pinze da biopsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αφίδα βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biopsia para Uma Única Utilização, Biopsietang for engangsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické kleště, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forsepsi

 Contents (20)



WC 2.0mm
Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729789918

LOT

29442907

REF

Catalog No.

M00513441



Use By

2025-05-19



90701940-01

Internal BSC Bar Code

90708579-010



(01)X0714729789918172505191029442907

CE 2797

Made in COSTA RICA

2546 First Street

Propark

El Coyo, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.

Patent information can be obtained at

<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE

R

Sterilized using
irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см» (сторона 1)



«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см»



Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см» в открытом виде.

Boston
Scientific

JUMBO

Single-Use Biopsy Forceps

Pince de biopsia de un so usso, Pince a biopsia a usage unique, Biopsietange für den einmaligen Gebrauch, Pince de biopsia monouso, Biopsietange voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsiatang til engangsbrug, Ασπίδα βιοψίας, Ασπίδα βιοψίας, Pinça de Biopsia para uma Única Utilização, Biopsiatang för engångsbruk, Egyzer használatos biopsziás csipesz, Jednorazowe biopsyjne kleśce, Jednorazowe szczypcy biopsyjne, Biopsiesinsett til engangsbruk, Tek Kullarmik Bivipsi Forsprey



Contents (20)



WC 3.2mm

Minimum Required Working Channel

GTIN 08714729648871

LOT

29391372

REF

Catalog No.

M00513361



Use By


2025-05-11

€ 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Propark
El Coyol, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>


STERILE	R	Sterilized using irradiation.
---------	---	-------------------------------

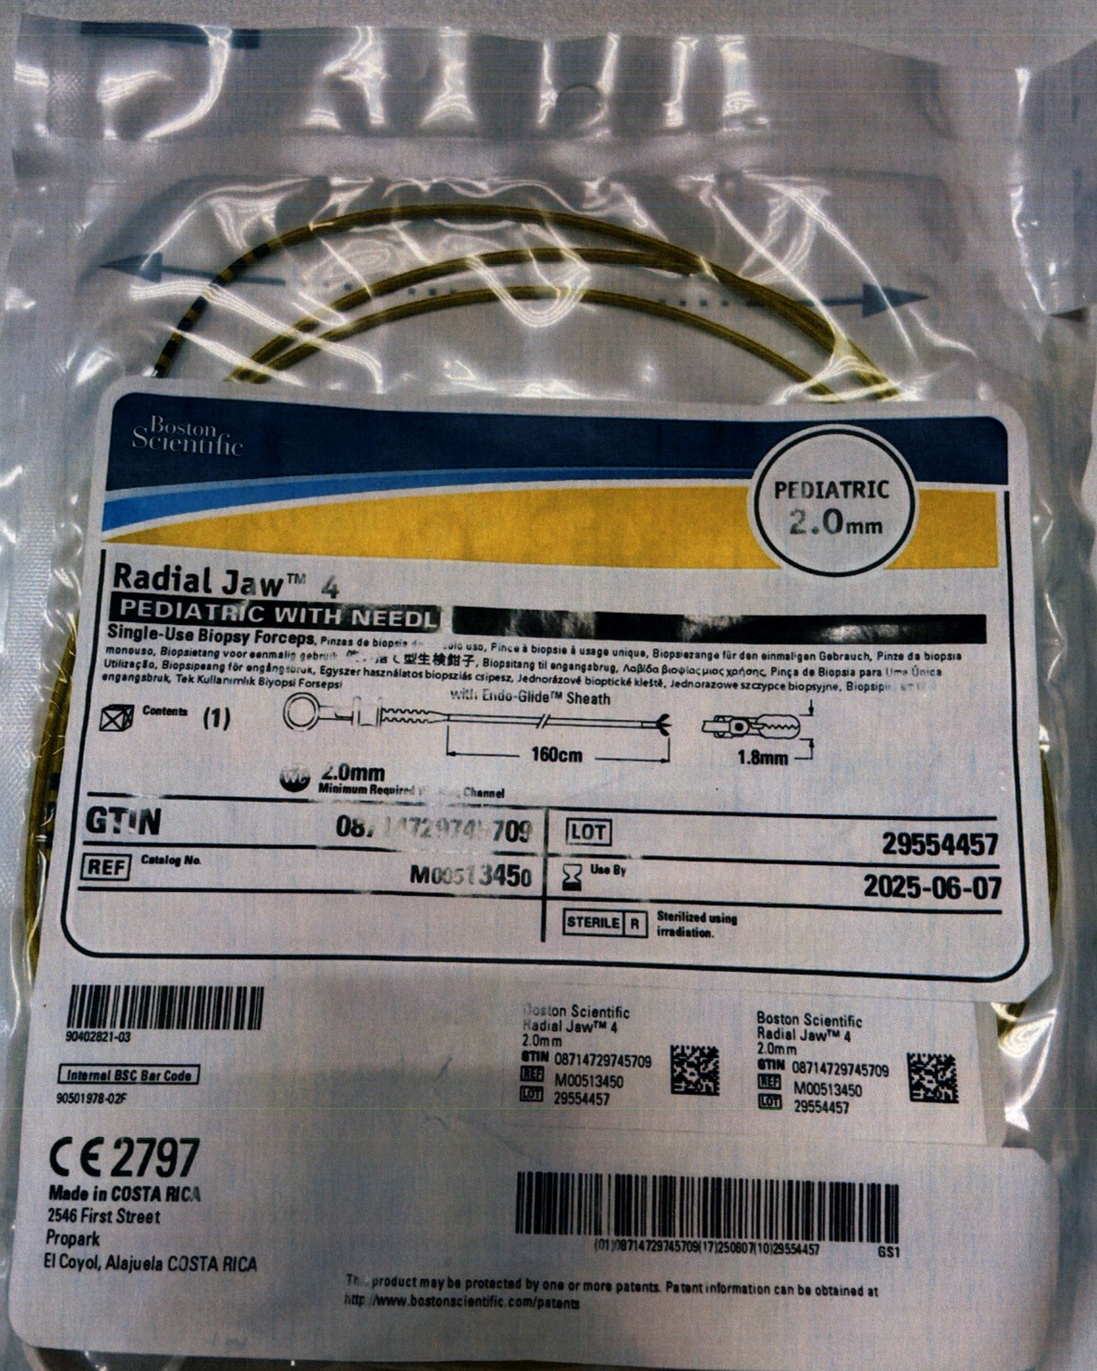

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см»

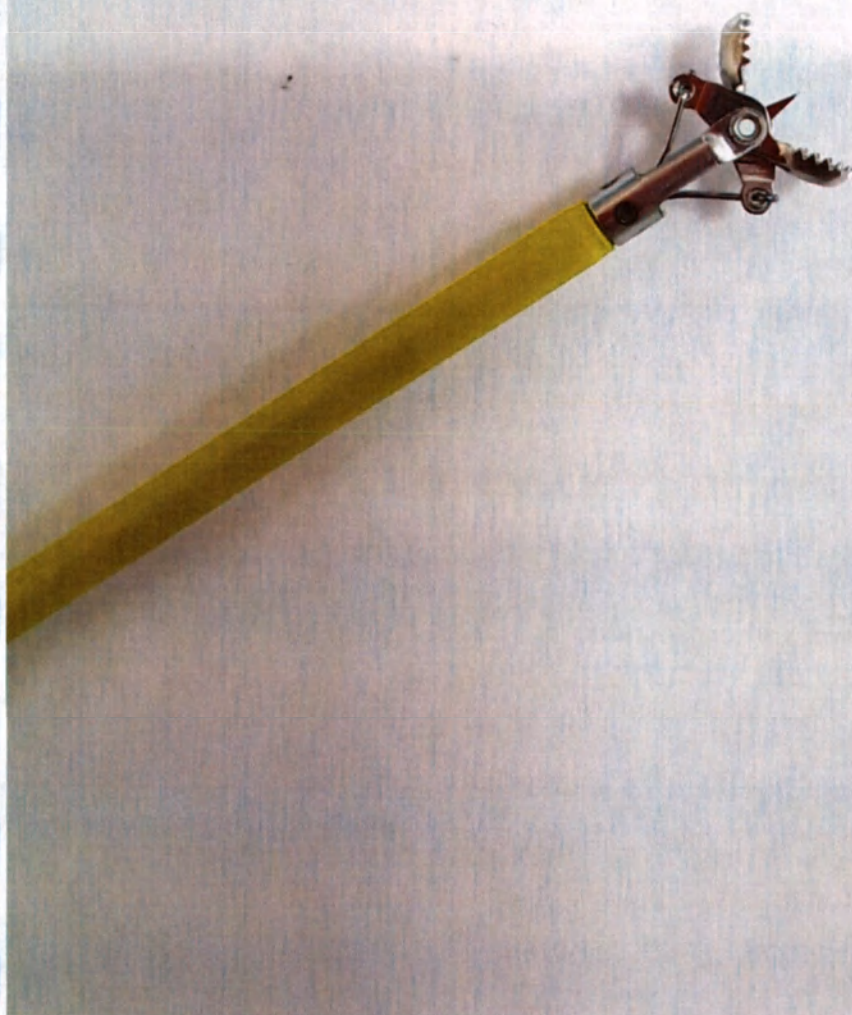

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см» в открытом виде.

**PEDIATRIC
2.0mm**

Boston
Scientific

Radial Jaw™ 4 **PEDIATRIC WITH NEEDLE**

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de uso único, Pince à biópsia à usage unique, Biopsierange für den einmaligen Gebrauch, Pinze da biópsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αοβόλο βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazowe biopsyjckie klesze, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullamikk Biopsi Forpseri

 **Contents (20)**



WC 2.0mm
Minimum Required Working Channel

GTIN 08714729789925 **LOT** 29554457

REF Catalog No. M00513451 **Use By** 2025-06-07



08714729789925

Internal BSC Bar Code
9079539-040



651

CE 2797

Made in COSTA RICA

2546 First Street

Propark

El Coyo, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.

Patent information can be obtained at


<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R Sterilized using irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, педиатрические с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 160 см» (сторона 1)



«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете

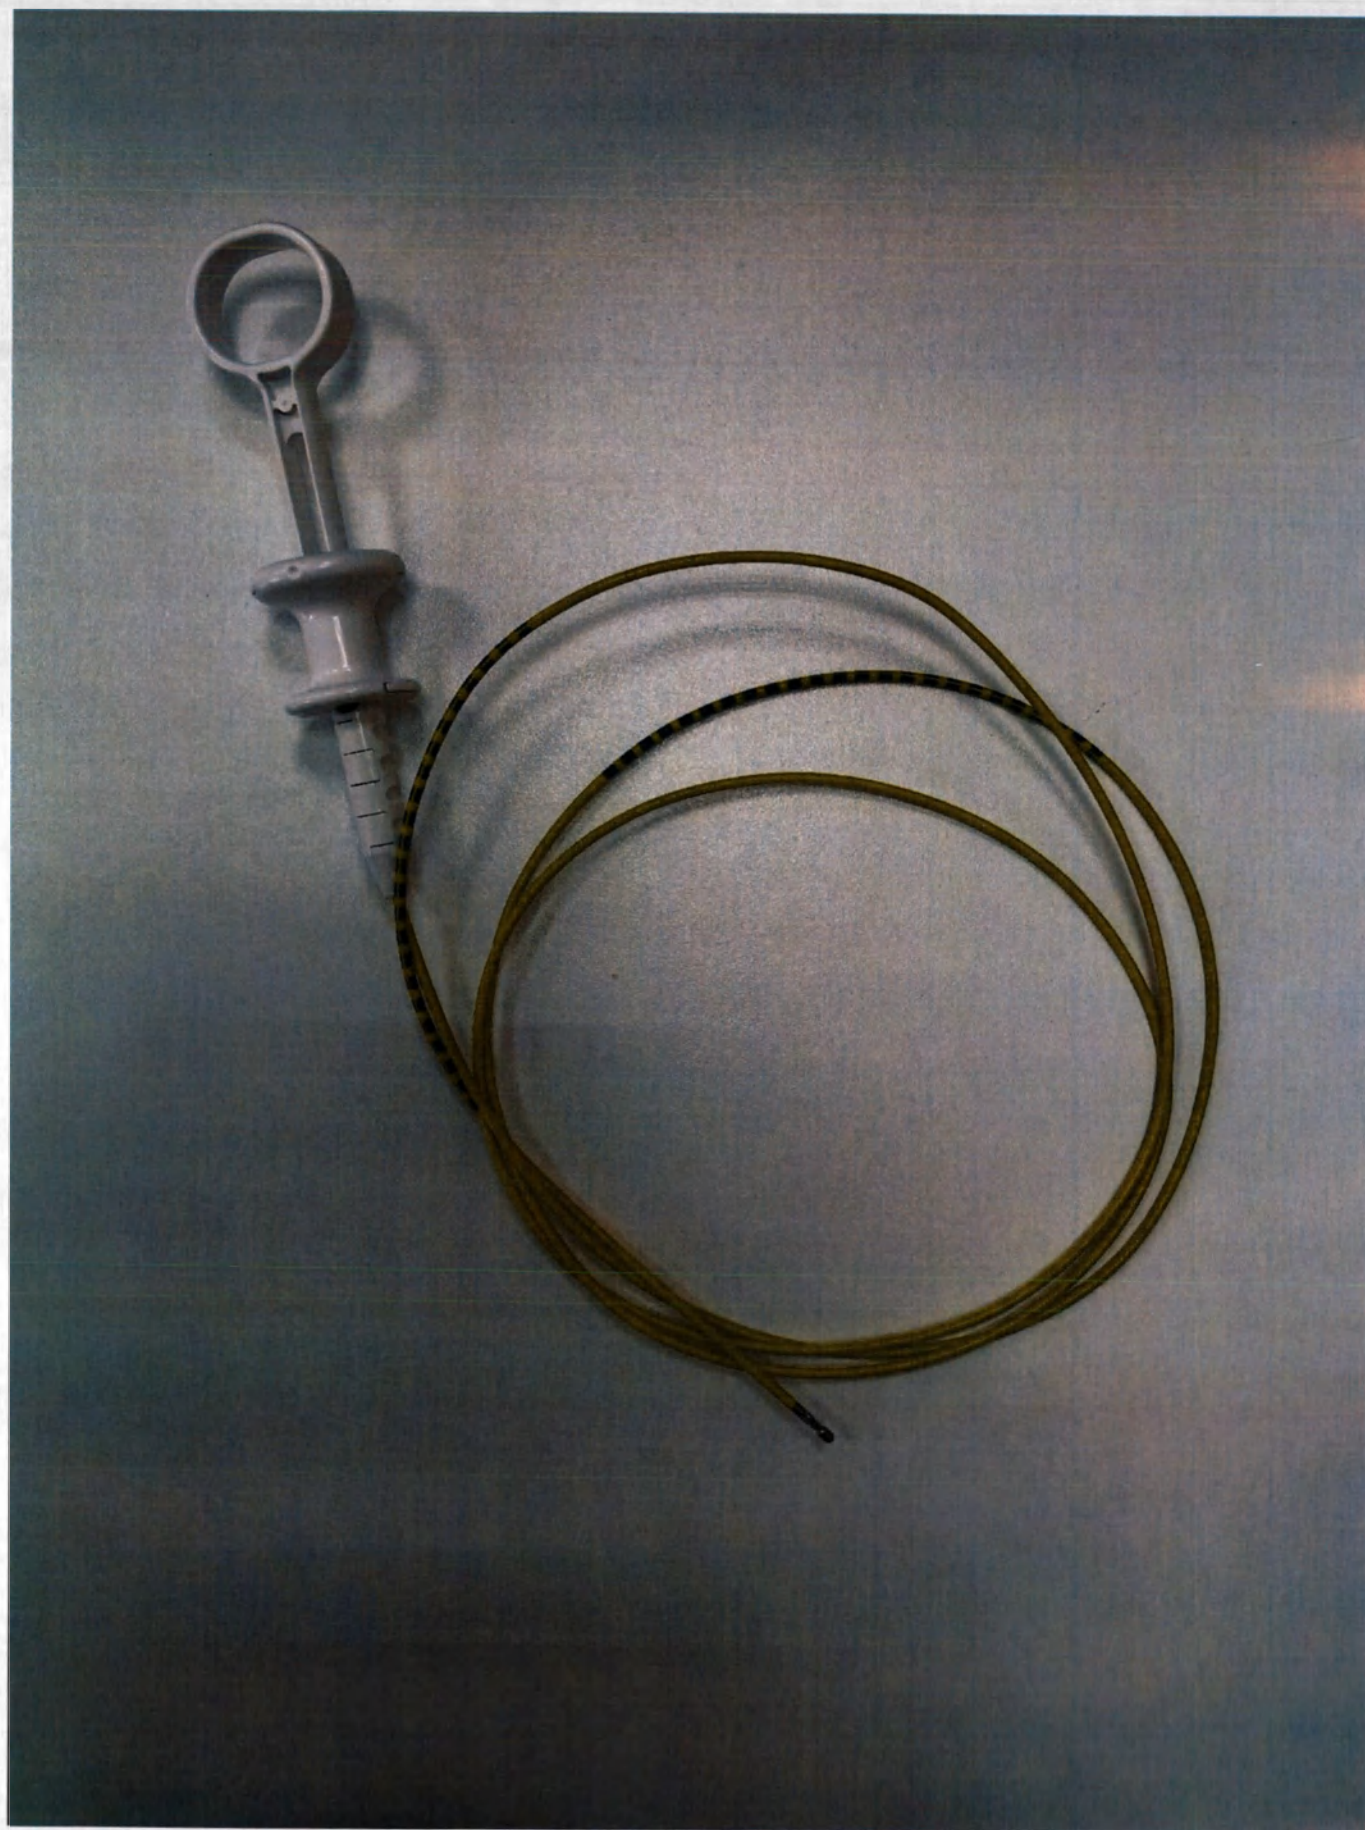

Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см»



Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в открытом виде.

**LARGE
2.8mm**


Boston
Scientific

Radial Jaw™ 4 LARGE CAPACITY

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de un solo uso, Pince à biopsie à usage unique, Biopsierange für den einmaligen Gebrauch, Pinze de biópsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αφαιδα βιοψίας μονοχρήσης, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorázové biopsické kleště, Jednorazowe szczypcy biopsyjne, Biopsinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forceps

 **Contents (20)**



WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN	08714729648758	LOT	29514759
REF	Catalog No. M00513301	Use By	2025-05-31



90701940-01

Internal BSC Bar Code

90706713-04D



051

CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Properak
El Ceyol, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R Sterilized using irradiation.


Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» (сторона 1)



«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см»

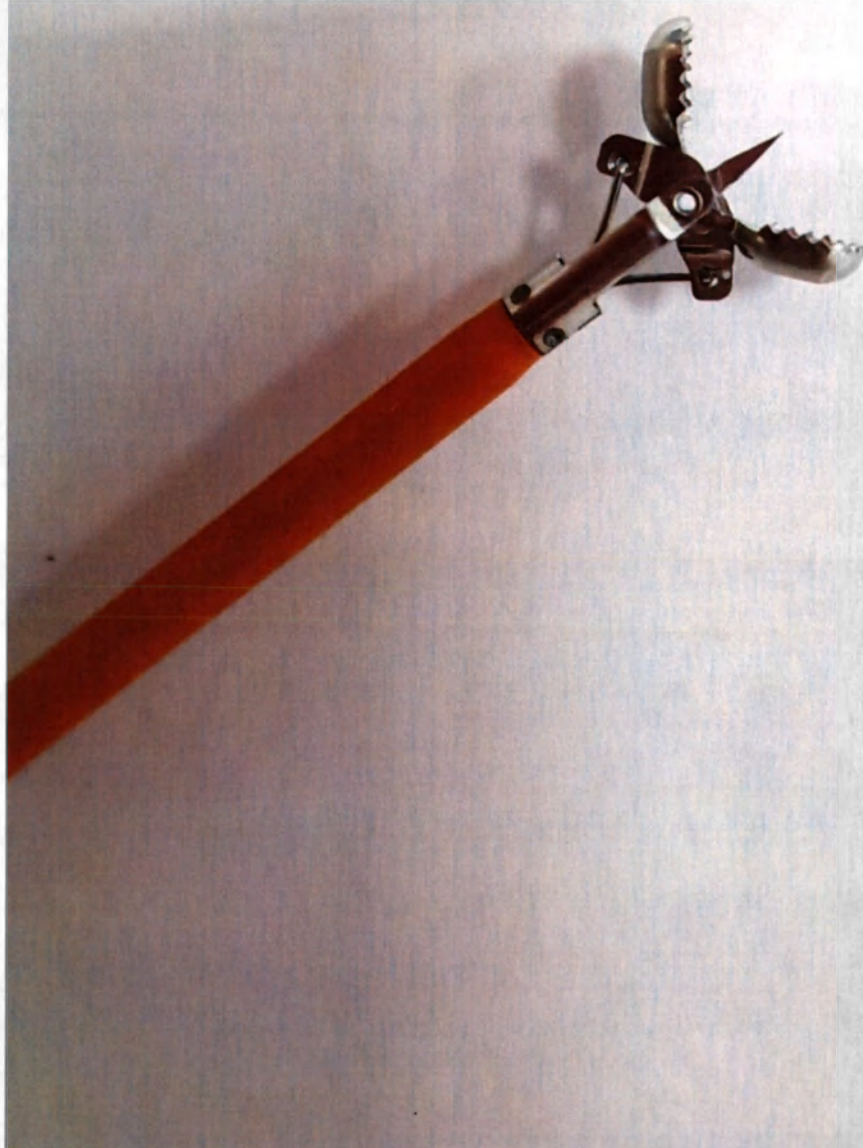

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см» в открытом виде.

JUMBO
3.2mm


Boston
Scientific

Radial Jaw™ 4 JUMBO WITH NEEDLE

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de um só uso, Pince à biopsie à usage unique, Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch, Pinze da biópsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αοβίδιο βιοψιολιόσχημο, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopstické kleště, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forceps

 Contents (20)



WC 3.2mm
Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729648895

LOT

29337029

REF

Catalog No.

M00513371



Use By

2025-05-03



90701940-02

Internal BSC Bar Code

90706623-030



GST

08714729648895 17235038 1028337029

CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Proper
El Ceyol, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE

R

Sterilized using
irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, Jumbo с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 3,2 мм, рабочая длина 240 см» (сторона 1)



«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см»



Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в открытом виде.

**LARGE
2.8mm**

Boston
Scientific


Radial Jaw™ 4

LARGE CAPACITY

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de uso único, Pince à biopsie à usage unique, Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch, Pinza de biopsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αφαιδα βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické klemě, Jednorazowe szczytko biopsyjne, Biopsipinsatt til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forcepsü.

 **Contents (20)**



WC 2.8mm

Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729648796

LOT

29397958

REF

Catalog No.

M00513321

 **Use By**

2025-05-12



Internal BSC Bar Code
8001549-02

90308 705-040



08714729648796 1712505 21102307958

CE 2797

Made in COSTA RICA

2546 First Street

Proper

El Ceyol, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R

Sterilized using
irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» (сторона 1)



«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см»



Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в открытом виде.

**STANDARD
2.8mm**

Boston
Scientific


Radial Jaw™ 4

STANDARD CAPACITY

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de um só uso, Pinça à biópsia à usage unique, Biopsierange für den einmaligen Gebrauch, Pinça de biópsia monouso, Biopsietang voor eenmalig gebruik, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Αφάδα βιοψίας μιας χρήσης, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang för engångsbruk, Egyszer használatos biopsziás csipesz, Jednorazové biopsické kleště, Jednorazowe szczypce biopsyjne, Biopsipinsett til engangsbruk, Tek Kullanımlık Biyopsi Forcepsü

 Contents (20)



WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN 08714729777953 **LOT** 29588410

REF Catalog No. M00513381 **Use By** 2025-06-13



90201940-01

Universal BSC Bar Code

90960198-010



(07) 08714729777953 17 29588410 051

CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street

Propark
El Ceyol, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R Sterilized using irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» (сторона 1)

Boston
Scientific


STANDARD
2.8mm

Radial Jaw™ 4

STANDARD CAPACITY WITH NEEDLE

Single-Use Biopsy Forceps. Pinças de biópsia de uso único, Pinça à biópsia à usage unique, Biopsiezange für einen einmaligen Gebrauch, Pinza de biopsia monouso, Biopsietangszorost megalkalmazás, 使い捨て型生検鉗子, Biopsietang til engangsbrug, Najdbiószorgócsőcsatlakozó, Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização, Biopsietang til engangsbrug, Egyetlen használatos biopsziás csipesz, Jednorazová biopsická stáček, Jednorazowa szułka biopsyjna, Biopsietangsett til engangsbruk, Tek Kullantek Biopsietang Forceps.

with Endo-Glide™ Sheath



WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729745655

LOT

28579617

REF Catalog No.

M00513390

Use By

2024-12-15

STERILE R Sterilized using irradiation



90402821-03

Internal BSC Bar Code

90744757-02E

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.8mm
GTIN 08714729745655
REF M00513390
LOT 28579617

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.8mm
GTIN 08714729745655
REF M00513390
LOT 28579617

CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Propark
El Coyoil, Alajuela COSTA RICA



08714729745655 1729472181048179813 081

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patents>

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см»



Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема с иглой, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 160 см» в открытом состоянии.

Boston
Scientific

STANDARD
2.8mm


Radial Jaw™ 4

STANDARD CAPACITY

Single-Use Biopsy Forceps

Pinça: de biópsia de um só uso. Pince à biopsie à usage unique. Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch. Pinza de biópsia monouso. Biopsietang voor eenmalig gebruik. 使い捨て型生検鉗子. Biopsietang til engangsbrug. Aðfóð Biopsíacynscröngur. Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização. Biopsietang för engångsbruk. Egyszer használatos biopsziárá csipesz. Jednorazové biopsické kleště. Jednorazowe szczypce biopsyjne. Biopsipinsang til engangsbrug. Tek Kullannmék Biopsi Forceps.

Contents (1)



VVC 2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729745662

LOT

29464951

REF

Catalog No.

M00513400

Use By

2025-05-23

STERILE R

Sterilized using
irradiation.



30402821-04

Internal BSC Bar Code

90744807-01E

CE 2797

Made in COSTA RICA
2546 First Street
Propark
El Coyol, Alajuela COSTA RICA

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.8mm
GTIN 08714729745662
REF M00513400
LOT 29464951

Boston Scientific
Radial Jaw™ 4
2.8mm
GTIN 08714729745662
REF M00513400
LOT 29464951




(01)08714729745662 171250523 10129404951 651

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в запечатываемом пакете



Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см»

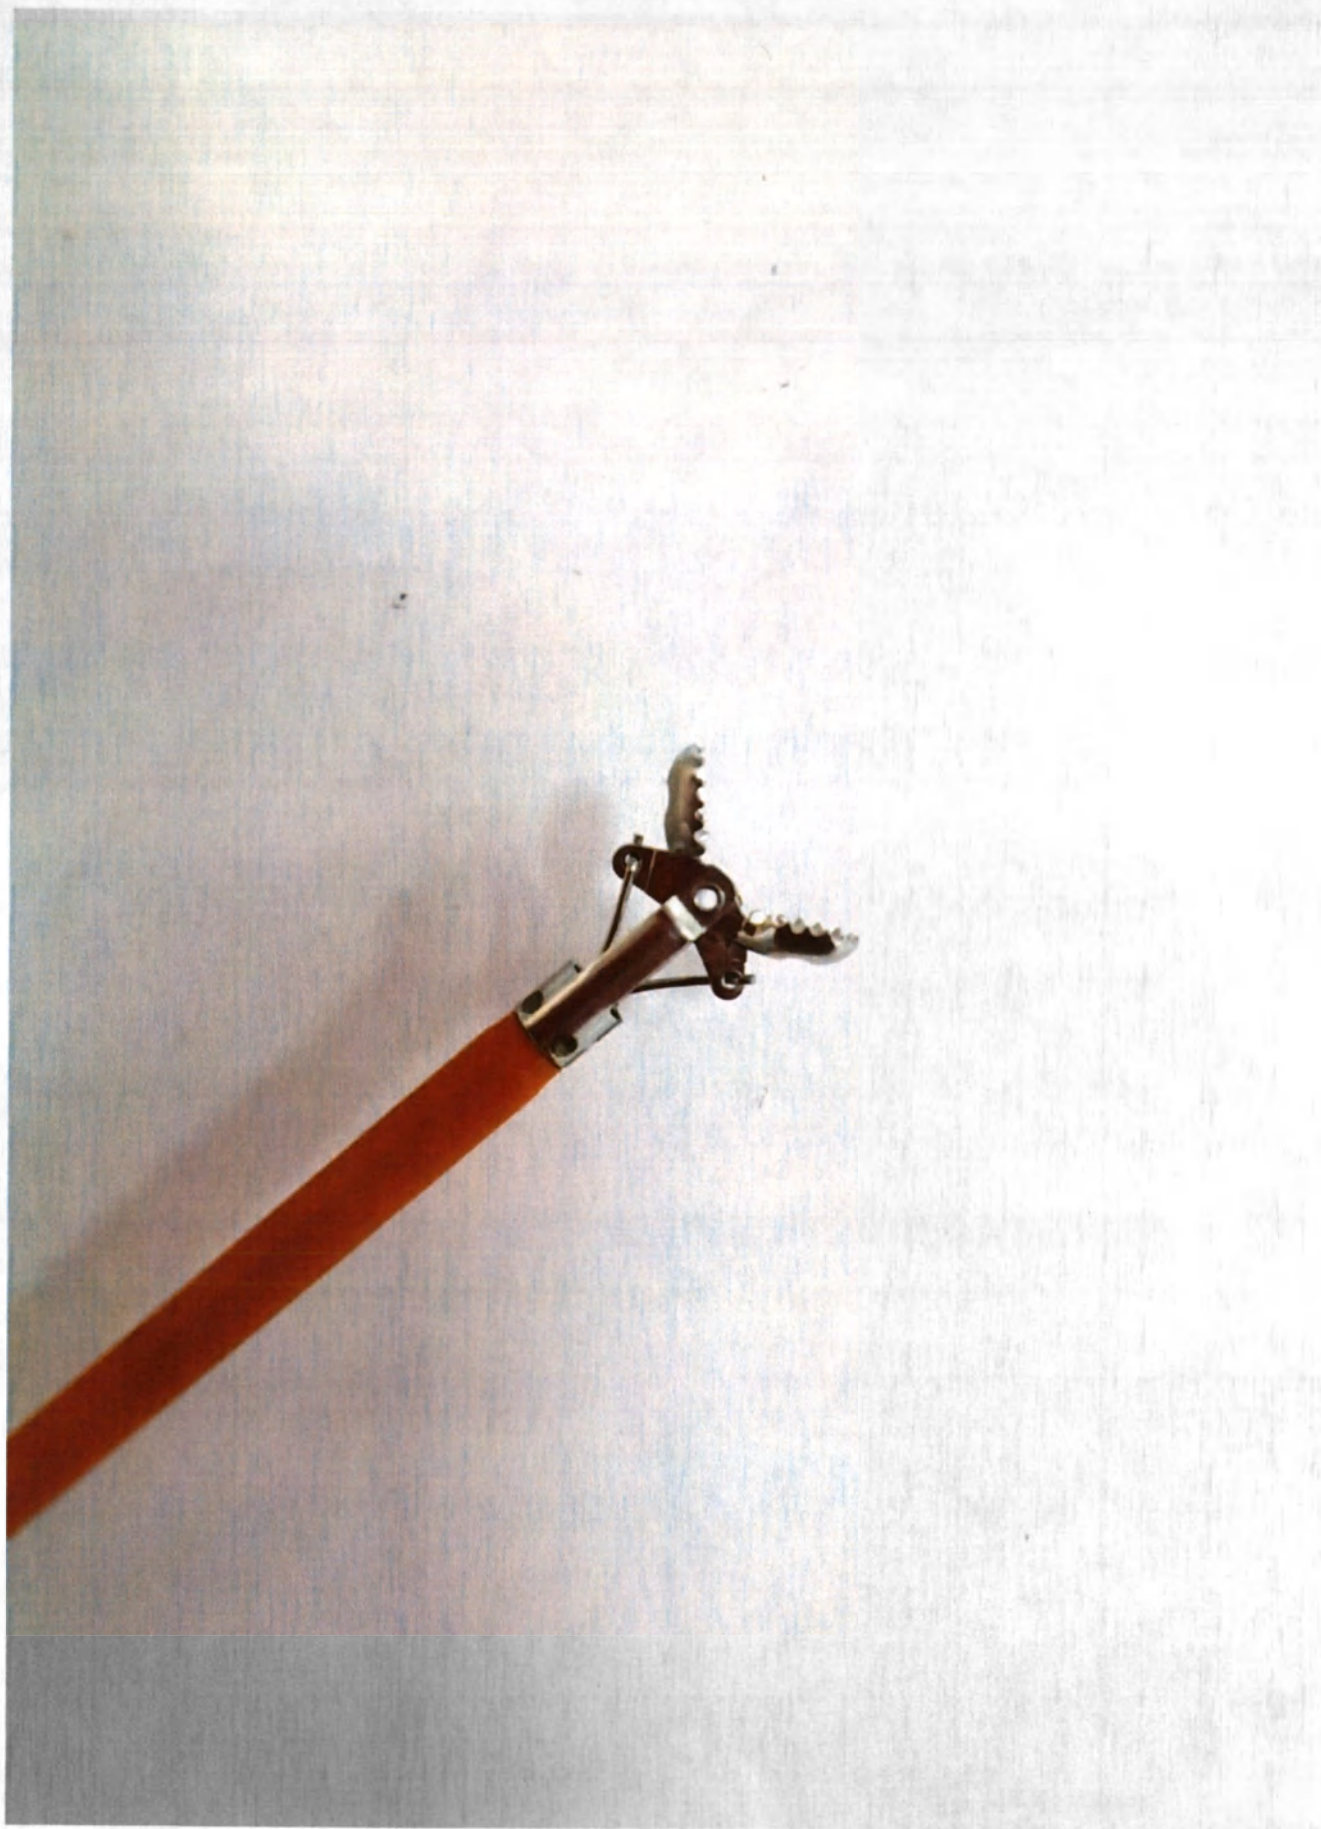

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» в открытом виде.

**STANDARD
2.8mm**

Boston
Scientific

Radial Jaw™ 4

STANDARD CAPACITY

Single-Use Biopsy Forceps

Pinças de biópsia de un sólo uso. Pinça à biópsia à usage unique. Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch. Pinça de biópsia monouso. Biopsietang voor eenmalig gebruik. 使い捨て型生検鉗子. Biopsietang til engangsbruk. Agyűző Biopszió, egyszeri használat. Pinça de Biópsia para Uma Única Utilização. Biopsietang för engångsbruk. Egyszeri használatos biopsziás csipesz. Jednorazowe biopsyiczne kleszcze. Jednorazowe szczypce biopsyjne. Biopsipinsett til engangsbruk. Tek Kullanılmak Biyopsi Forcepsi.

 **Contents (20)**



WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN 08714729777960 **LOT** 29464951

REF Catalog No. M00513401 **Use By** 2025-05-23



90701940-02

Internal BSC Bar Code

90660182 4110



(010871472977796011)3506231025464951

CE 2797

Made in COSTA RICA

2546 First Street


Propark

El Ceyol, Alajuela COSTA RICA


This product may be protected by one or more patents.
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE R Sterilized using irradiation.

Коробка. «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 240 см» (сторона 1)

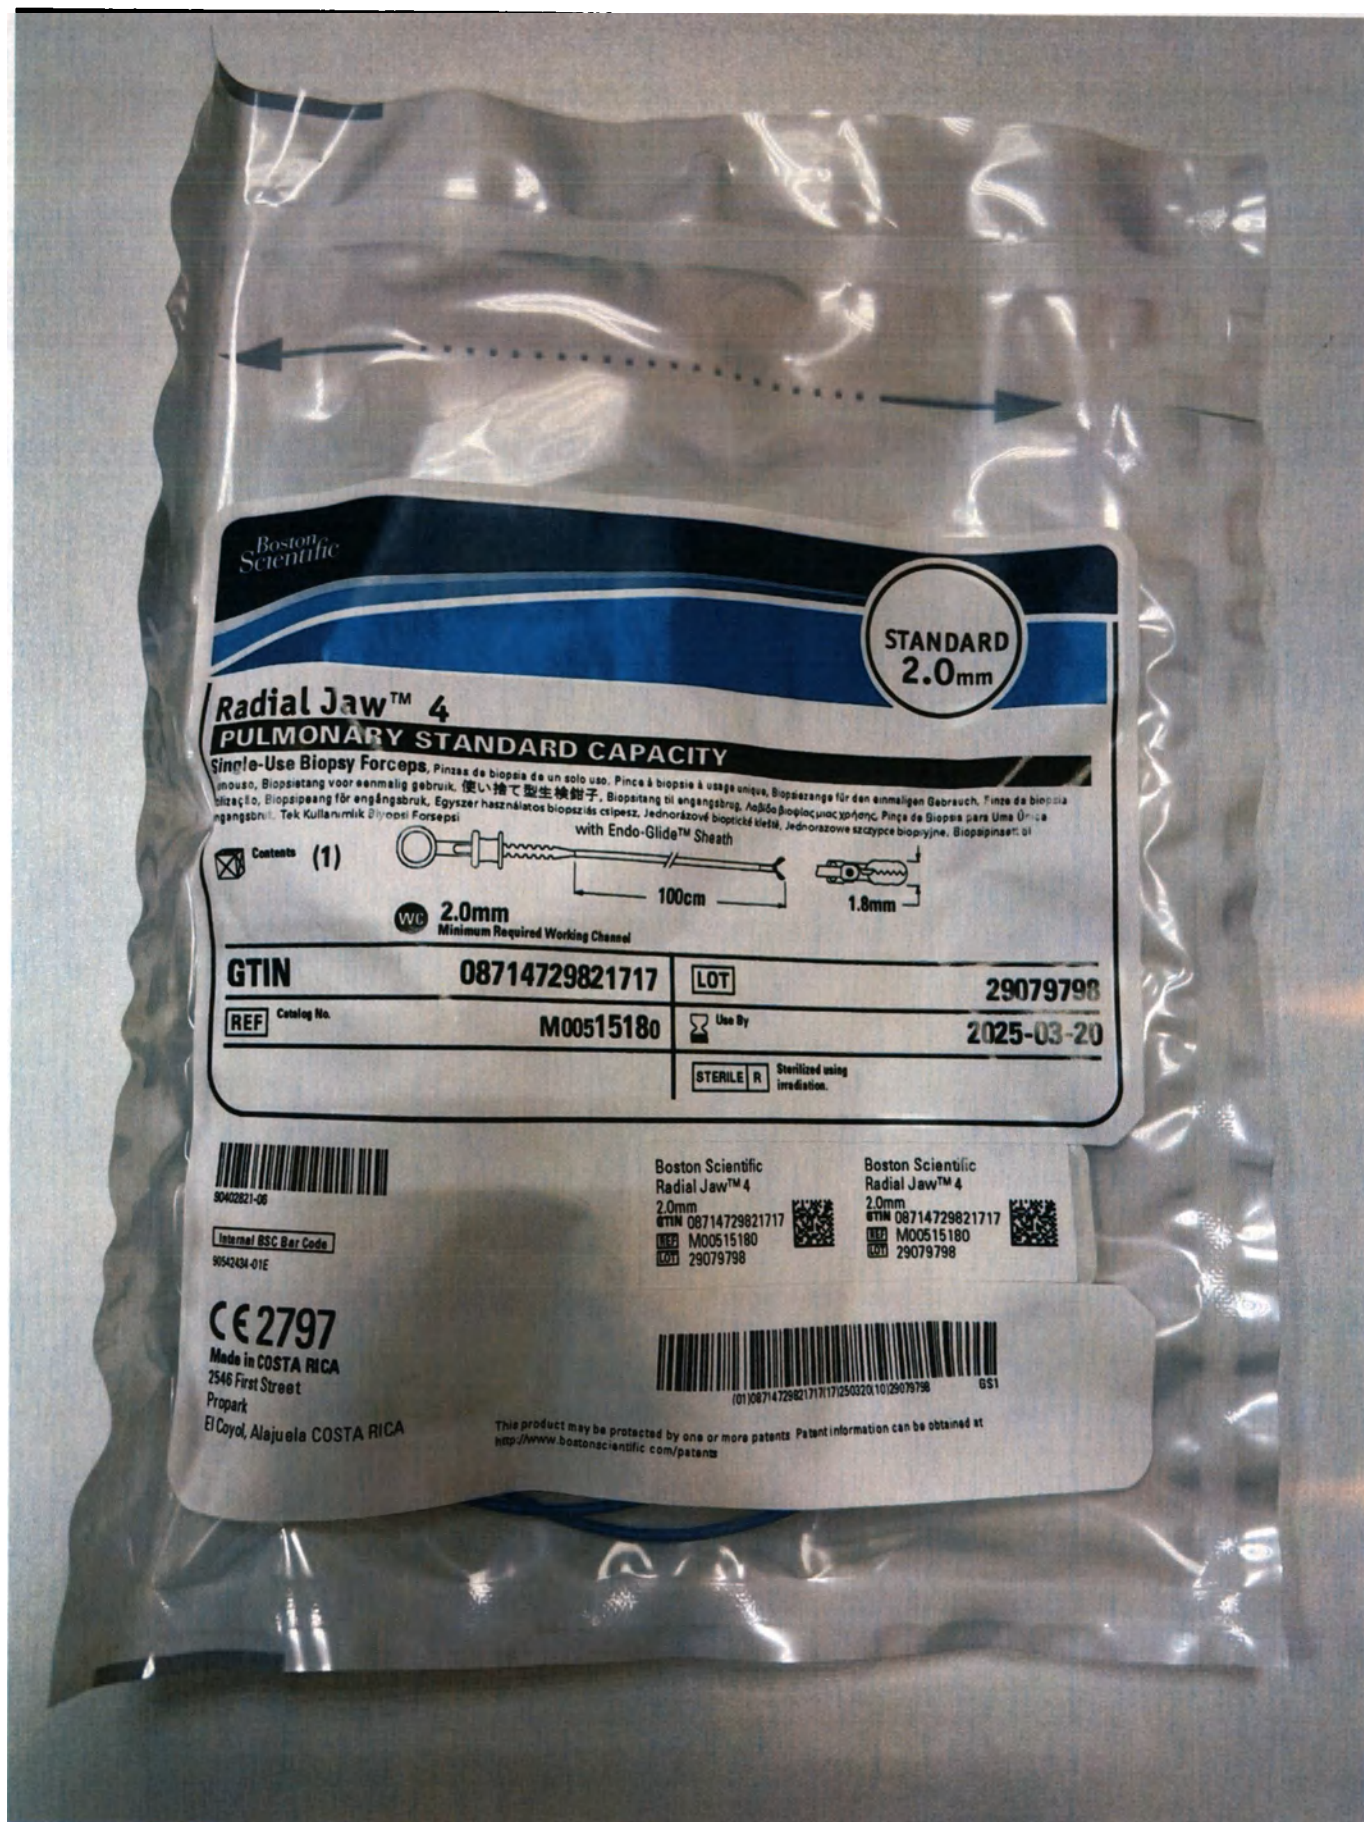


«Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см» в запечатываемом пакете

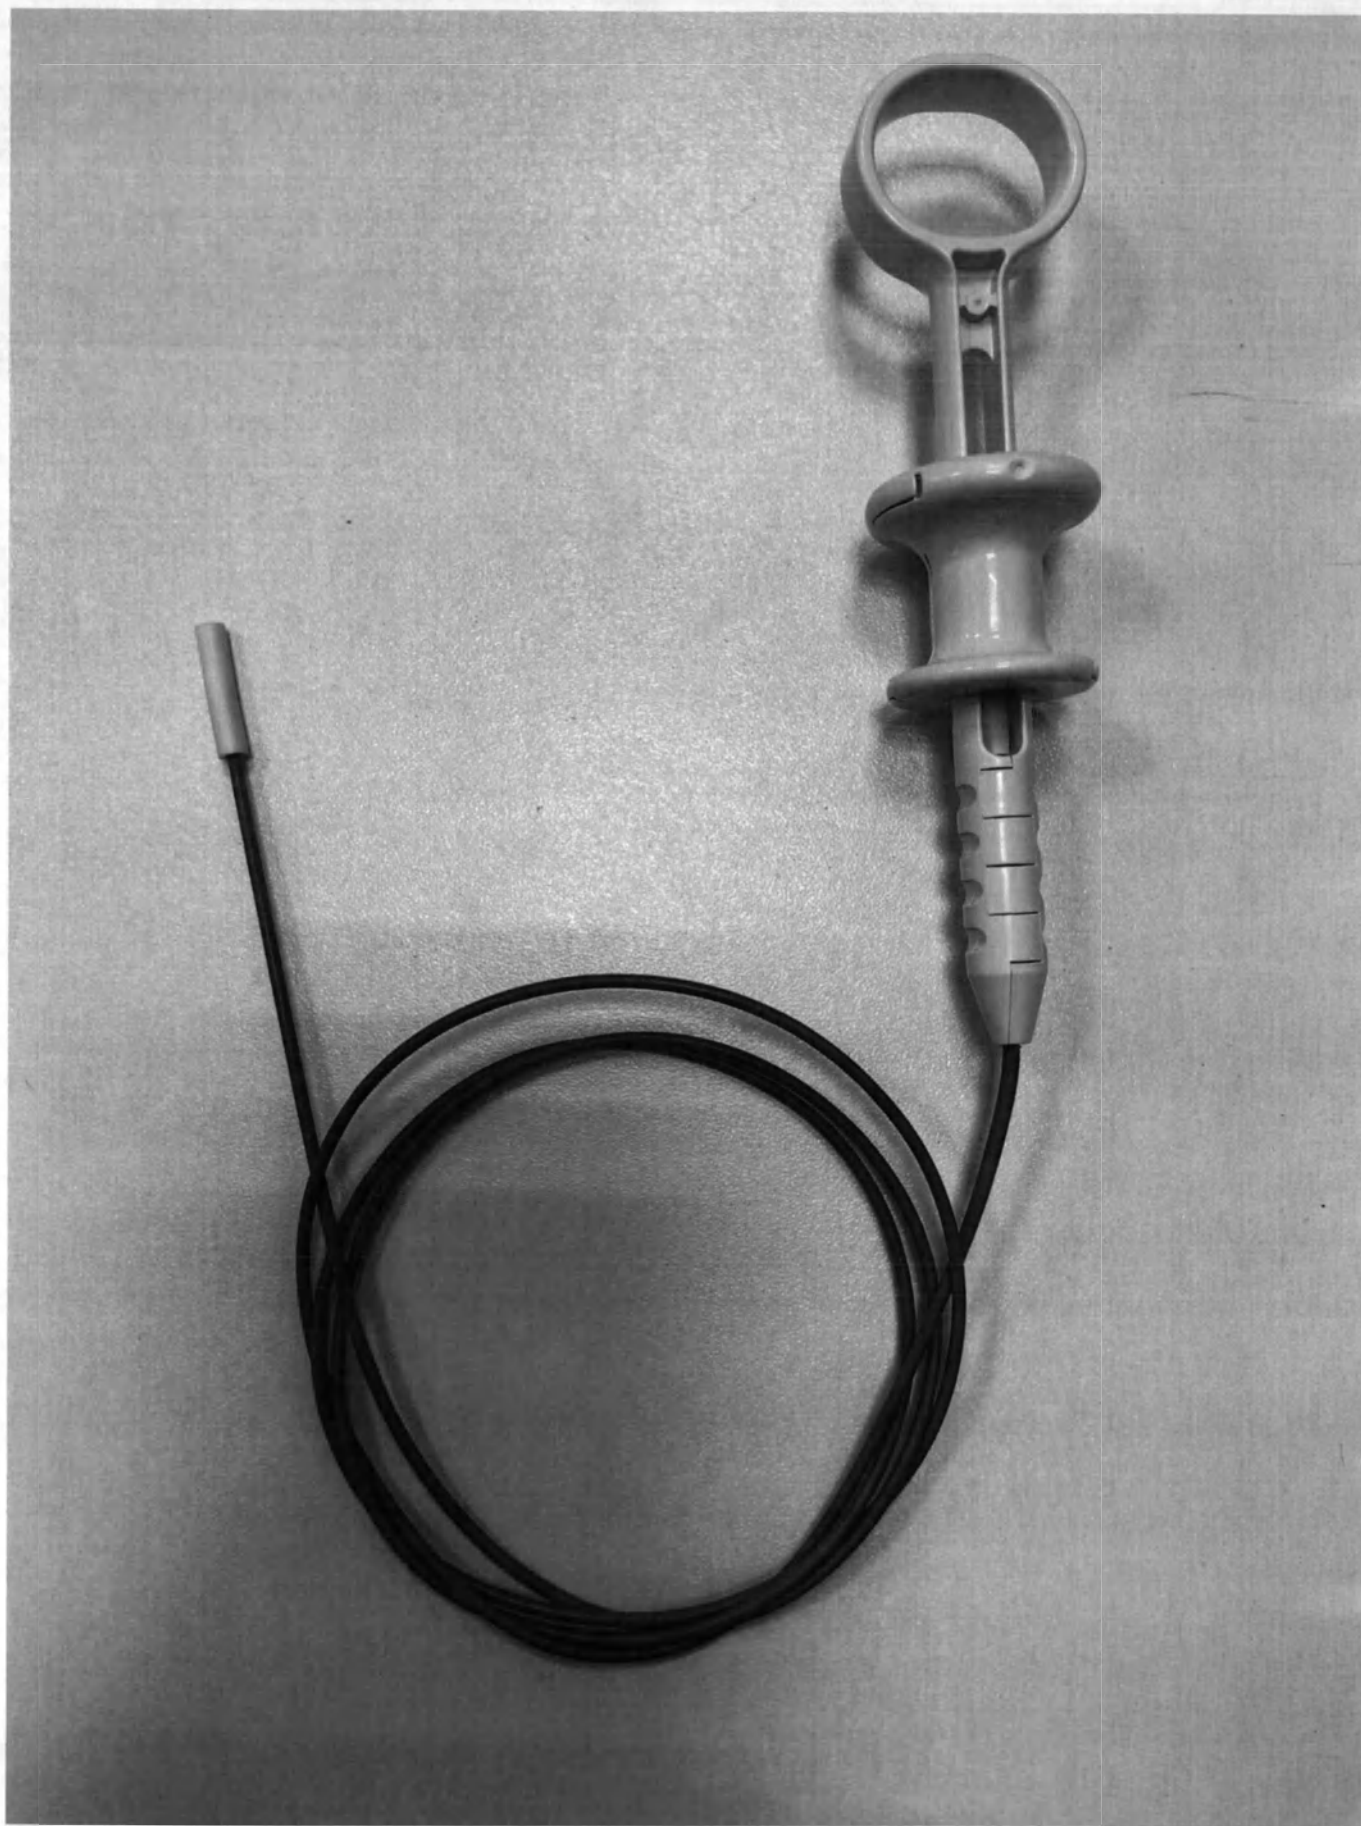


Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см»



Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические стандартного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина 100 см» в открытом состоянии.

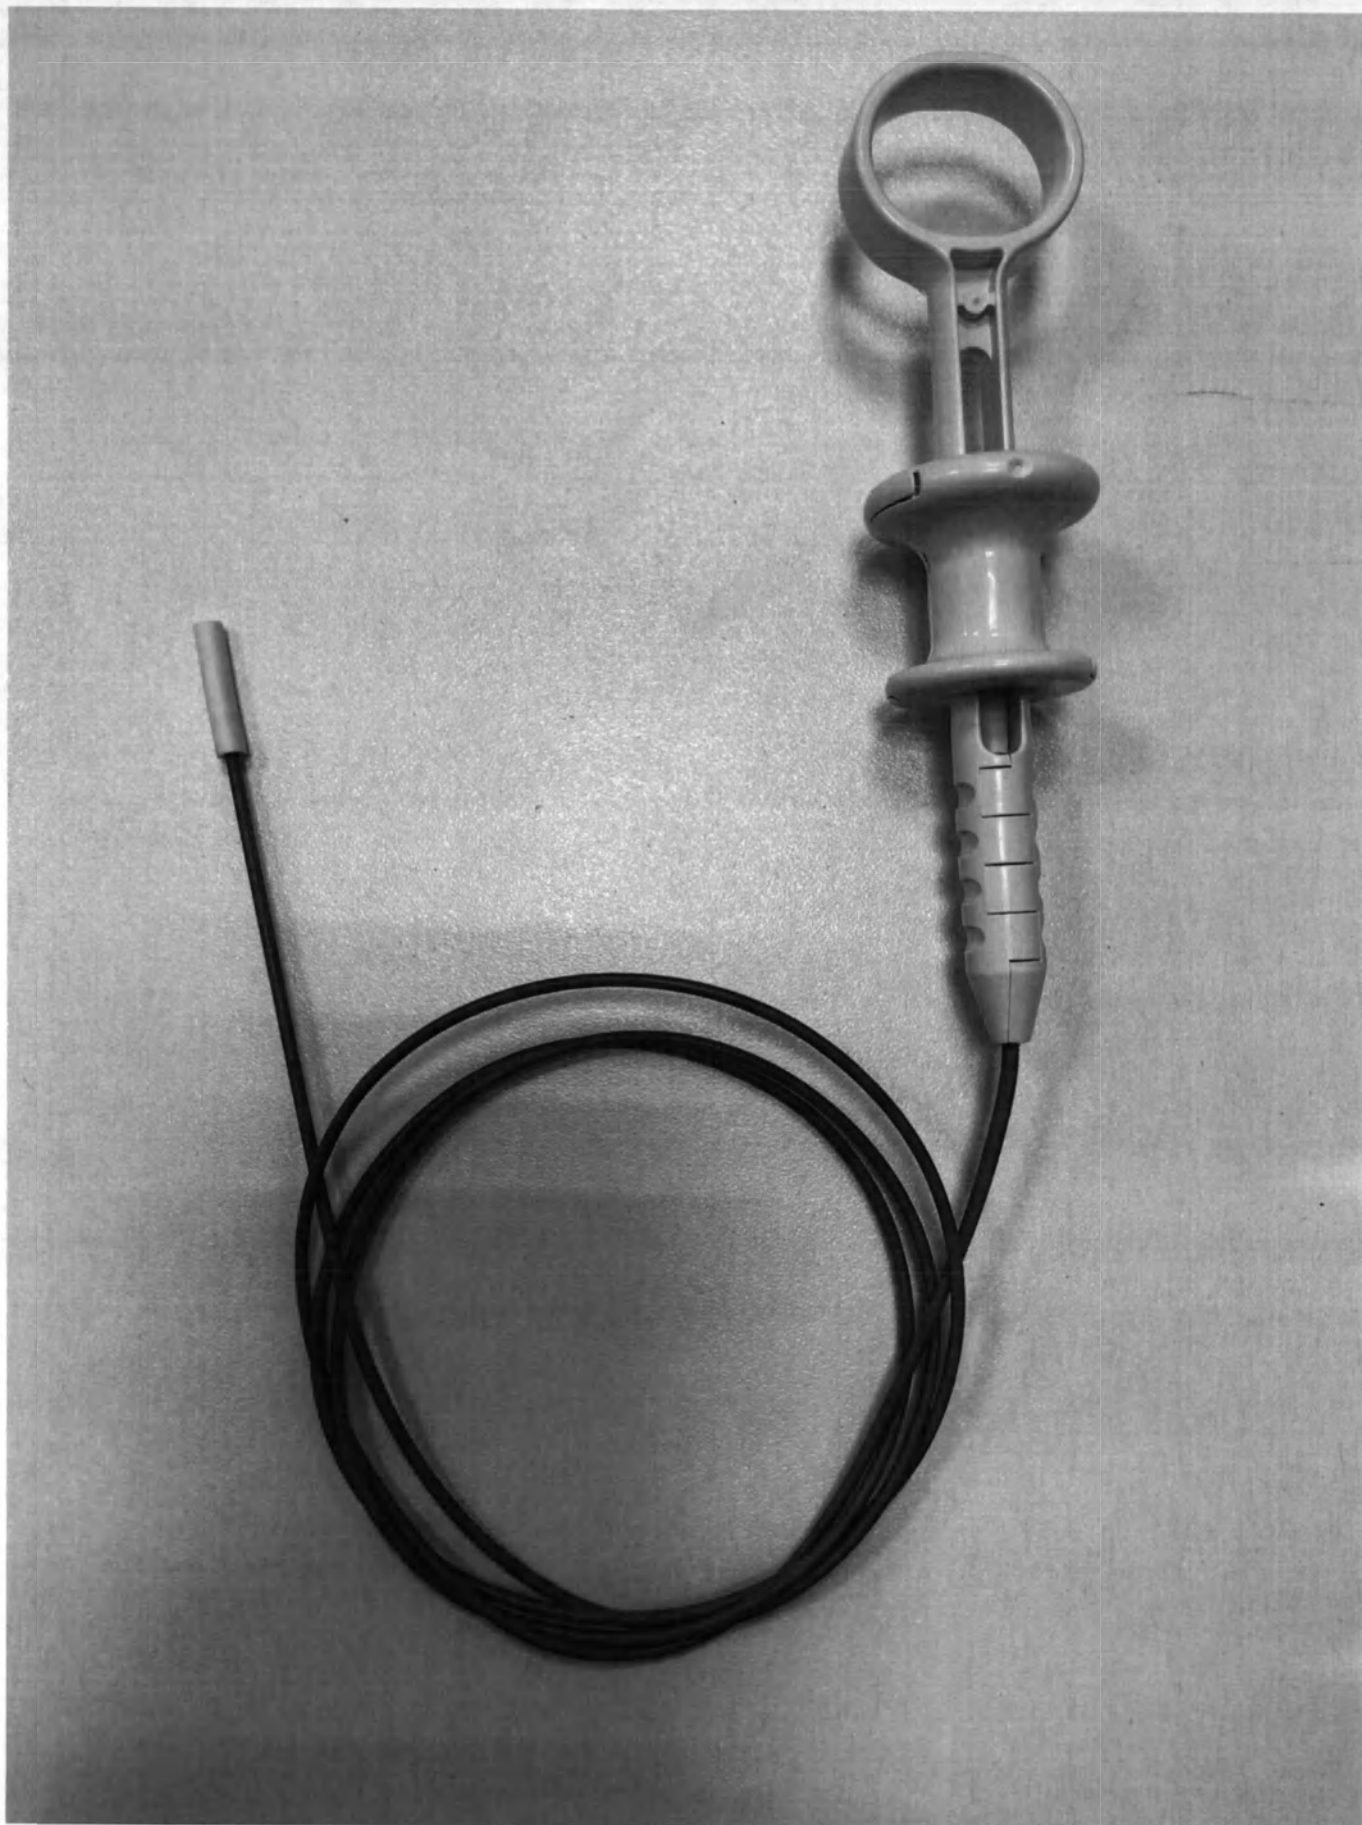

Общий вид «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 100 см»

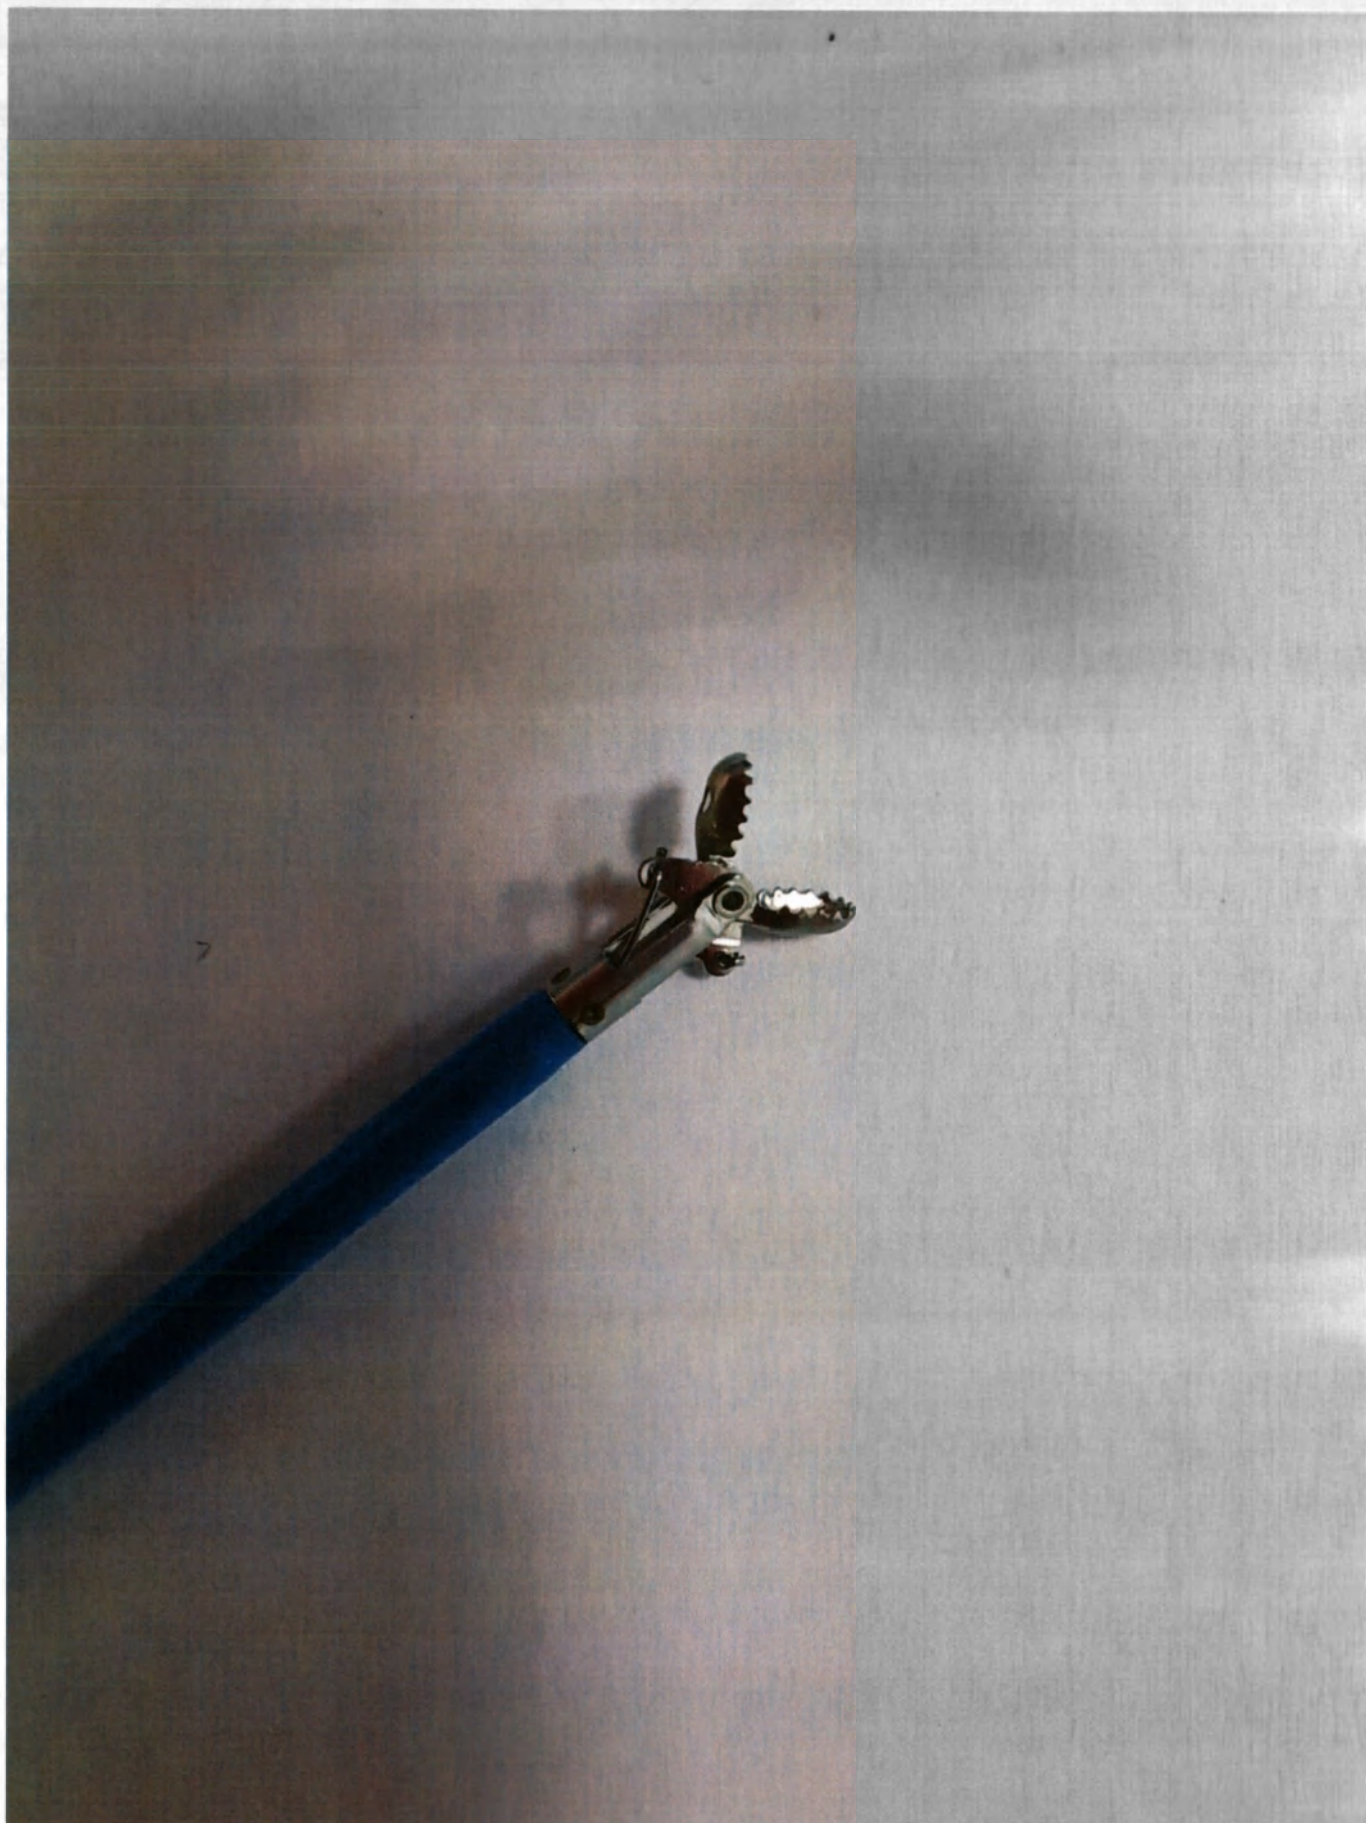

Бранши в сборе «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 100 см» в открытом состоянии.

LARGE
2.8mm

Boston
Scientific


Radial Jaw™ 4

PULMONARY LARGE CAPACITY

Single-Use Biopsy Forceps

Pinzas de biopsia de un solo uso. Pinça a biopsia a usage unique. Biopsiezange für den einmaligen Gebrauch. Pinza de biopsia monouso. Biopsierang voor eenmalig gebruik. 使い捨て型生体組織子. Biopsierang til engangsbrug. Agyódo-pegfogó, jócs, xortonc. Pinça de Biopsia para Uma Única Utilização. Biopsierang für engangsbruk. Egyzer használatos biopsziás csipesz. Jednorazové biopsické kleště. Jednorazowe szczyce biopsyjne. Biopsipinsett til engangsbruk. Tek kullannimikk Biopsi Forcepsi

Contents (20)



WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel

GTIN

08714729818076

LOT

29308970

REF

Catalog No.

M00515202

Use By

2025-04-27



90701940-04

CE 2797
Made in COSTA RICA

2546 First Street

Propark


El Ceyol, Alajuela COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>


STERILE R Sterilized using irradiation.




Коробка . «Щипцы биопсийные одноразовые Radial Jaw 4, пульмонологические увеличенного объема, минимальная рекомендуемая ширина рабочего канала 2,8 мм, рабочая длина 100 см»
(сторона 1)

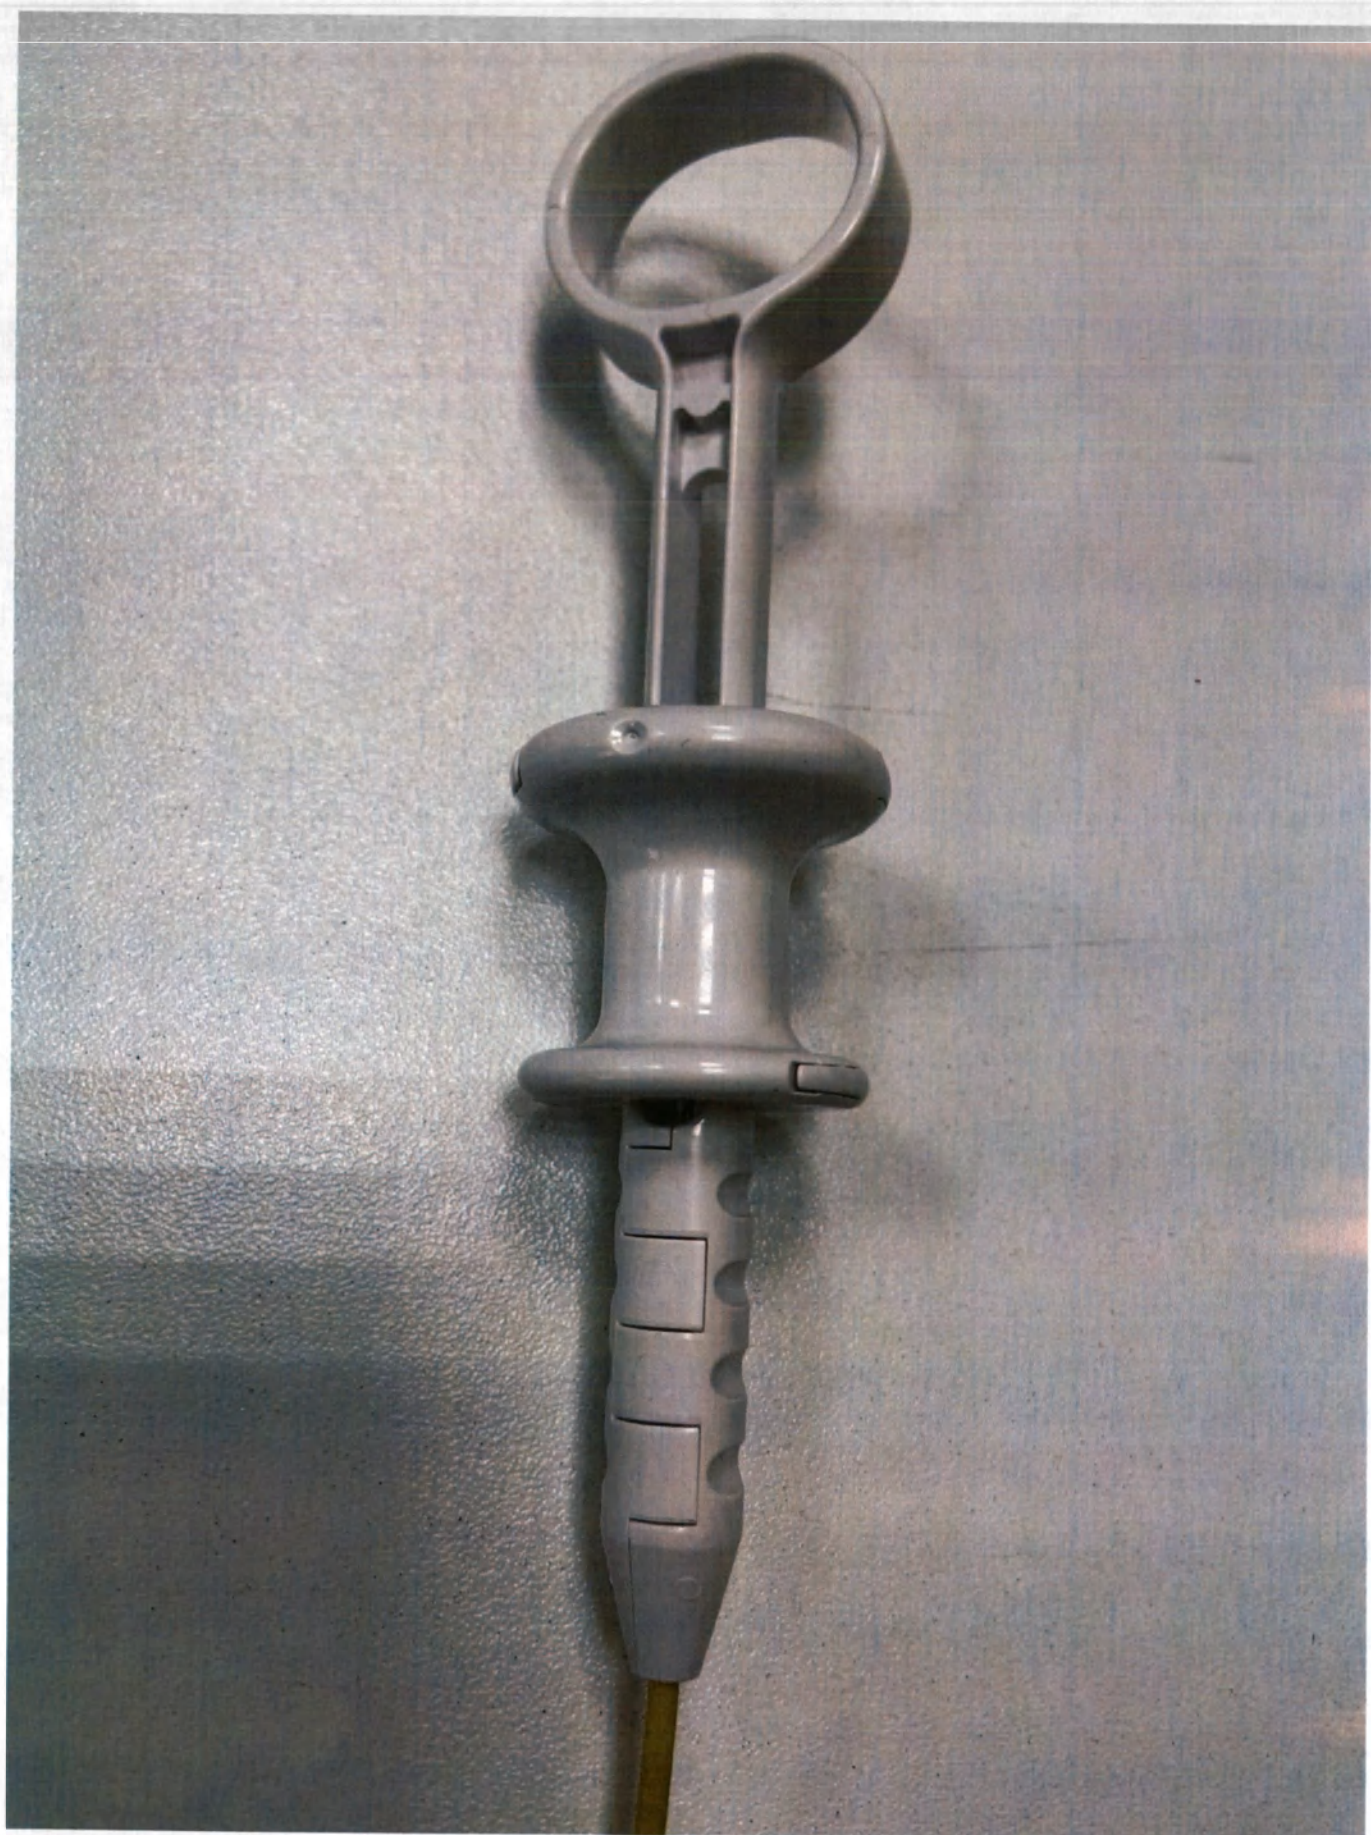

Рукоятка (для всех вариантов исполнения кроме Jumbo)

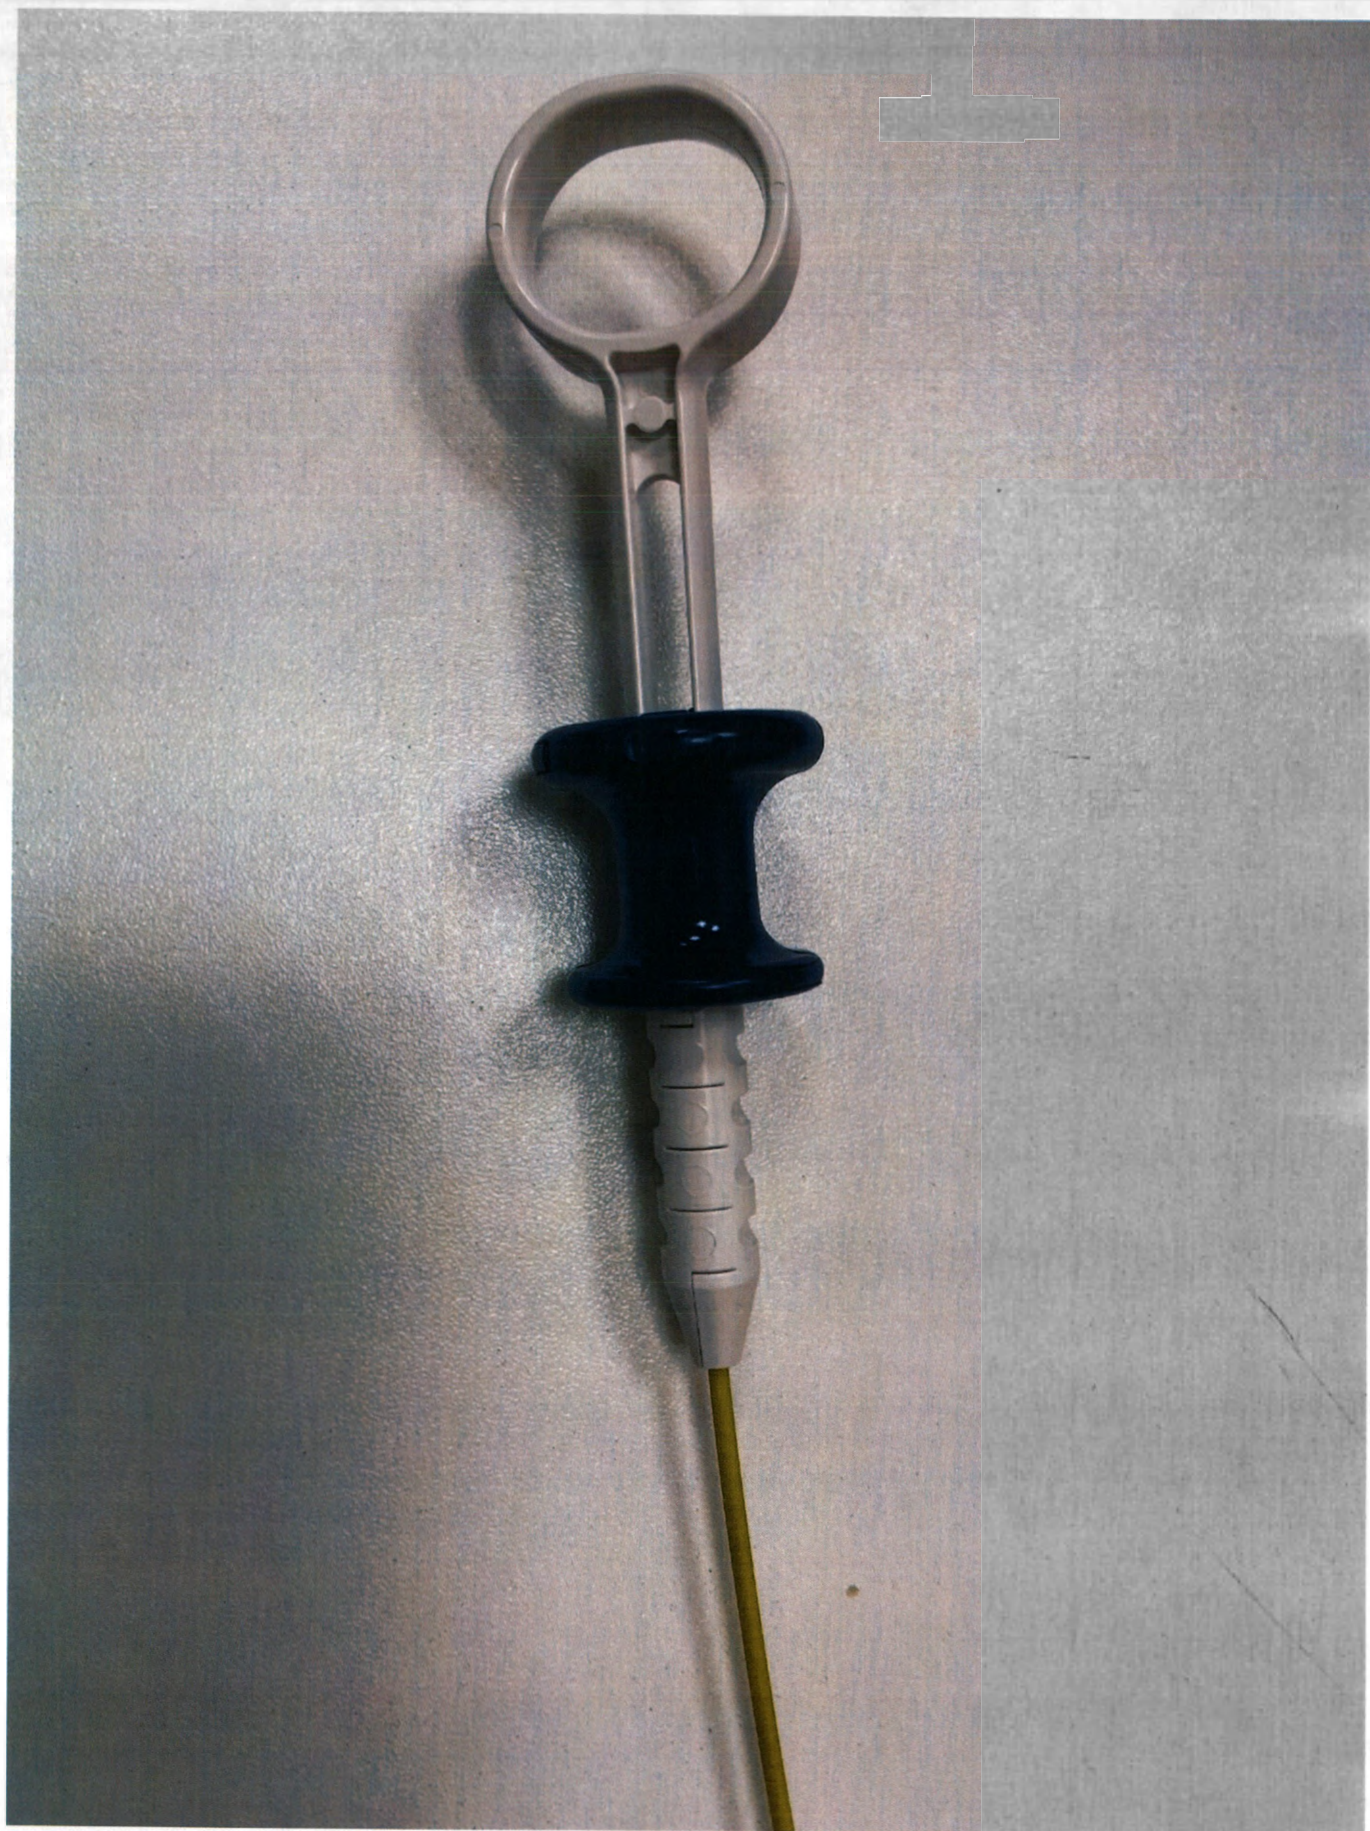


Рукоятка (для вариантов исполнения Jumbo)

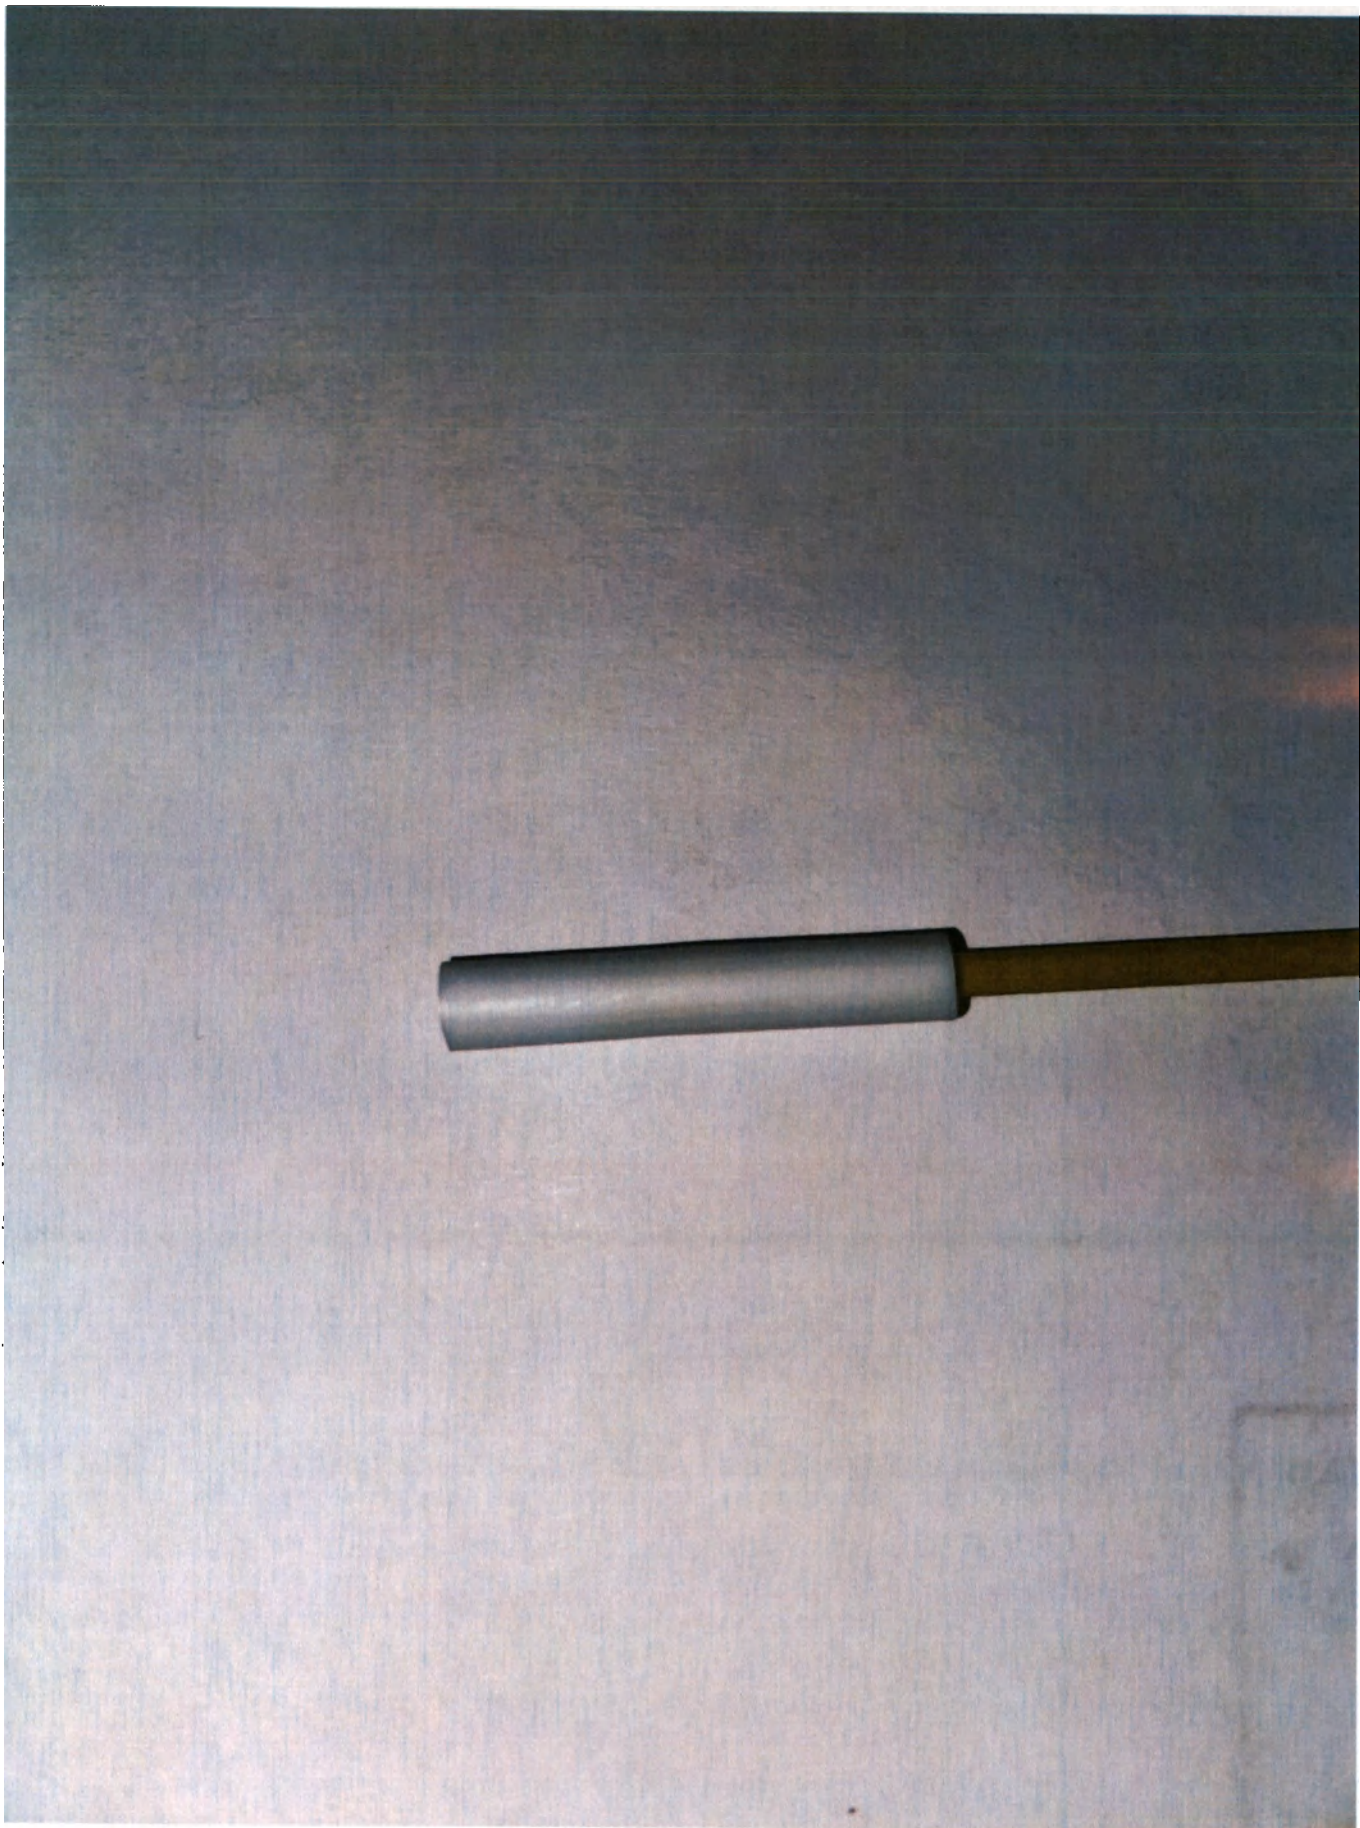

Трубка дистального конца



Запечатываемый пакет (сторона 2)



Инструкция по применению




Коробка (сторона 2)

**Boston
Scientific**



**EU Authorized
Representative**
Boston Scientific Limited
Ballyknitt Business Park
Colmoy
IRELAND



**Legal
Manufacturer**
Boston Scientific Corporation
200 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-372-1891

Rx ONLY

 For single use only.
Do not reuse.

 Do Not
STERILIZE
Resterilize

 Consult instructions
for use.

 Do not use if package
is damaged.

Коробка (сторона 3)

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
77 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

