

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Набор контрольных сывороток для контроля качества определения
общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях
иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e
analyzers)**

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 3
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Roche Diagnostics Rus LLC

2, Letnikovskaya street, bld.3
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru


Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилуминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers),

в составе:


1. Сыворотка контрольная 1 (PC SYPH1, отрицательная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.
2. Сыворотка контрольная 2 (PC SYPH2, положительная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.
3. Флакон пустой, объемом 2 мл - 4 шт.
4. Этикетка для флакона – 12 шт.;
5. Инструкция по применению



Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers)

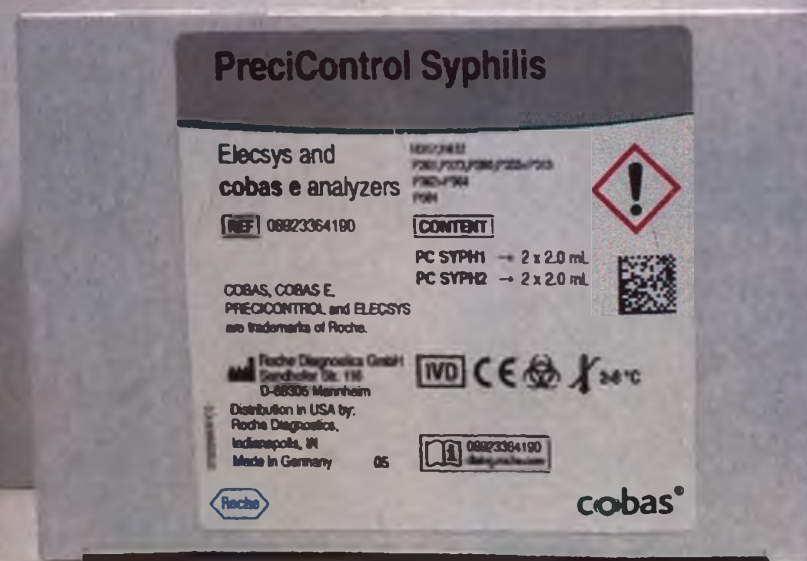

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers)

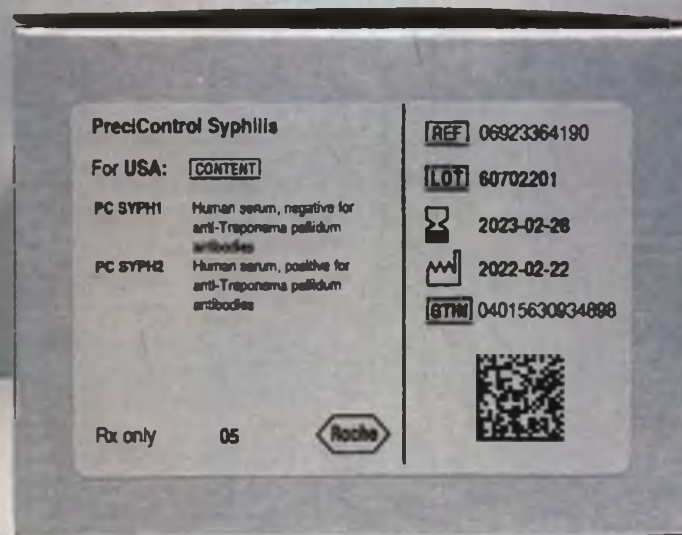

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers)

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers),

в составе:

1. Сыворотка контрольная 1 (PC SYPH1, отрицательная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.
2. Сыворотка контрольная 2 (PC SYPH2, положительная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.
3. Флакон пустой, объемом 2 мл - 4 шт.
4. Этикетка для флакона - 12 шт.
5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6021 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВПЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.


E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 06923364190

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers),
в составе:

1. Сыворотка контрольная 1 (PC SYPH1, отрицательная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.

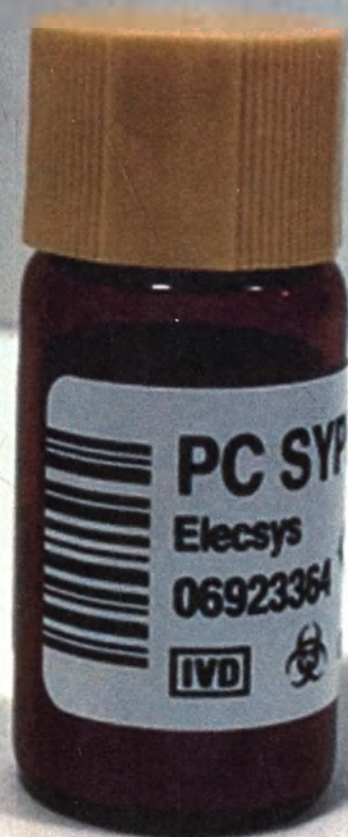

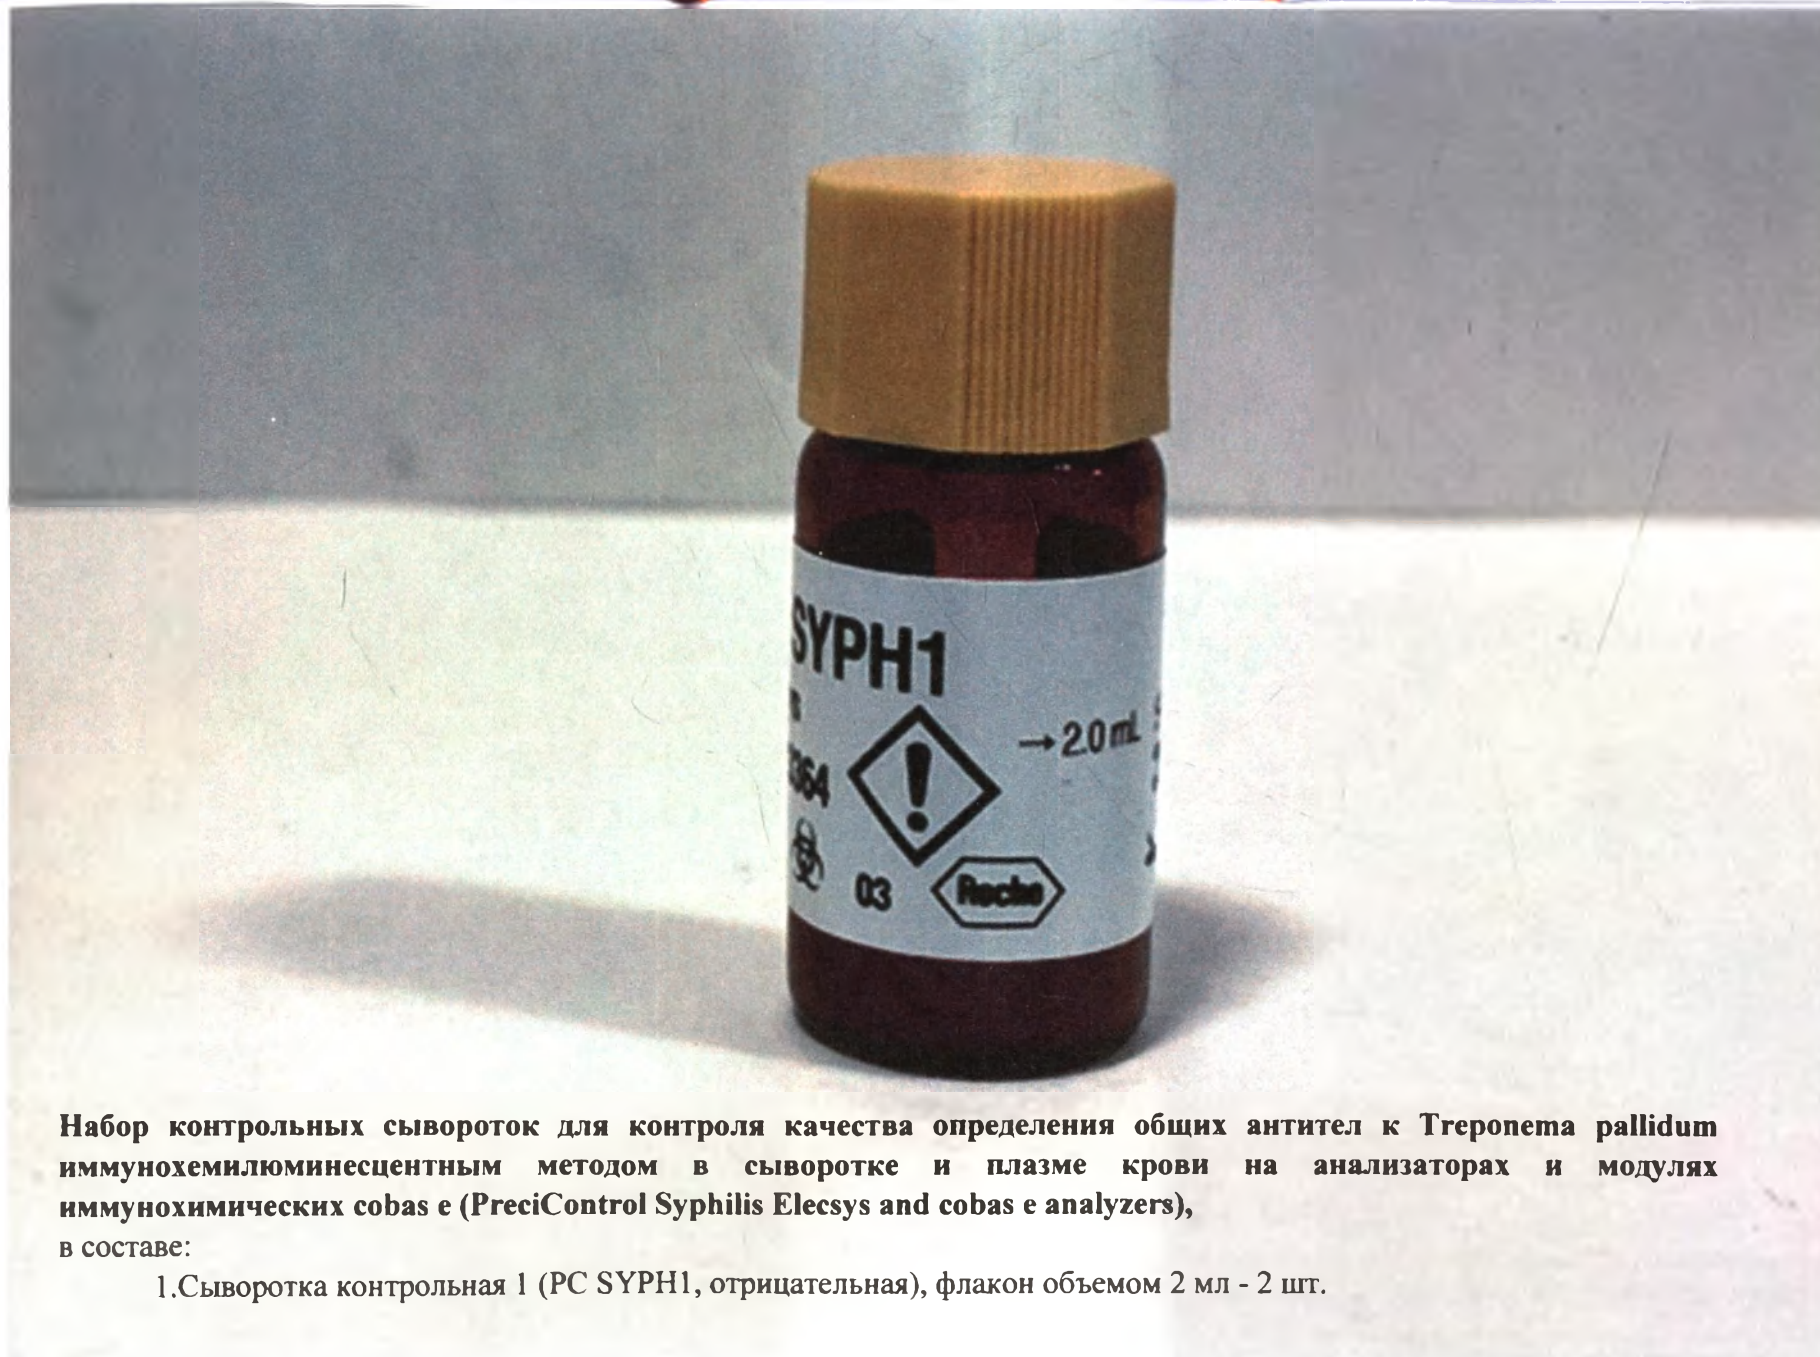



Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Сыворотка контрольная 1 (PC SYPH1, отрицательная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Сыворотка контрольная 1 (PC SYPH1, отрицательная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.

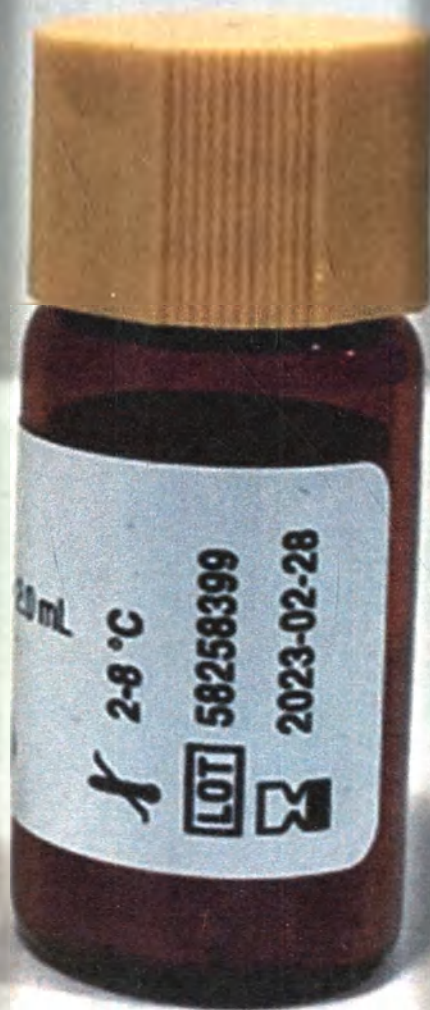

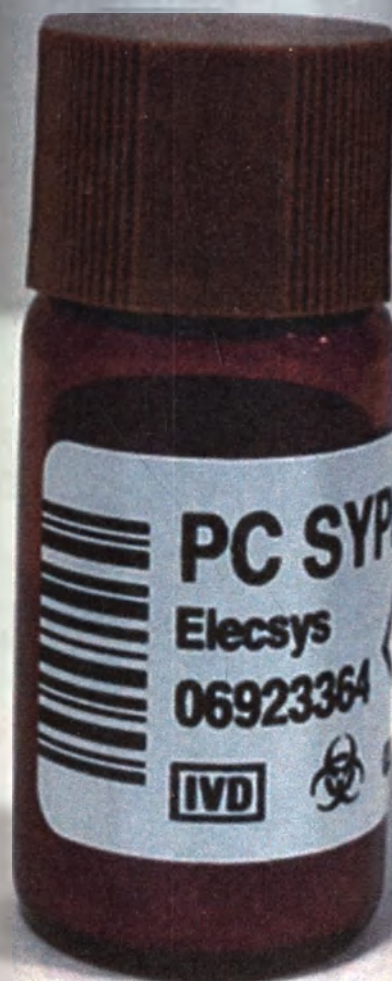

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PeciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

2.Сыворотка контрольная 2 (PC SYPH2, положительная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.




Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers),
в составе:

2. Сыворотка контрольная 2 (PC SYPH2, положительная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers),

в составе:


2. Сыворотка контрольная 2 (PC SYPH2, положительная), флакон объемом 2 мл - 2 шт.

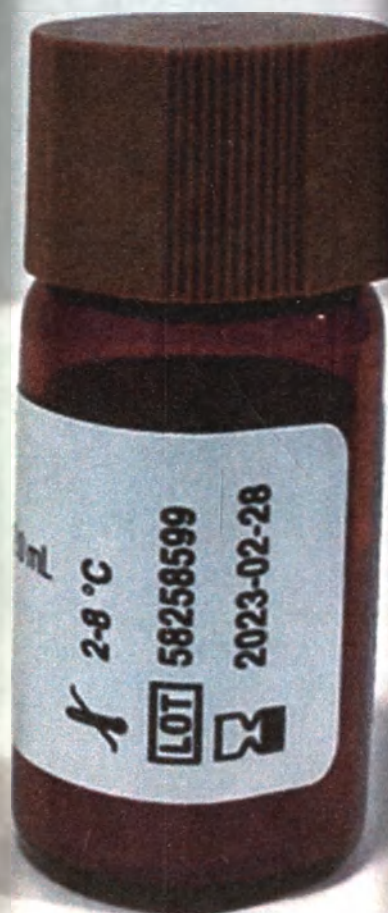

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers),


в составе:

3. Флакон пустой, объемом 2 мл - 4 шт.

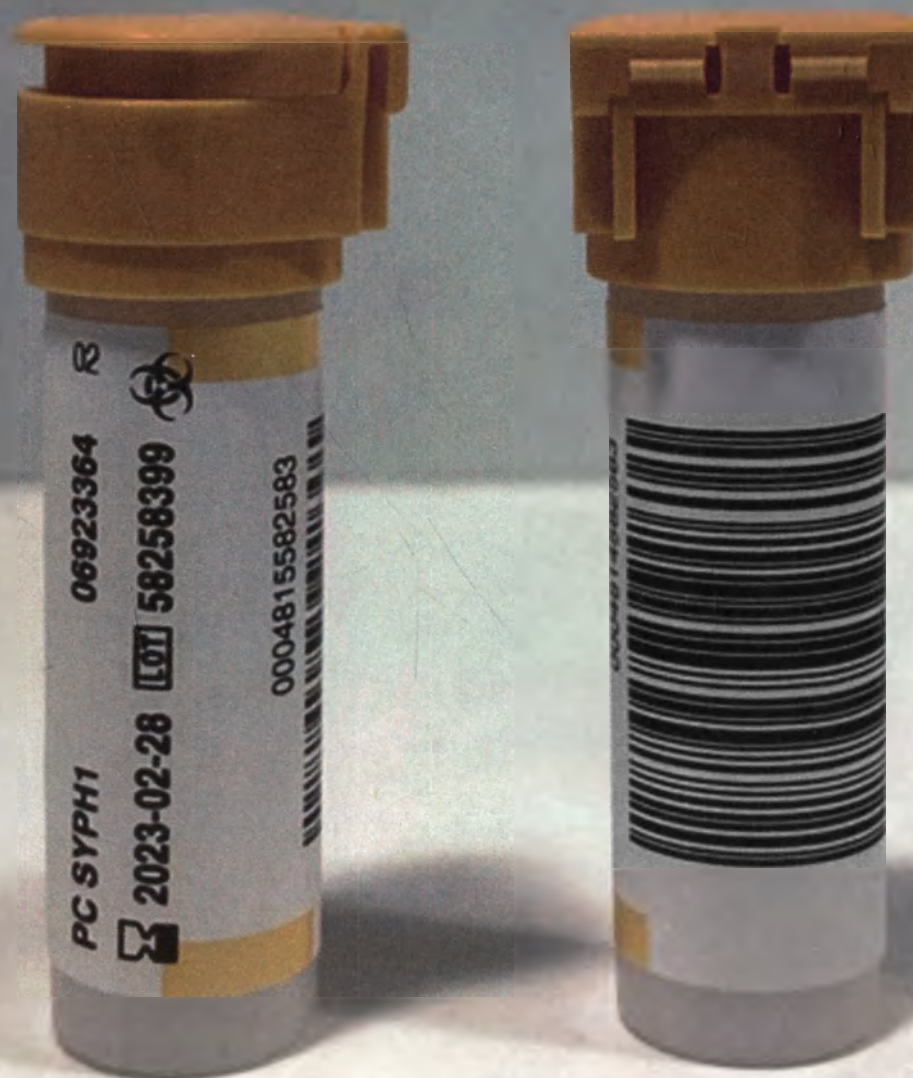

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

3. Флакон пустой, объемом 2 мл - 4 шт.

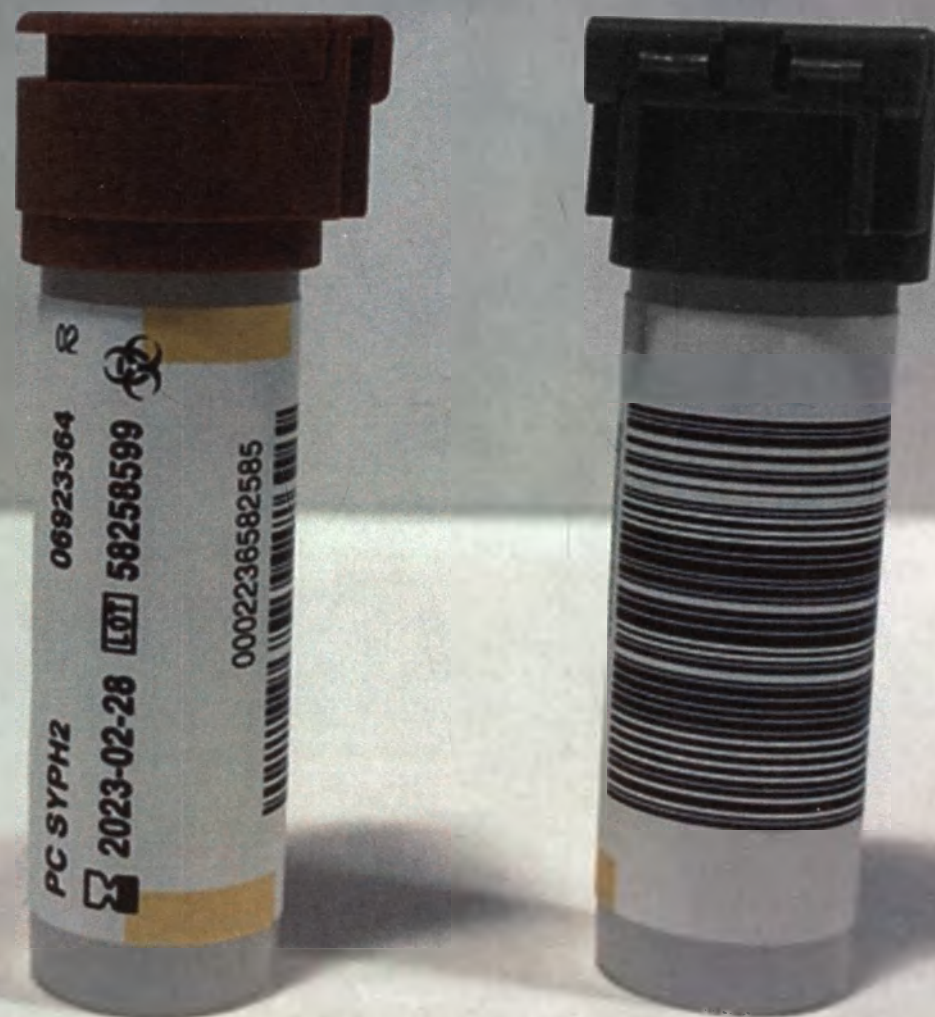



Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к *Treponema pallidum* иммунохемилуминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Syphilis Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

4.Этикетка для флакона – 12 шт.;



Копия
№ 1.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
14 листа (ов)

по доверенности
от 11.02.2022 г.