

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers),

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

ООО «Рош Диагностика Рус»

Россия, 115114, Москва
ул. Летниковская, дом 2, стр. 3
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Факс: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Roche Diagnostics Rus LLC


2, Letnikovskaya street, bld.3
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia

Тел.: +7 (495) 229 69 99
Fax: +7 (495) 229 62 64

www.roche.ru

Набор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе:


1. Калибратор 1 (FERR Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (FERR Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Карта со штрих-кодом – 1 шт.;

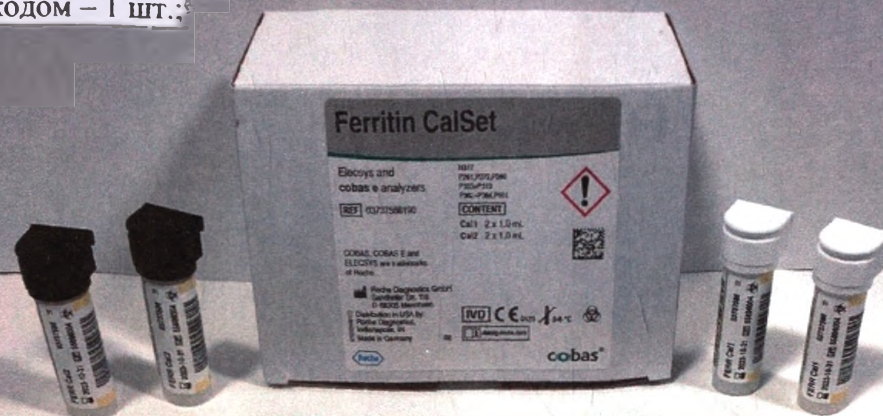

бор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови
мунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet
Elecsys and cobas e analyzers)



бор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови
мунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet
ecsys and cobas e analyzers)

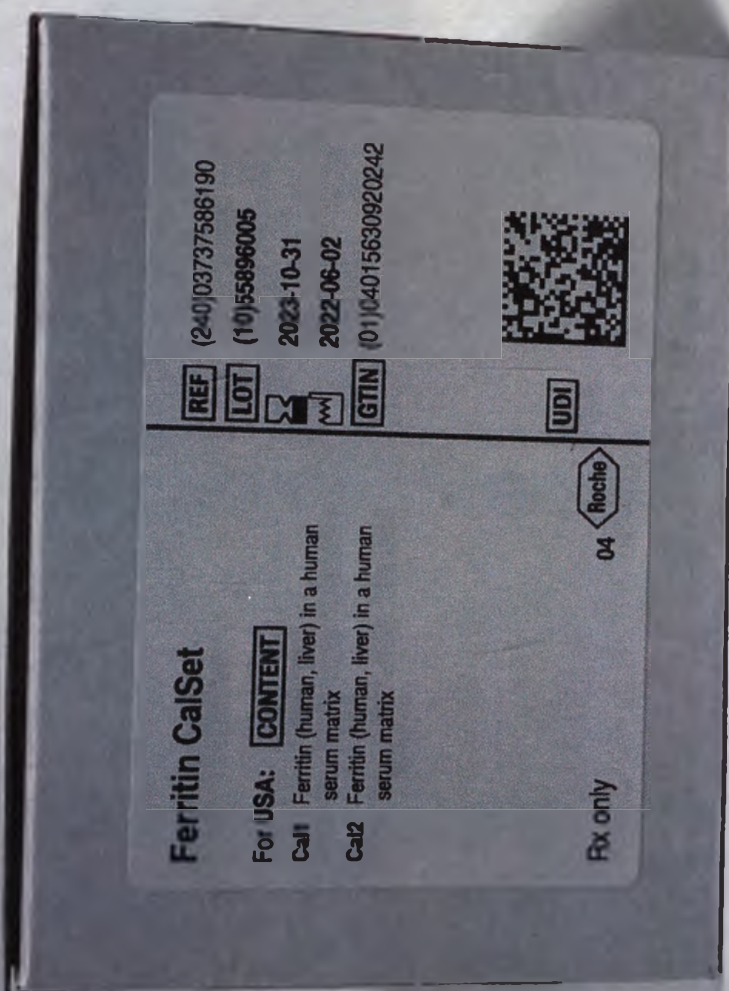

Набор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Ferritin CalSet

Набор калибраторов для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах модулей иммунохимических cobas e (Ferritin CalSet Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (FERR Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (FERR Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Карта со штрих-кодом – 1 шт.;
4. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14469 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Активна к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диалогистикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диалогистика Рус» (ООО «Рох Диалогистика Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д 2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 03737386190



индикатор 1 (FERR Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;



2. Калибратор 2 (FERR Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

3.Карта со штрих-кодом – 1 шт.;


FERR
CalSet

Elecsys
and cobas e analyzers


03737586

381

LOT 558960



01

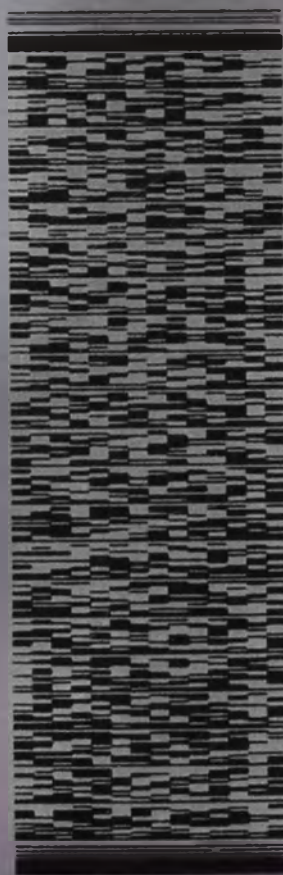



по доверенности
от 11.02.2022 г.

Кодов 10.7

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
8 листа (ов)