

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Система поддержки функций сердца и легких
Rotaflow II System*

Производства


«Маке Кардиопульмонари ГмбХ» /

Maquet Cardiopulmonary GmbH

Kehler Str. 31, 76437 Rastatt Germany

Regulatory.Affairs.cp@maquet.com

Аппарат Rotaflow II

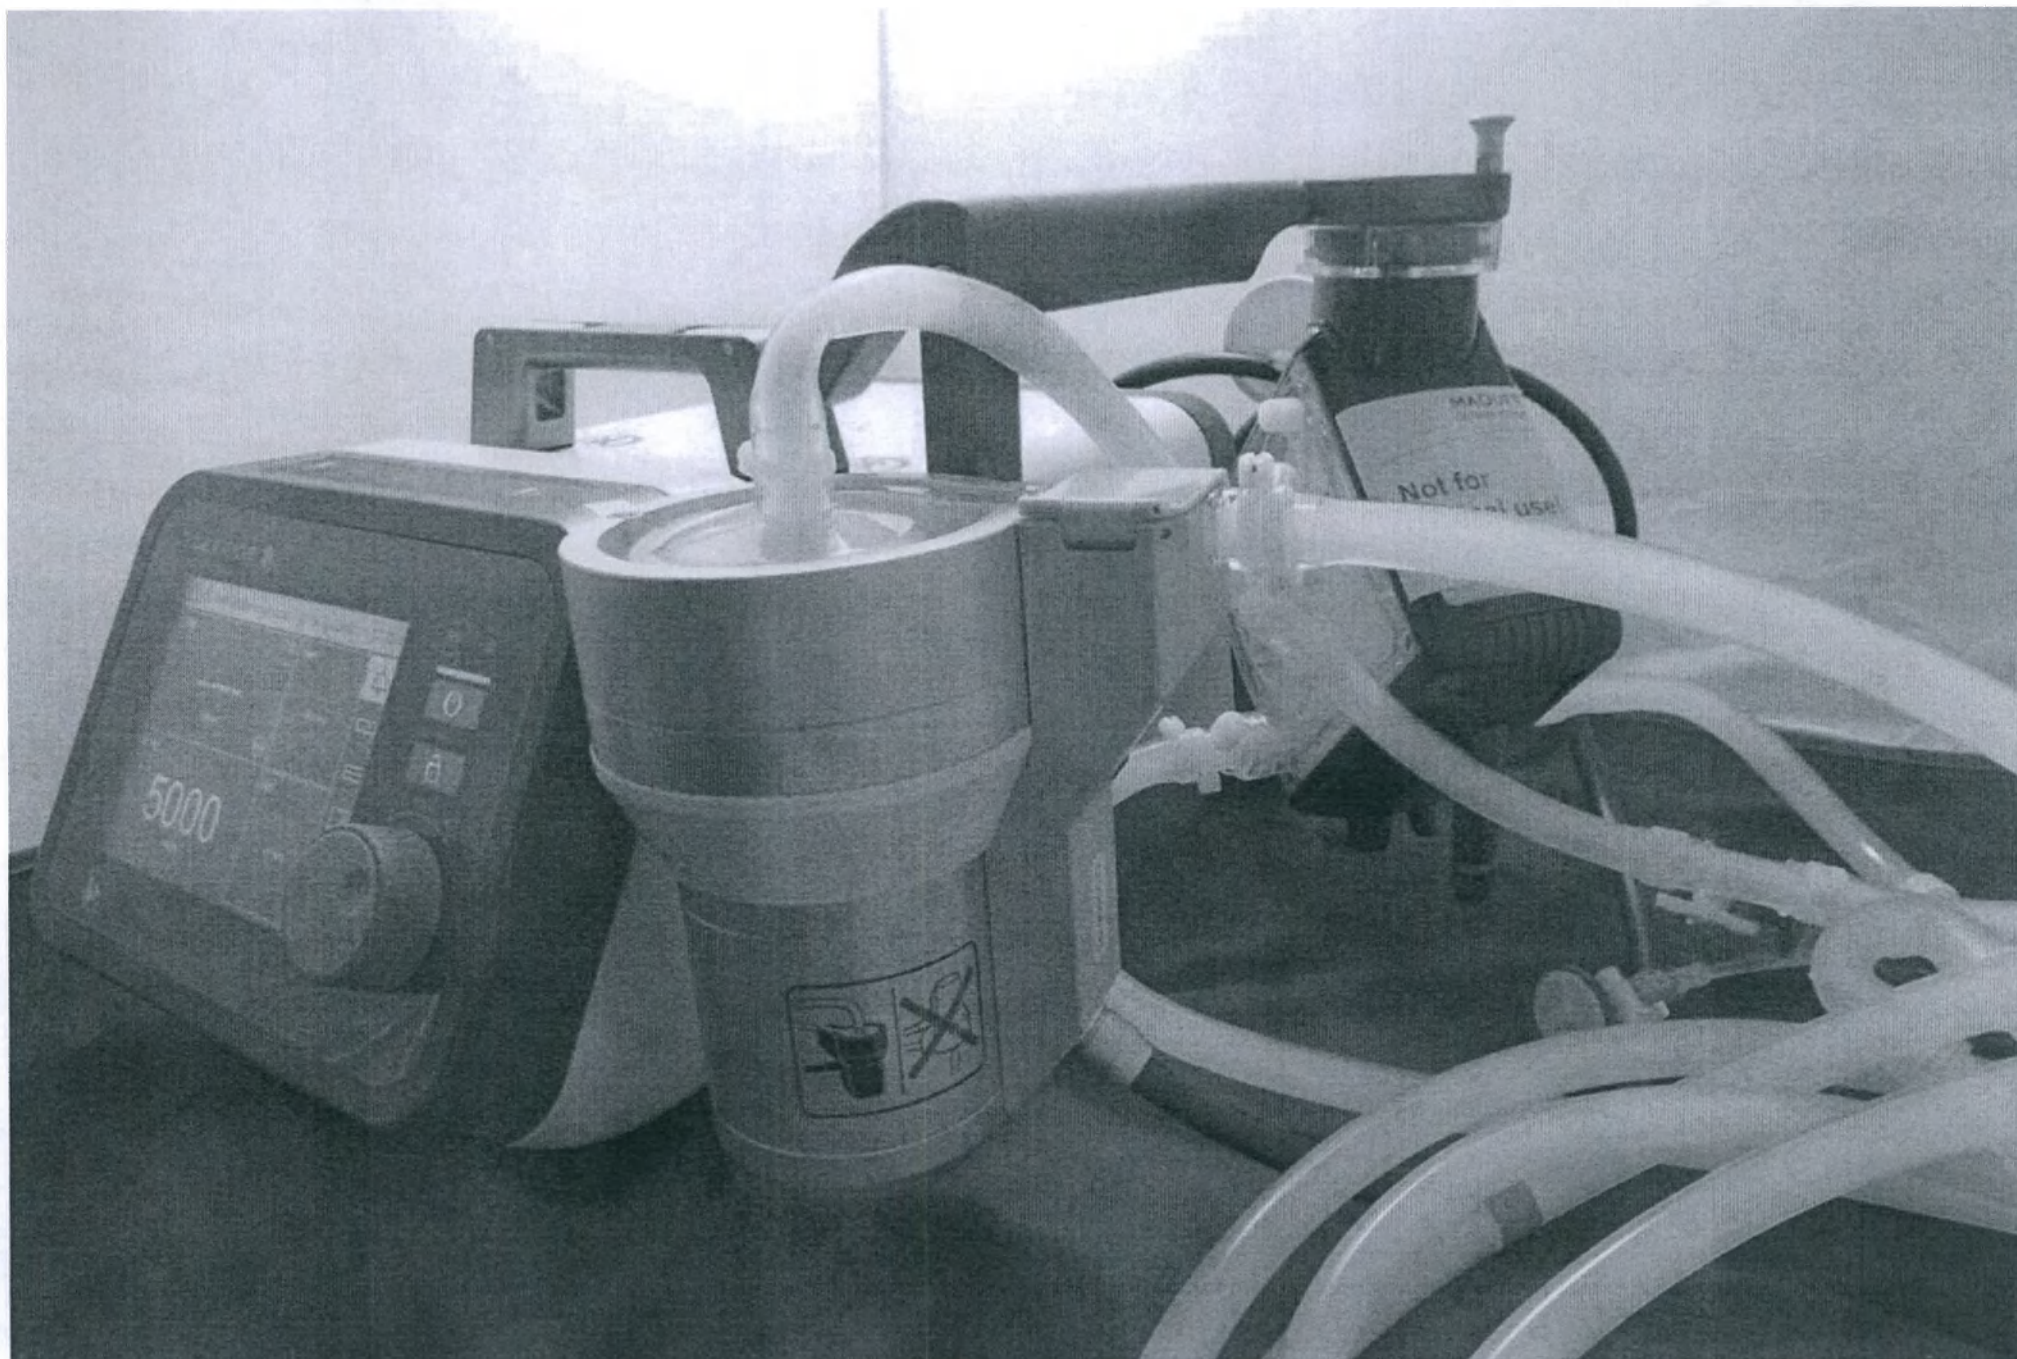


Аппарат Rotaflow II




1. Аппарат Rotaflow II (основной блок) (Rotaflow II Base Unit)



1. Аппарат Rotaflow II (основной блок) (Rotaflow II Base Unit)

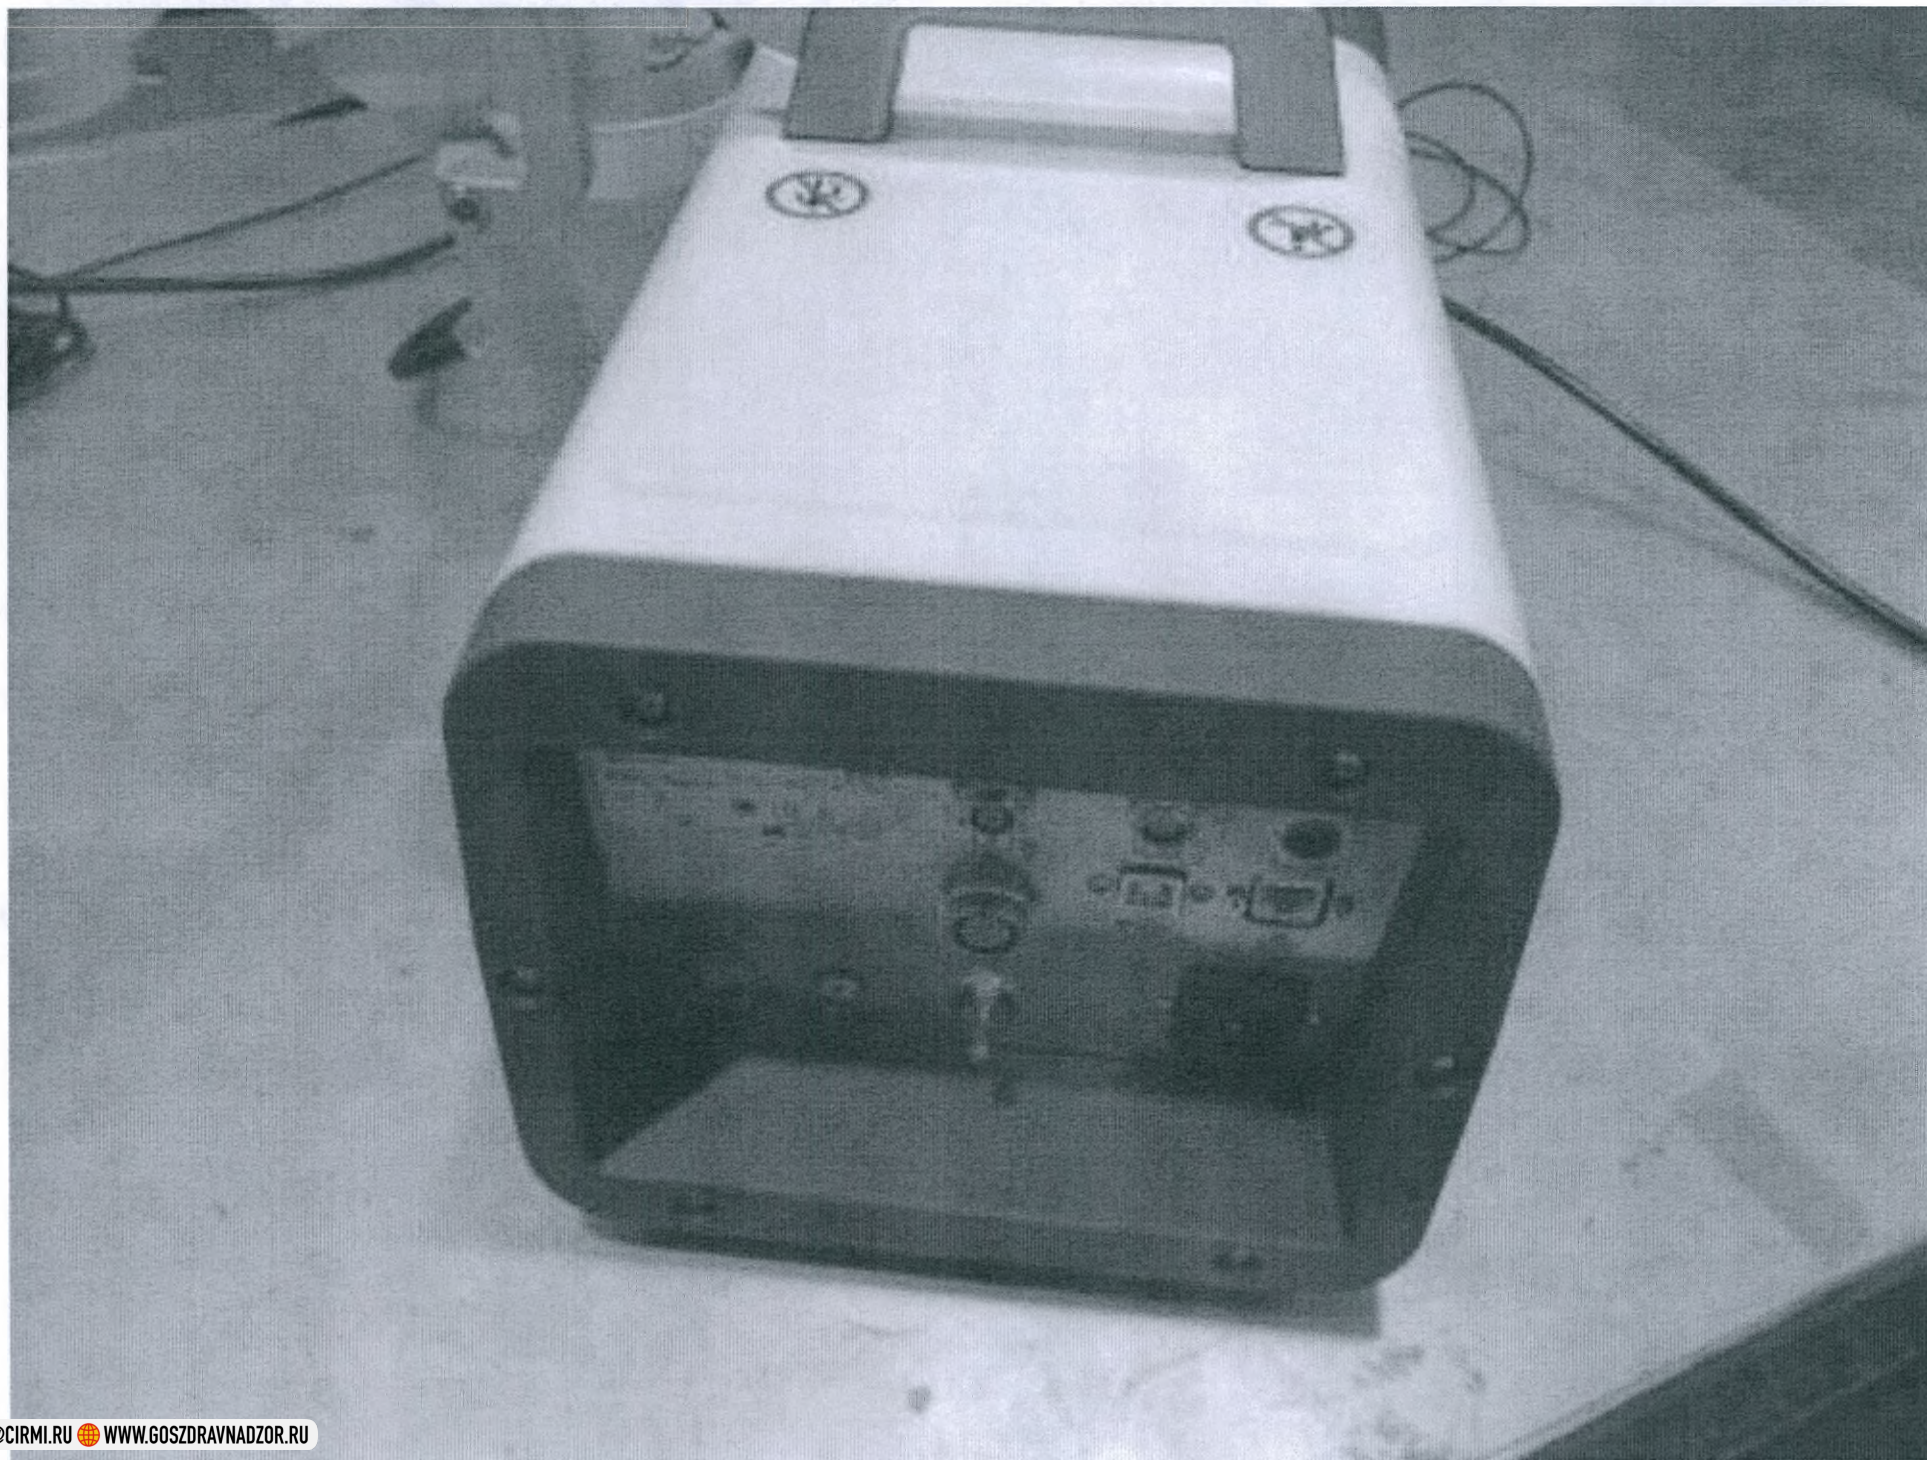


1. Аппарат Rotaflow II (основной блок) (Rotaflow II Base Unit)

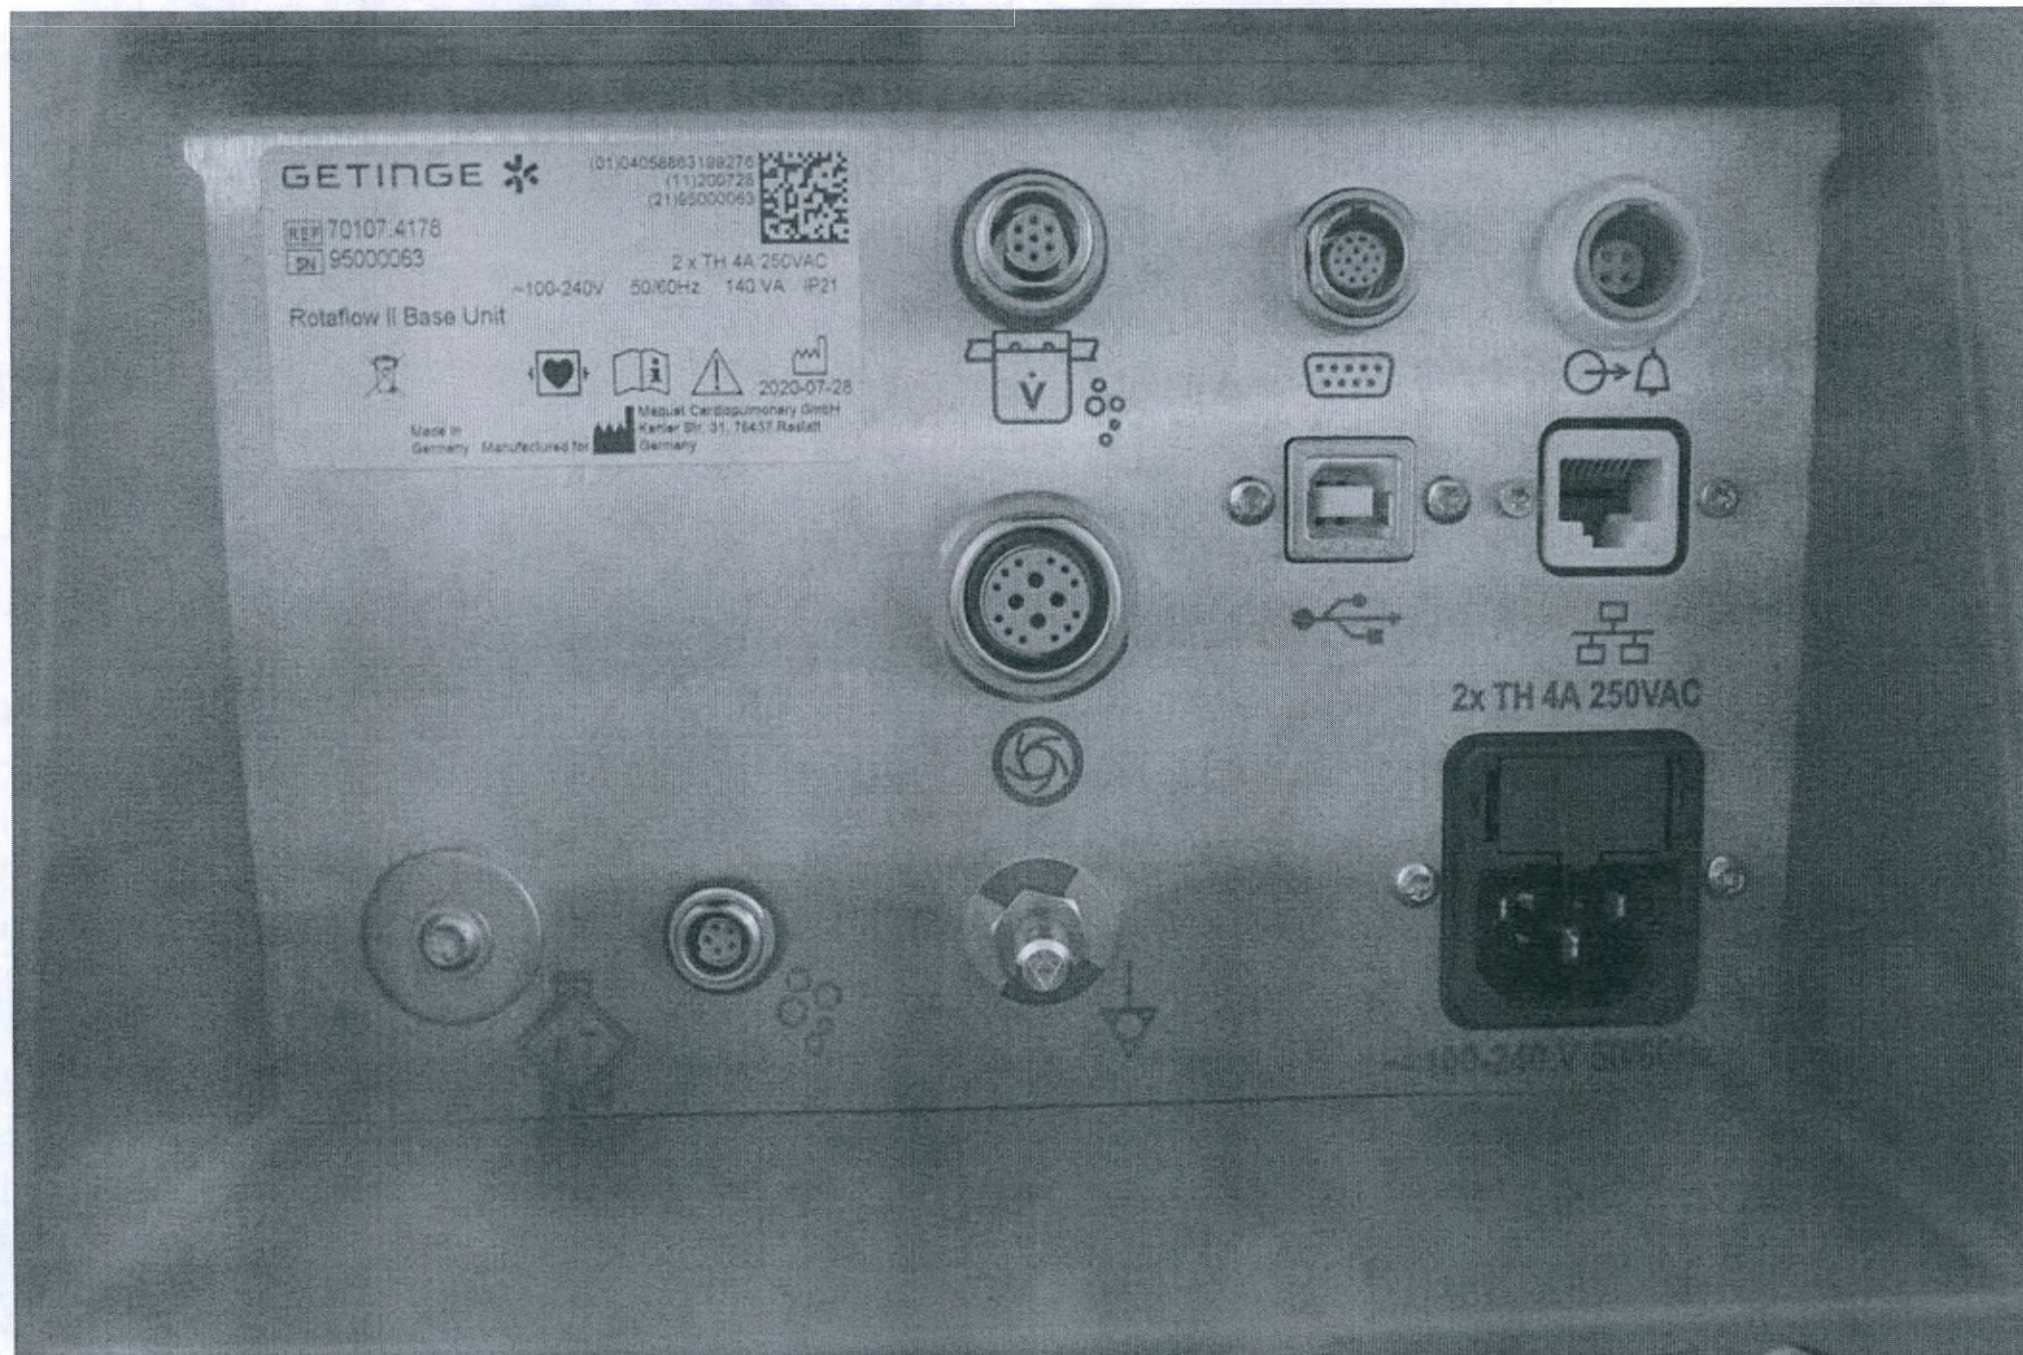


1. Аппарат Rotaflow II (основной блок) (Rotaflow II Base Unit)




1. Аппарат Rotaflow II (основной блок) (Rotaflow II Base Unit)

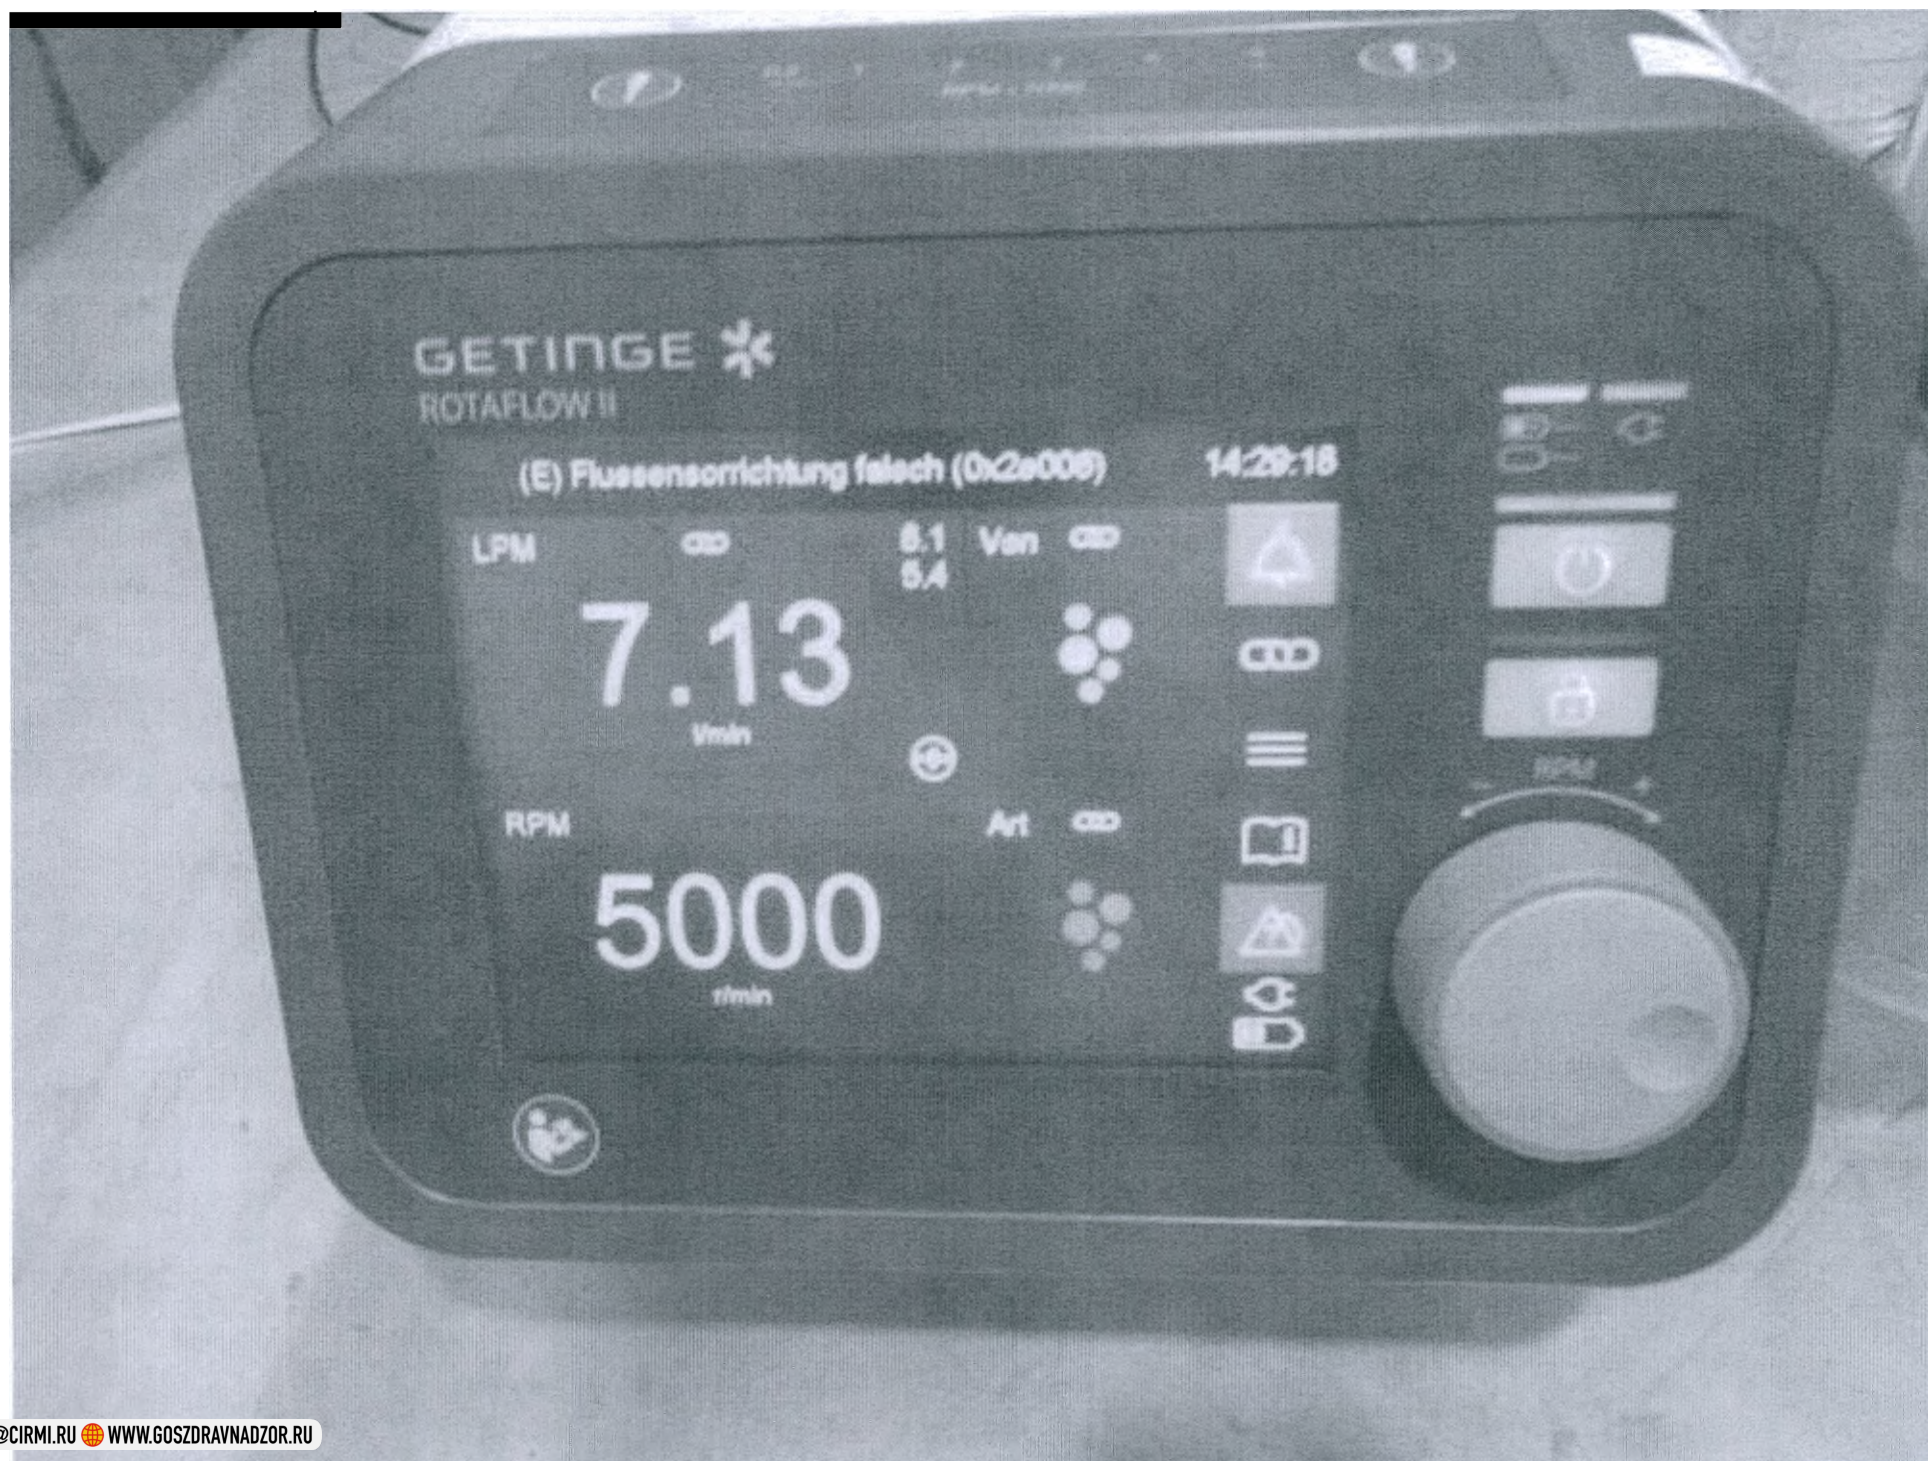


2. Кабель сетевого питания аппарата Rotaflow II (Mains power cable)

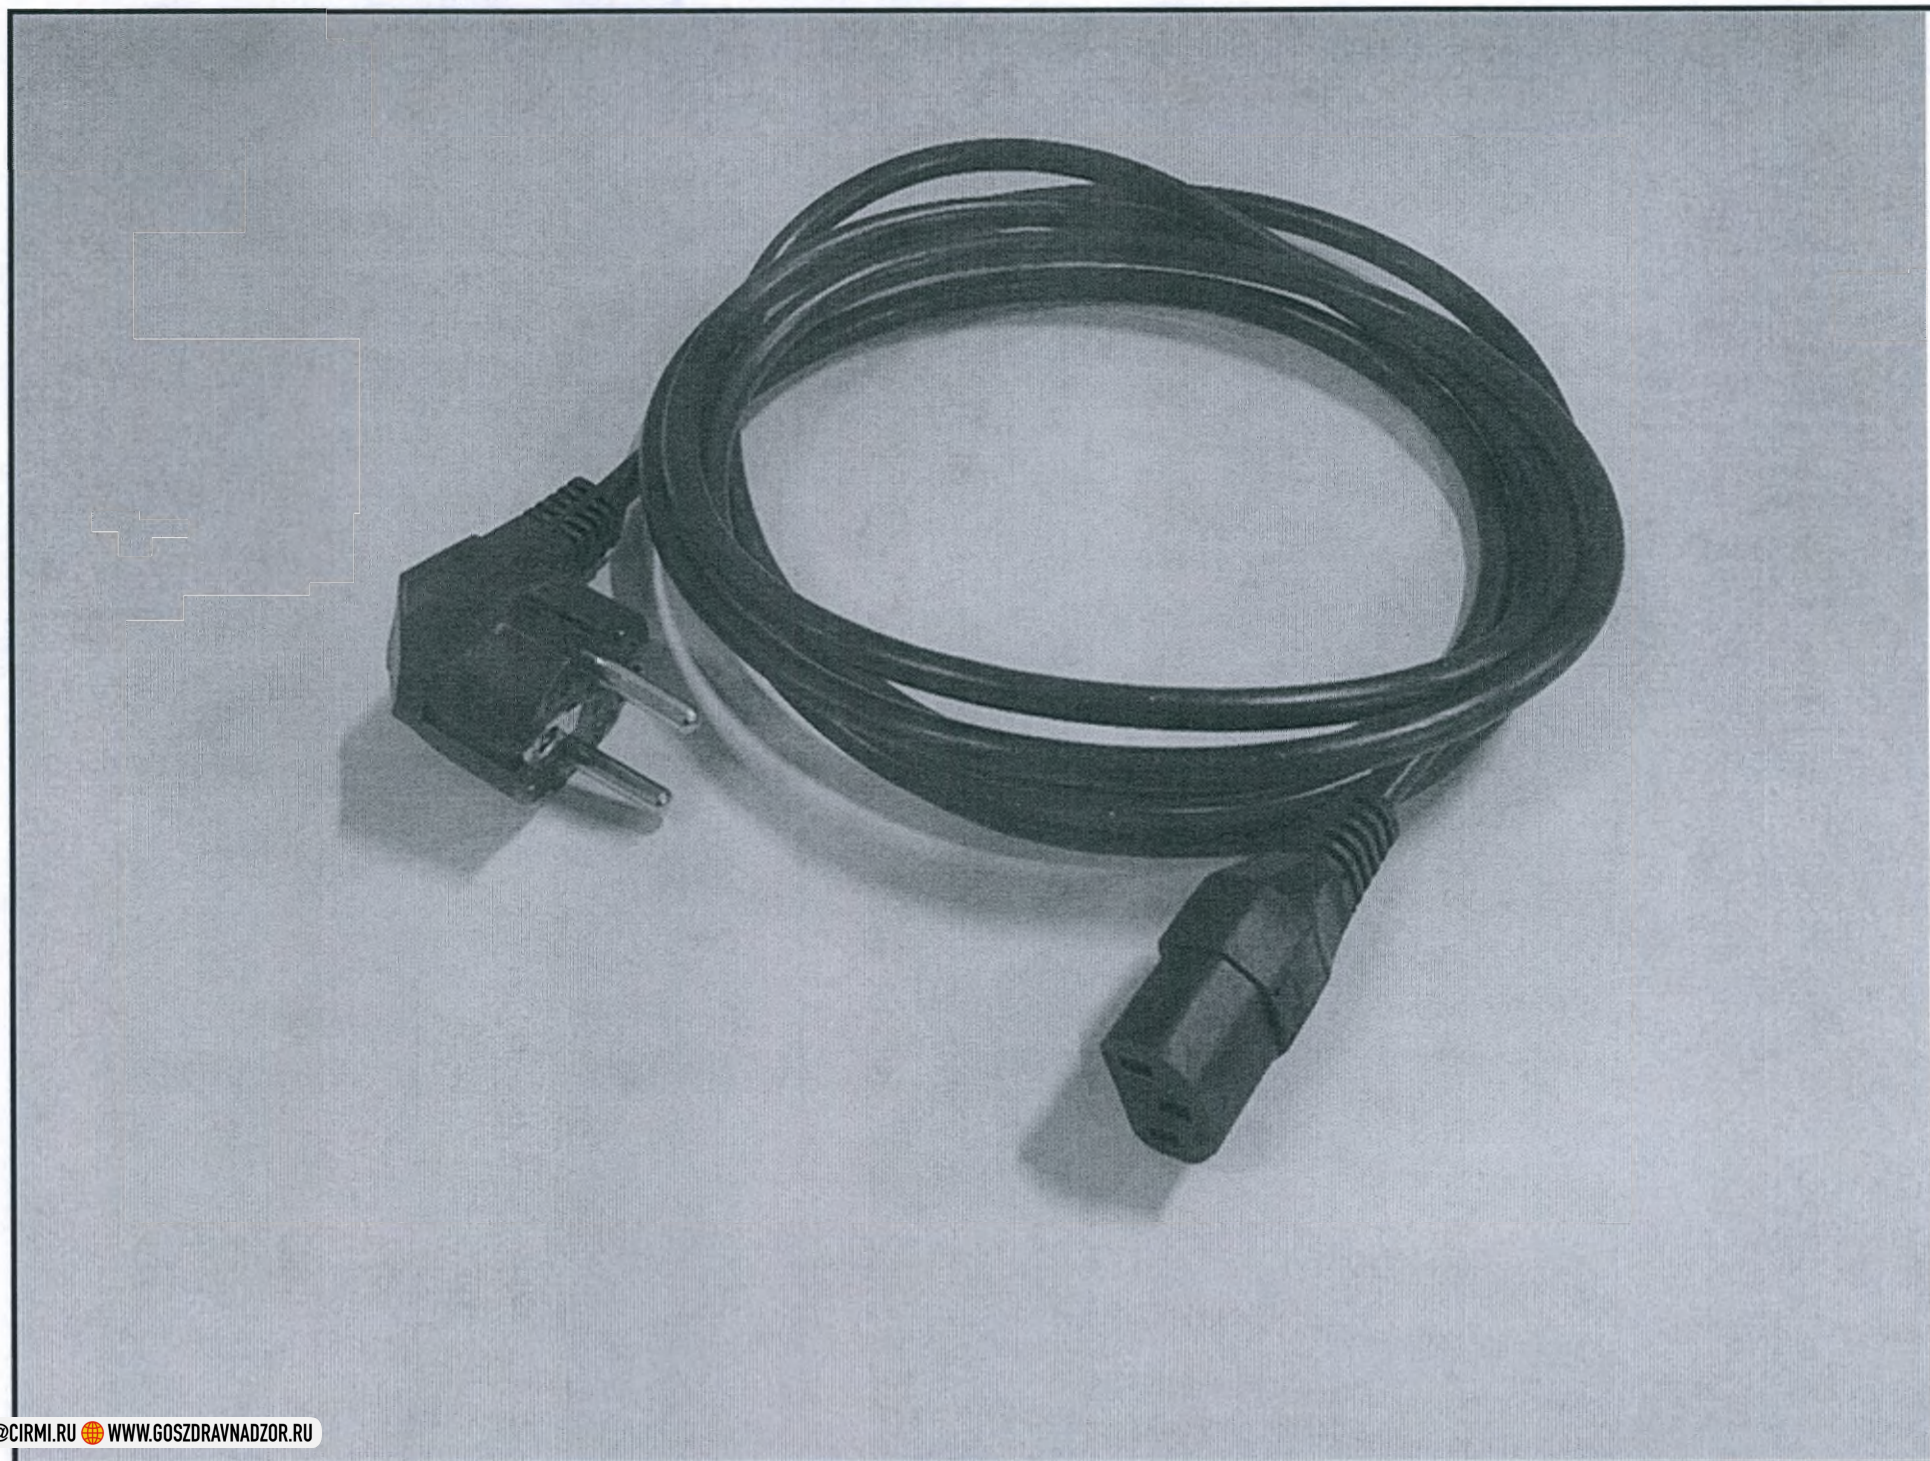


3. Привод аппарата с гибким держателем (Rotaflow II Drive Flex) (при необходимости)

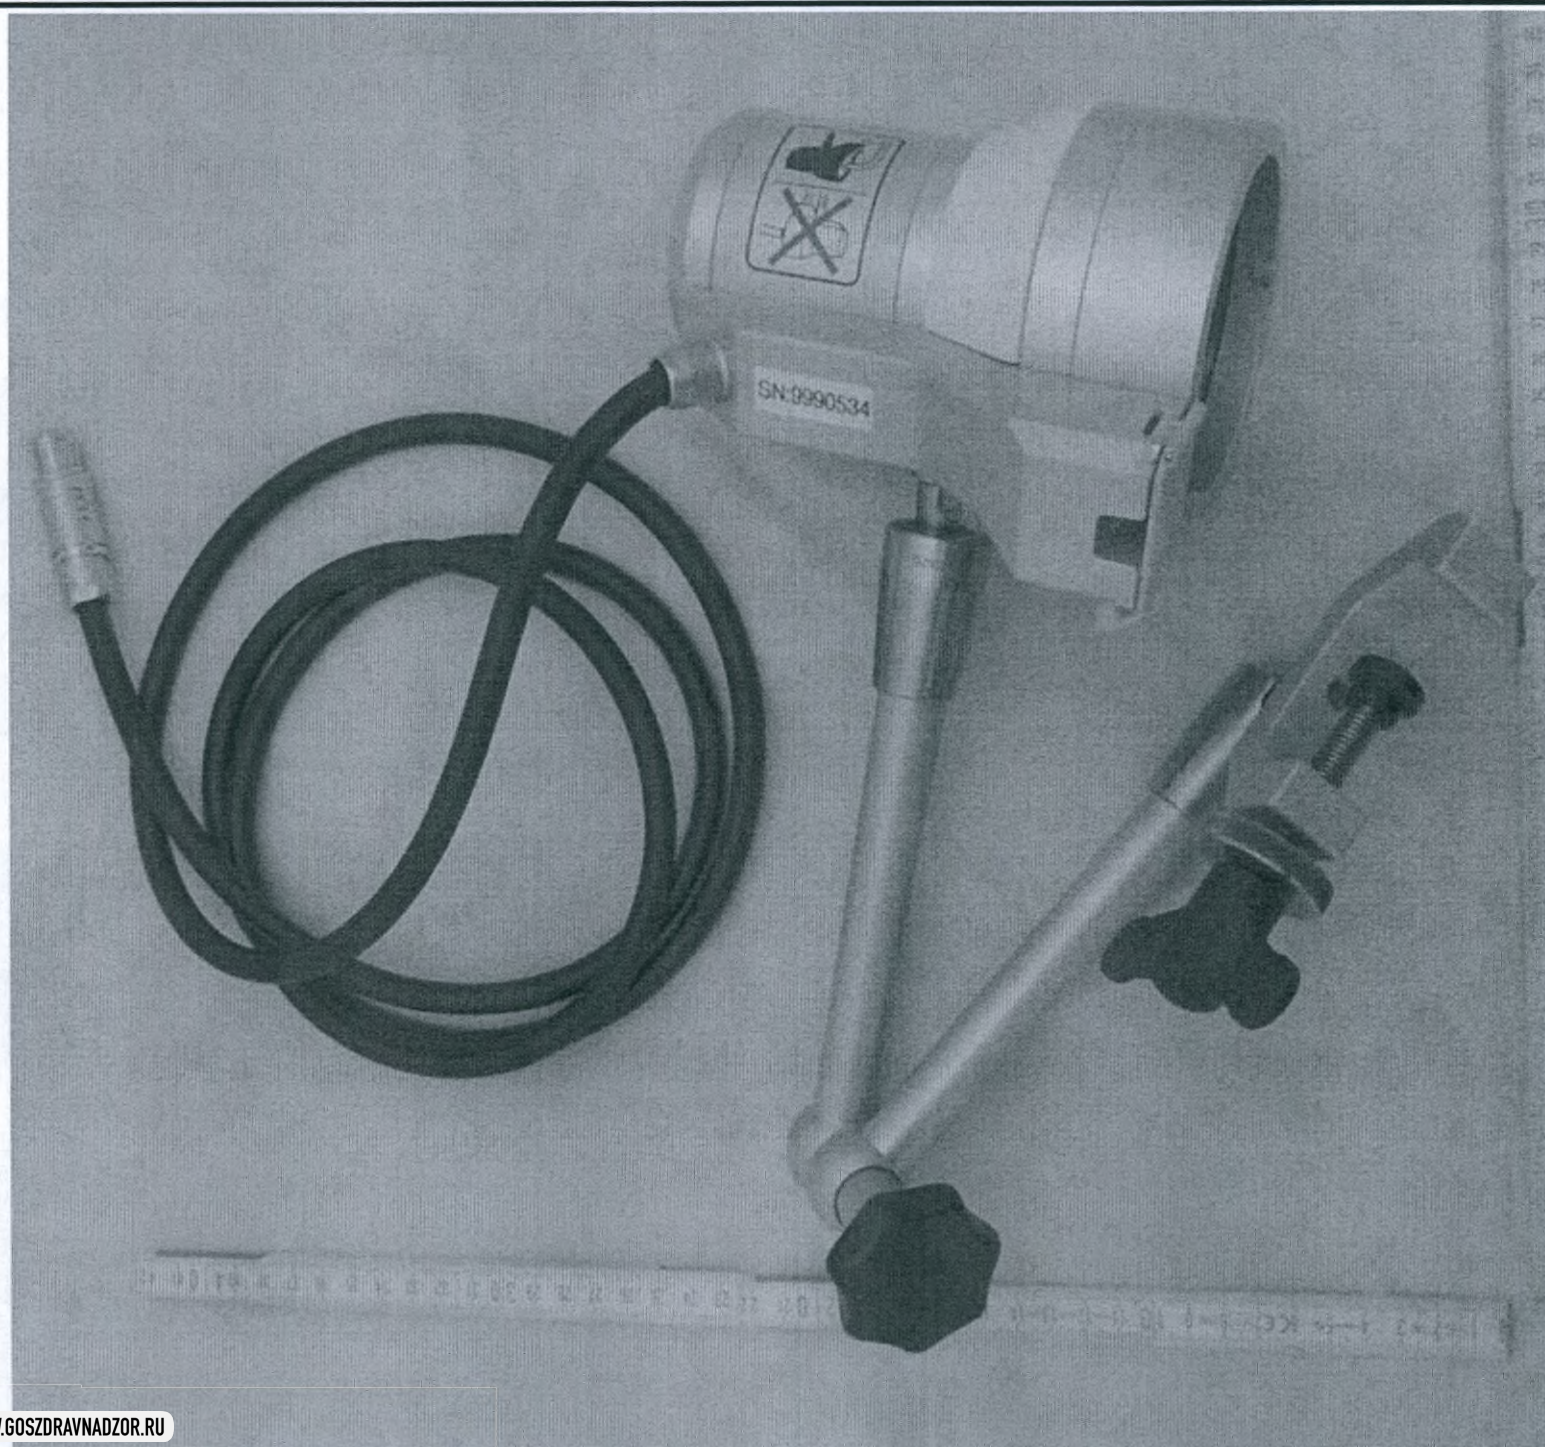


4. Привод аппарата с компактным держателем (Rotaflow II Drive Compact) (при необходимости)

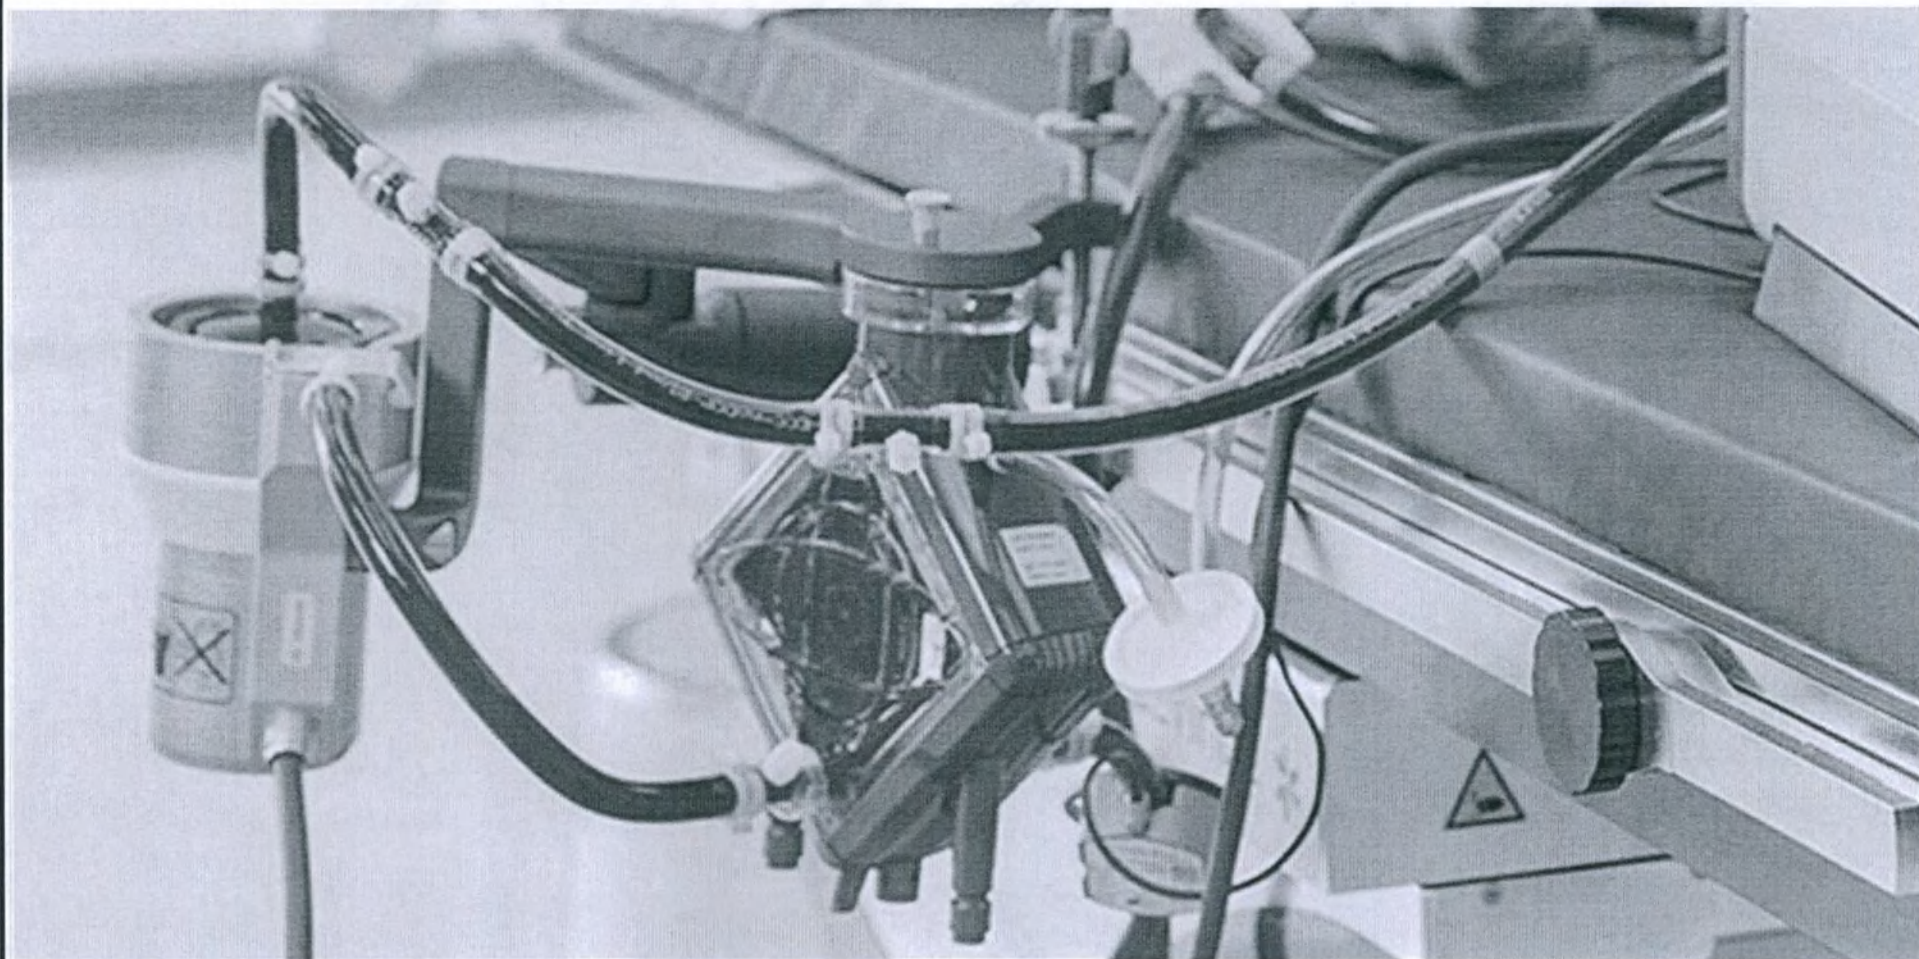


5. Аварийный привод (Rotaflow Emergency Drive)

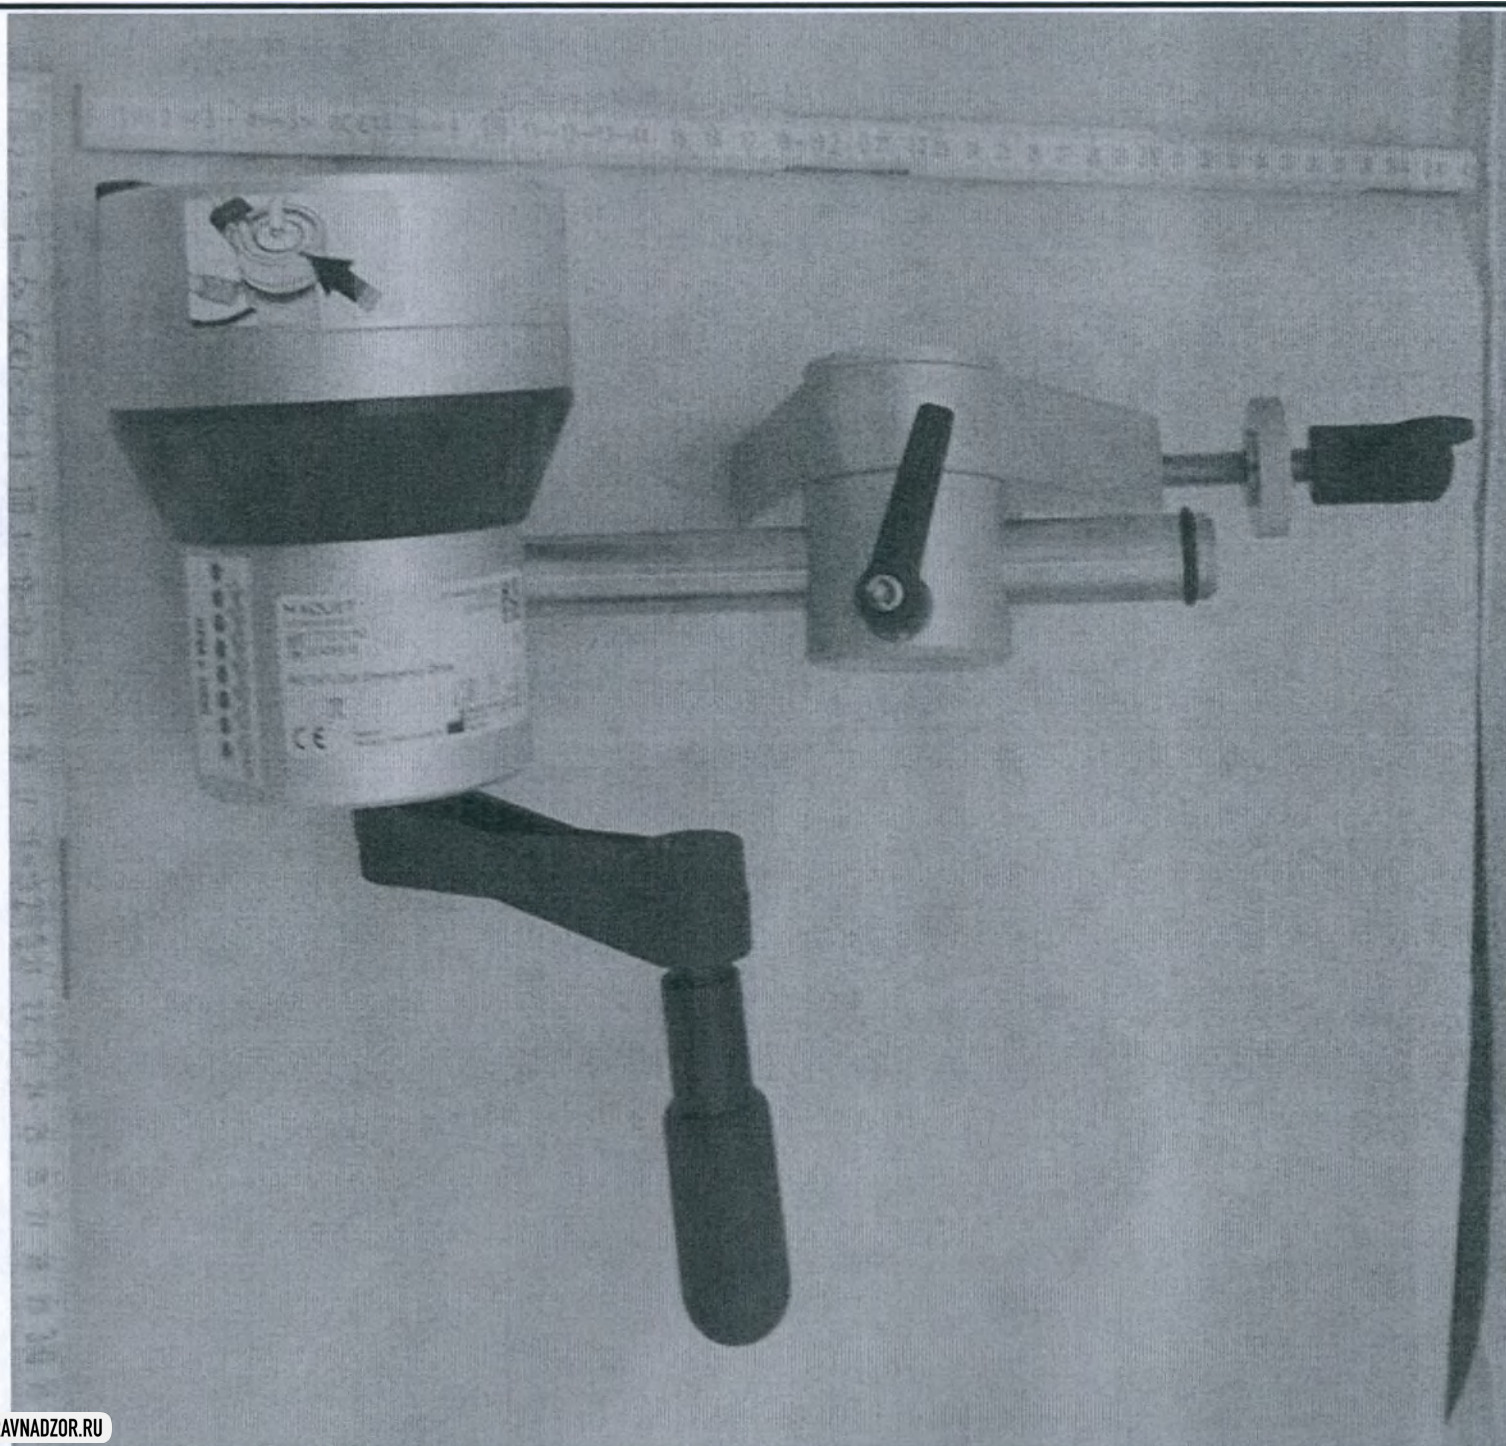


6. Датчик потока/пузырей воздуха (FBS)

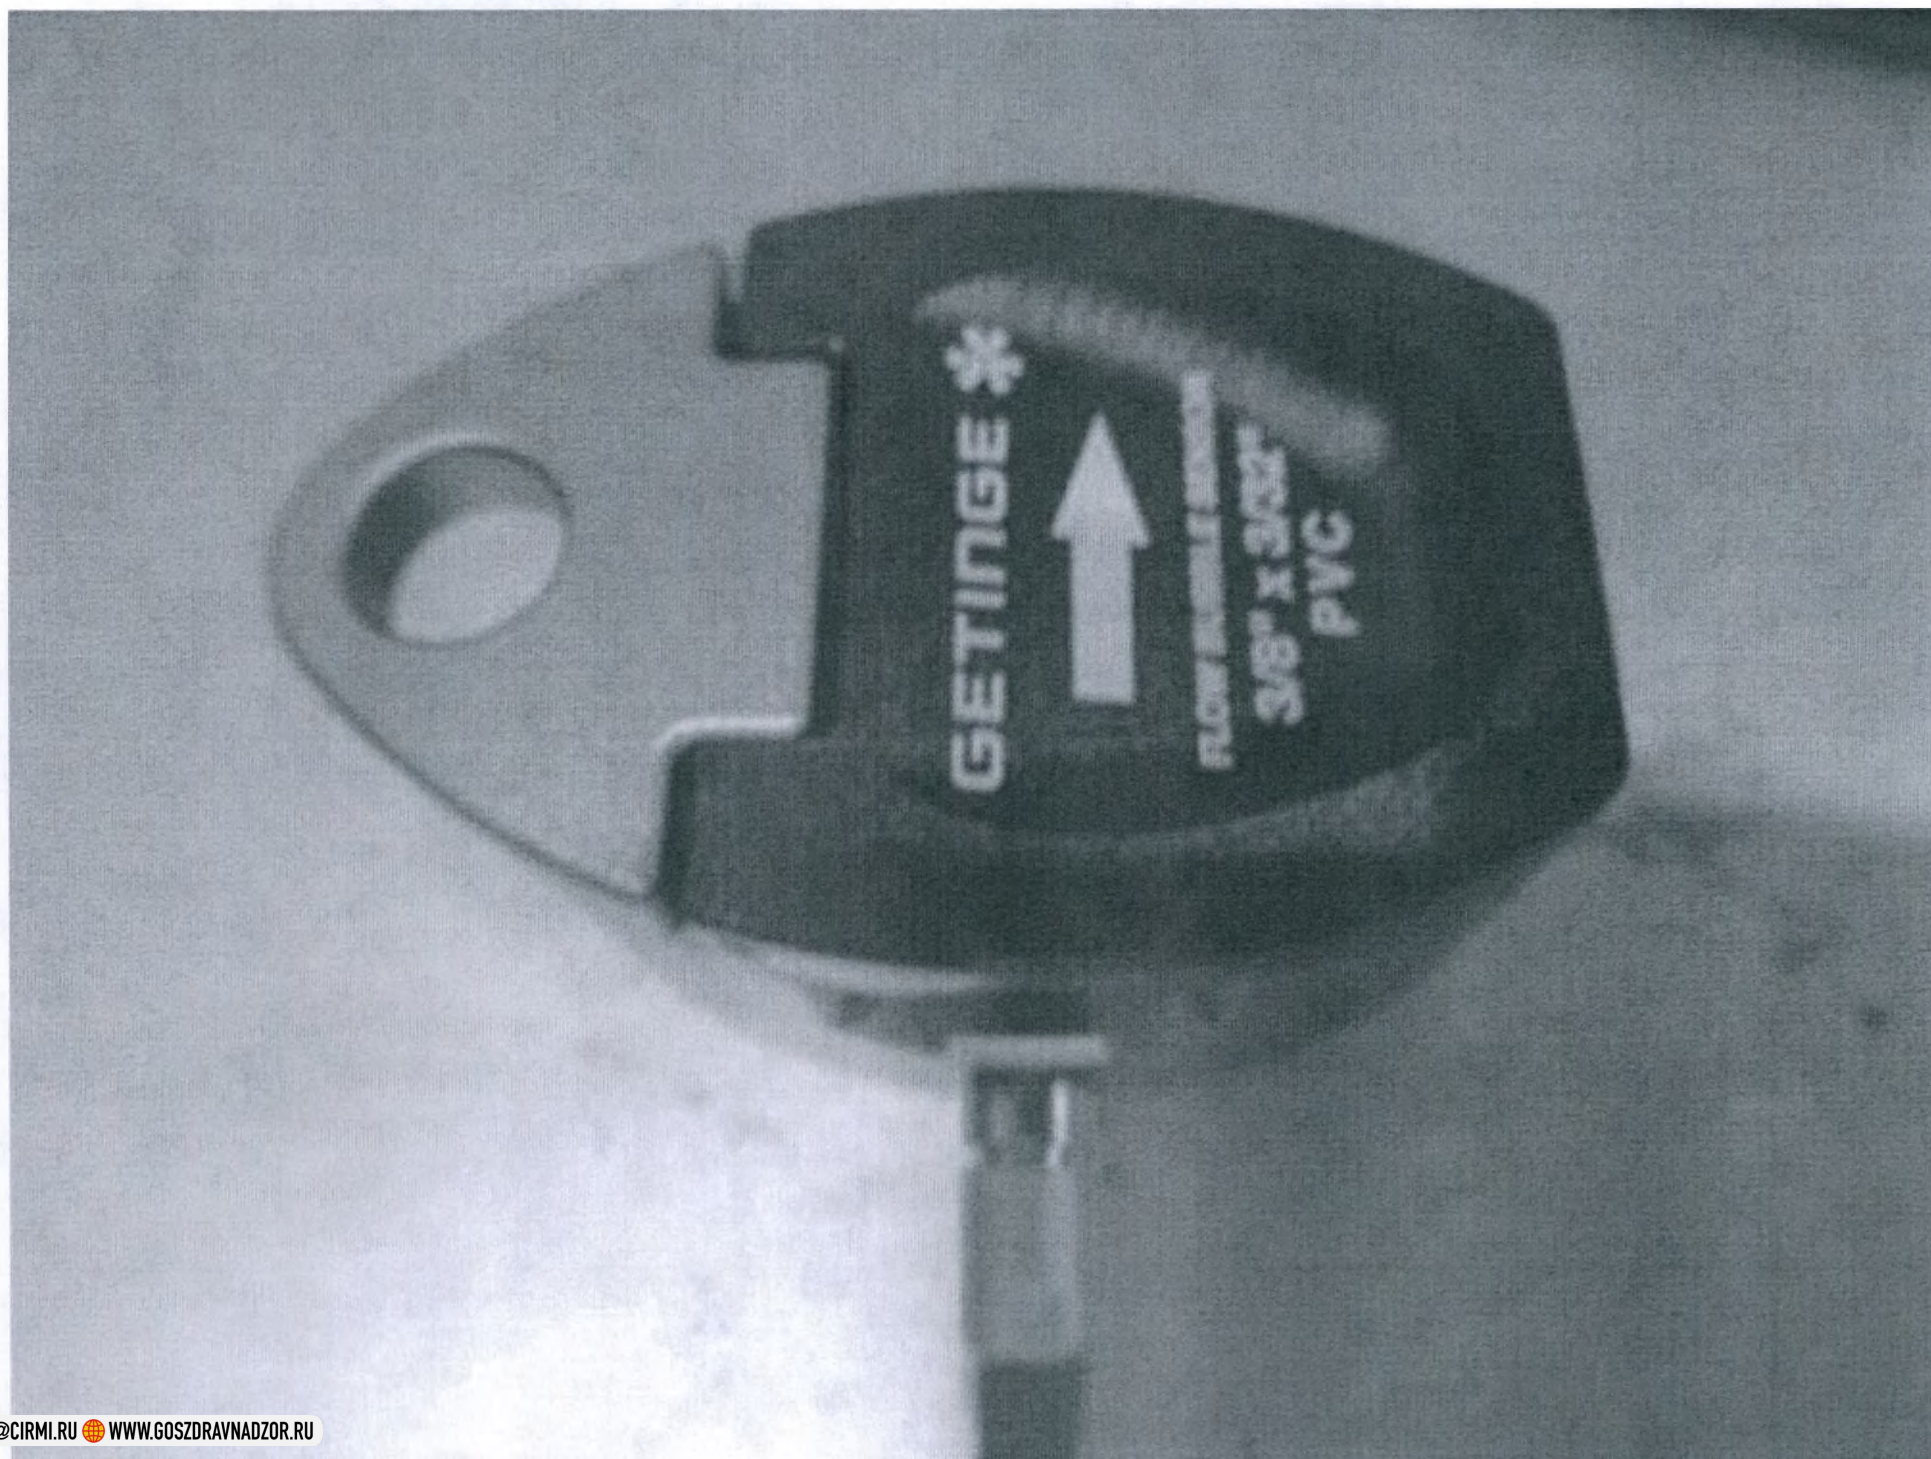


6. Датчик потока/пузырей воздуха (FBS)

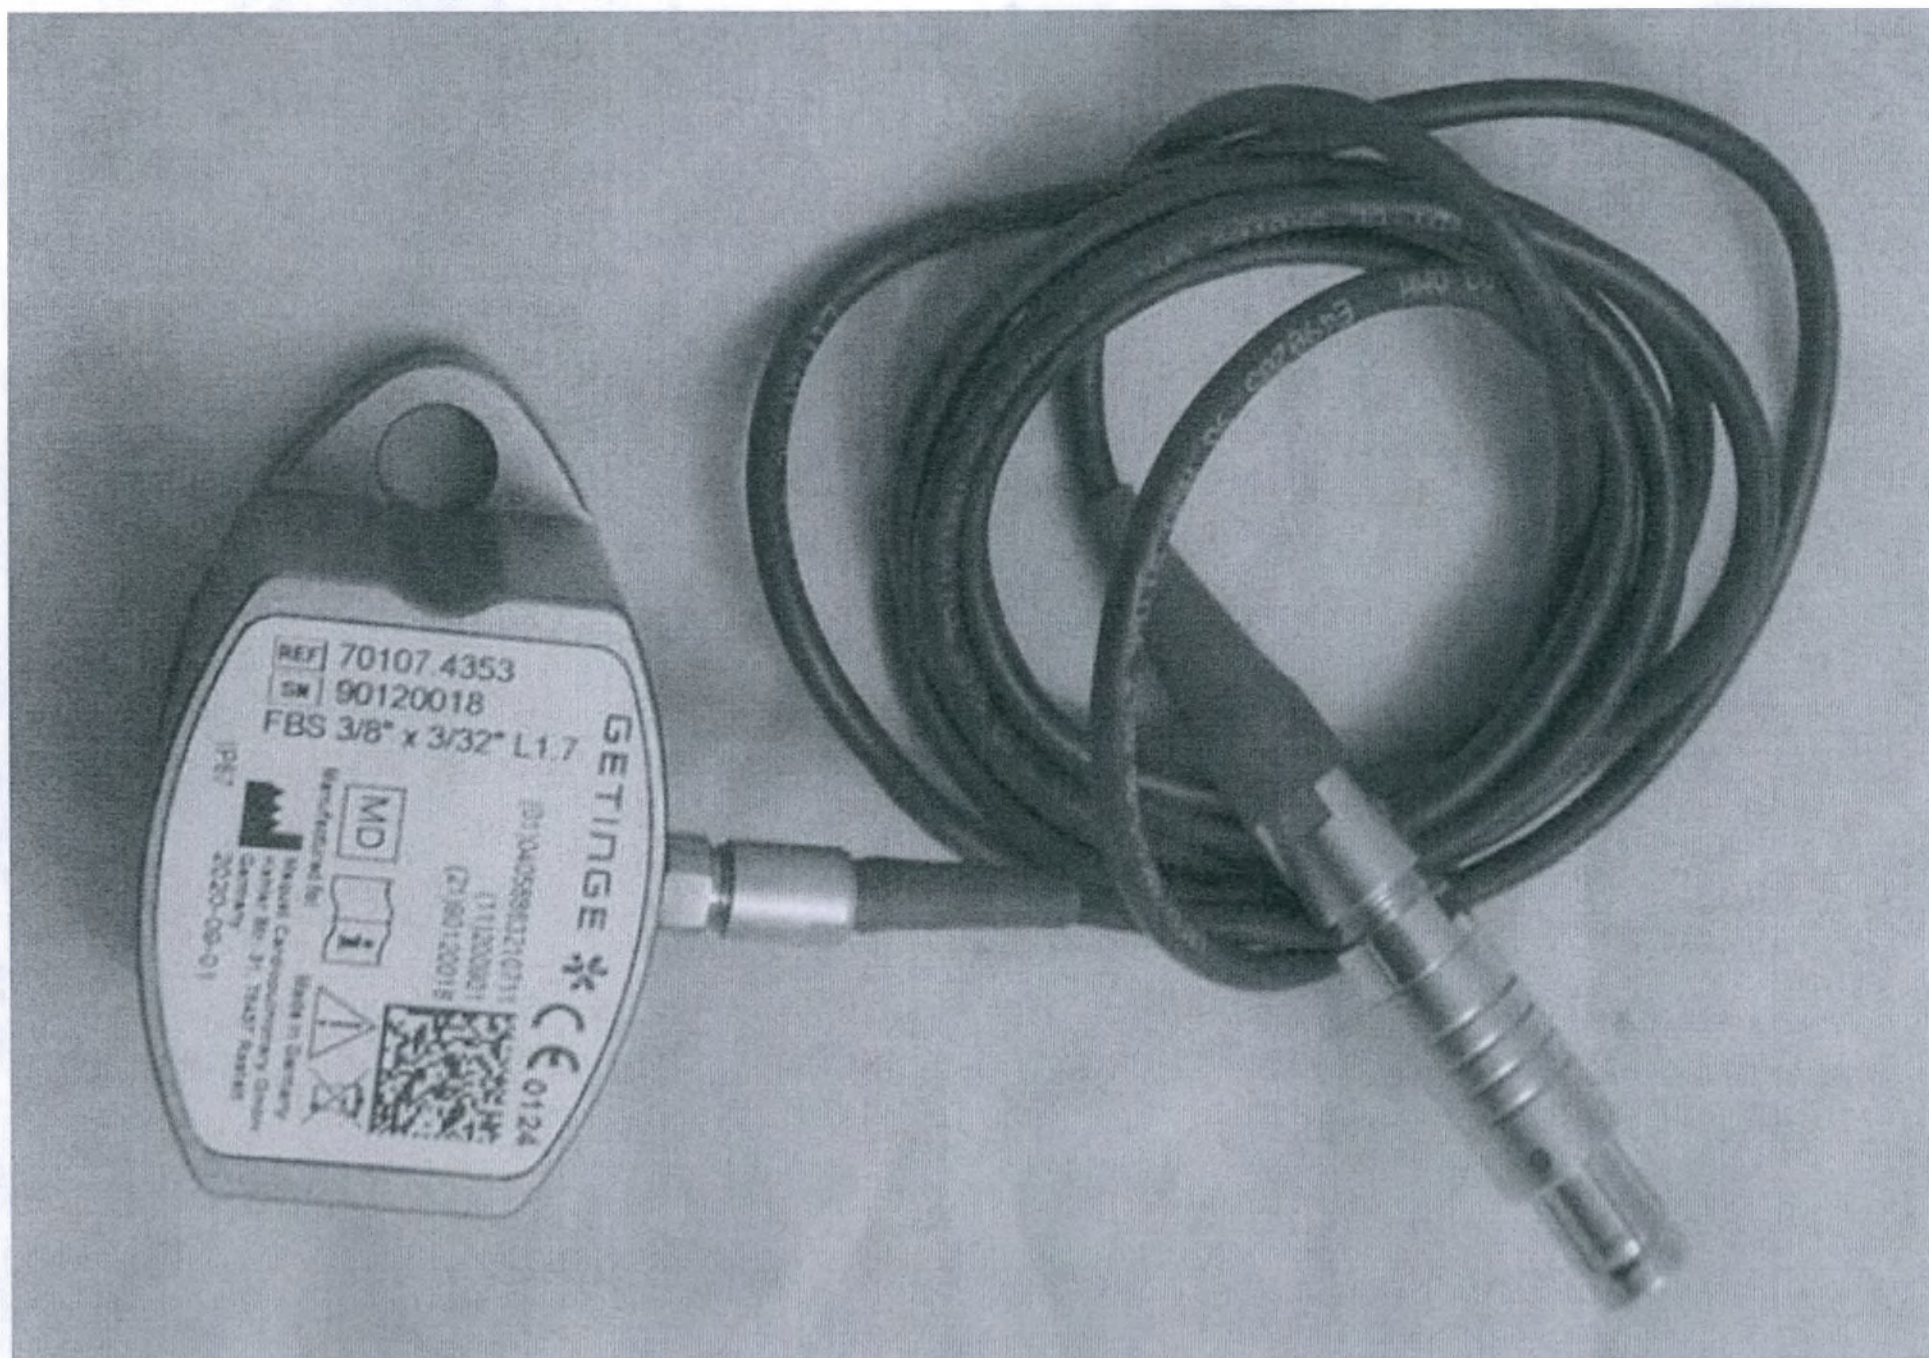


7. Датчик пузырей воздуха (BS)

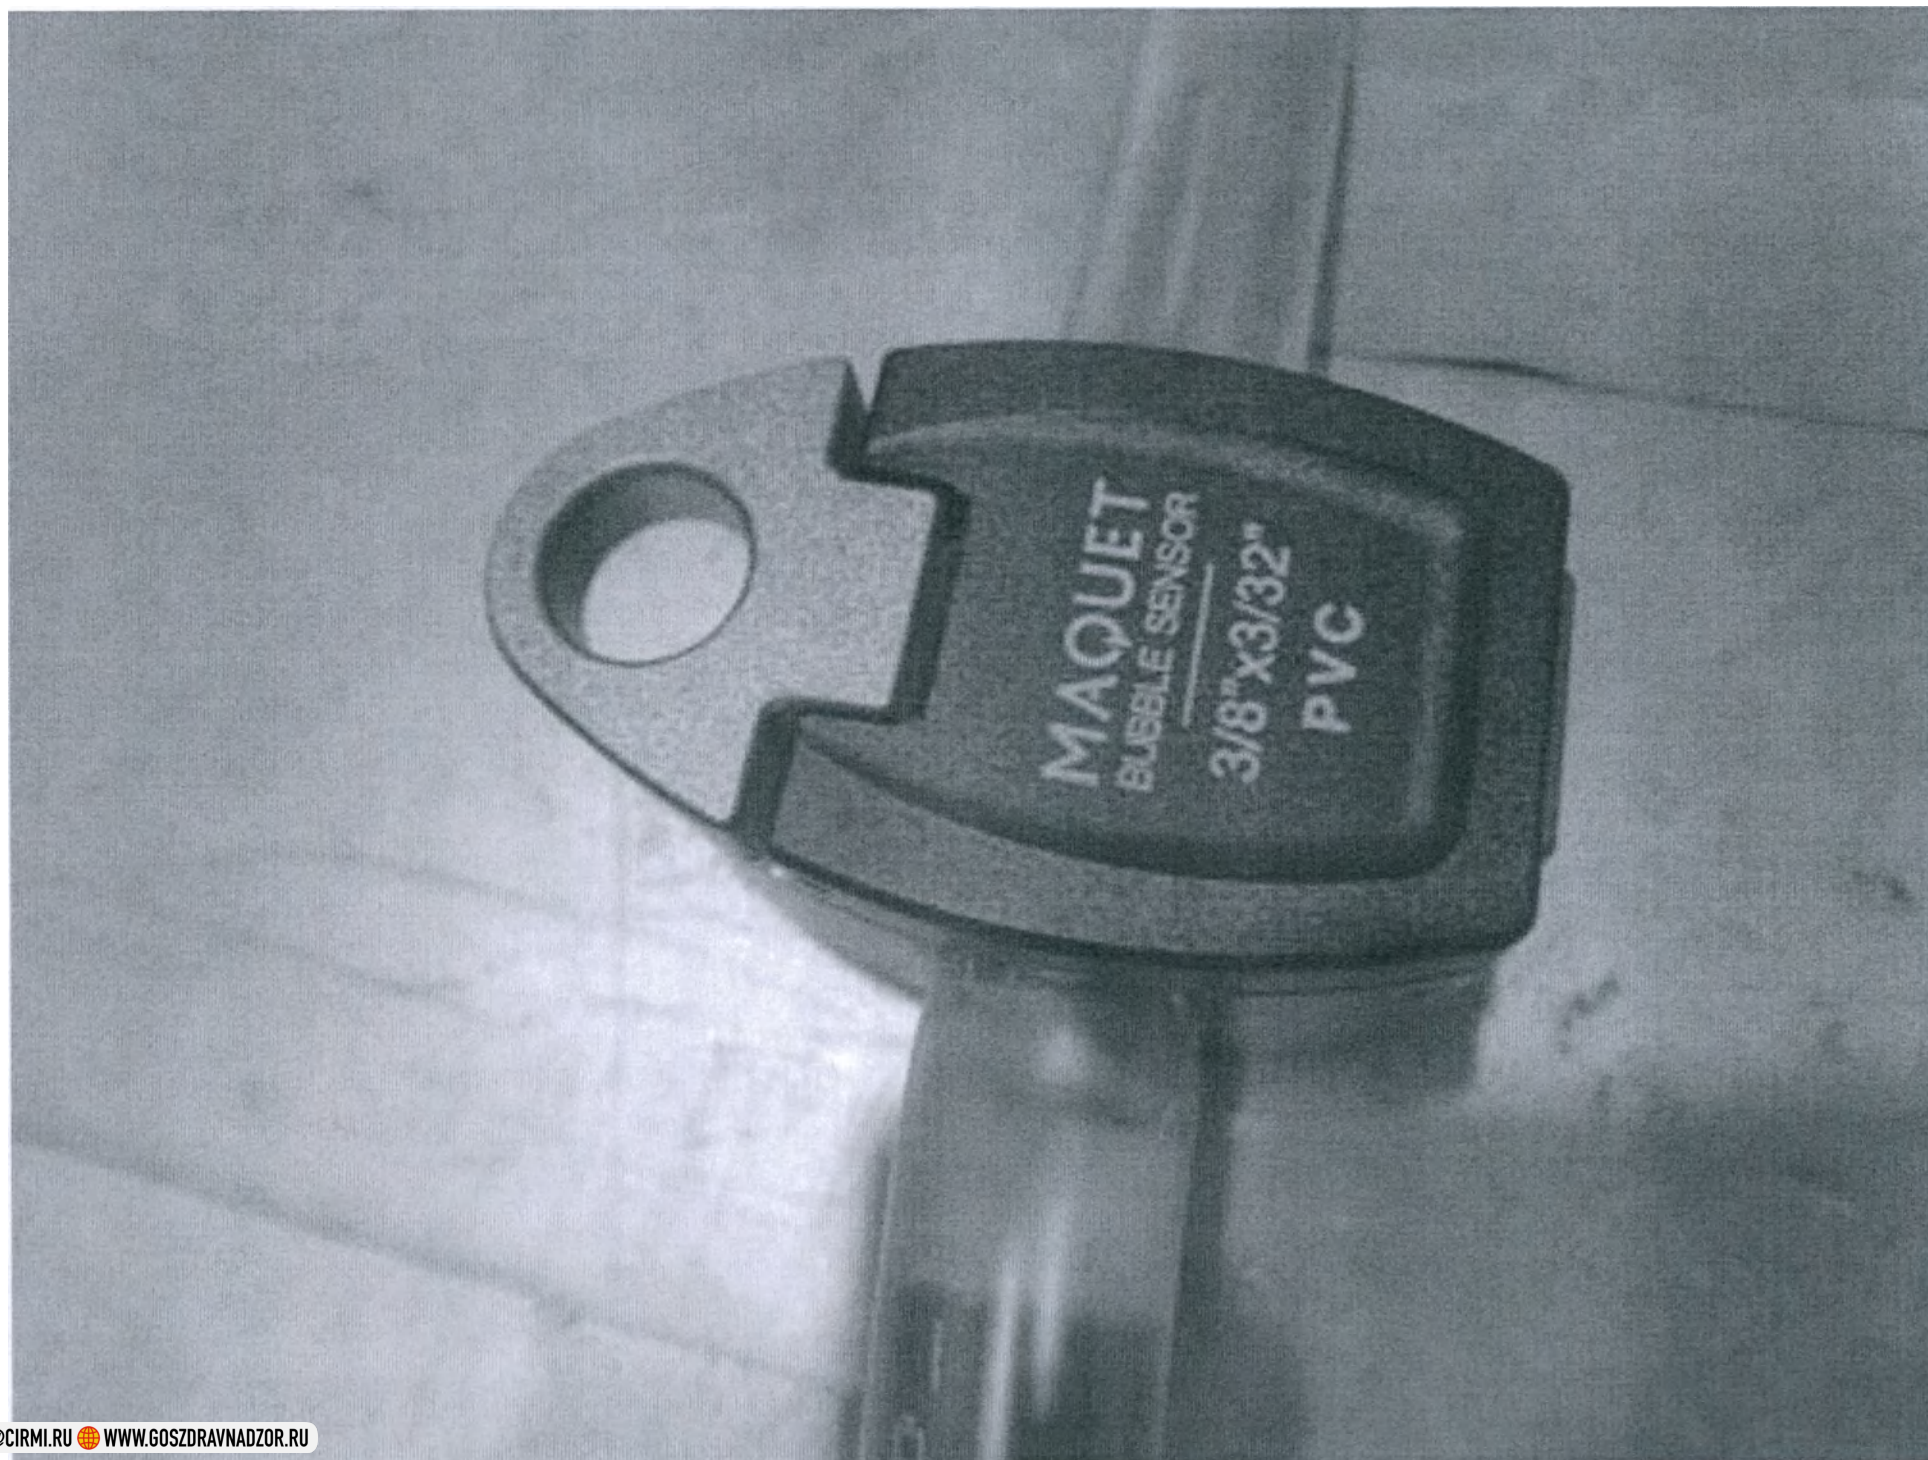


9. Тележка специальная мобильная Sprinter Cart (при необходимости), в составе: тележка (Sprinter Cart)

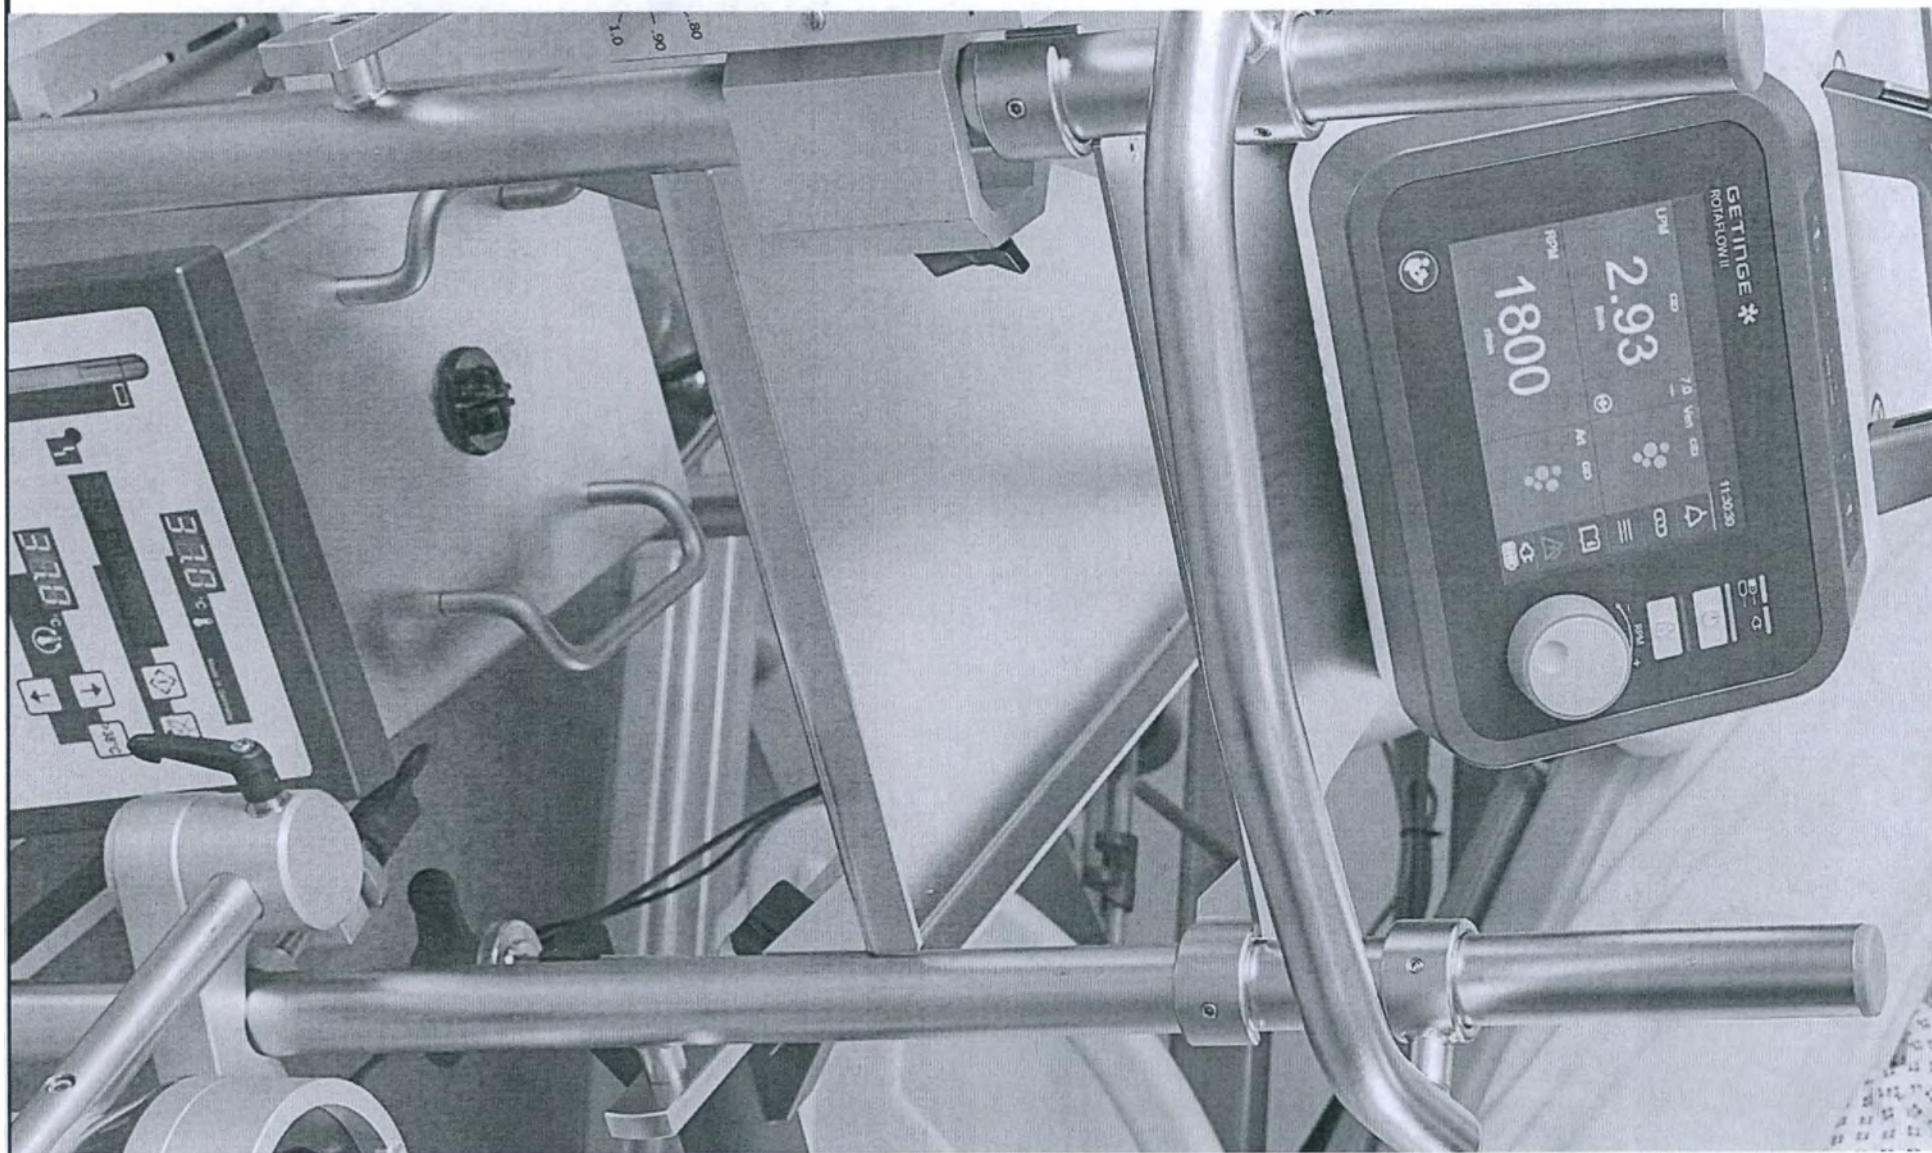


9. Тележка специальная мобильная Sprinter Cart (при необходимости), в составе: тележка (Sprinter Cart)

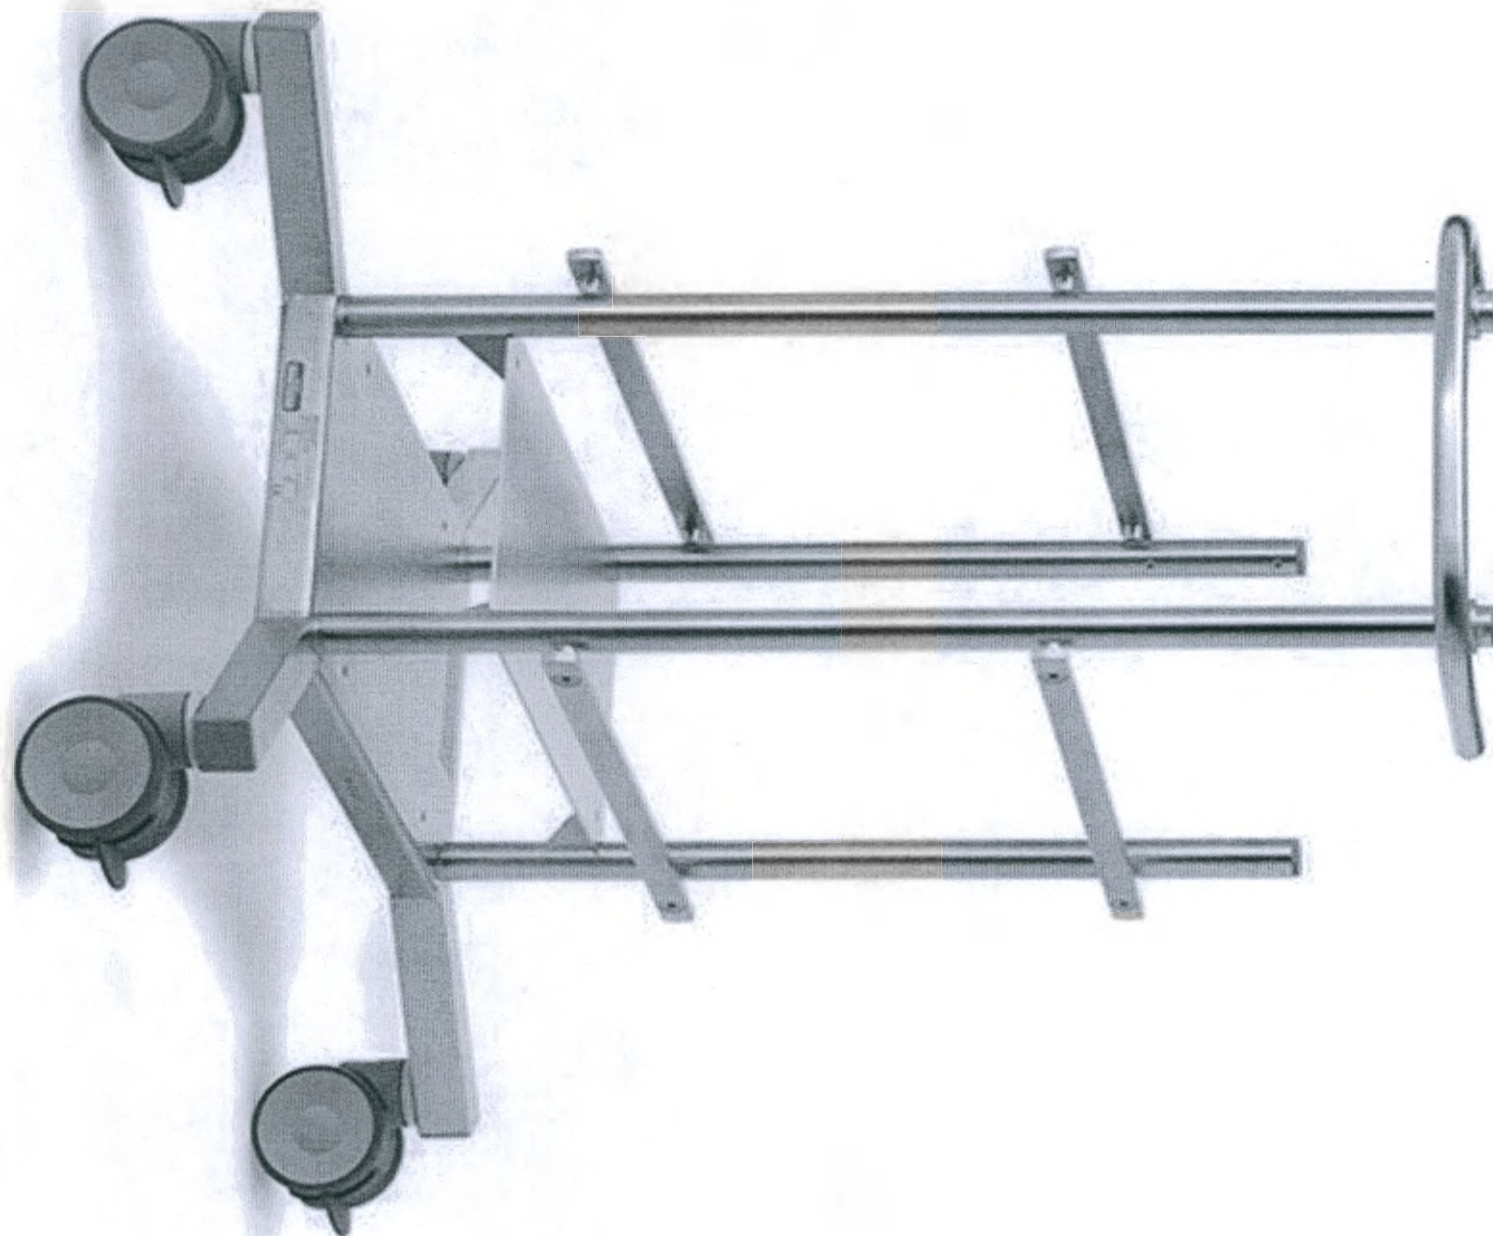


10. Тележка специальная мобильная Sprinter Cart XL (при необходимости), в составе: тележка (Sprinter Cart XL)

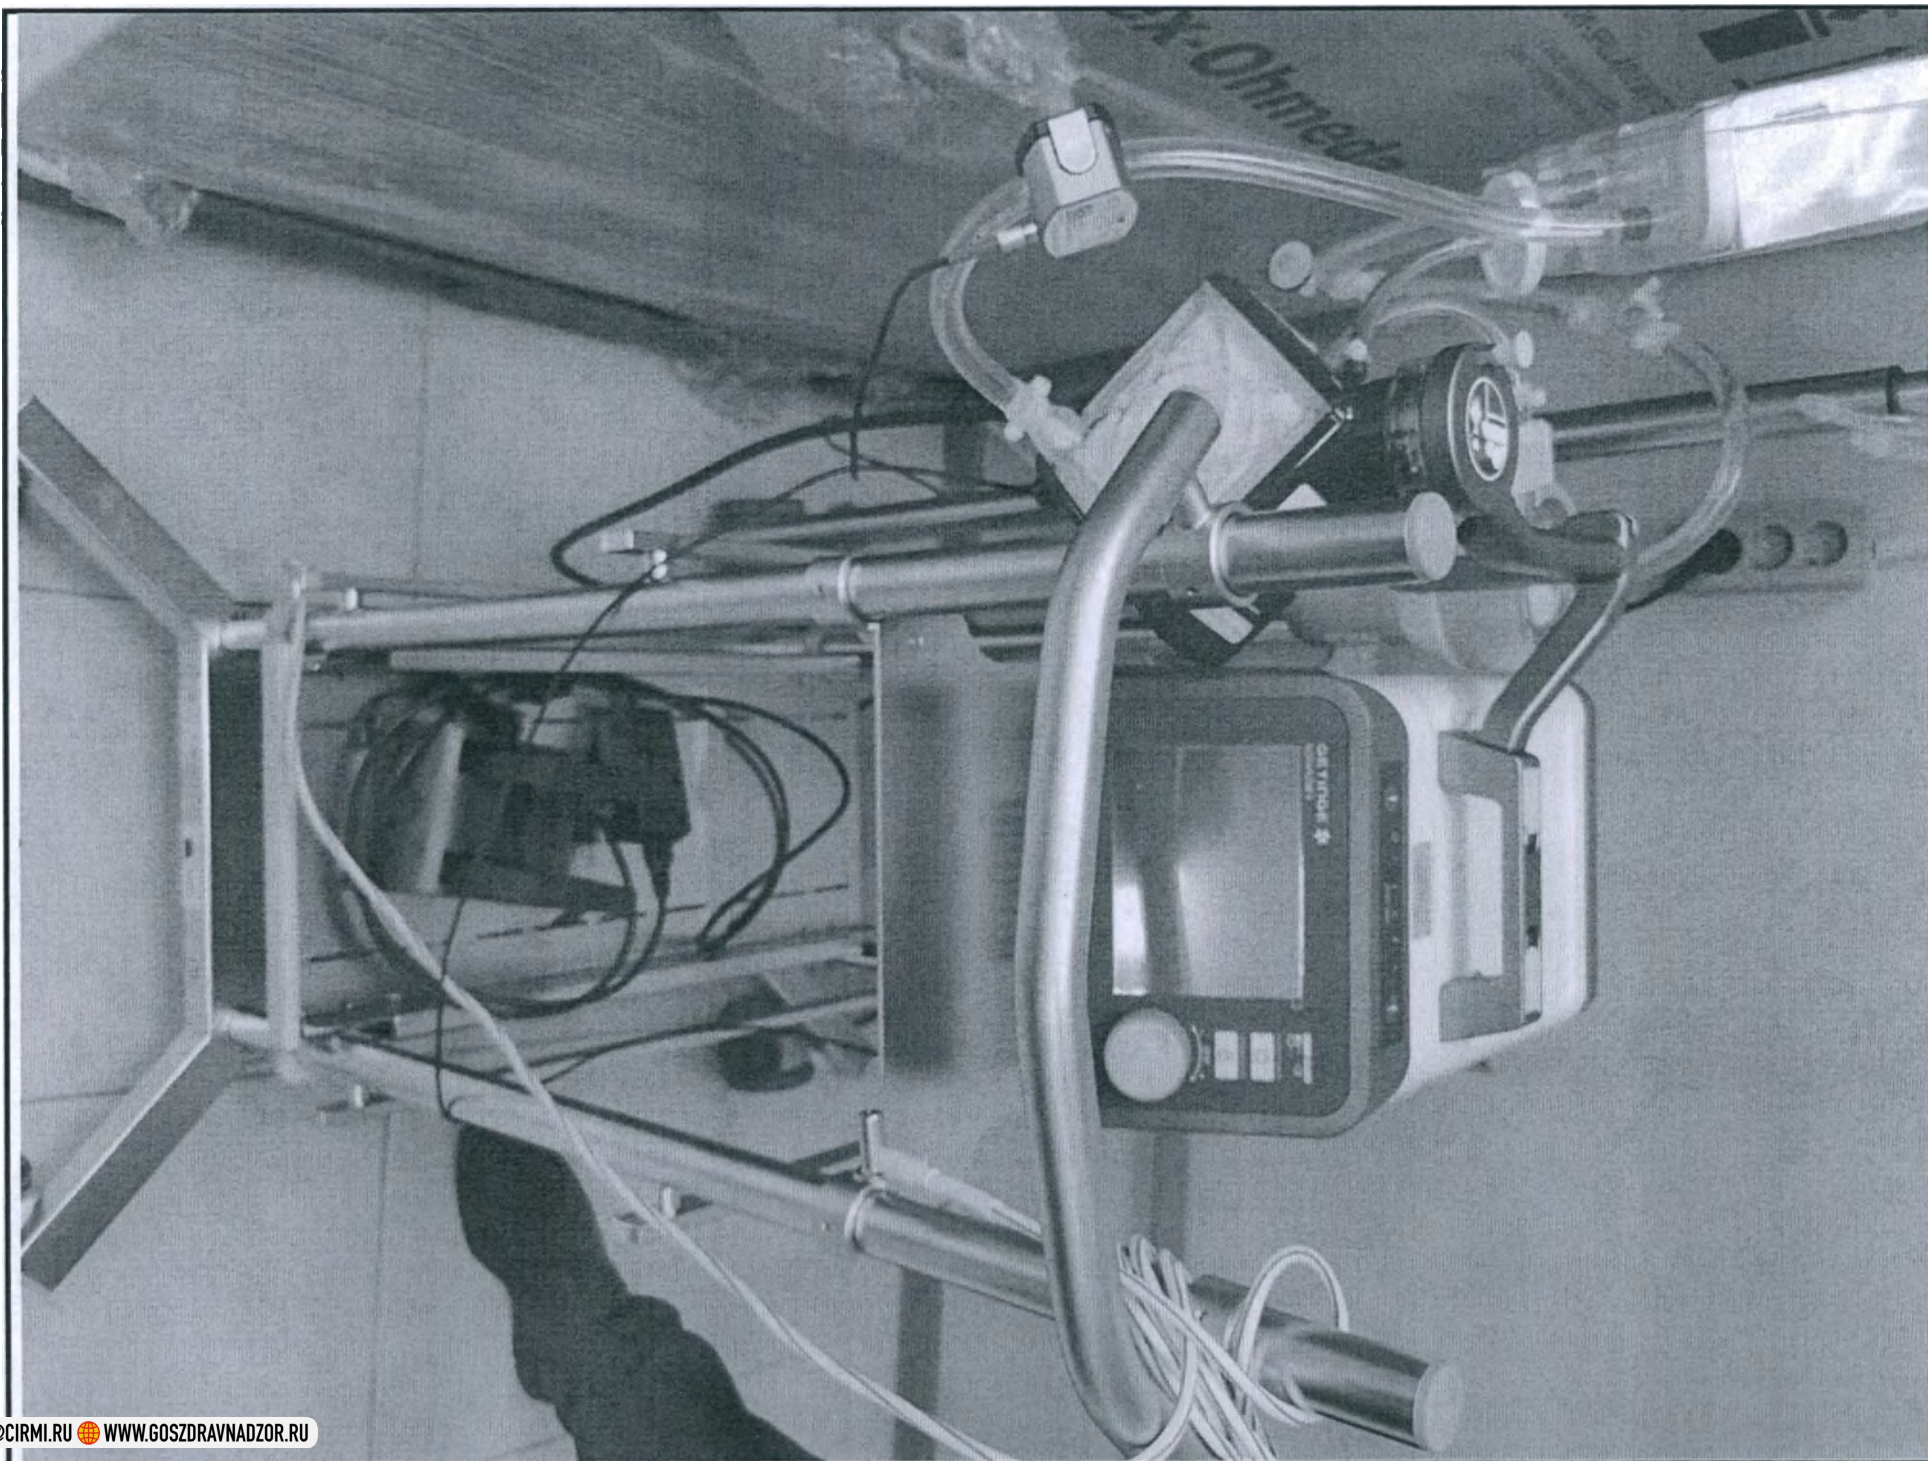


10. Тележка специальная мобильная Sprinter Cart XL (при необходимости), в составе: тележка (Sprinter Cart XL)

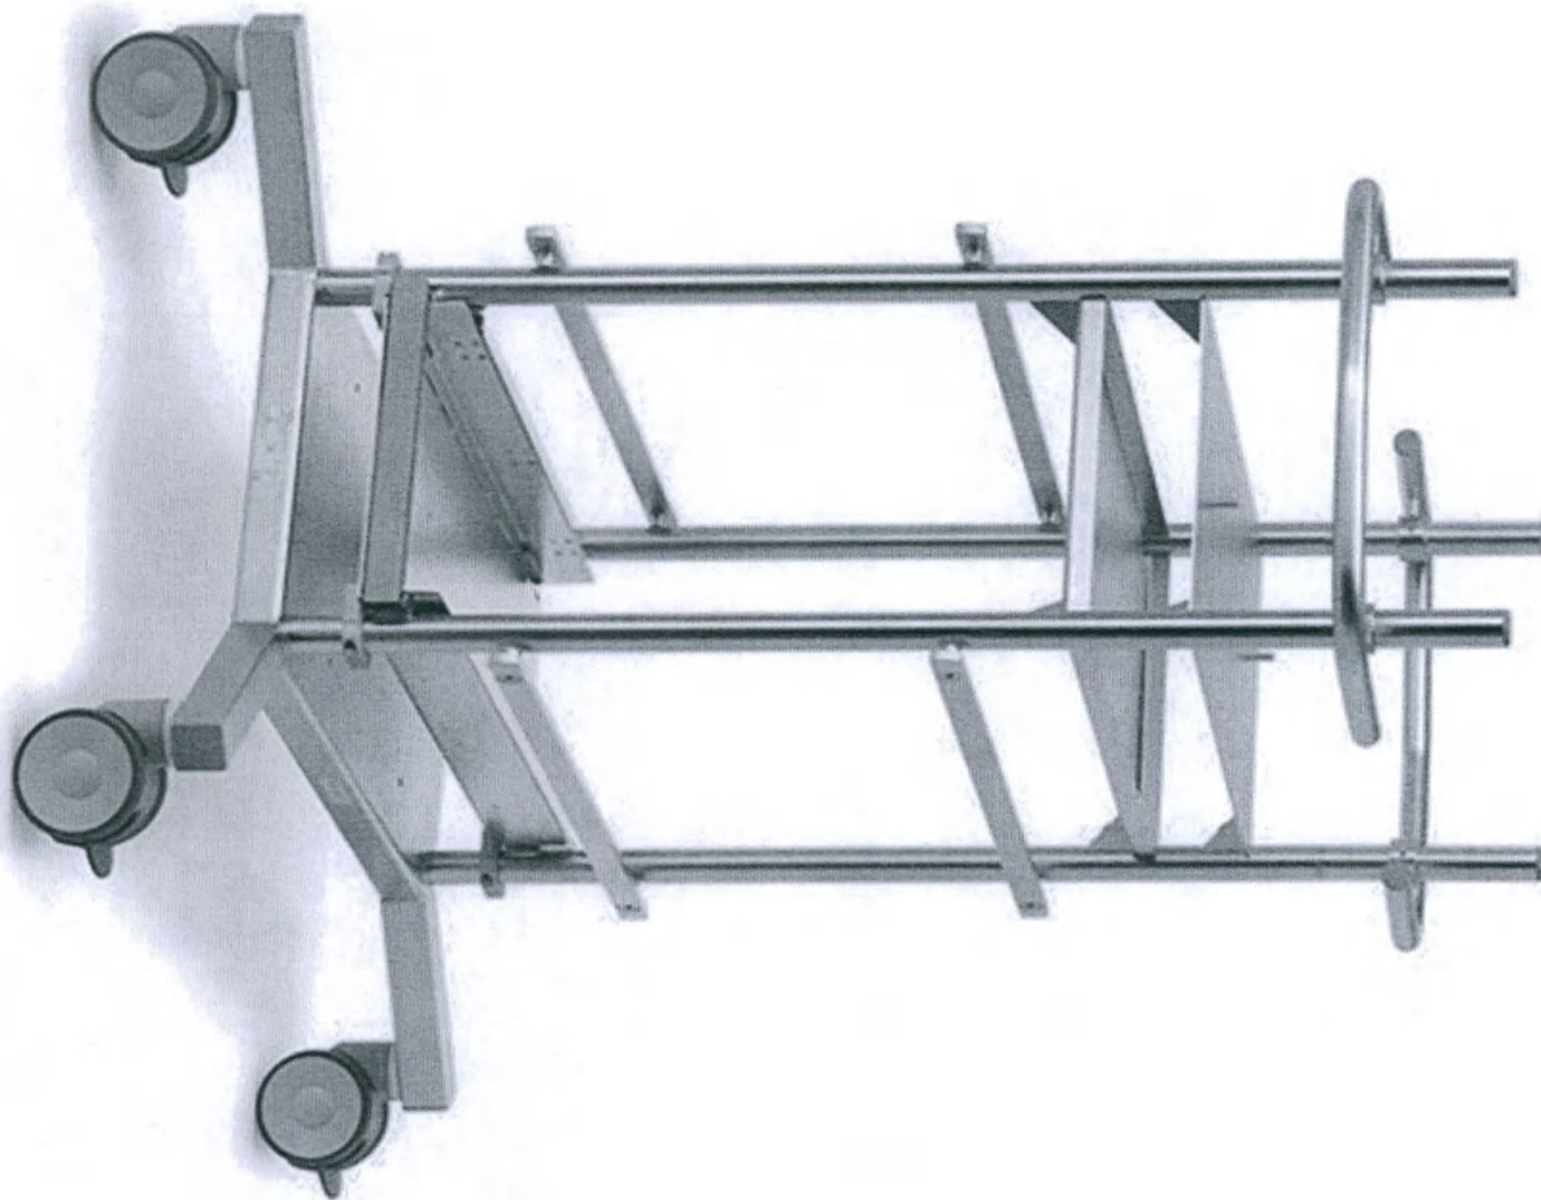


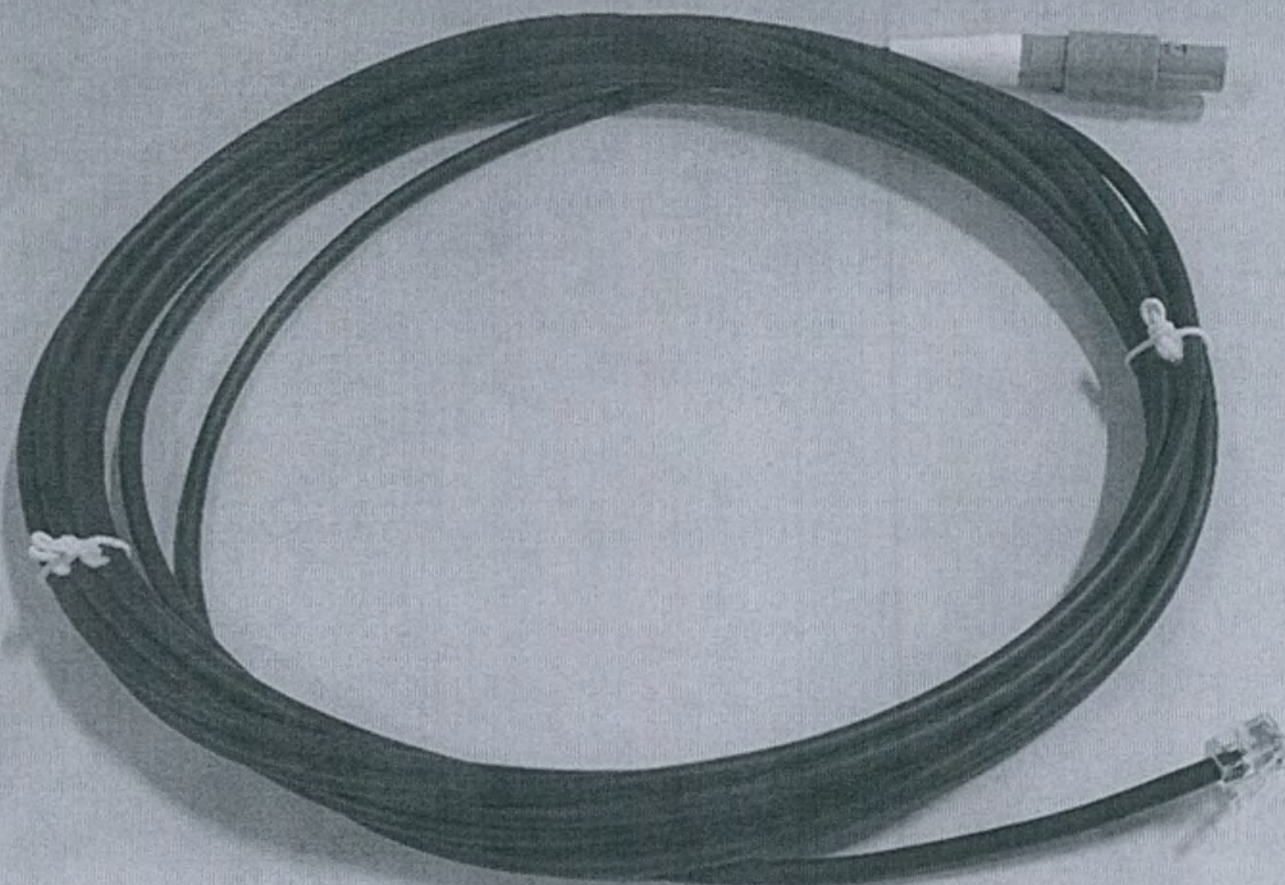Принадлежности:**1. Кабель вывода сигналов тревоги**


2. Кабель последовательного интерфейса (RS232)

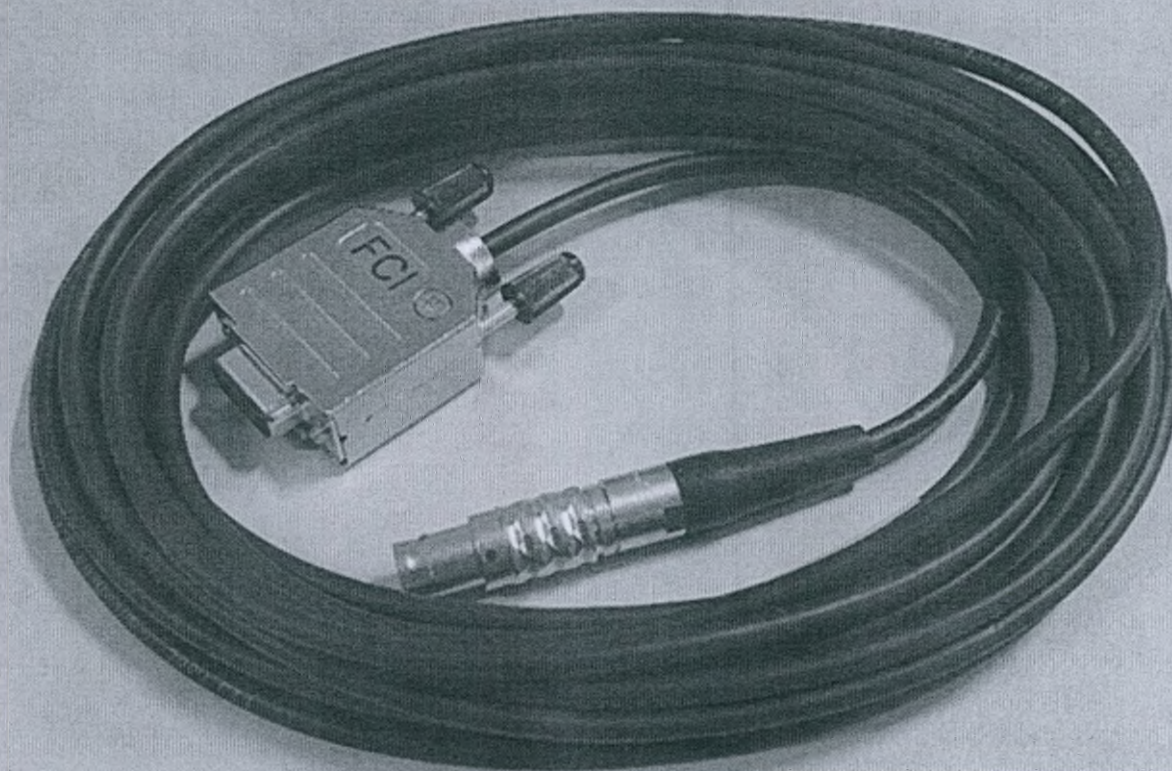


3. Кабель для выравнивания потенциалов

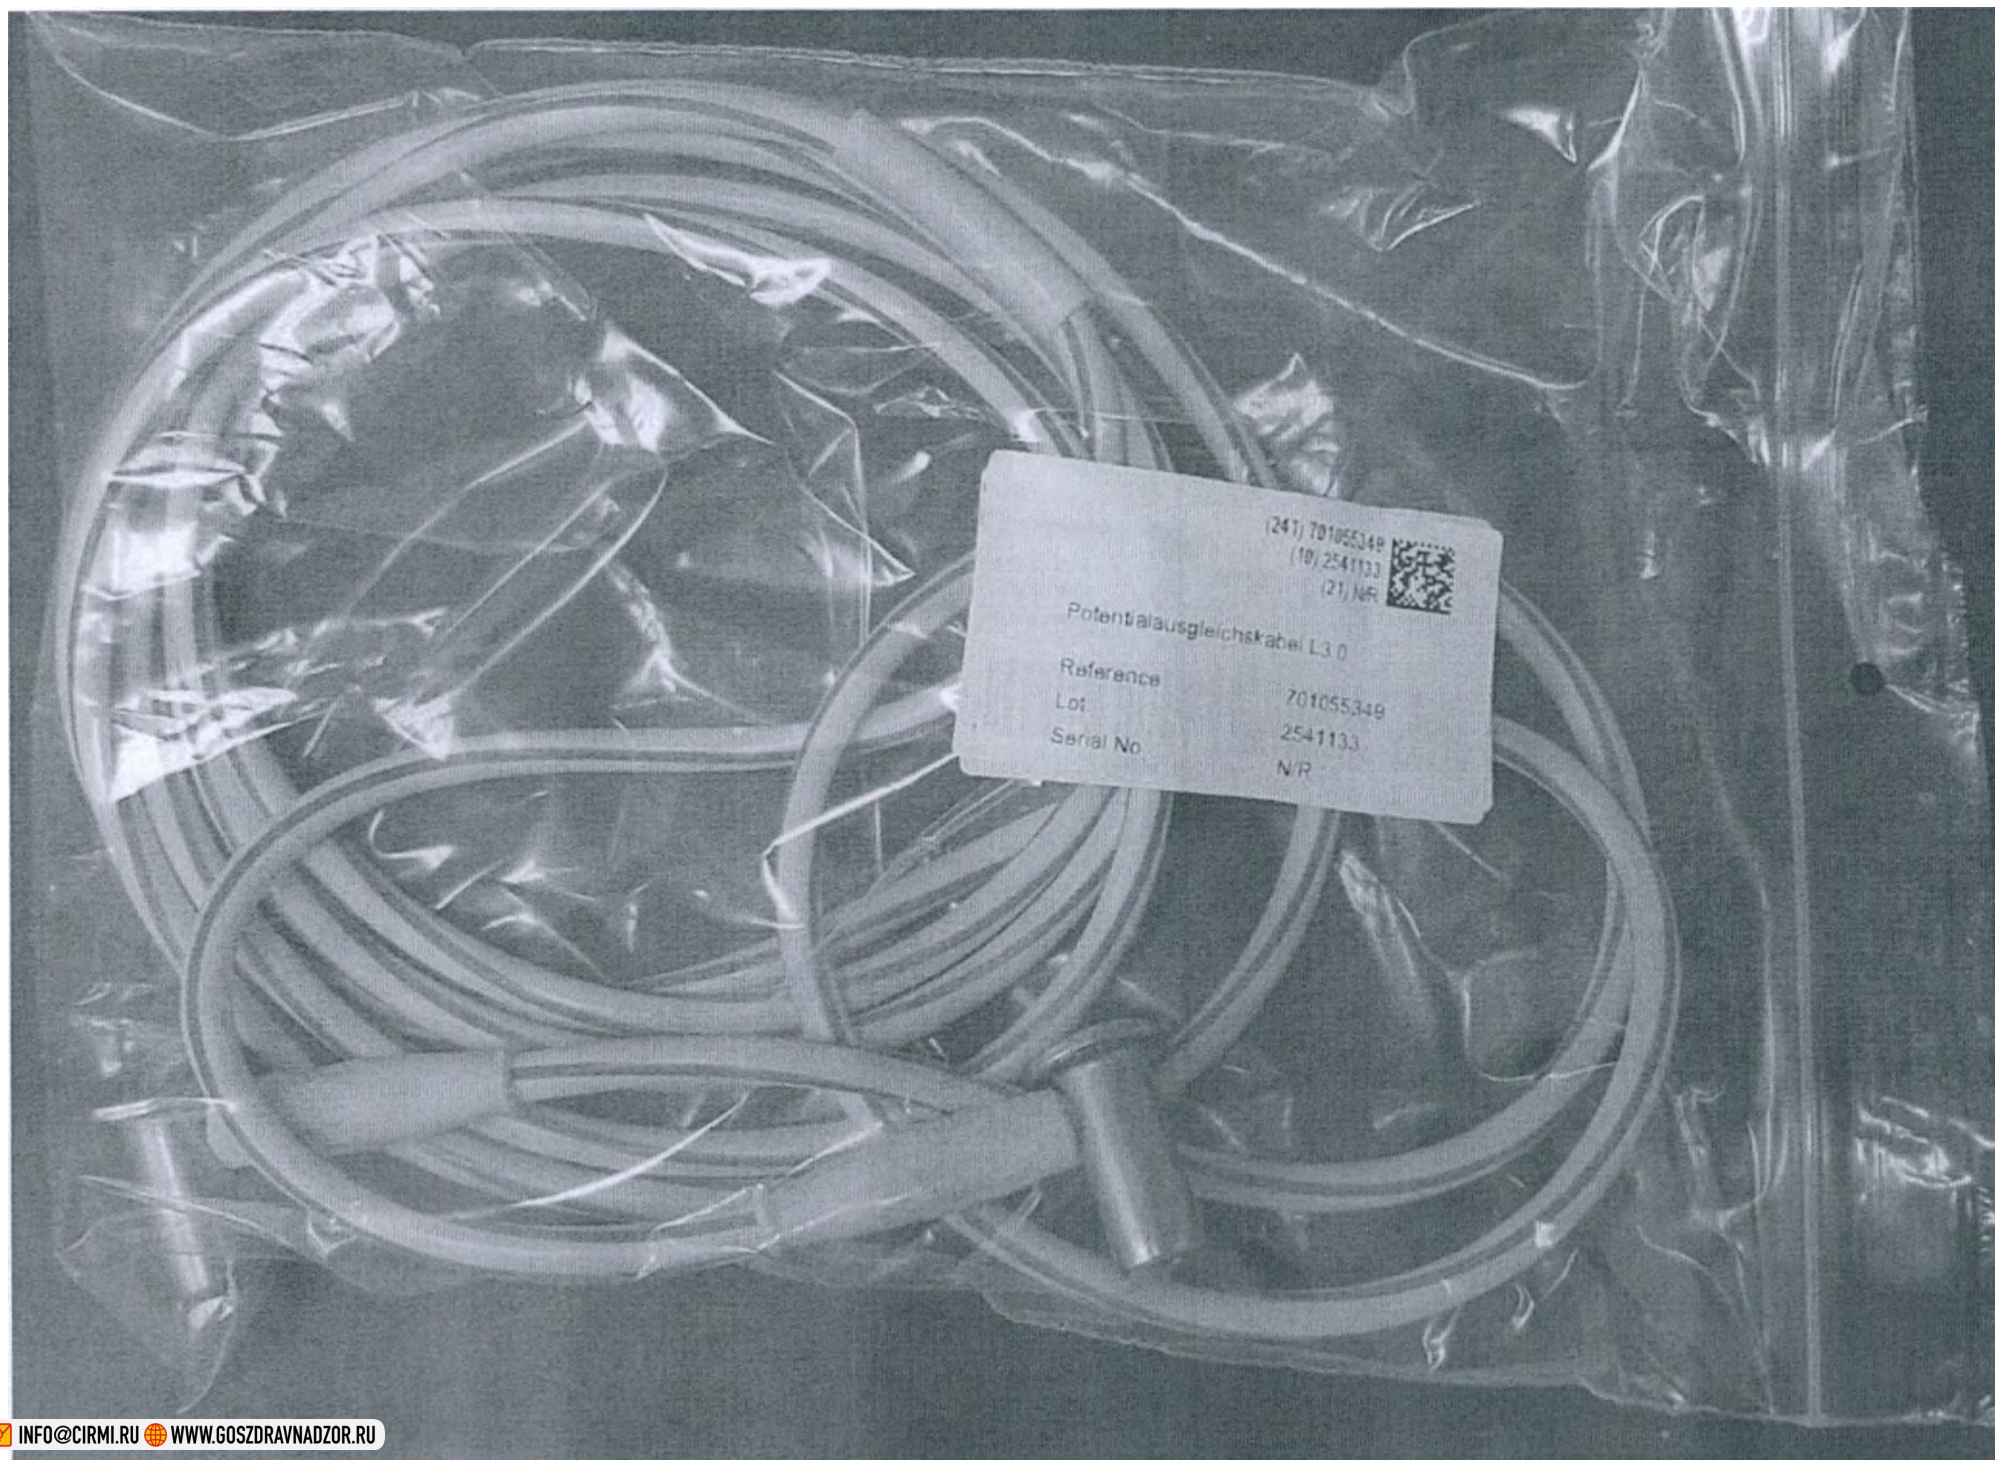


4. Держатель для крепления расходных материалов НКН 7900

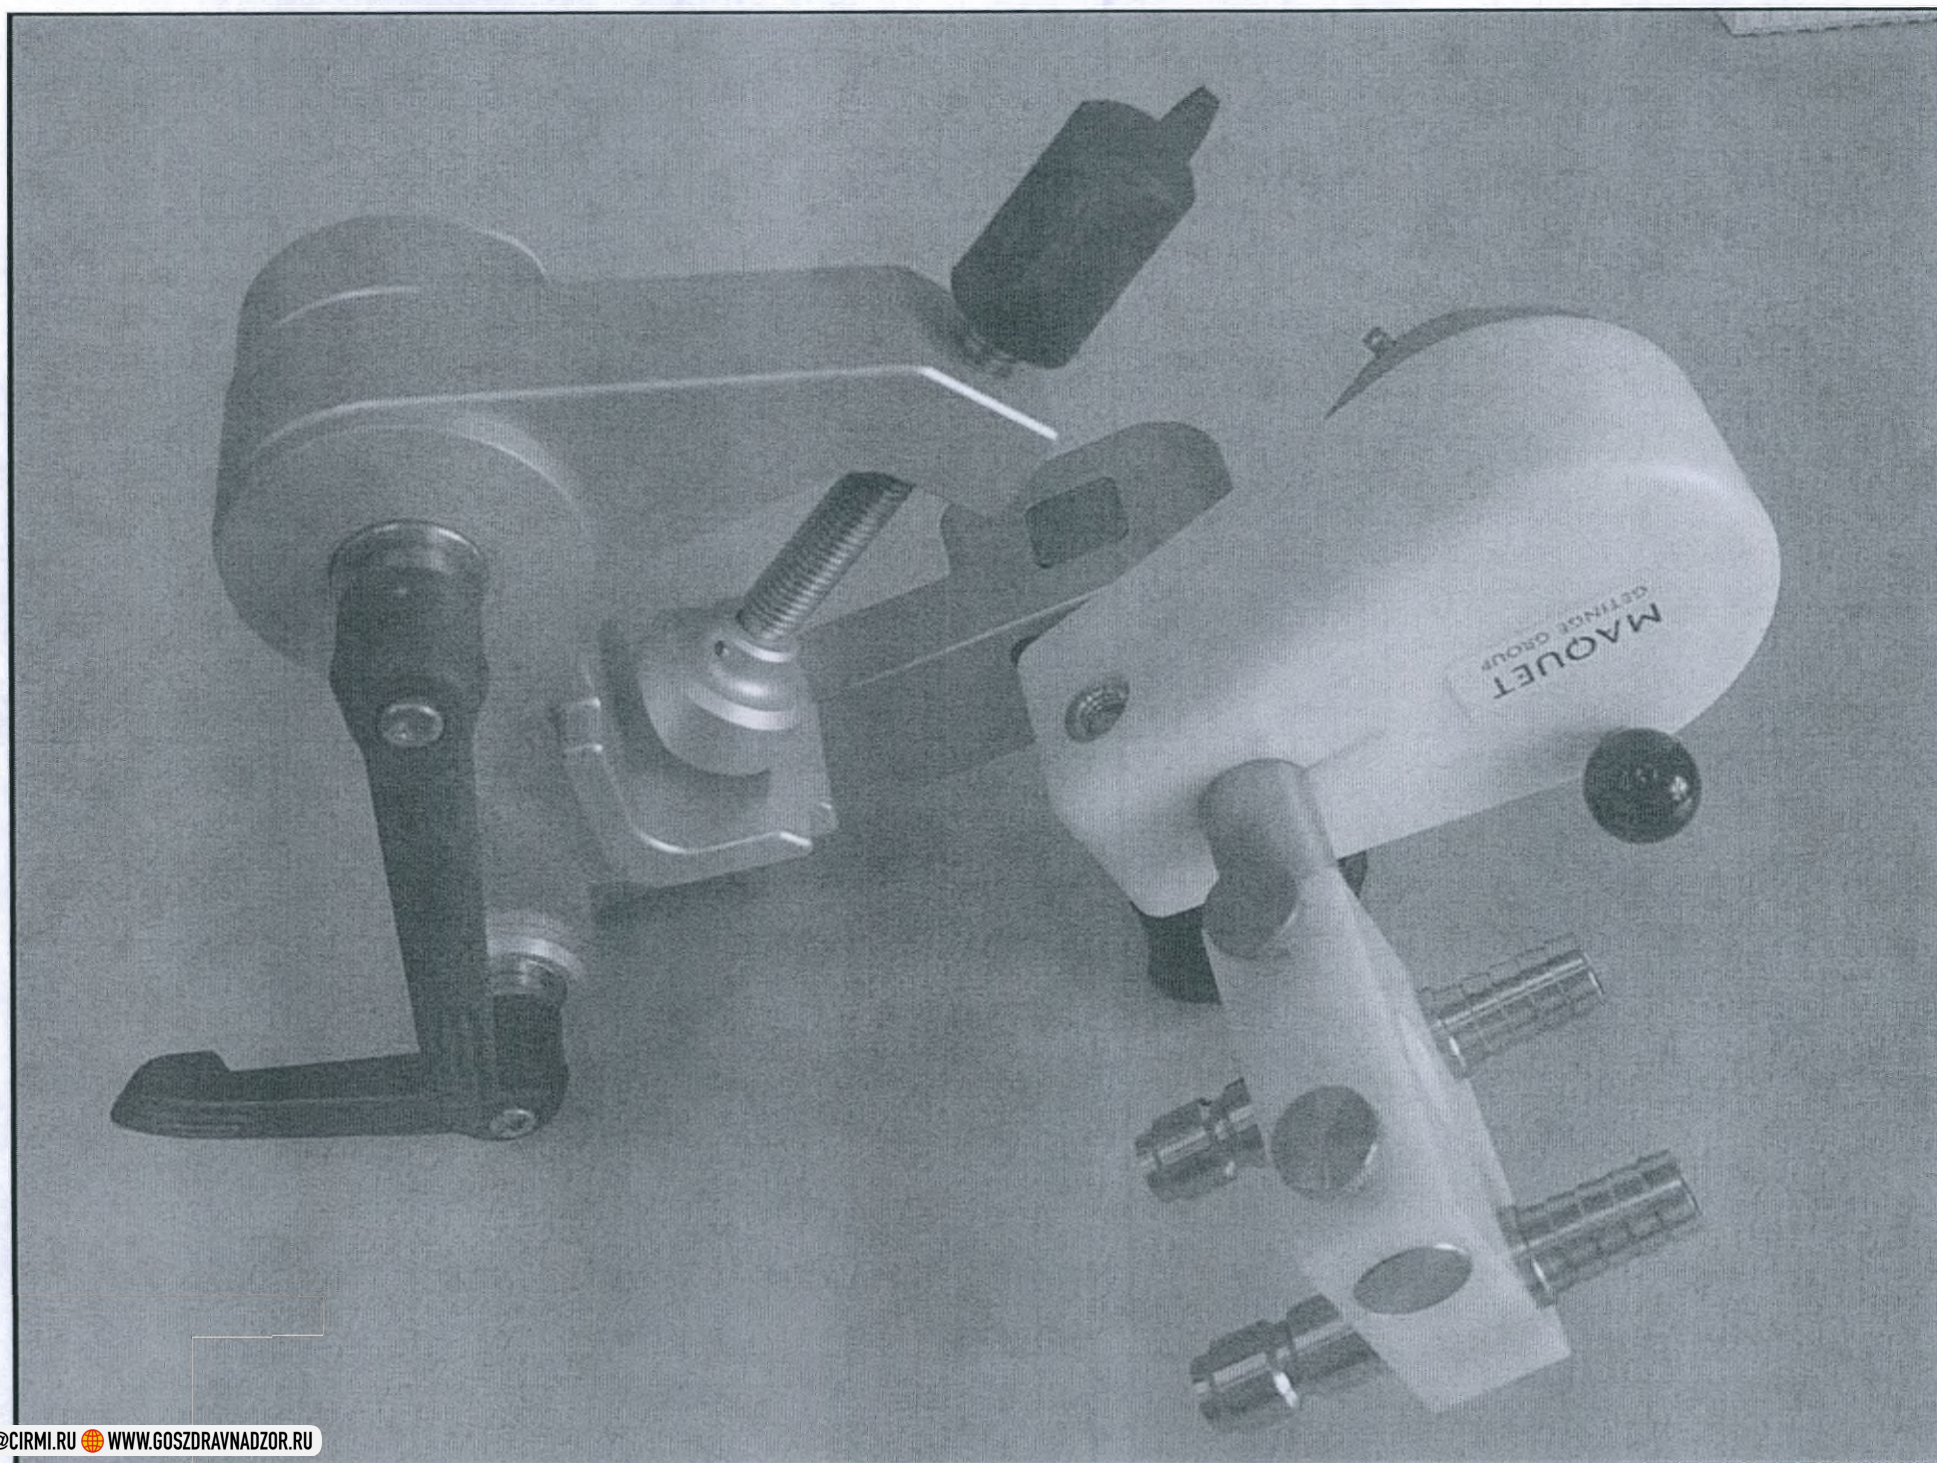


5. Точка фиксации

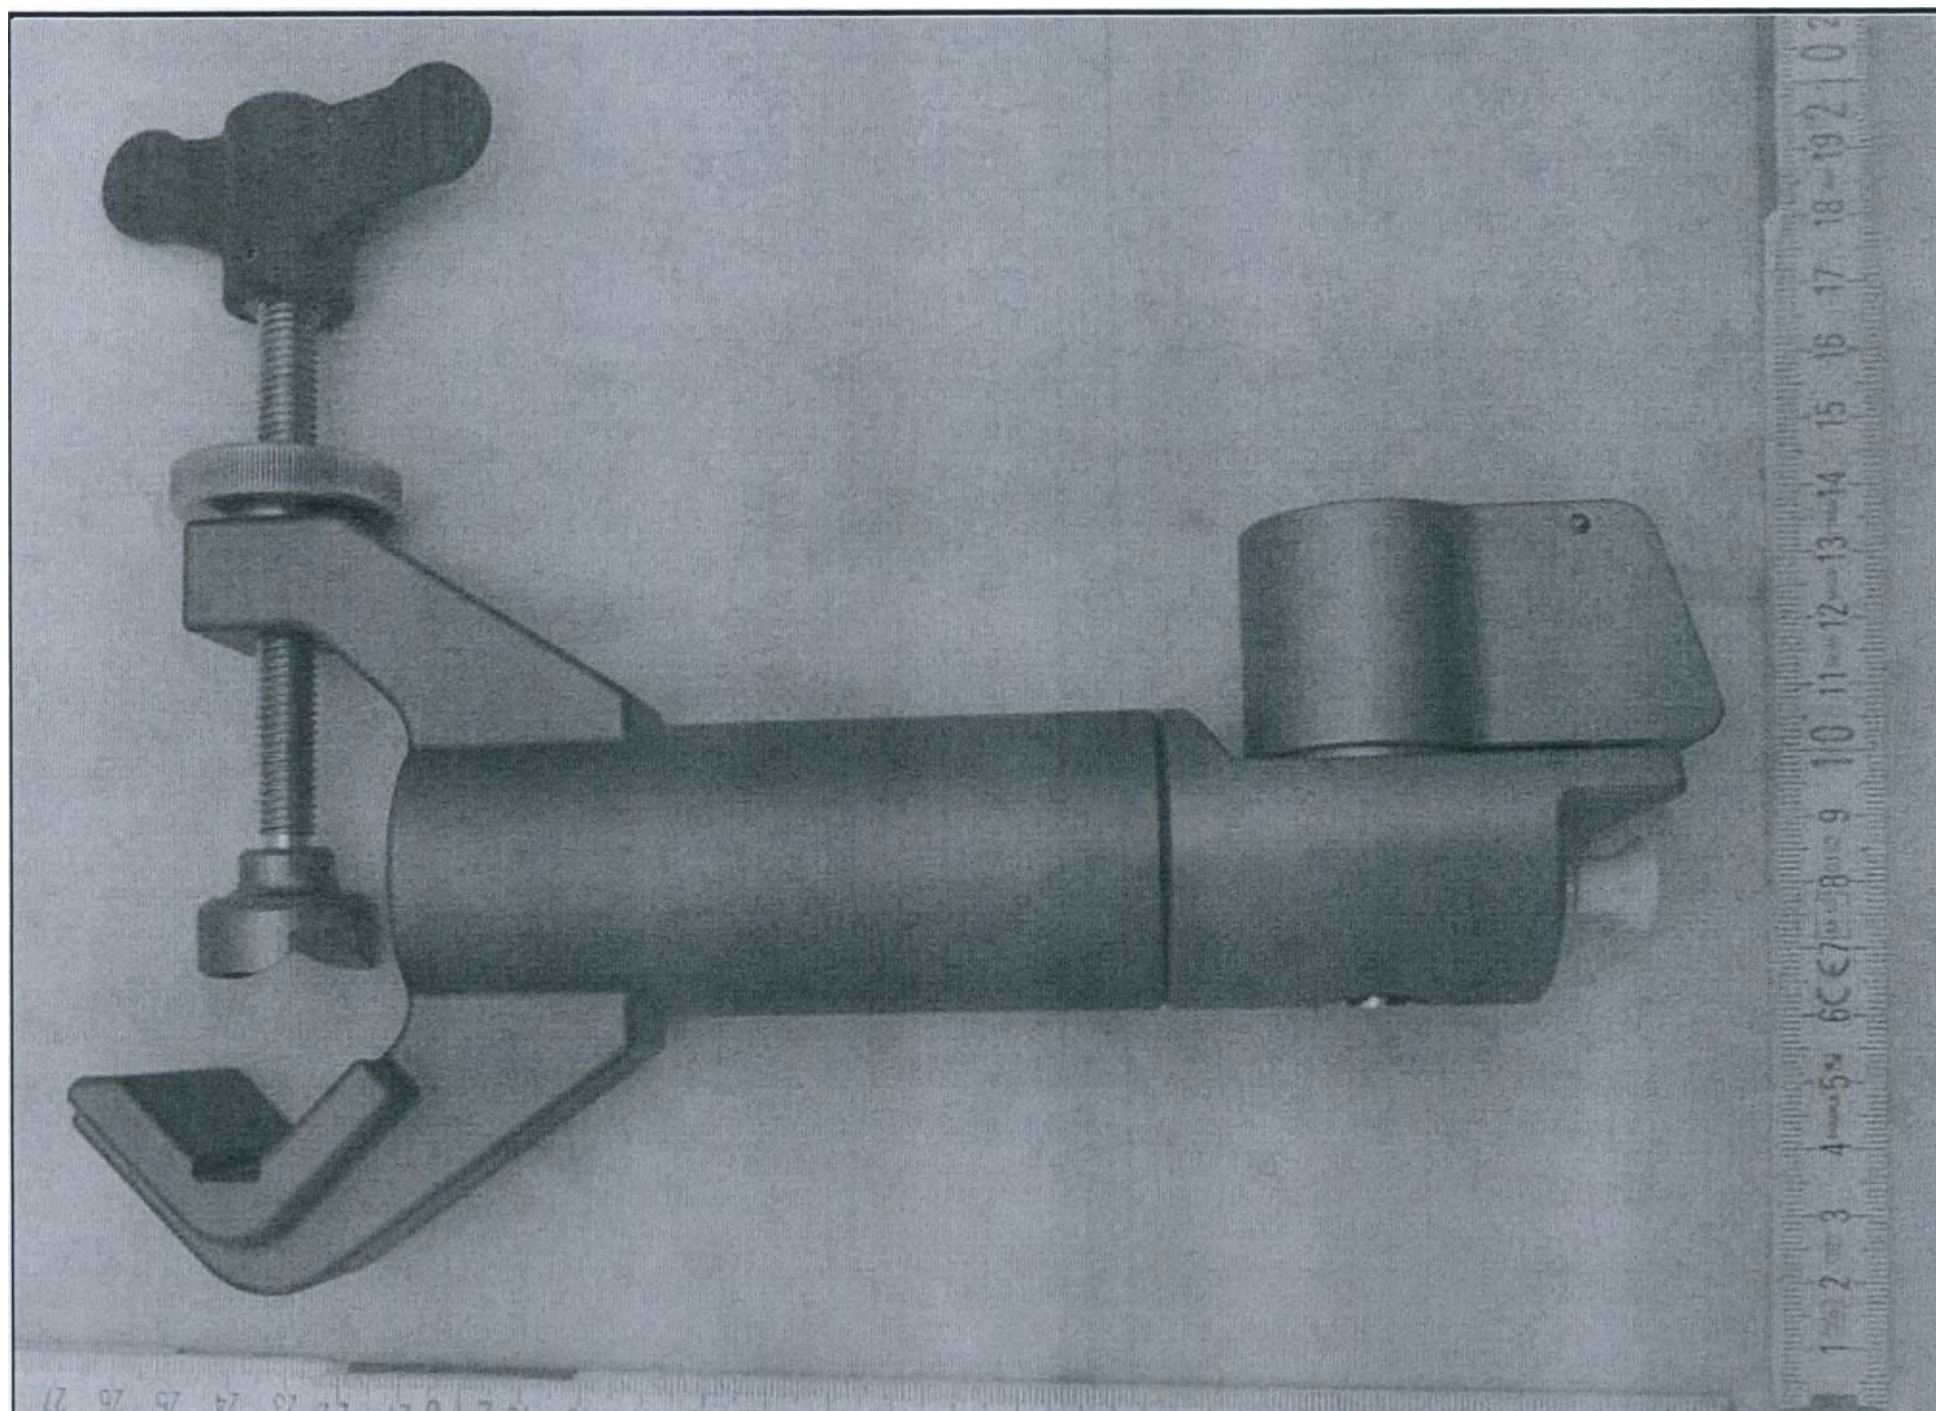


6. Батареи, 2 шт.

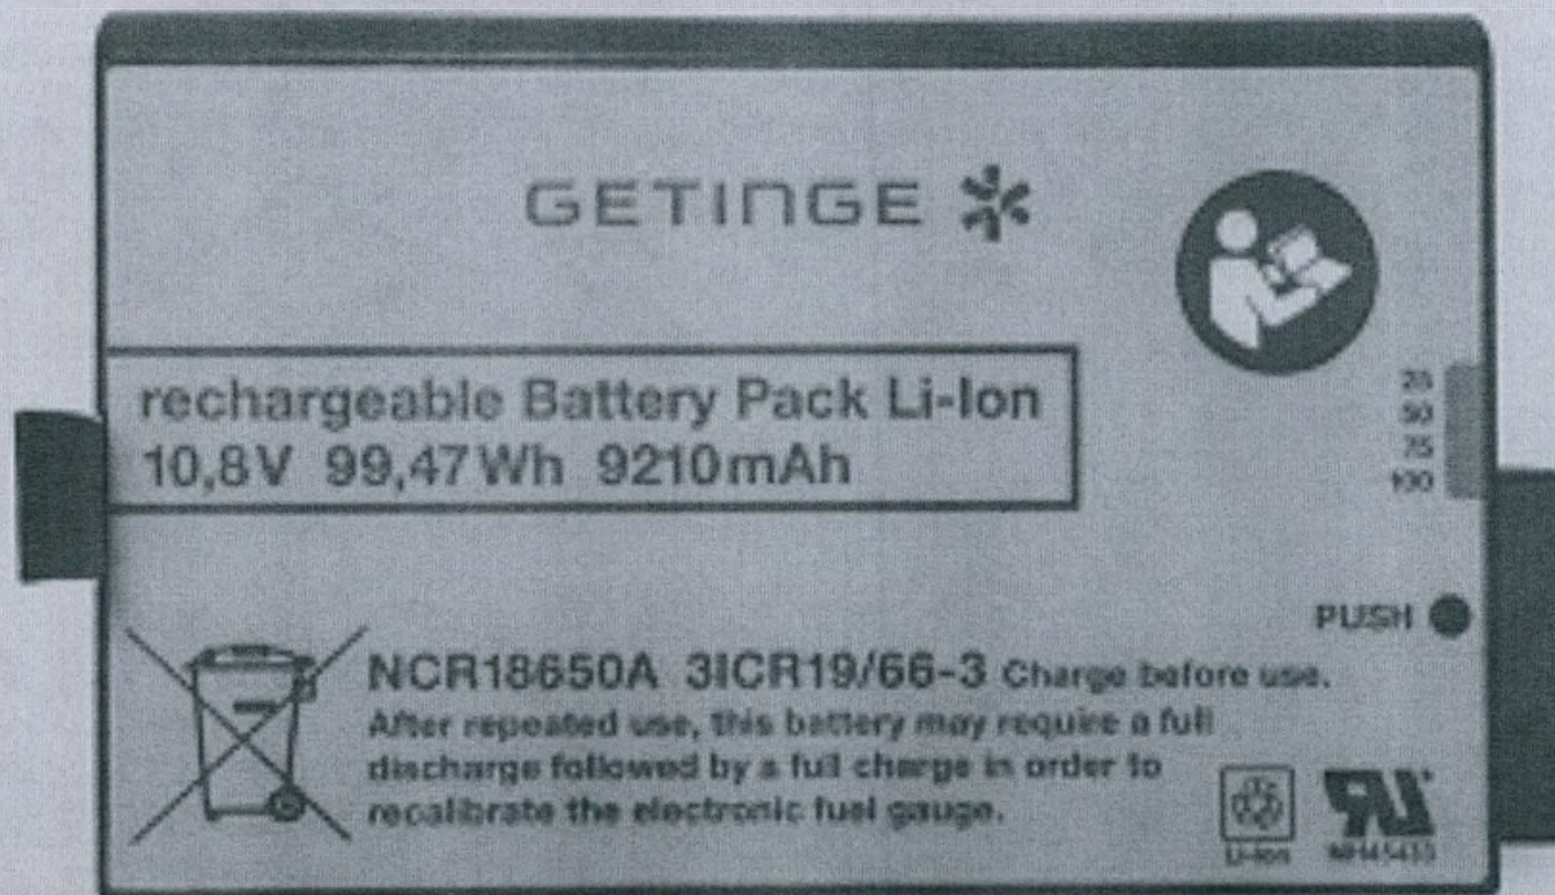

7. Внешнее устройство для зарядки и калибровки батарей

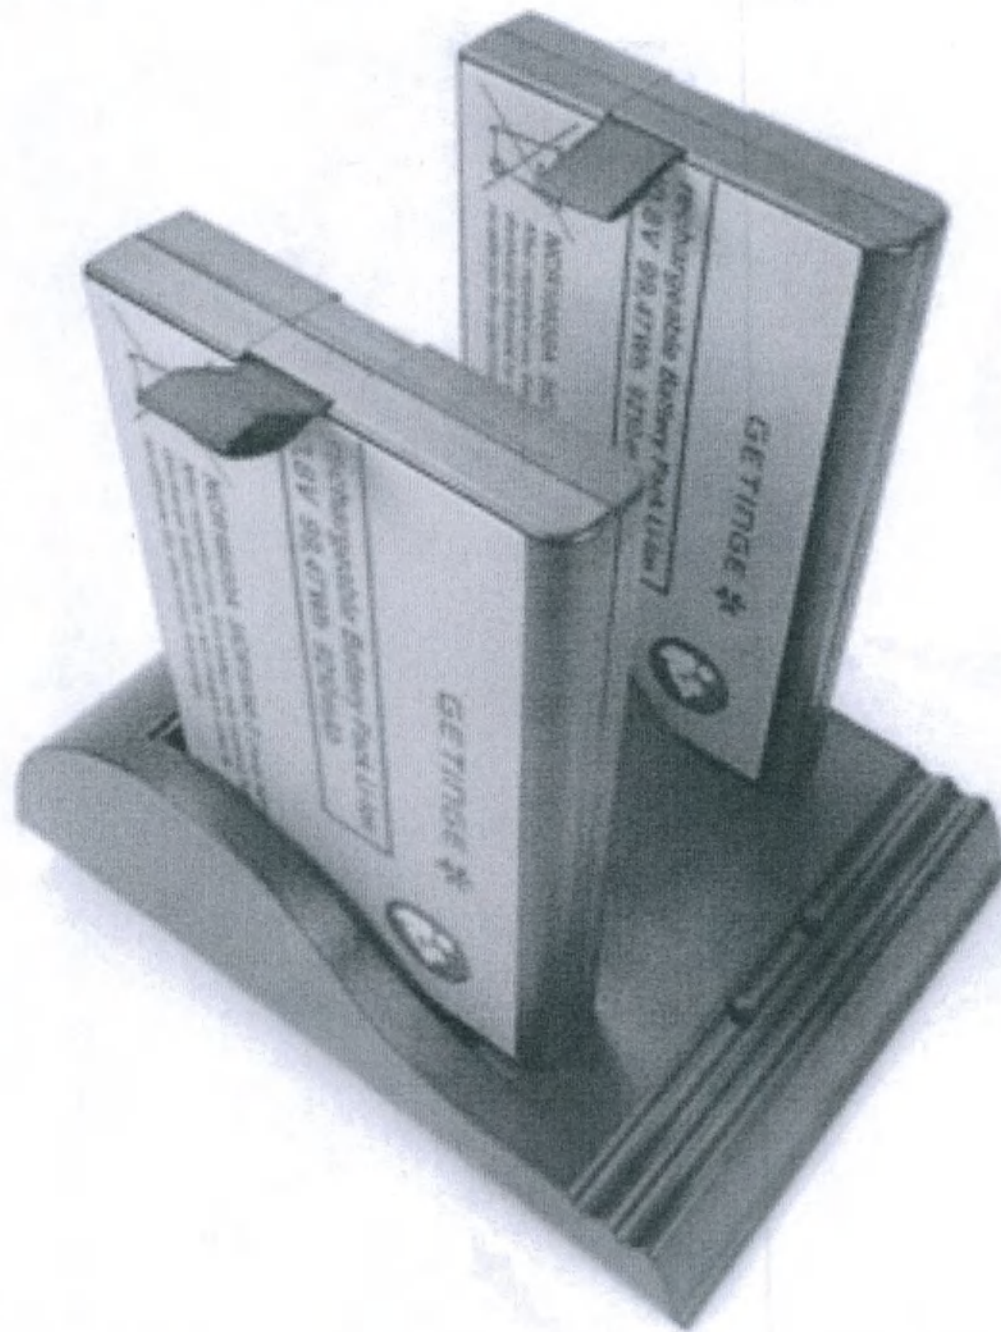

8. Кабель внешнего устройства для зарядки и калибровки батарей.

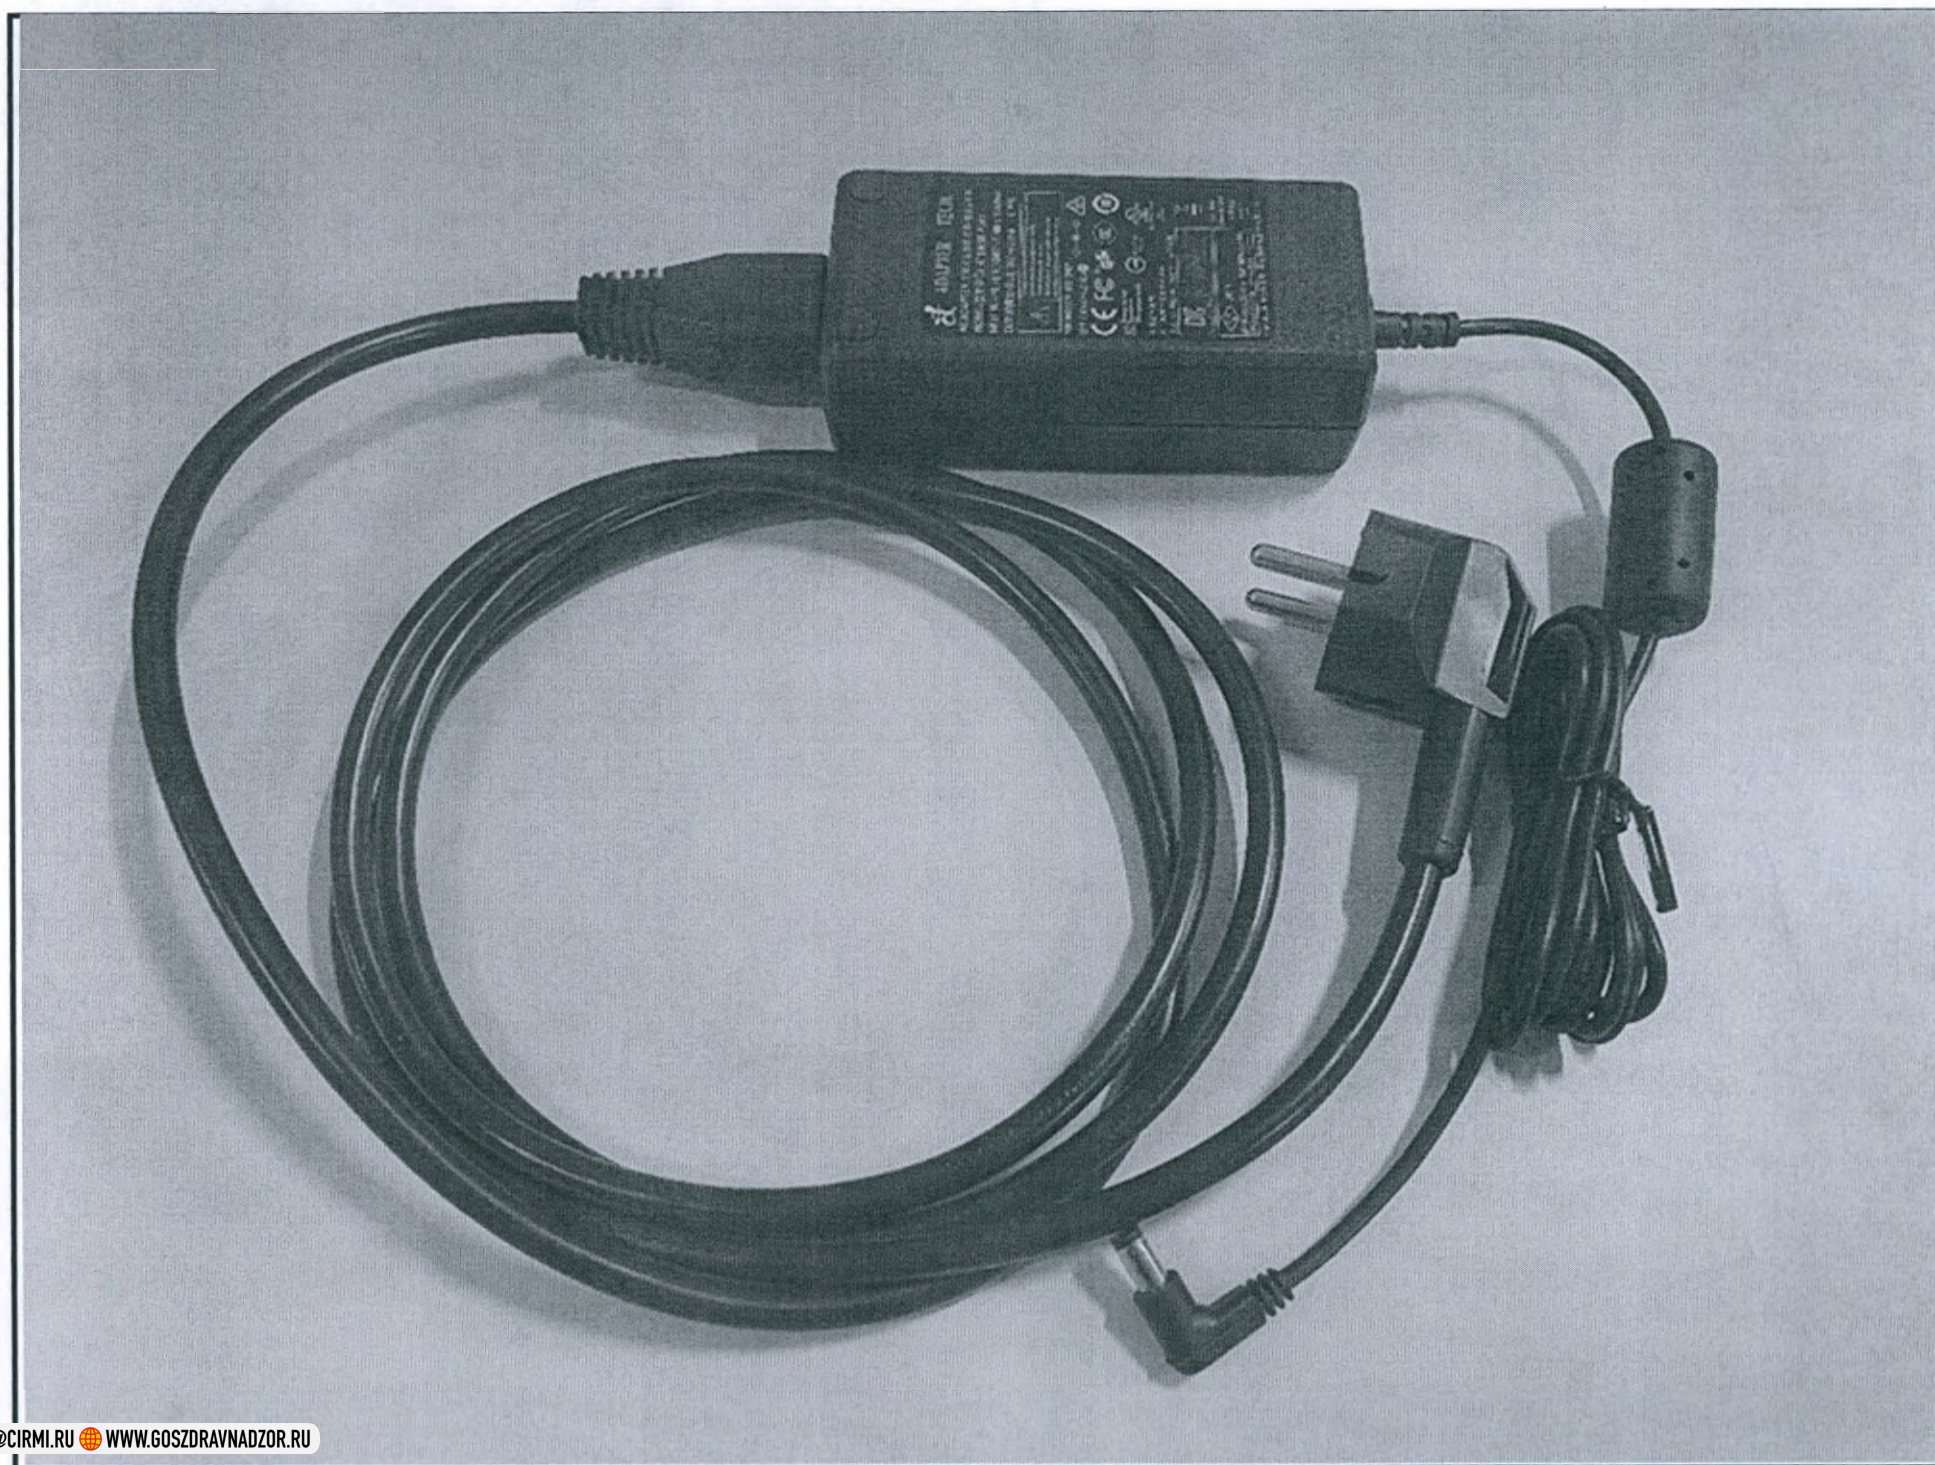

Принято, проинформировано и исполнено
281 дваруаь восемь летов
Генеральный директор ООО «МАКЕ»
Медведева А.М.

А.М. Медведева

