

Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 1210201

На коробку:

виненәмири олончәноисәфәри кут /
оинәвоәчәлоиси х оволо



Контроли MagnoLIA CA 125
Набор реагентов для контроля
качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.

LOT E004 2022-08-23 2024-02-23

REF 1210201

IVD

ТУ 21.20.23-632-98539446-2022
RU XXXXXXXXXXXXXXXX


ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
объем 0,5 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
объем 0,5 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1210205

На коробку:



REF 1210205
LOT E004
2024-02-23

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Контроли MagnoLIA CA 125

Состав набора:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-632-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXX

Контроли MagnoLIA CA 125
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

LOT E004
REF 1210205
IVD

2022-08-23
2024-02-23


+2⁺8 °C
100

Готово к использованию
Для профессионального применения



На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
объем 0,5 мл
+2⁺8 °C
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
объем 0,5 мл
+2⁺8 °C
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Вариант исполнения 3

Кат. № 1210210

На коробку:

Контроли MagnoLIA CA 125

LOT E004
1210210

1210210

2024-02-23

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Женевский пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)678779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E004

REF 1210210

IVD

2022-08-23

2024-02-23

200

+2⁺8
°C

i

!




ТУ 21.20.23-632-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.


На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
объем 0,5 мл



-10 шт.

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
объем 0,5 мл



-10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Вариант исполнения 3	стр. 8,9,10
Контроли 1, 2	стр. 11,12

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт

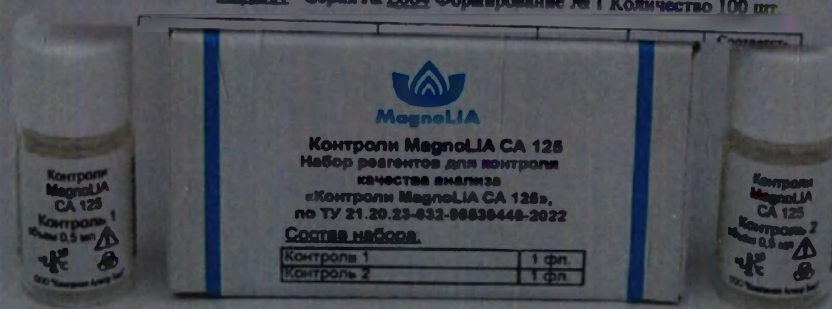


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.


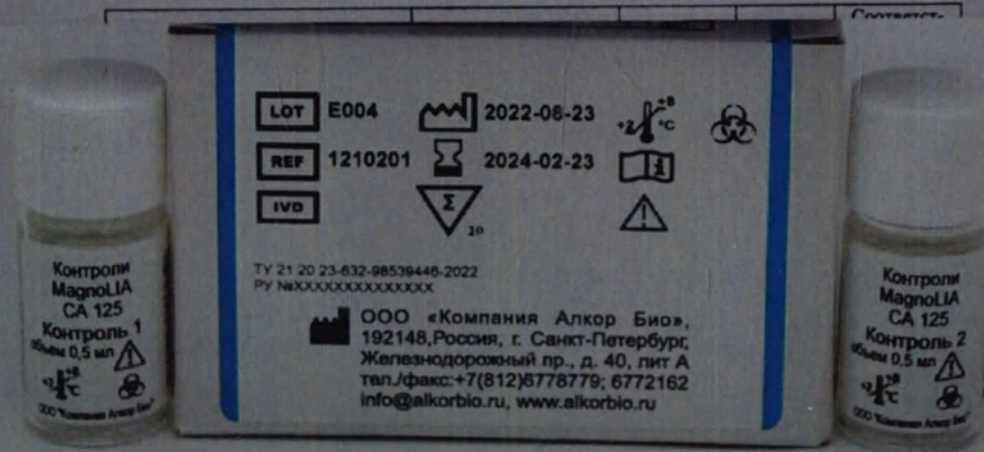


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210201 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

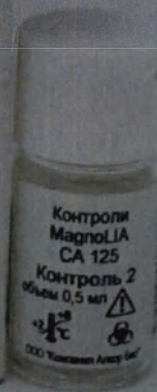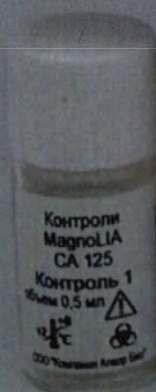

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Контроли MagnoLIA CA 125

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.

ТУ 21.20.23-632-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX

LOT E004

REF 1210205

IVD

2022-08-23

2024-02-23

100

+2/+8

3

!

!

Готово к использованию
Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 1
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли MagnoLIA CA 125

LOT

E004



2024-02-23

REF

1210205

+37°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

Контроли
MagnoLIA
CA 125
Контроль 2
Объем 0,5 мл
+37°C
Биологический
ООО «Компания Алкор Био»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210205 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Содержит:



Контроли MagnoLIA CA 125
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Состав набора:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.

LOT E004

2022-08-23

REF 1210210

2024-02-23


IVD

206

ТУ 21.20.23-632-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX

Готово к использованию
Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

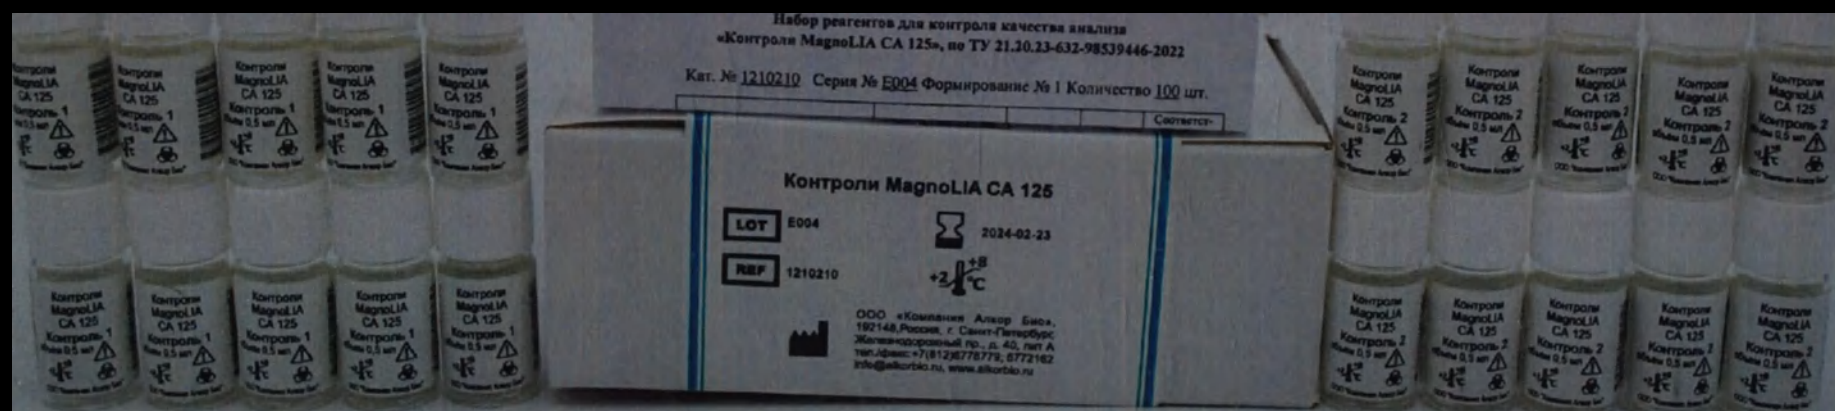

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроль Magnolia CA 125», по ТУ 21.20.23-632-98539446-2022

Кат. № 1210210 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствует



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

(~~1~~) лист

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.П. Полинцев

