

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

стр. 2,3,4

Вариант исполнения 2

стр. 5,6,7

Калибраторы 1,2,3,4

стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Кат. № 1210101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Кат. № 1210101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

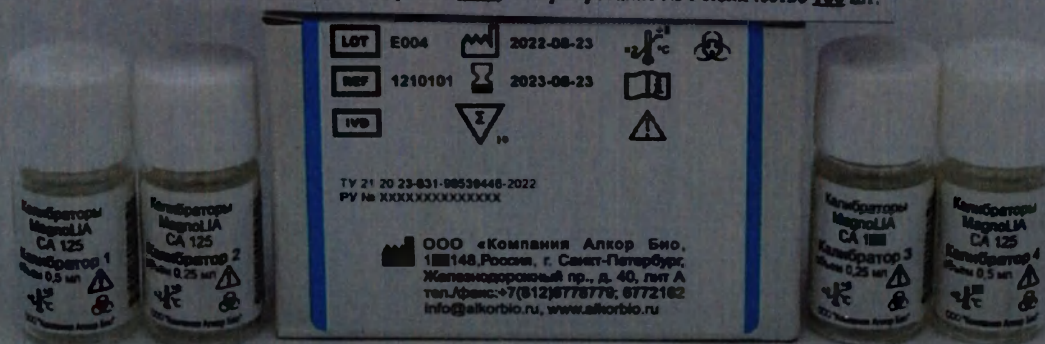

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № Е004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Кат. № 1210101 Серия № Е004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Кат. № 1210105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Калибраторы MagnoLIA CA 125
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Состав набора

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-631-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXX000000

LOT E004

2022-08-23

REF 1210105

2023-08-23

ГVS

Σ



Готово к использованию
для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Кат. № 1210105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы MagnoLIA CA 125

LOT E004

2023-08-23

REF 1210105



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Кат. № 1210105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



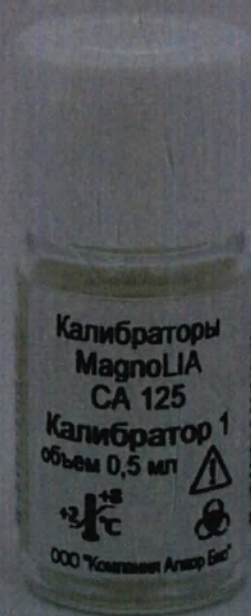

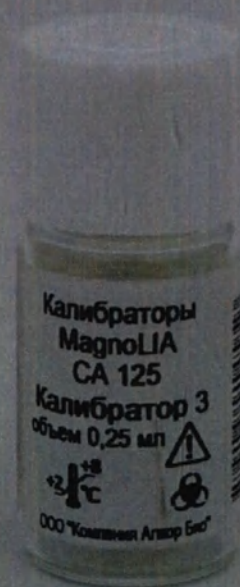

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

1 (одиннадцать) лист 11

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 1210101

На коробку:




Калибраторы MagnoLIA CA 125
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Состав набора

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения

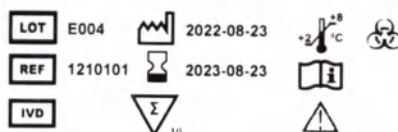

ТУ 21 20 23-631-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
+7(812)6778779; 6772162
albio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 1
объем 0,5 мл
+2⁵°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 2
объем 0,25 мл
+2⁵°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 3
объем 0,25 мл
+2⁵°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 4
объем 0,5 мл
+2⁵°C
000 "Компания Алкор Био"



«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1210105

На коробку:


1210105
E004
Калибраторы MagnoLIA CA 125
2023-08-23
+2[°]C
+8[°]C
ООО «Компания Алкор Био»,
192148 Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит А,
тел./факс: +7(812)6787878, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Калибраторы MagnoLIA CA 125
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA CA 125»,
по ТУ 21.20.23-631-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E004

REF 1210105

IVD

 2022-08-23

 2023-08-23

 50

+2[°]C
+8[°]C



ТУ 21.20.23-631-98539446-2022
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 1
объем 0,5 мл
+2[°]C
+8[°]C
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 3
объем 0,25 мл
+2[°]C
+8[°]C
ООО «Компания Алкор Био»




-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 2
объем 0,25 мл
+2[°]C
+8[°]C
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
CA 125
Калибратор 4
объем 0,5 мл
+2[°]C
+8[°]C
ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

