


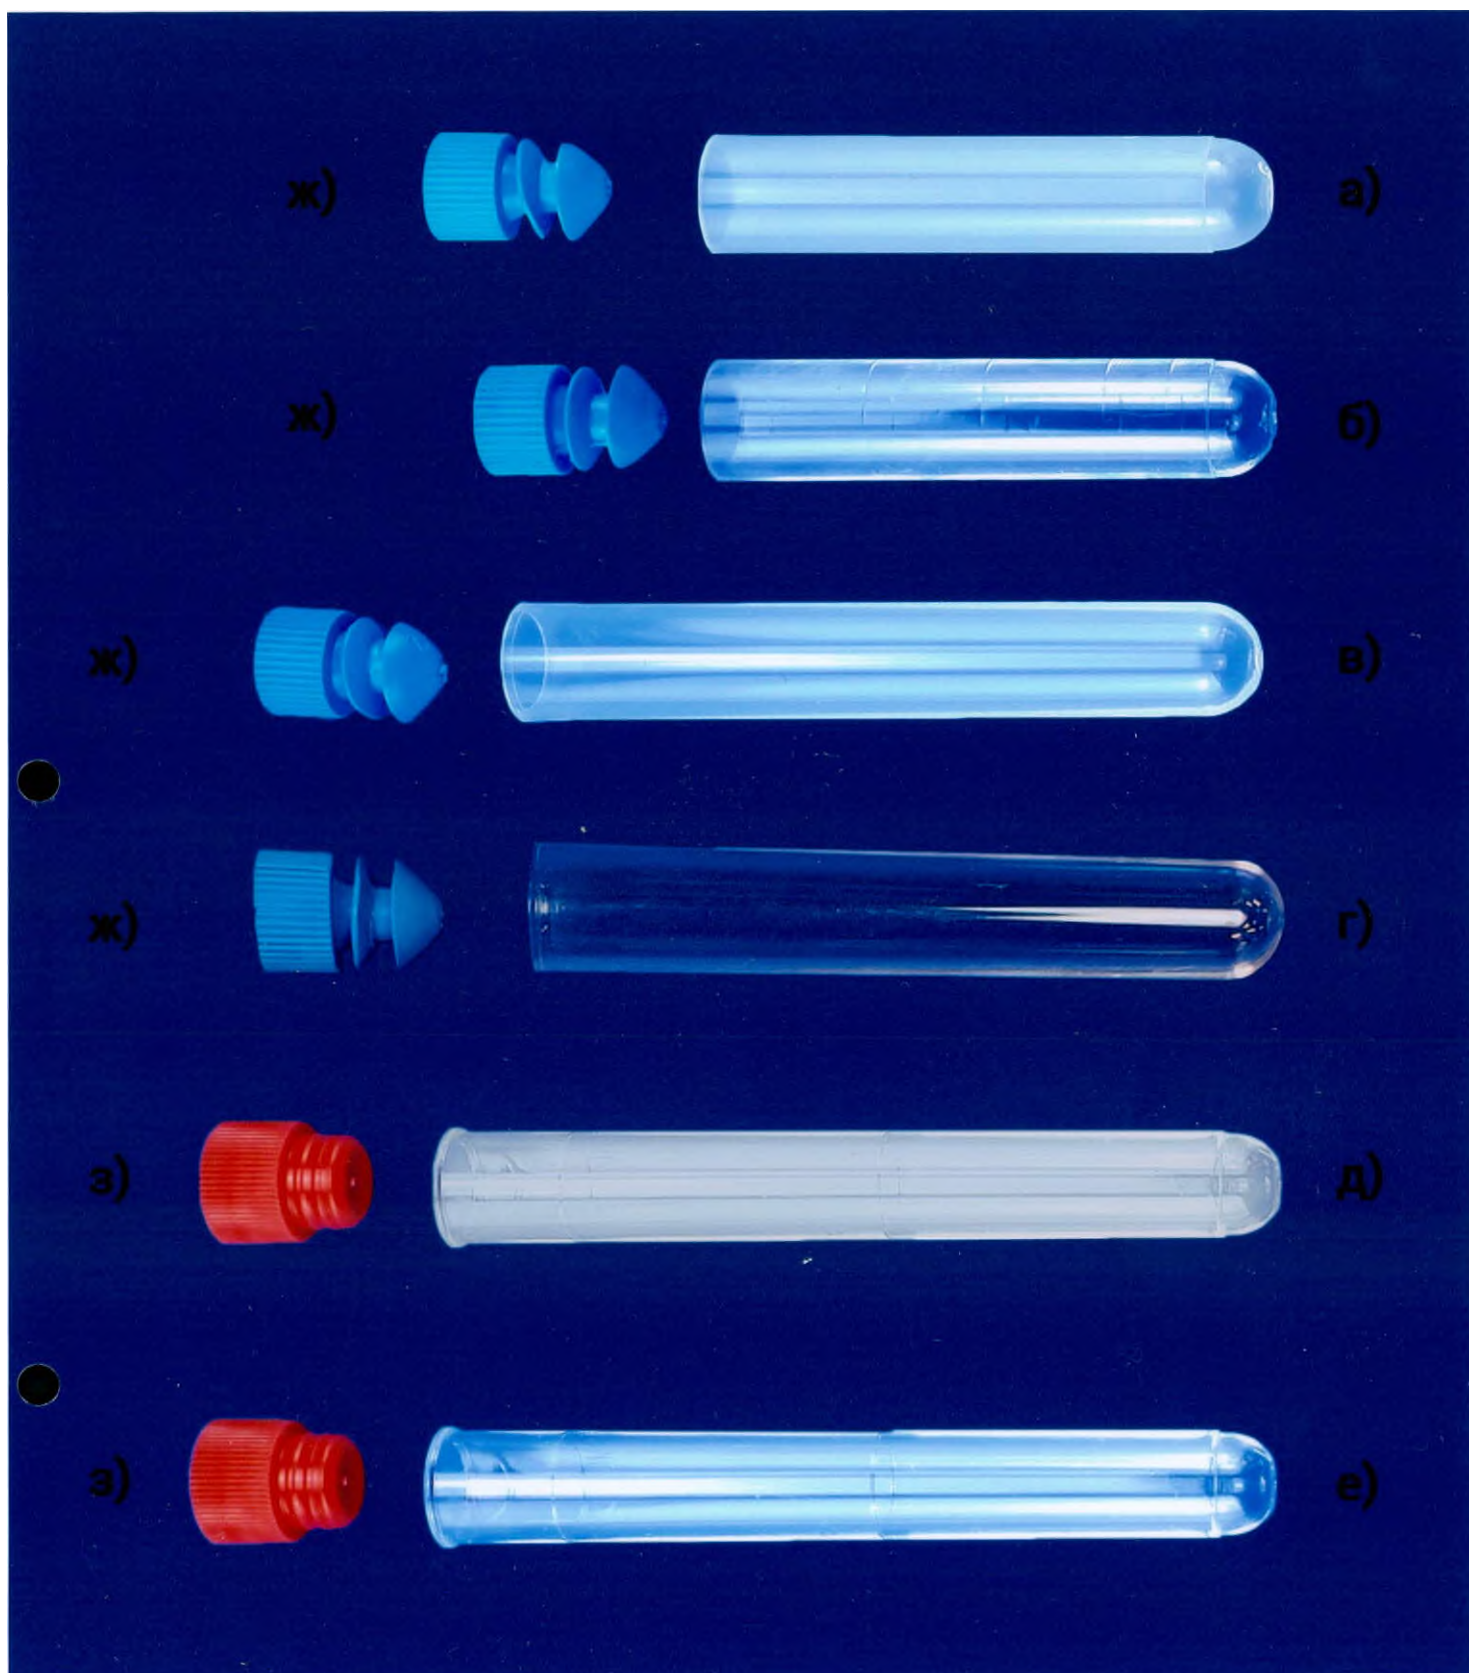

**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

а) Микропробирка круглодонная ПМ2-12-55-ПП

б) Микропробирка круглодонная ПМ2-12-55-ПС

в) Пробирка круглодонная П2-12-75-ПП


г) Пробирка круглодонная П2-12-75-ПС

д) Пробирка круглодонная П2-12-86-ПП

е) Пробирка круглодонная П2-12-86-ПС

ж) Пробка 12 с крыльями

з) Пробка 12 без крыльев

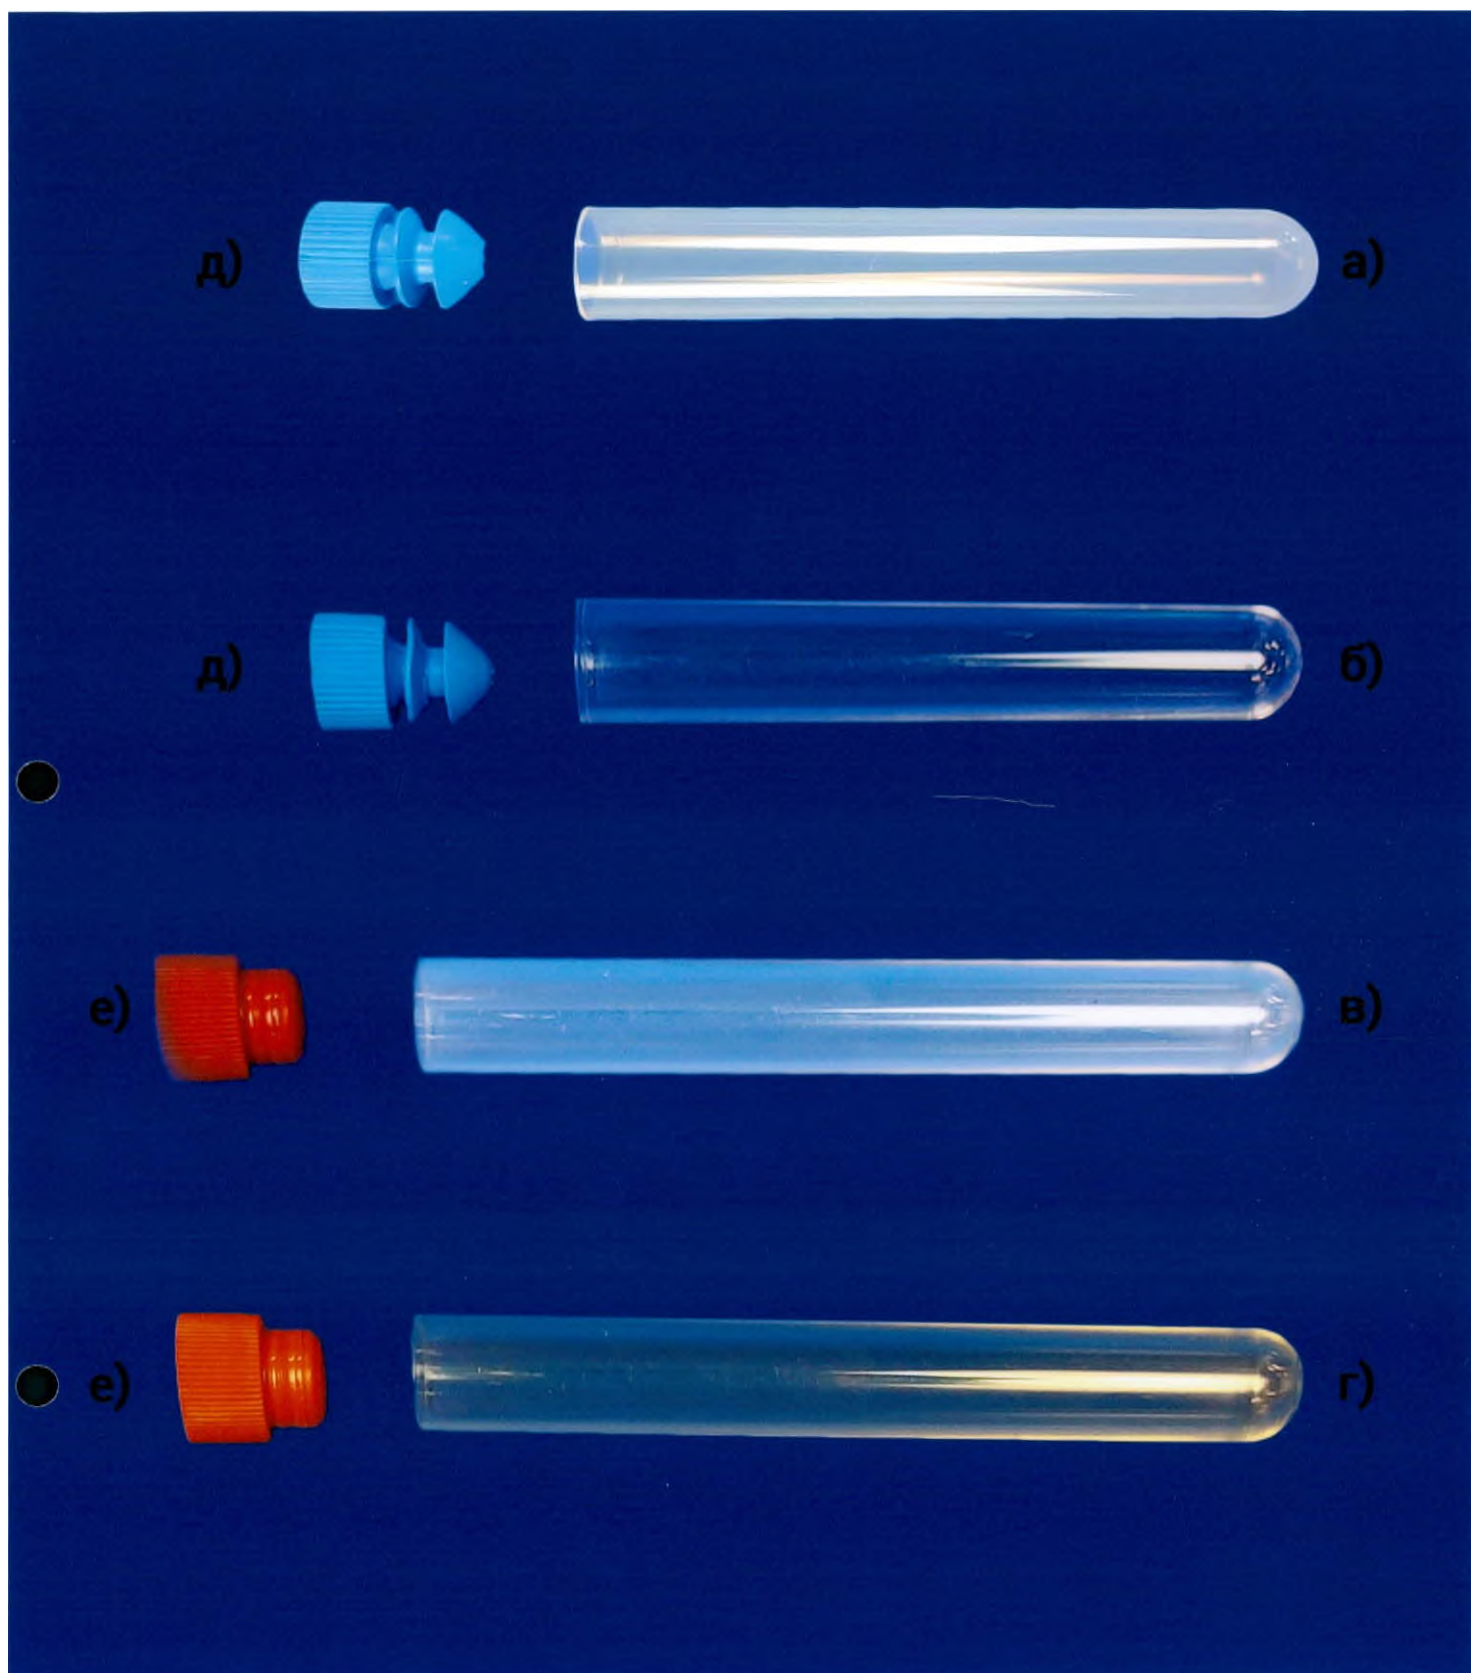

**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

а) Пробирка круглодонная П2-13-75-ПП


б) Пробирка круглодонная П2-13-75-ПС

в) Пробирка круглодонная П2-13-100-ПП

г) Пробирка круглодонная П2-13-100-ПС

д) Пробка 13 с крыльями

е) Пробка 13 без крыльев

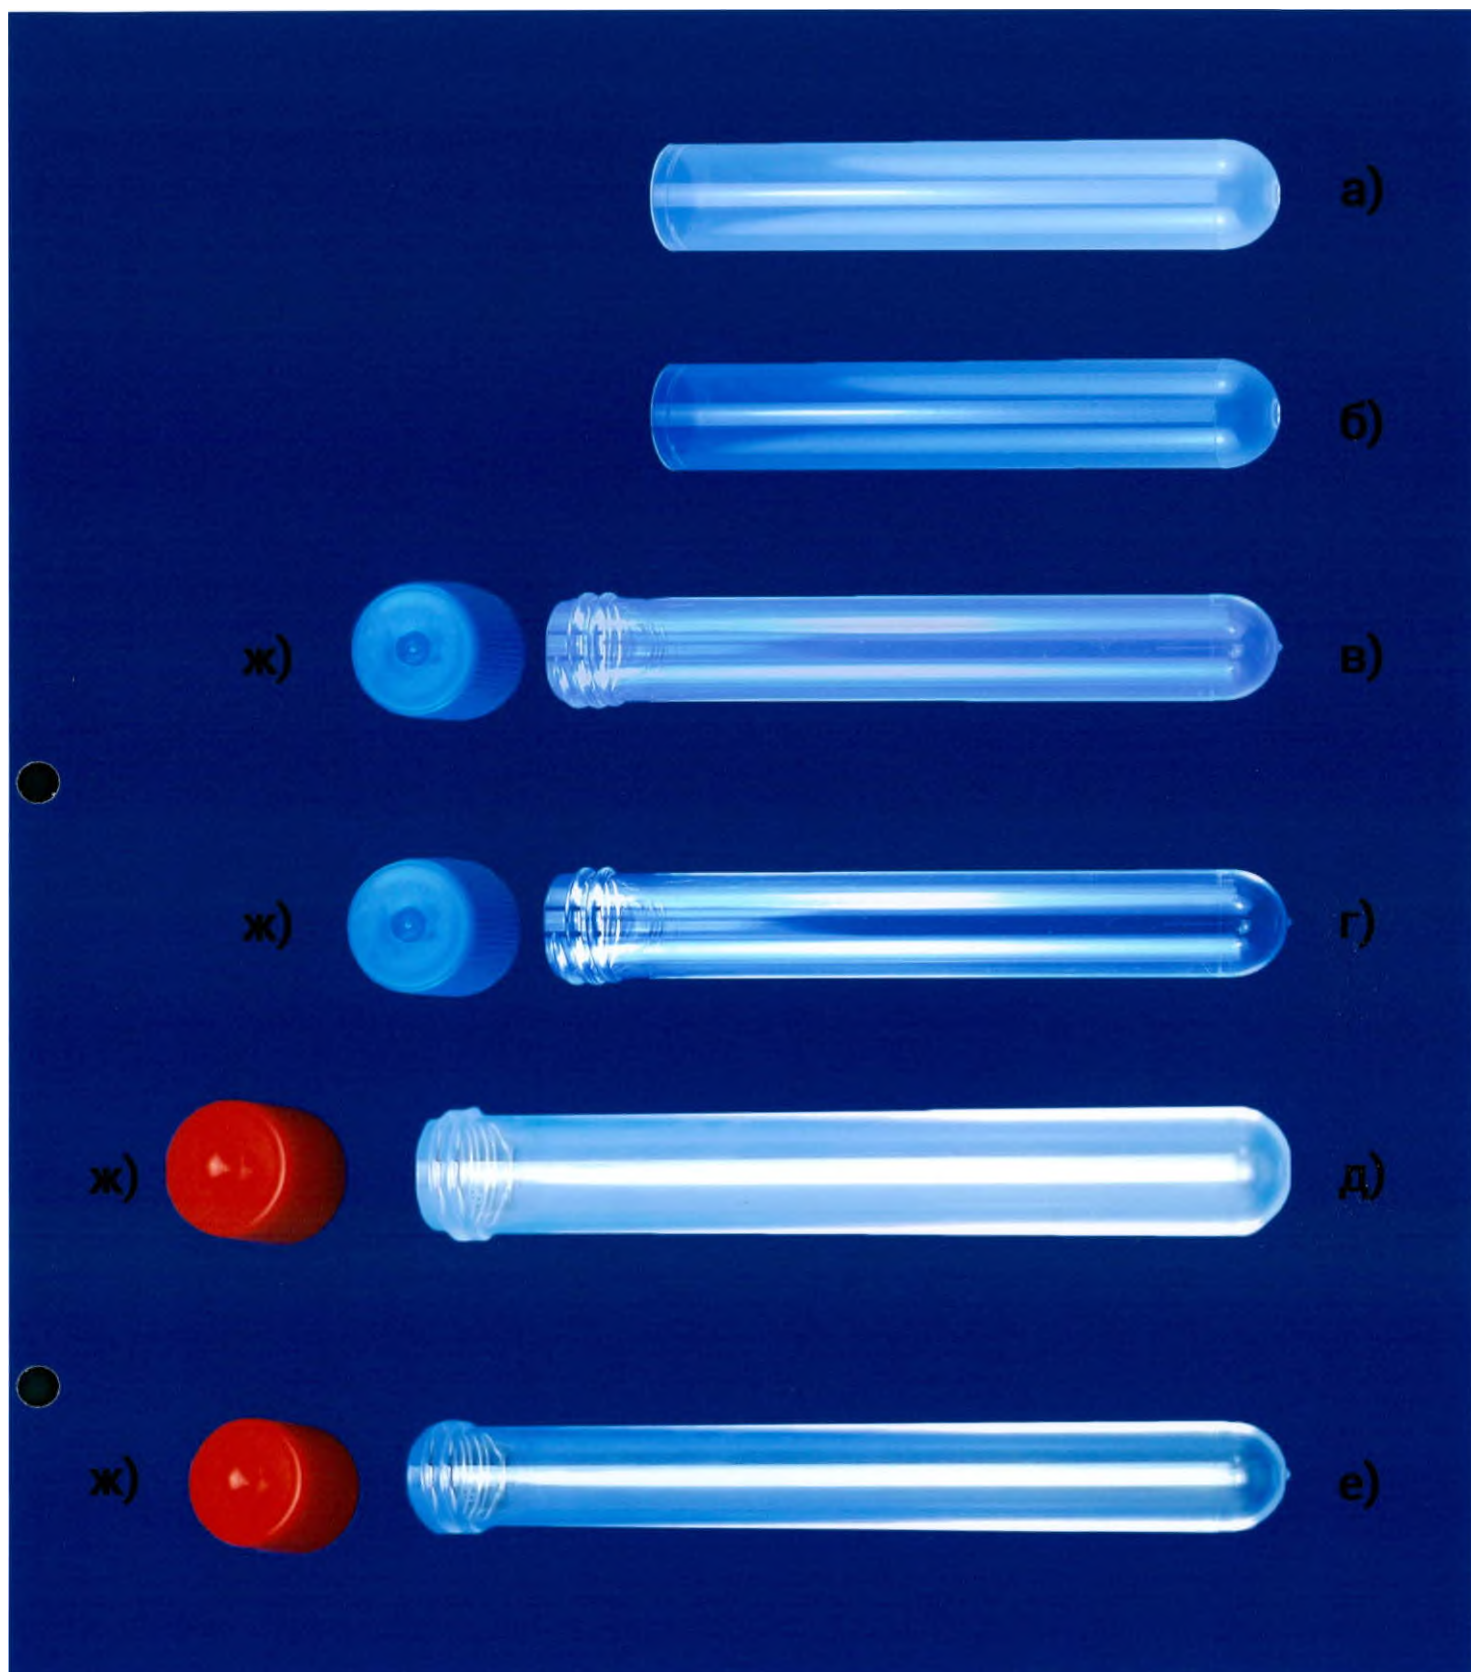

**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

а) Пробирка круглодонная П2-16-91-ПП

б) Пробирка круглодонная П2-16-91-ПС

в) Пробирка круглодонная П2-16-100-ПП

г) Пробирка круглодонная П2-16-100-ПС

д) Пробирка круглодонная П2-16-120-ПП

е) Пробирка круглодонная П2-16-120-ПС

ж) Крышка 16/1




**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

а) Пробирка круглодонная П2-14-123-ПП

б) Пробирка круглодонная П2-14-123-ПС

в) Крышка 14

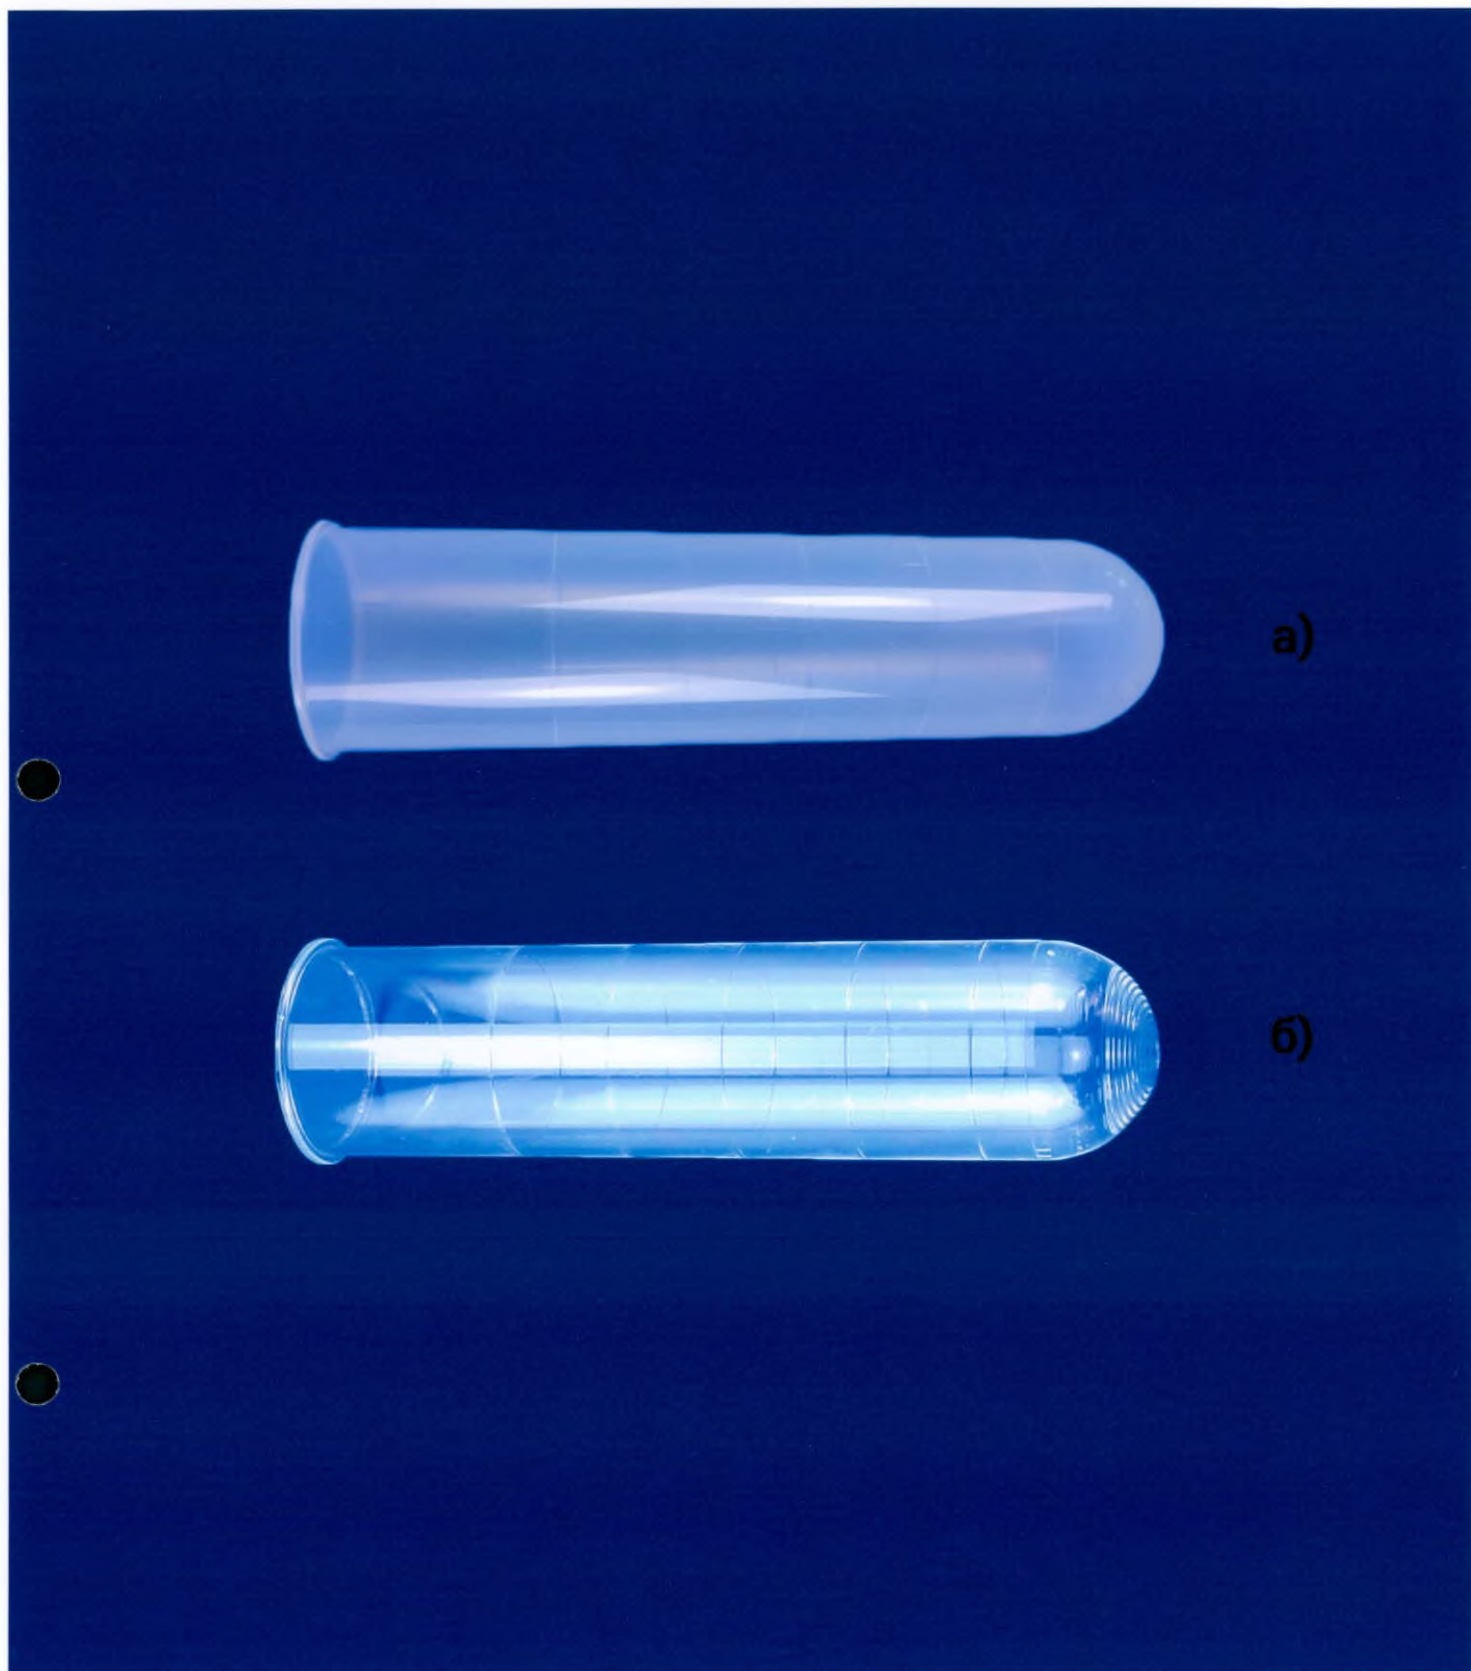

Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.

а) Пробирка круглодонная П2-25-95-ПП

б) Пробирка круглодонная П2-25-95-ПС




в)



а)




б)



е)



г)



е)



д)

Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.

а) Микропробирка круглодонная с юбкой устойчивости ПМ2Ю-15-46-ПП



б) Крышка 15/1

в) Крышка 15/1 с отверстием

г) Пробирка круглодонная с юбкой устойчивости П2Ю-15-102-ПП

д) Пробирка круглодонная с юбкой устойчивости П2Ю-15-102-ПС

е) Крышка 15/2

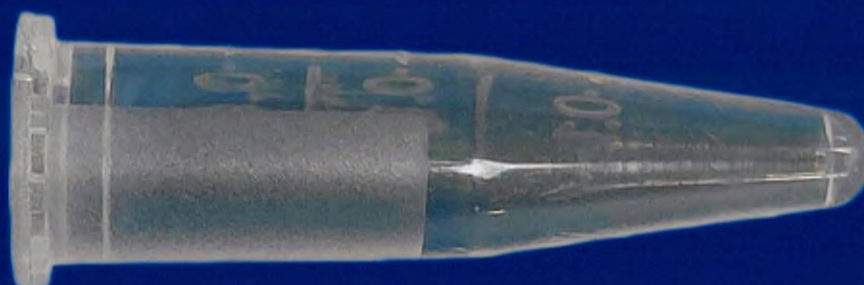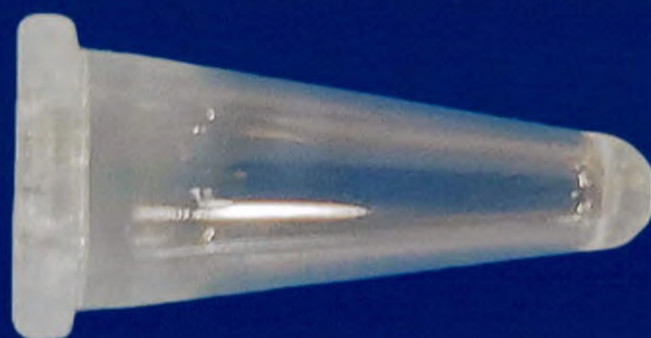


Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.

а) Микропробирка коническая ПМЗ-7-16-ПП

б) Микропробирка коническая ПМЗ-7-21-ПП

в) Микропробирка коническая ПМЗ-8-30-ПП

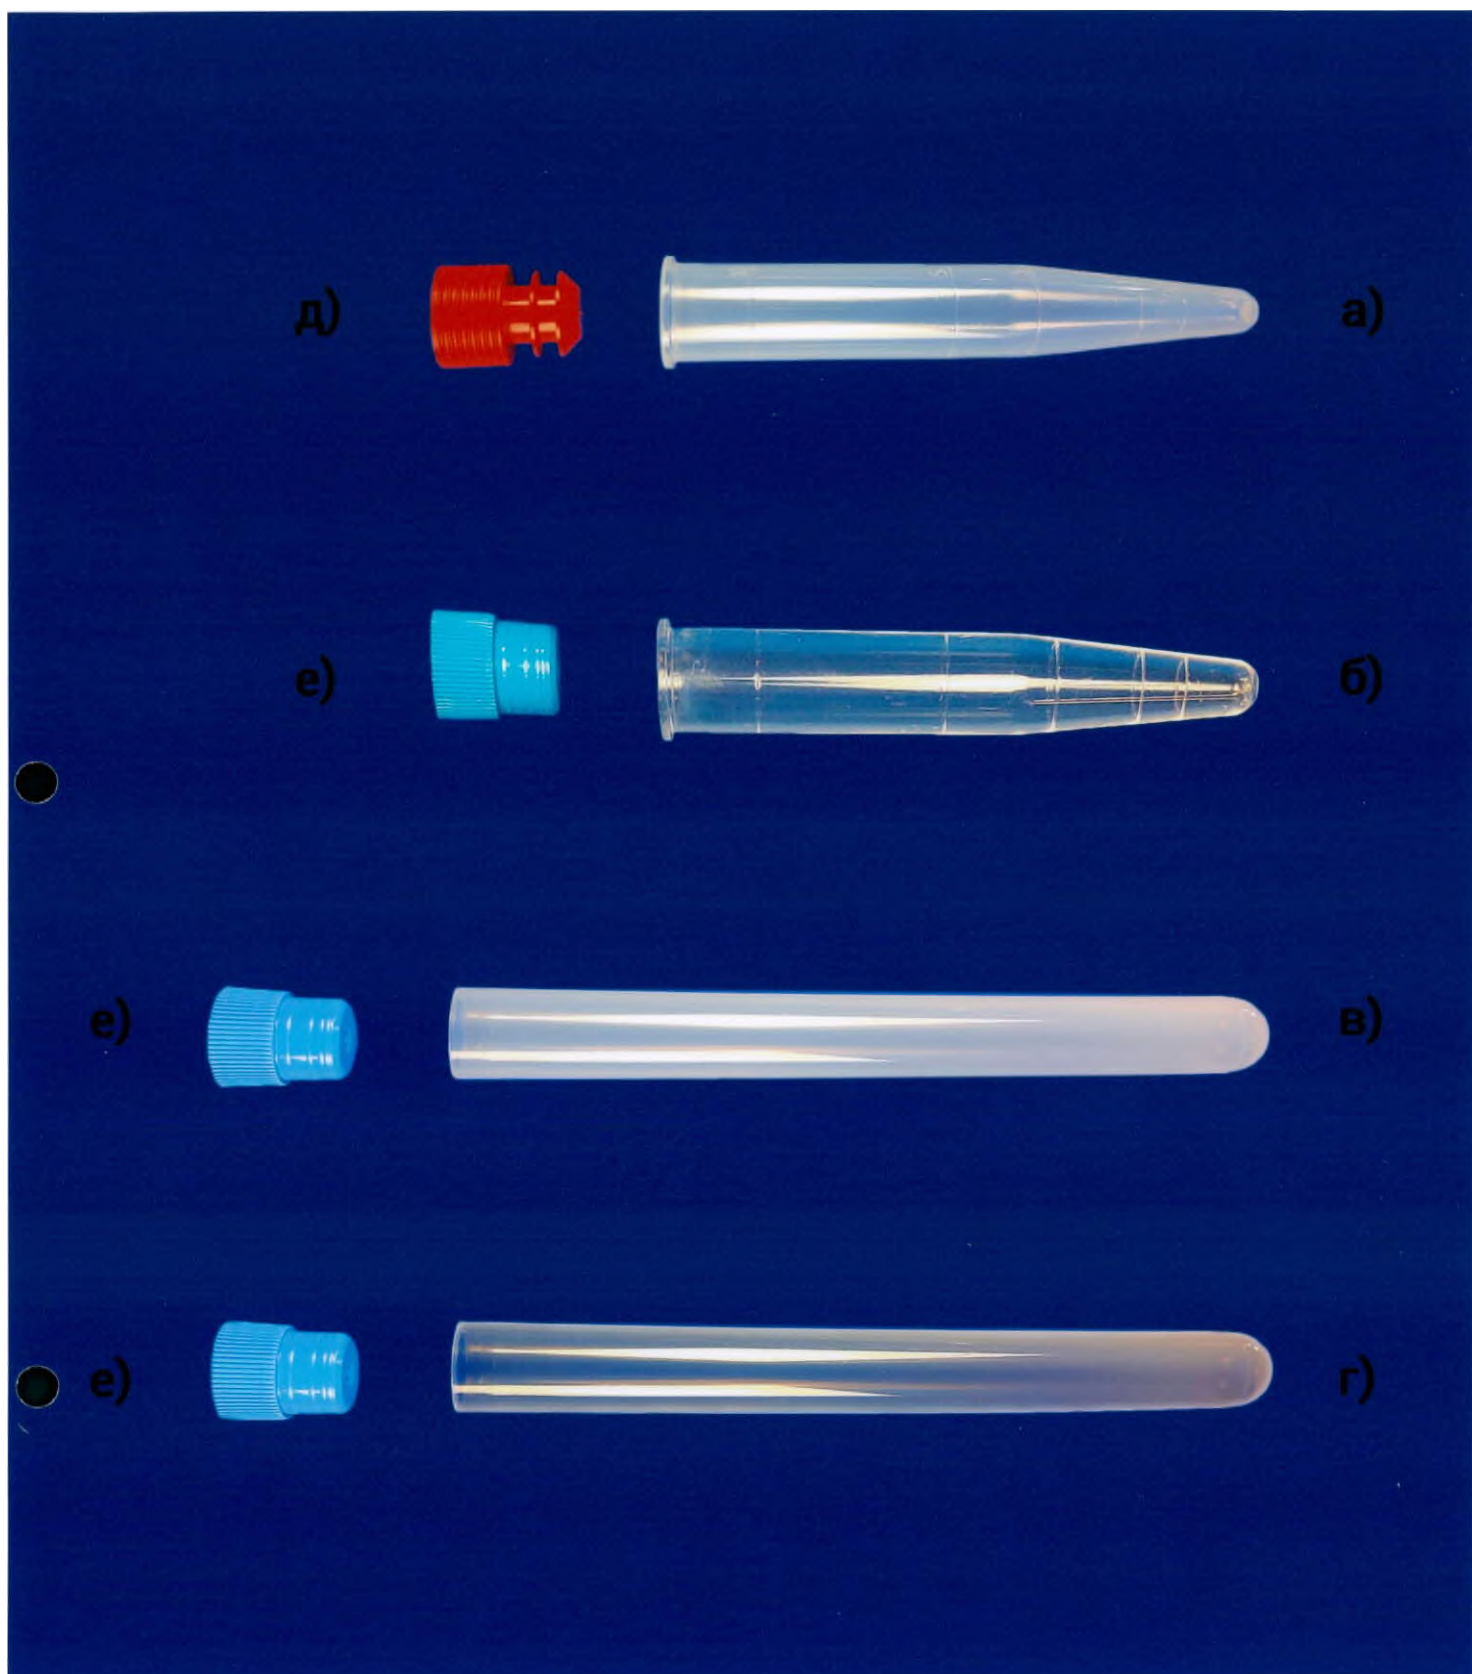

**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

- а) Пробирка коническая ПЗ-16-100-ПП**
- б) Пробирка коническая ПЗ-16-100-ПС**
- в) Пробирка круглодонная П2-16-150-ПП**
- г) Пробирка круглодонная П2-16-150-ПС**
- д) Пробка 16 с крыльями**
- е) Пробка 16 без крыльев**



**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

а) Пробирка остродонная П1-16-100-ПП

б) Пробирка коническая ПЗ-16-110-ПП


в) Крышка 16/1

г) Пробирка коническая ПЗ-17-120-ПП

д) Крышка 17

е) Пробирка остродонная П1-18-118-ПП

ж) Крышка 18

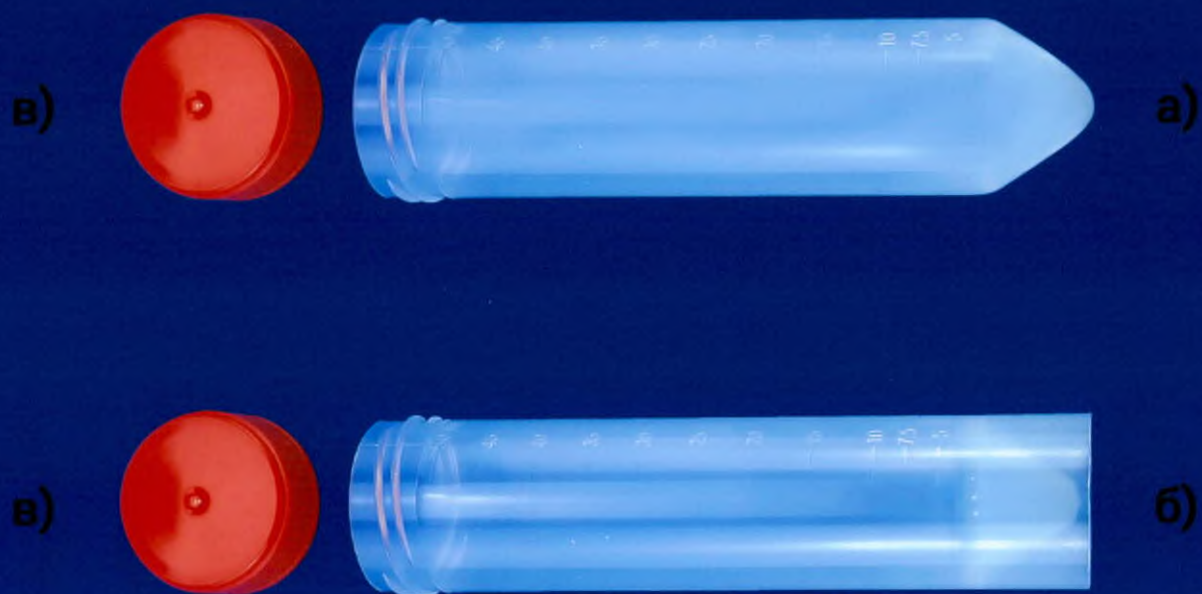


Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.

а) Пробирка остродонная П1-30-115-ПП

б) Пробирка остродонная с юбкой устойчивости П1Ю-30-115-ПП

в) Крышка 30

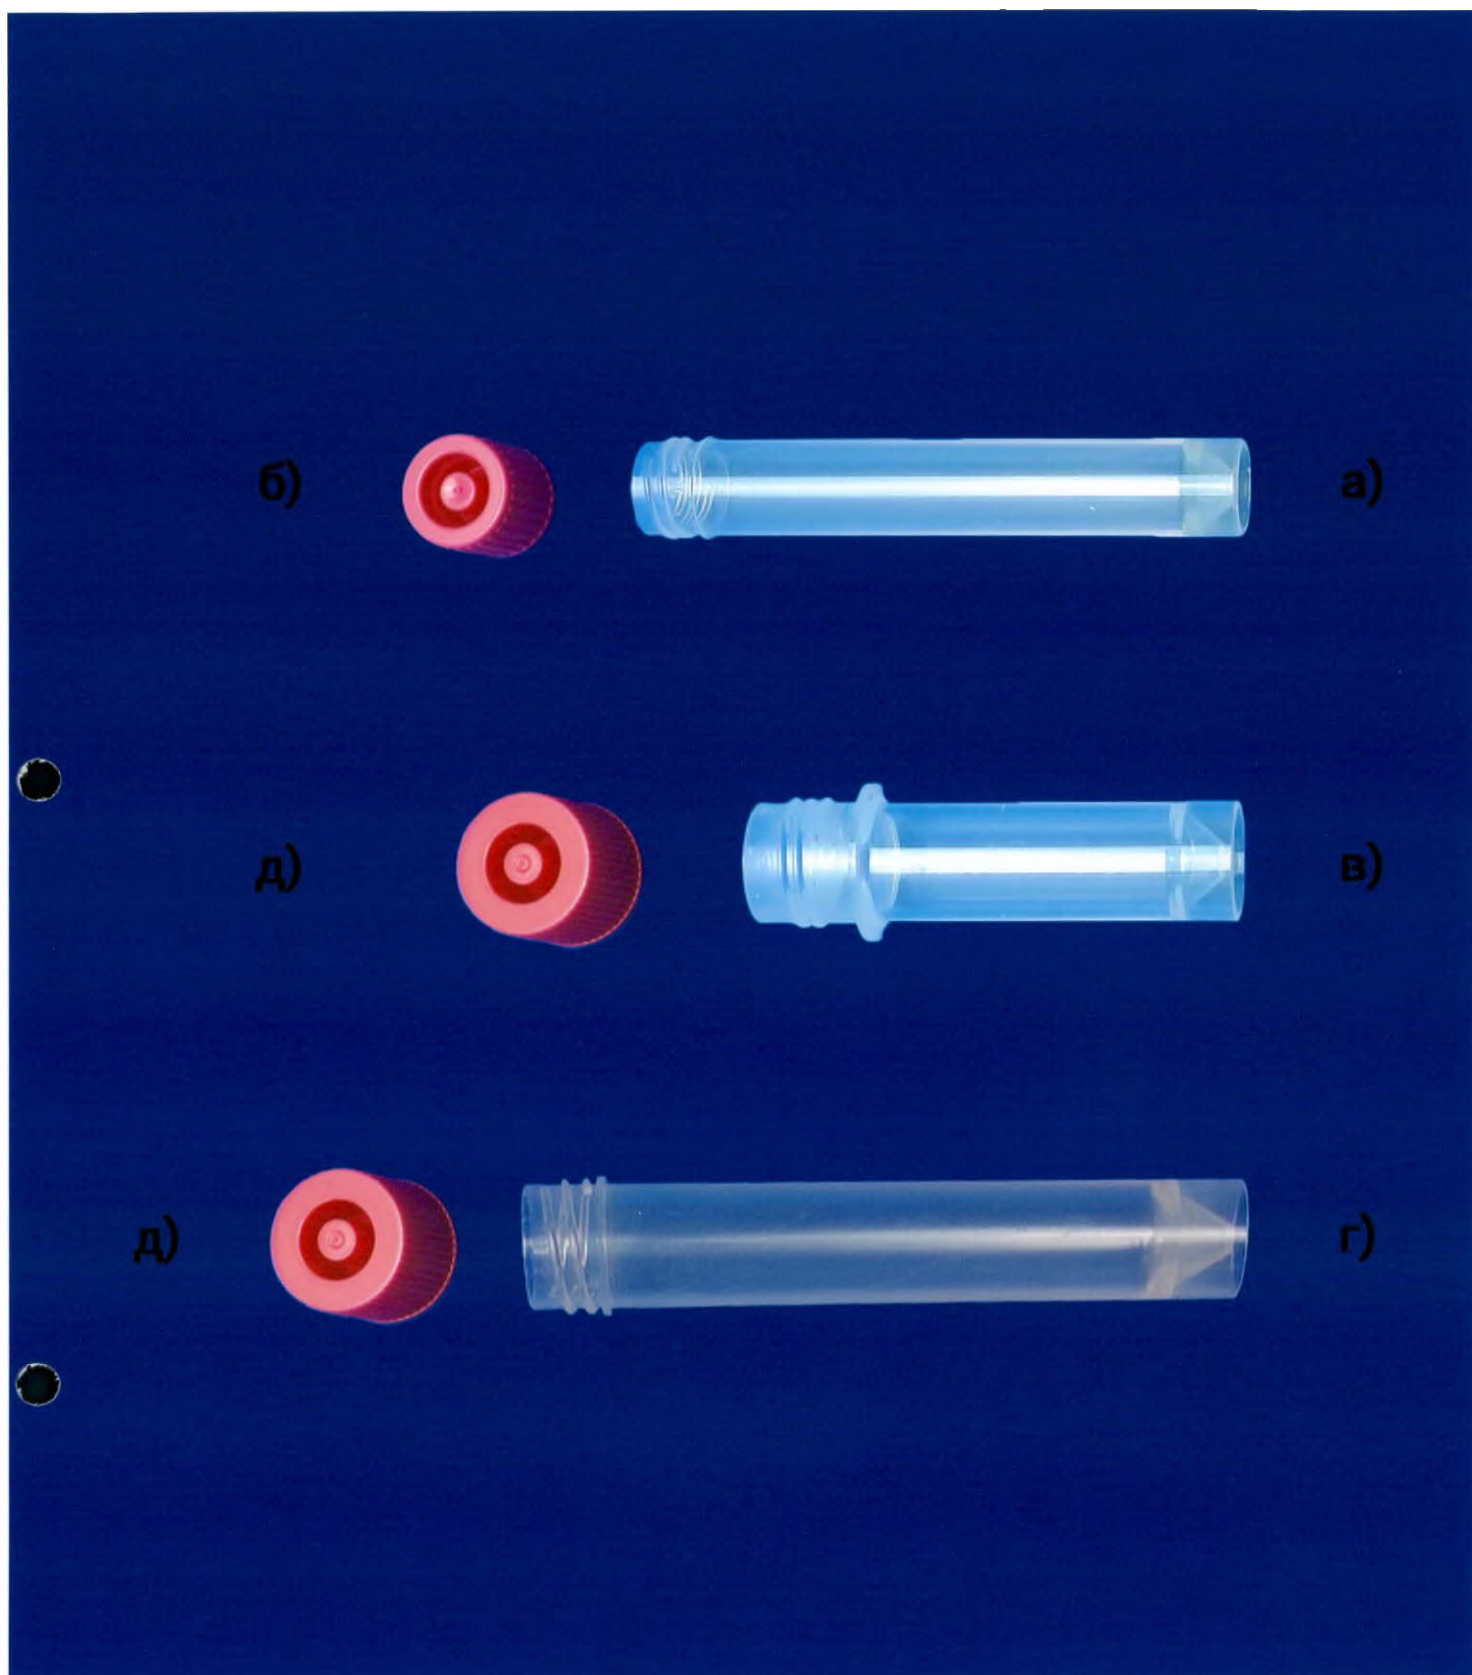

Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.


а) Пробирка остродонная с юбкой устойчивости П1Ю-13-82-ПП

б) Крышка 13

в) Пробирка остродонная с юбкой устойчивости П1Ю-16-60-ПП


г) Пробирка остродонная с юбкой устойчивости П1Ю-16-100-ПП

д) Крышка 16/2

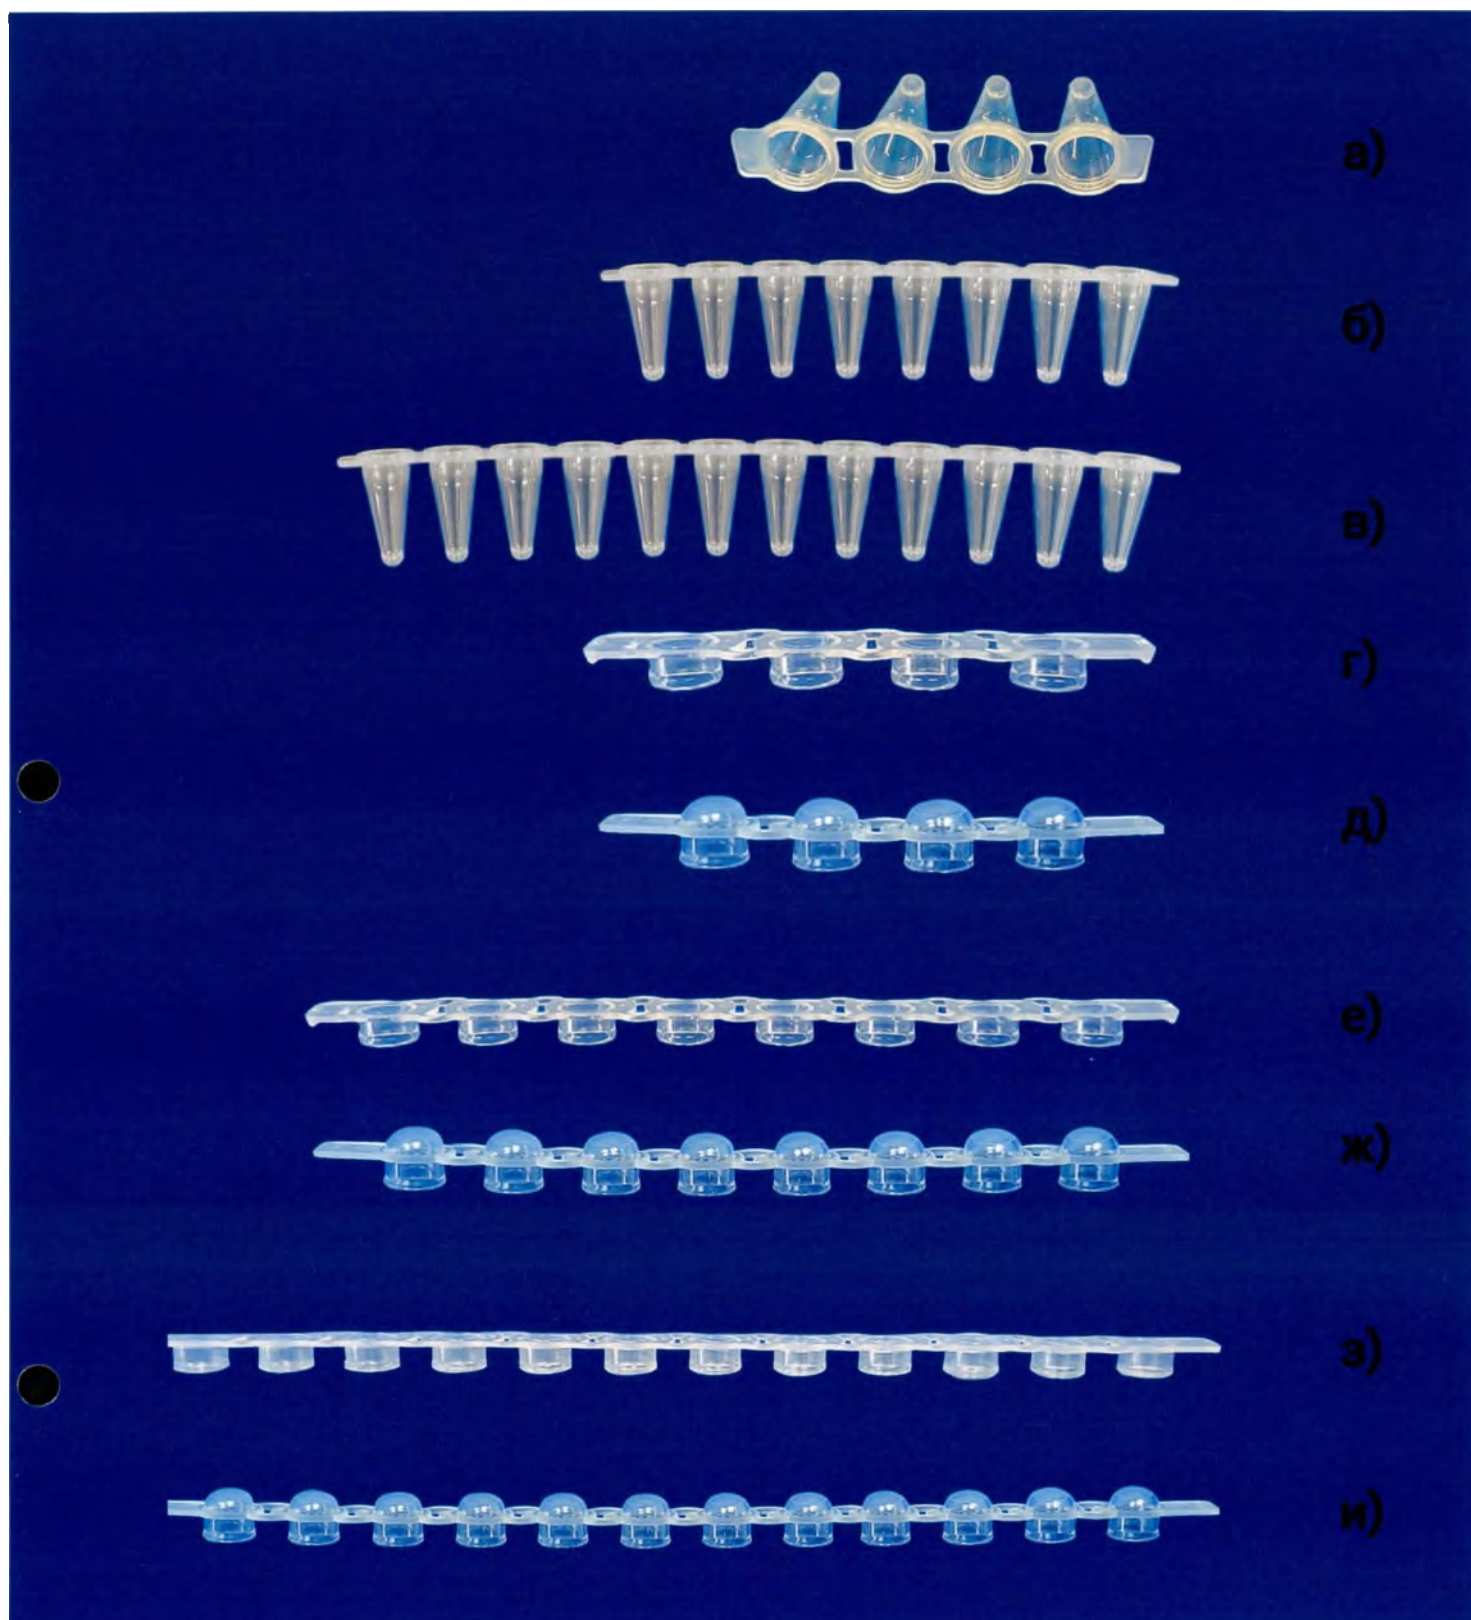


**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

- а) Микропробирка коническая ПМЗ-7-16-ПП в стрипе по 4 штуки**
- б) Микропробирка коническая ПМЗ-7-16-ПП в стрипе по 8 штук**
- в) Микропробирка коническая ПМЗ-7-16-ПП в стрипе по 12 штук**
- г) Пробка 7 плоская в стрипе по 4 штуки**
- д) Пробка 7 выпуклая в стрипе по 4 штуки**
- е) Пробка 7 плоская в стрипе по 8 штук**
- ж) Пробка 7 выпуклая в стрипе по 8 штук**
- з) Пробка 7 плоская в стрипе по 12 штук**
- и) Пробка 7 выпуклая в стрипе по 12 штук**

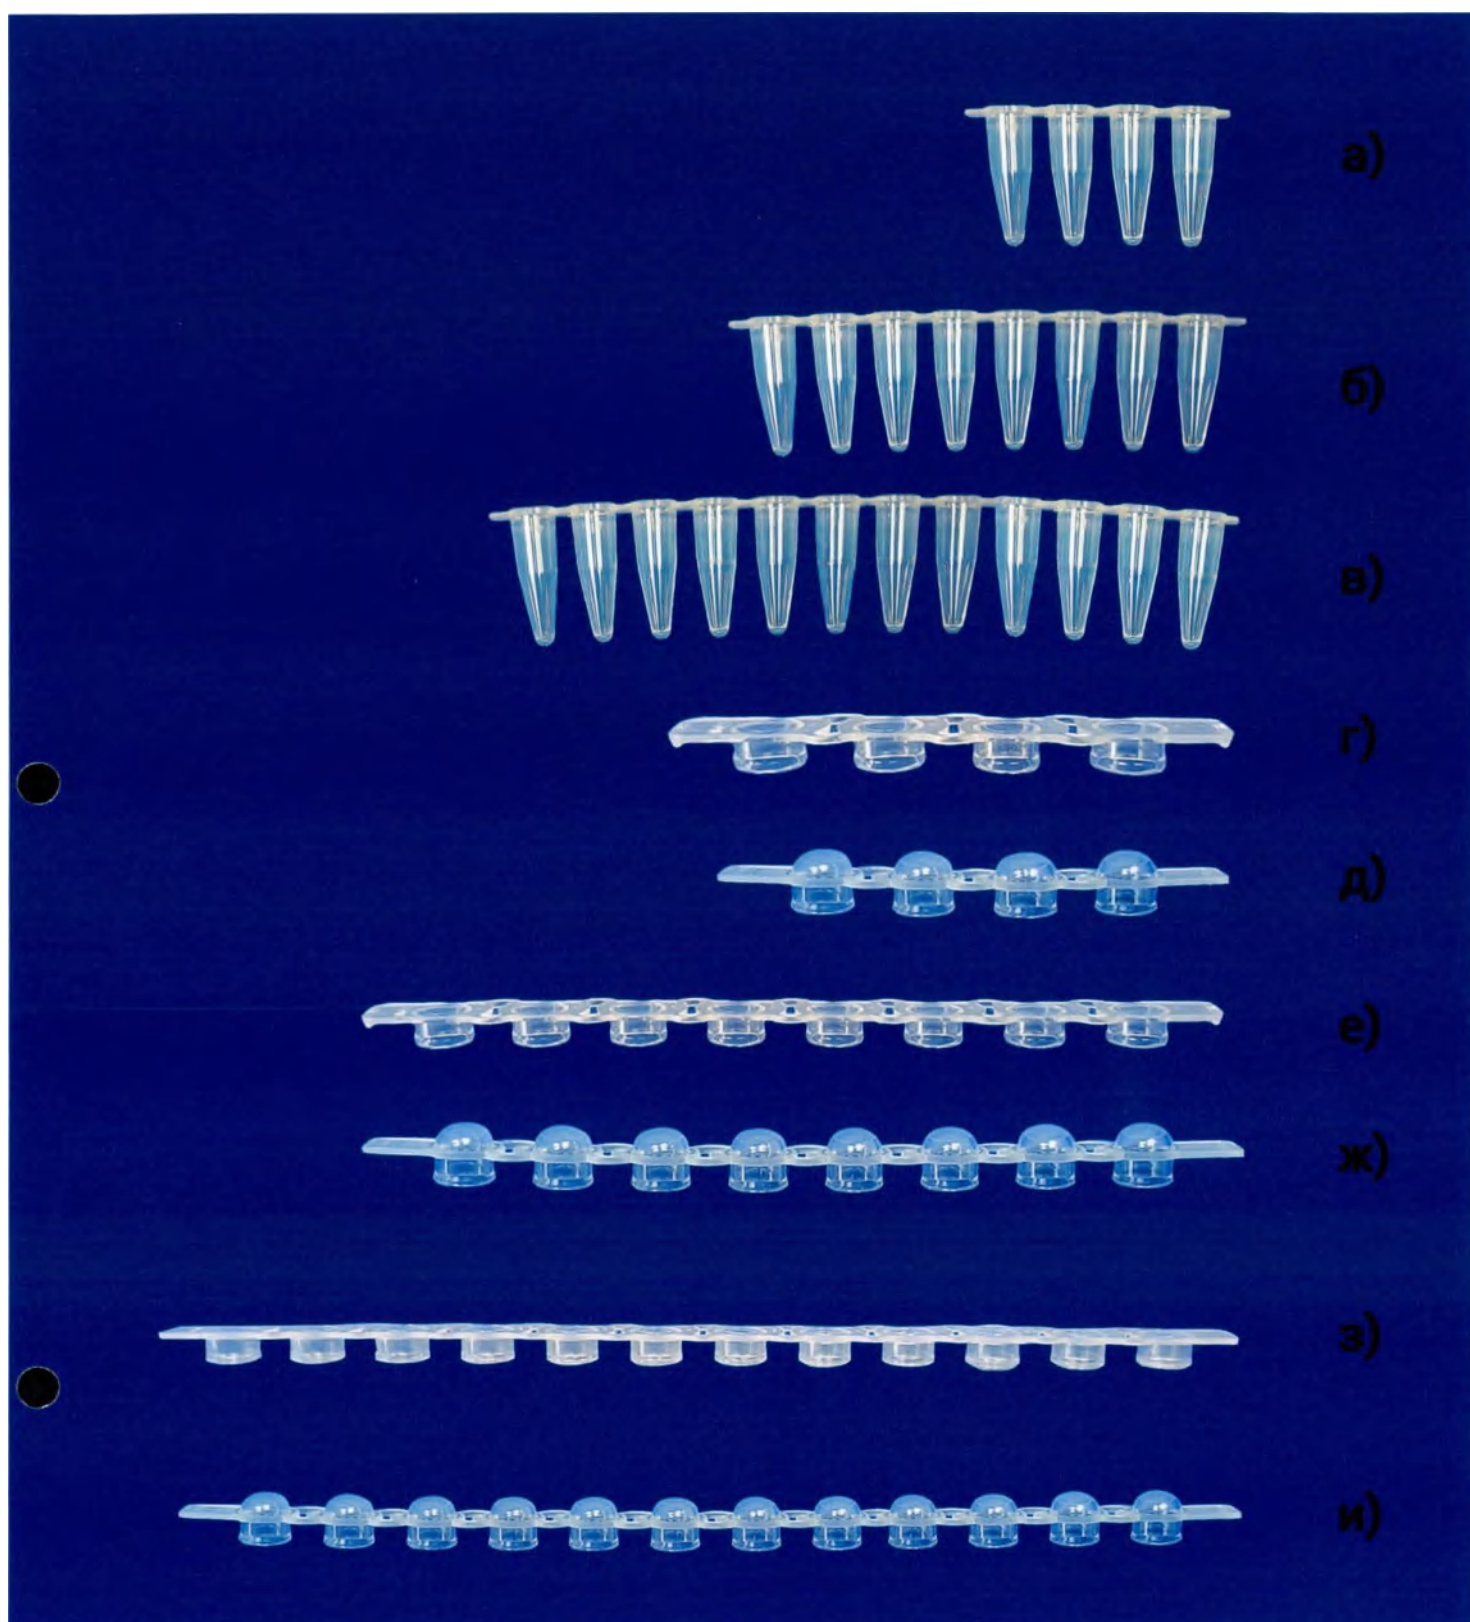

**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

- а) Микропробирка коническая ПМЗ-7-21-ПП в стрипе по 4 штуки**
- б) Микропробирка коническая ПМЗ-7-21-ПП в стрипе по 8 штук**
- в) Микропробирка коническая ПМЗ-7-21-ПП в стрипе по 12 штук**
- г) Пробка 7 плоская в стрипе по 4 штуки**
- д) Пробка 7 выпуклая в стрипе по 4 штуки**
- е) Пробка 7 плоская в стрипе по 8 штук**
- ж) Пробка 7 выпуклая в стрипе по 8 штук**
- з) Пробка 7 плоская в стрипе по 12 штук**
- и) Пробка 7 выпуклая в стрипе по 12 штук**

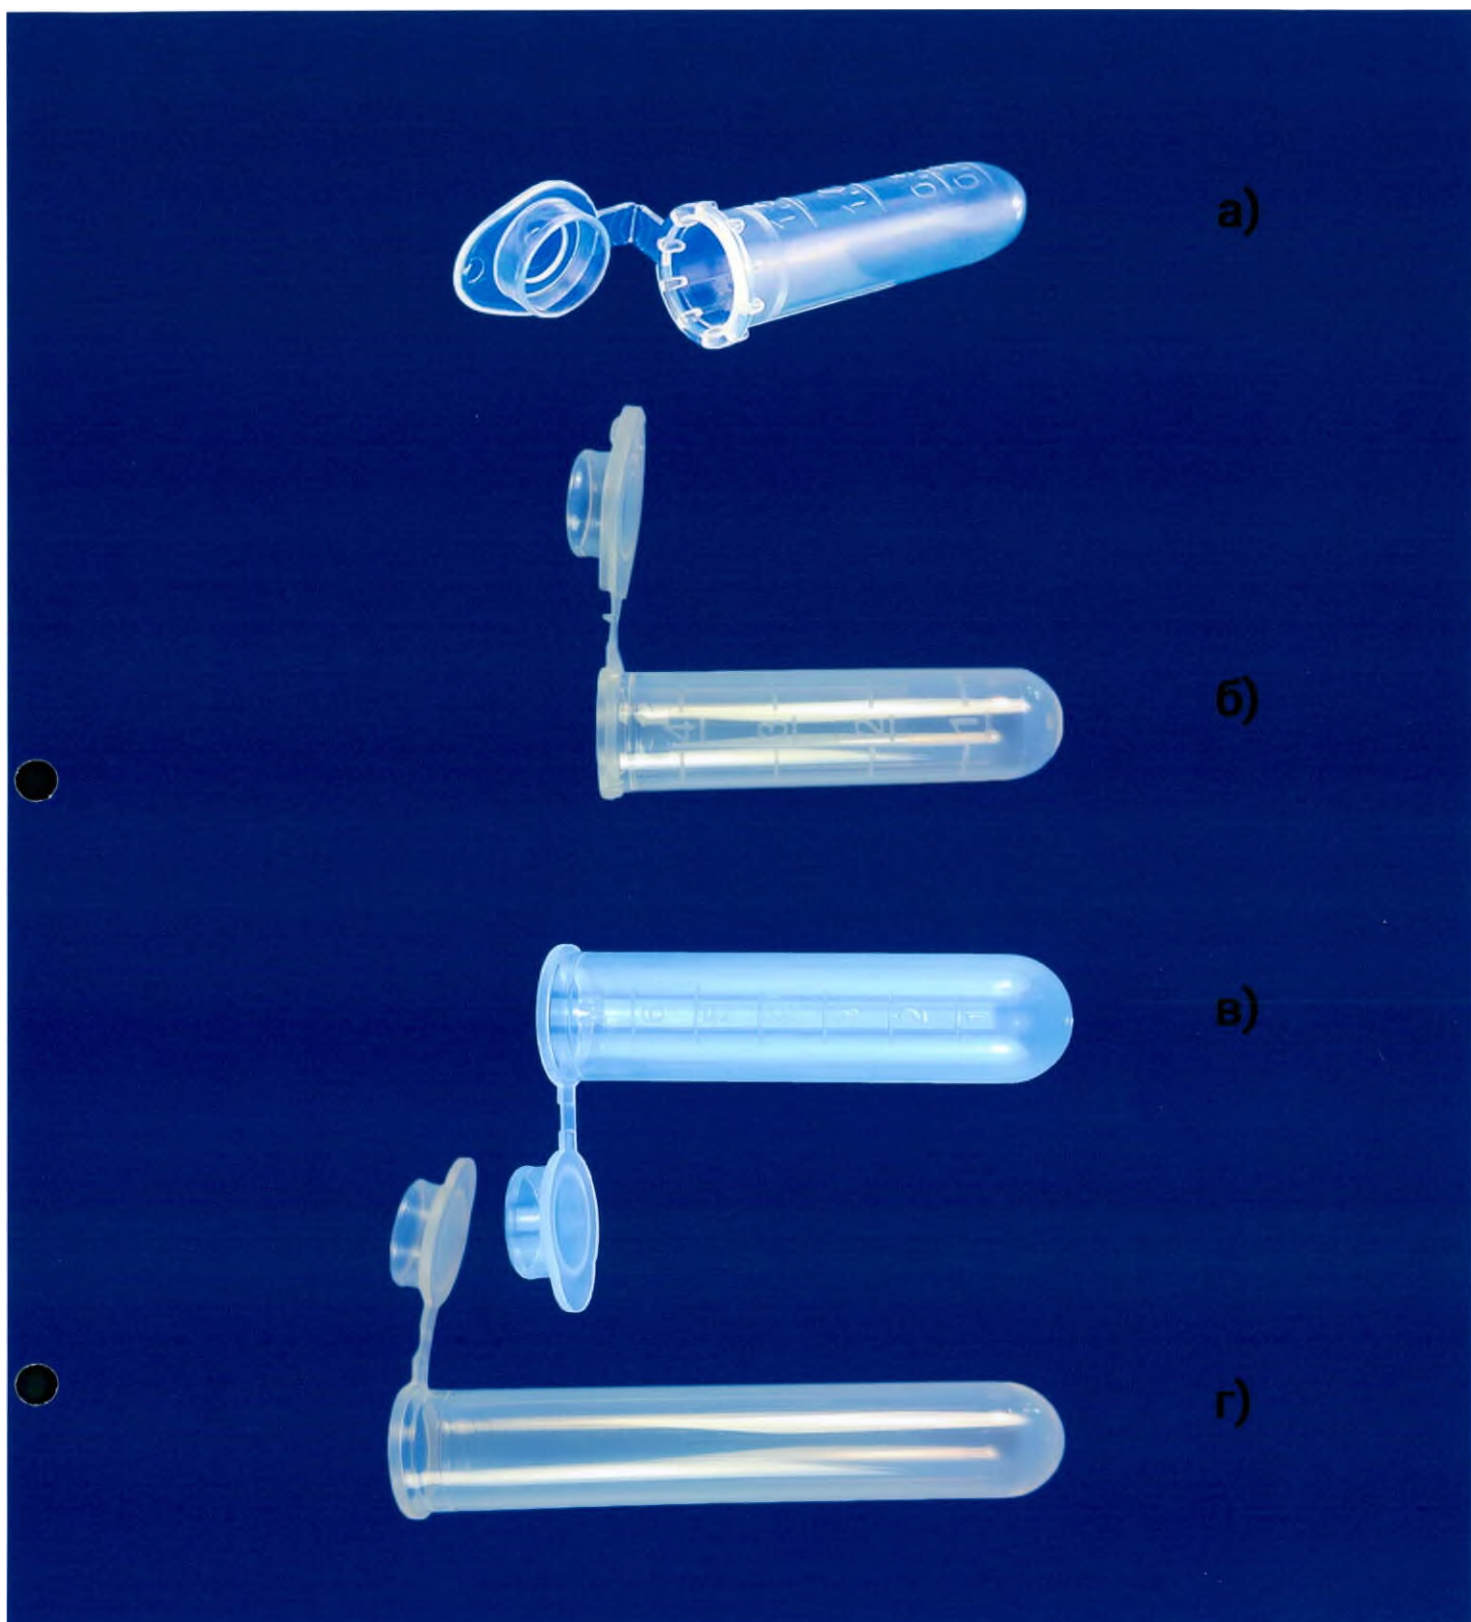


Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.

а) Микропробирка круглодонная ПМ2К-13-40-ПП

б) Микропробирка круглодонная ПМ2К-14-50-ПП

в) Пробирка круглодонная П2К-15-62-ПП

г) Пробирка круглодонная П2К-16-80-ПП

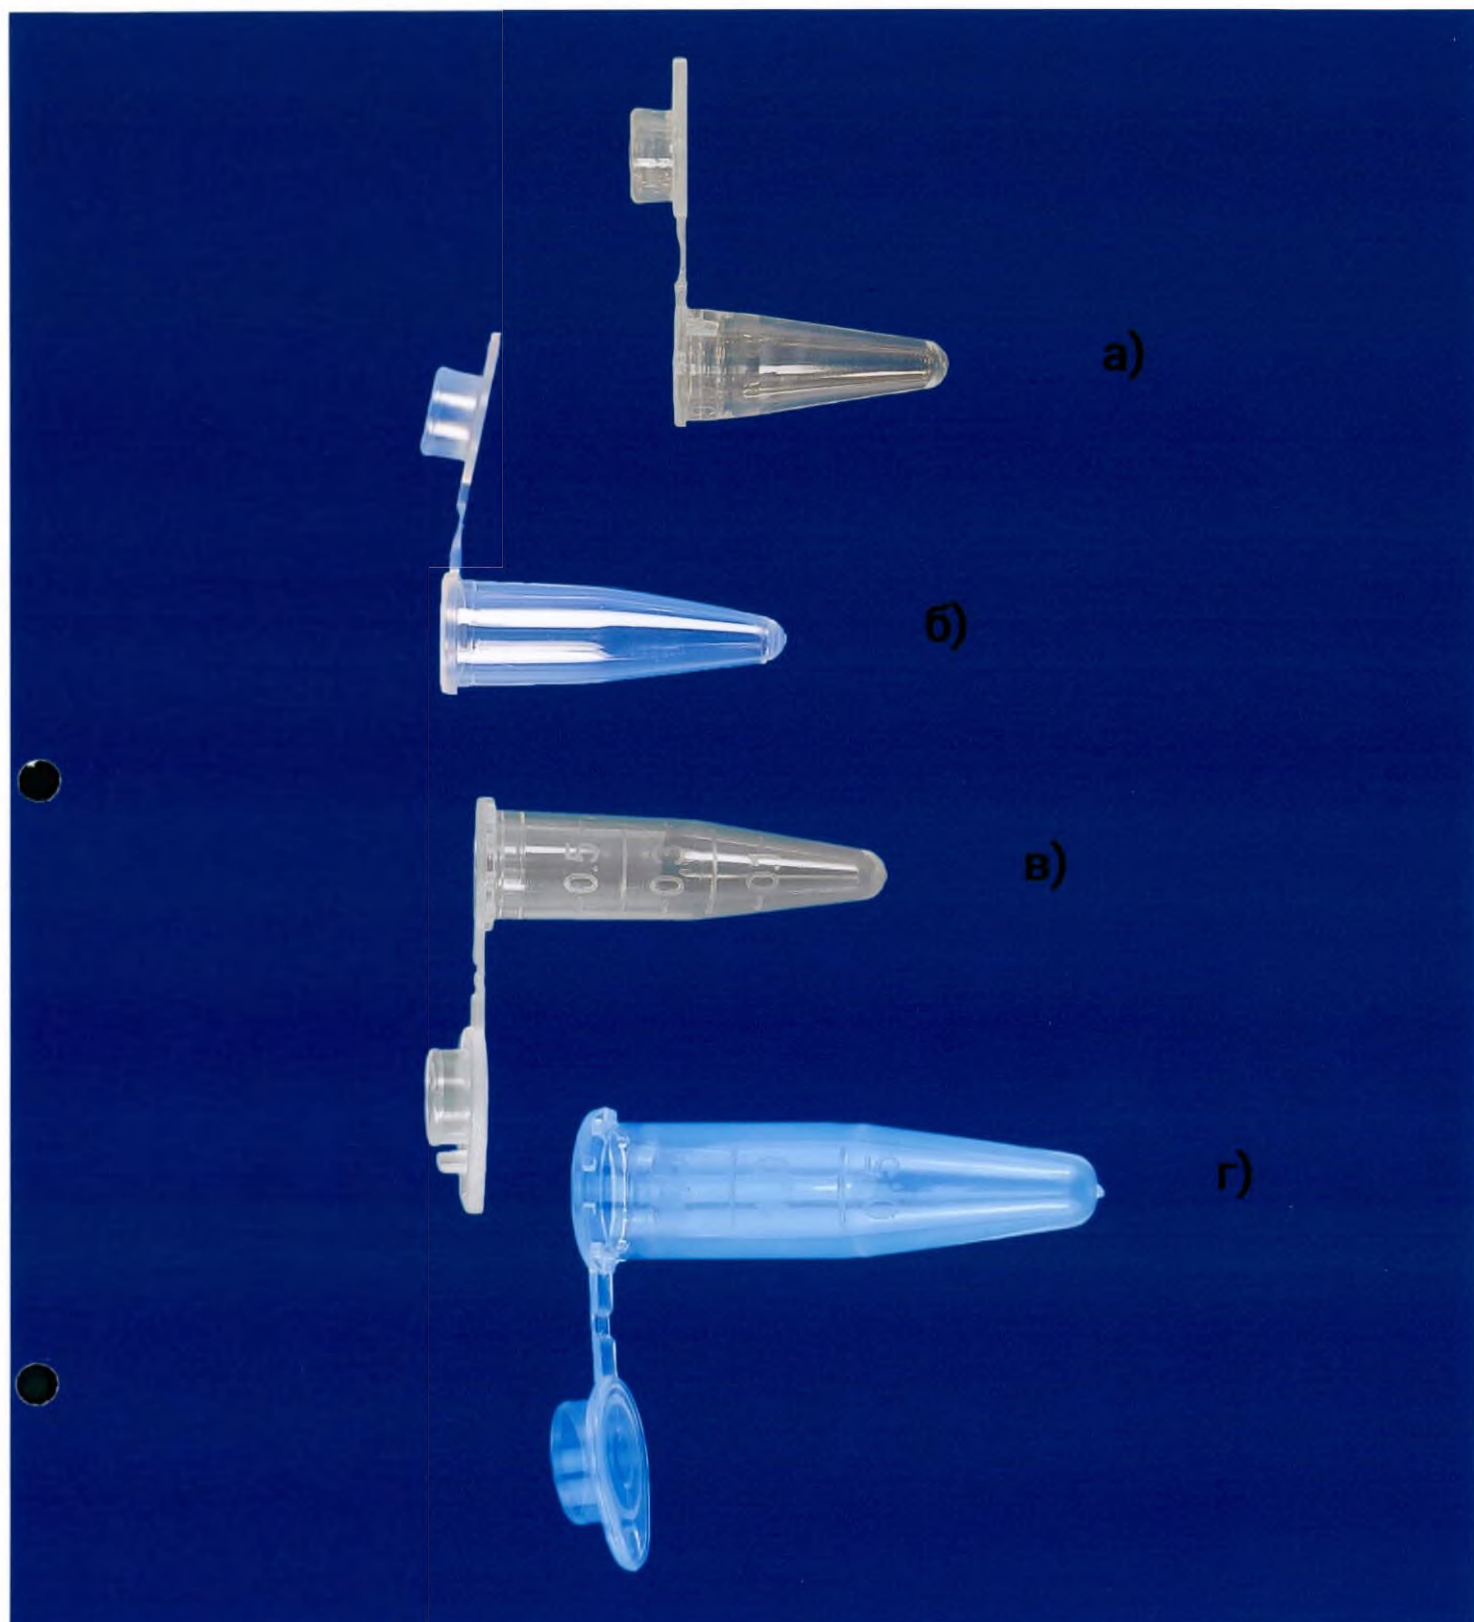

Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.

- а) Микропробирка коническая ПМЗК-7-16-ПП
- б) Микропробирка коническая ПМЗК-7-21-ПП
- в) Микропробирка коническая ПМЗК-8-30-ПП
- г) Микропробирка коническая ПМЗК-13-40-ПП



а)



б)



в)

Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.


а) Микропробирка коническая ПМЗК-7-16-ПП в стрипе по 4 штуки

б) Микропробирка коническая ПМЗК-7-16-ПП в стрипе по 8 штук


в) Микропробирка коническая ПМЗК-7-16-ПП в стрипе по 12 штук



а)

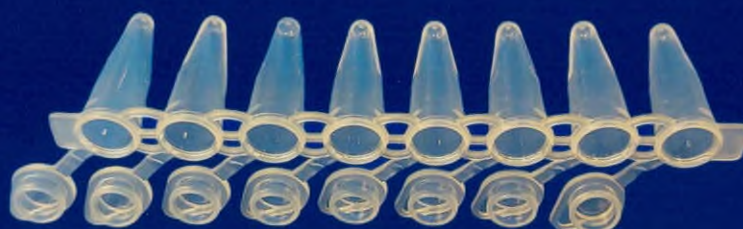

б)

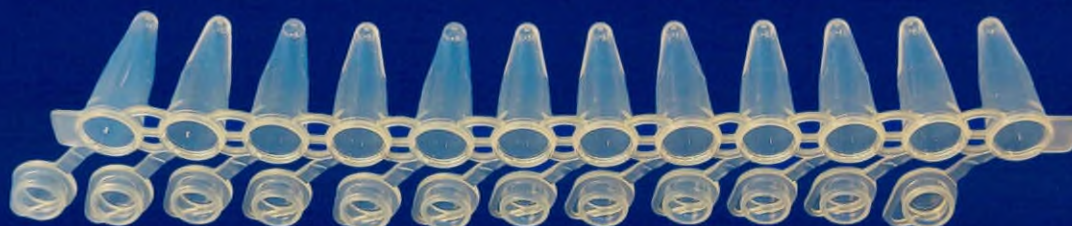

в)

**Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.**

а) Микропробирка коническая ПМЗК-7-21-ПП в стрипе по 4 штуки

б) Микропробирка коническая ПМЗК-7-21-ПП в стрипе по 8 штук

в) Микропробирка коническая ПМЗК-7-21-ПП в стрипе по 12 штук



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "ПЕРИНТ"
150000, Россия, Томская область,
г. Томск, ул. 9-я Интернациональная, 1
Домашний: +7 (3822) 441 000, факс:
Служба клиентов: ТУ 32.50.50-021
441 151-14

ПЕРИНТ
Пробирка полимерная
нестерильная для диагностики
in vitro

Микропробирка круглодонная ПМ2К-13-40-ПП

Barcode: 330606026832400000186423001008

LOT: 04
Сменная Пет 3
№ 12

Дата изг./mf date: 18.04.2023
Кон-во/Qty: 500 шт/psc

30°C
2
IVD
ОТК
www.perint.ru
НЕТОКСИЧНО

Инструкция по применению полимерных пробирок
ПРОБИРКА ПОЛИМЕРНАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ in vitro
по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022
ИП 32.50.50-021-54287340-2022

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "ПЕРИНТ"
М.А. Мамонтов
2023 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ, МЕДИЦИНСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022
Предназначена для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.

2 НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Пробирка предназначена для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.
Пробирка предназначена для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.
Пробирка предназначена для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.

3 ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
3.1. Показания к применению: полимерные пробирки предназначены для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.
3.2. Противопоказания к применению: полимерные пробирки не предназначены для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.

4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Область применения: полимерные пробирки предназначены для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.
Потенциальный потенциал: полимерные пробирки предназначены для проведения лабораторных исследований в соответствии с Приложением 2.

5 ТИП НАДЛЕЖАЩЕГО ОБЪЕМА
5.1. Тип: полимерная пробирка.
5.2. Объем: 0,5 мл.

6.2. Инструкция по применению
6.2.1. Подготовка пробирки к использованию.
6.2.2. Подготовка пробирки к использованию.

Пробирка полимерная нестерильная для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50-021-54287340-2022.
а) Микропробирка круглодонная ПМ2К-13-40-ПП (в групповой упаковке)
б) Инструкция по применению ИП 32.50.50-021-54287340-2022

8

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью АО «ПЕРИНТ» 18 л.
(всего на дуче)

Генеральный директор АО «ПЕРИНТ»

М.Я. Моносов

