

Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
свободный ПСА», по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA свободный ПСА», по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1180101

На коробку:




Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения.

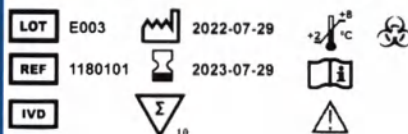

ТУ 21 20 23-622-98539446-2022
Р/У № XXXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
+7(812)6778779; 6772162
albio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 1
объем 1,0 мл
+2,8°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 2
объем 0,5 мл
+2,8°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 3
объем 0,5 мл
+2,8°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 4
объем 1,0 мл
+2,8°C
ООО «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA свободный ПСА», по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 1180105

На коробку:

Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА

LOT E003
1180105

2023-07-28

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковское шоссе, д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)878/78, 8772/62
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-622-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT E003

REF 1180105

IVD

2022-07-29

2023-07-29

50

+2⁺8
°C

i


!



Готово к использованию.
Для профессионального применения.

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 1
объем 1,0 мл




- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 2
объем 0,5 мл





- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 3
объем 0,5 мл



- 5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
свободный ПСА
Калибратор 4
объем 1,0 мл



- 5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) лист 9

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
свободный ПСА», по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Калибраторы 1,2,3,4	стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Кат. № 1180101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

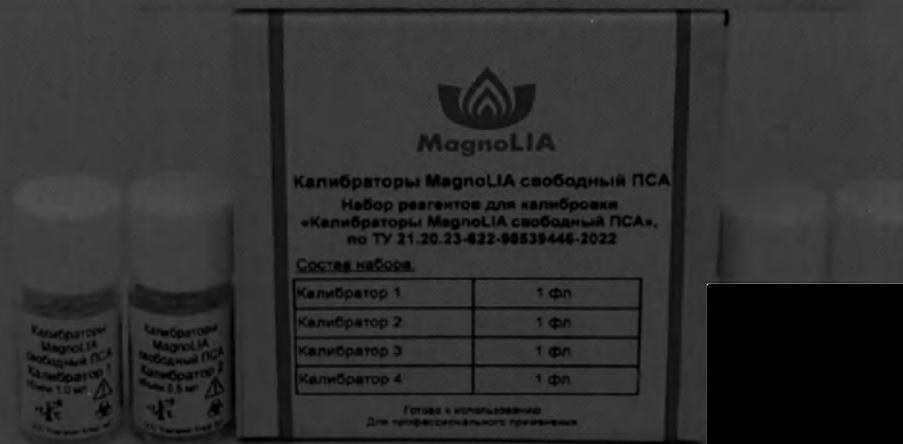

Состав набора.

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA свободный ПСА», по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Кат. № 1180101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

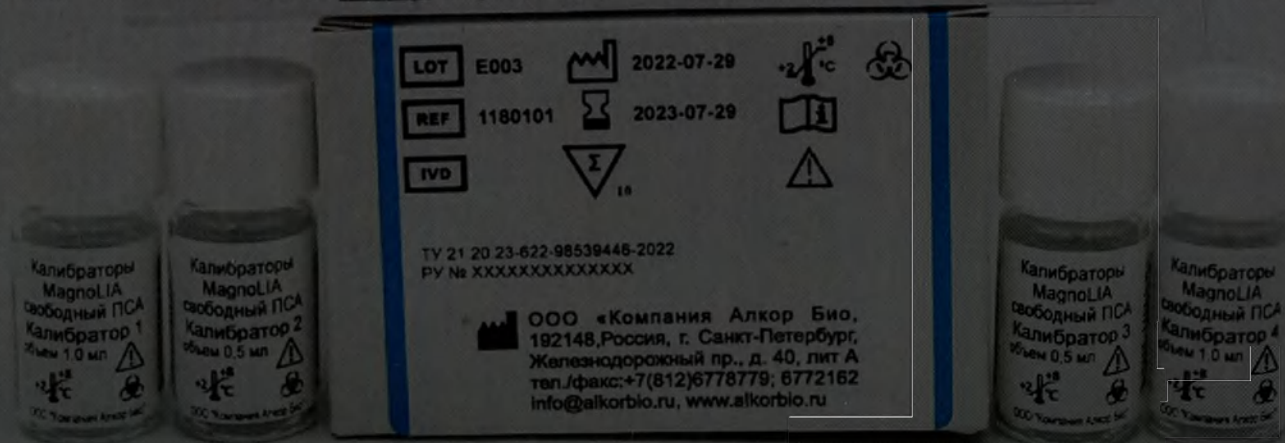


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Кат. № 1180101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

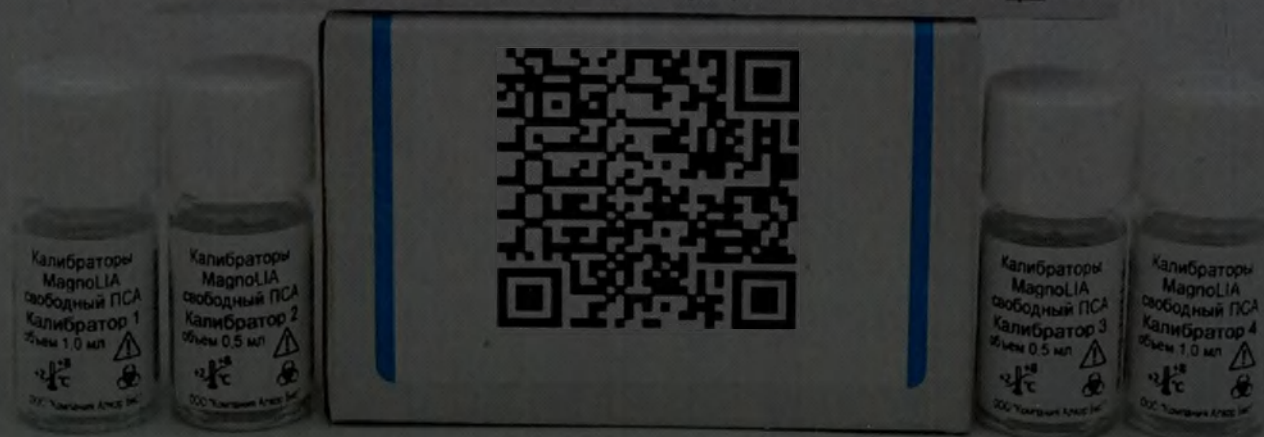

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Кат. № 1180105 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Состав набора

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

ТУ 21.20.23-622-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT E003

REF 1180105

PVD

2022-07-29

2023-07-29

80



Готово к использованию
Для идентификации применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки «Калибраторы
MagnoLIA свободный ПСА», по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА»,
по ТУ 21.20.23-622-98539446-2022

Кат. № 1180105 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы MagnoLIA свободный ПСА

LOT E003


2023-07-29


REP 1180106


+2




ООО «Компания Алкор Био»,
182148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru

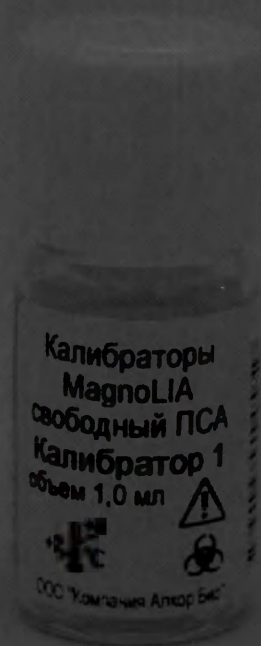

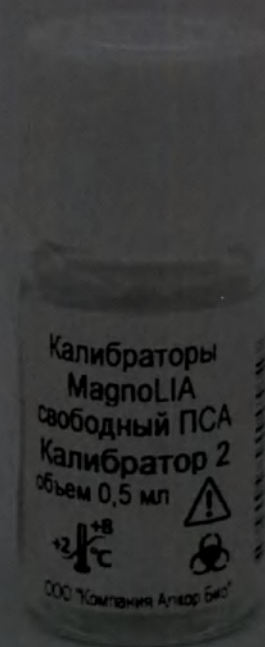

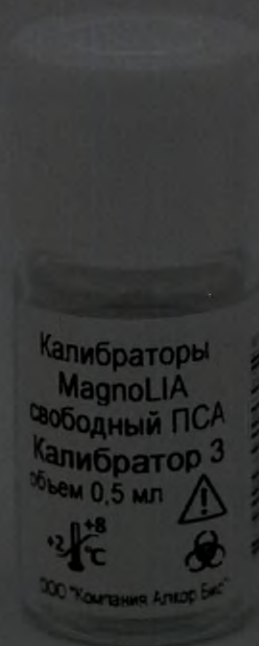

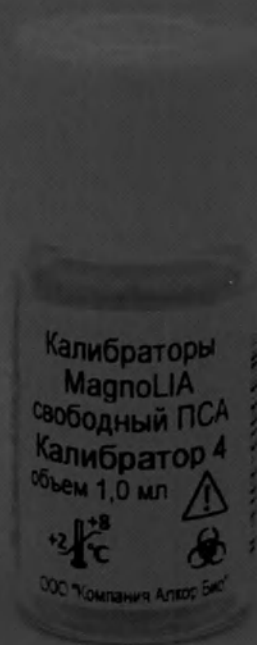

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

1 (оригинал) лист 80

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

