

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева

2023 г.



Фотографические изображения

«Вкладыш керамический эндопротеза тазобедренного сустава G7»

Производства:

«Biomet UK Limited», Соединенное Королевство (Биомет Ю-Кей Лимитед), Waterton Industrial Estate, Bridgend, CF31 3XA, United Kingdom

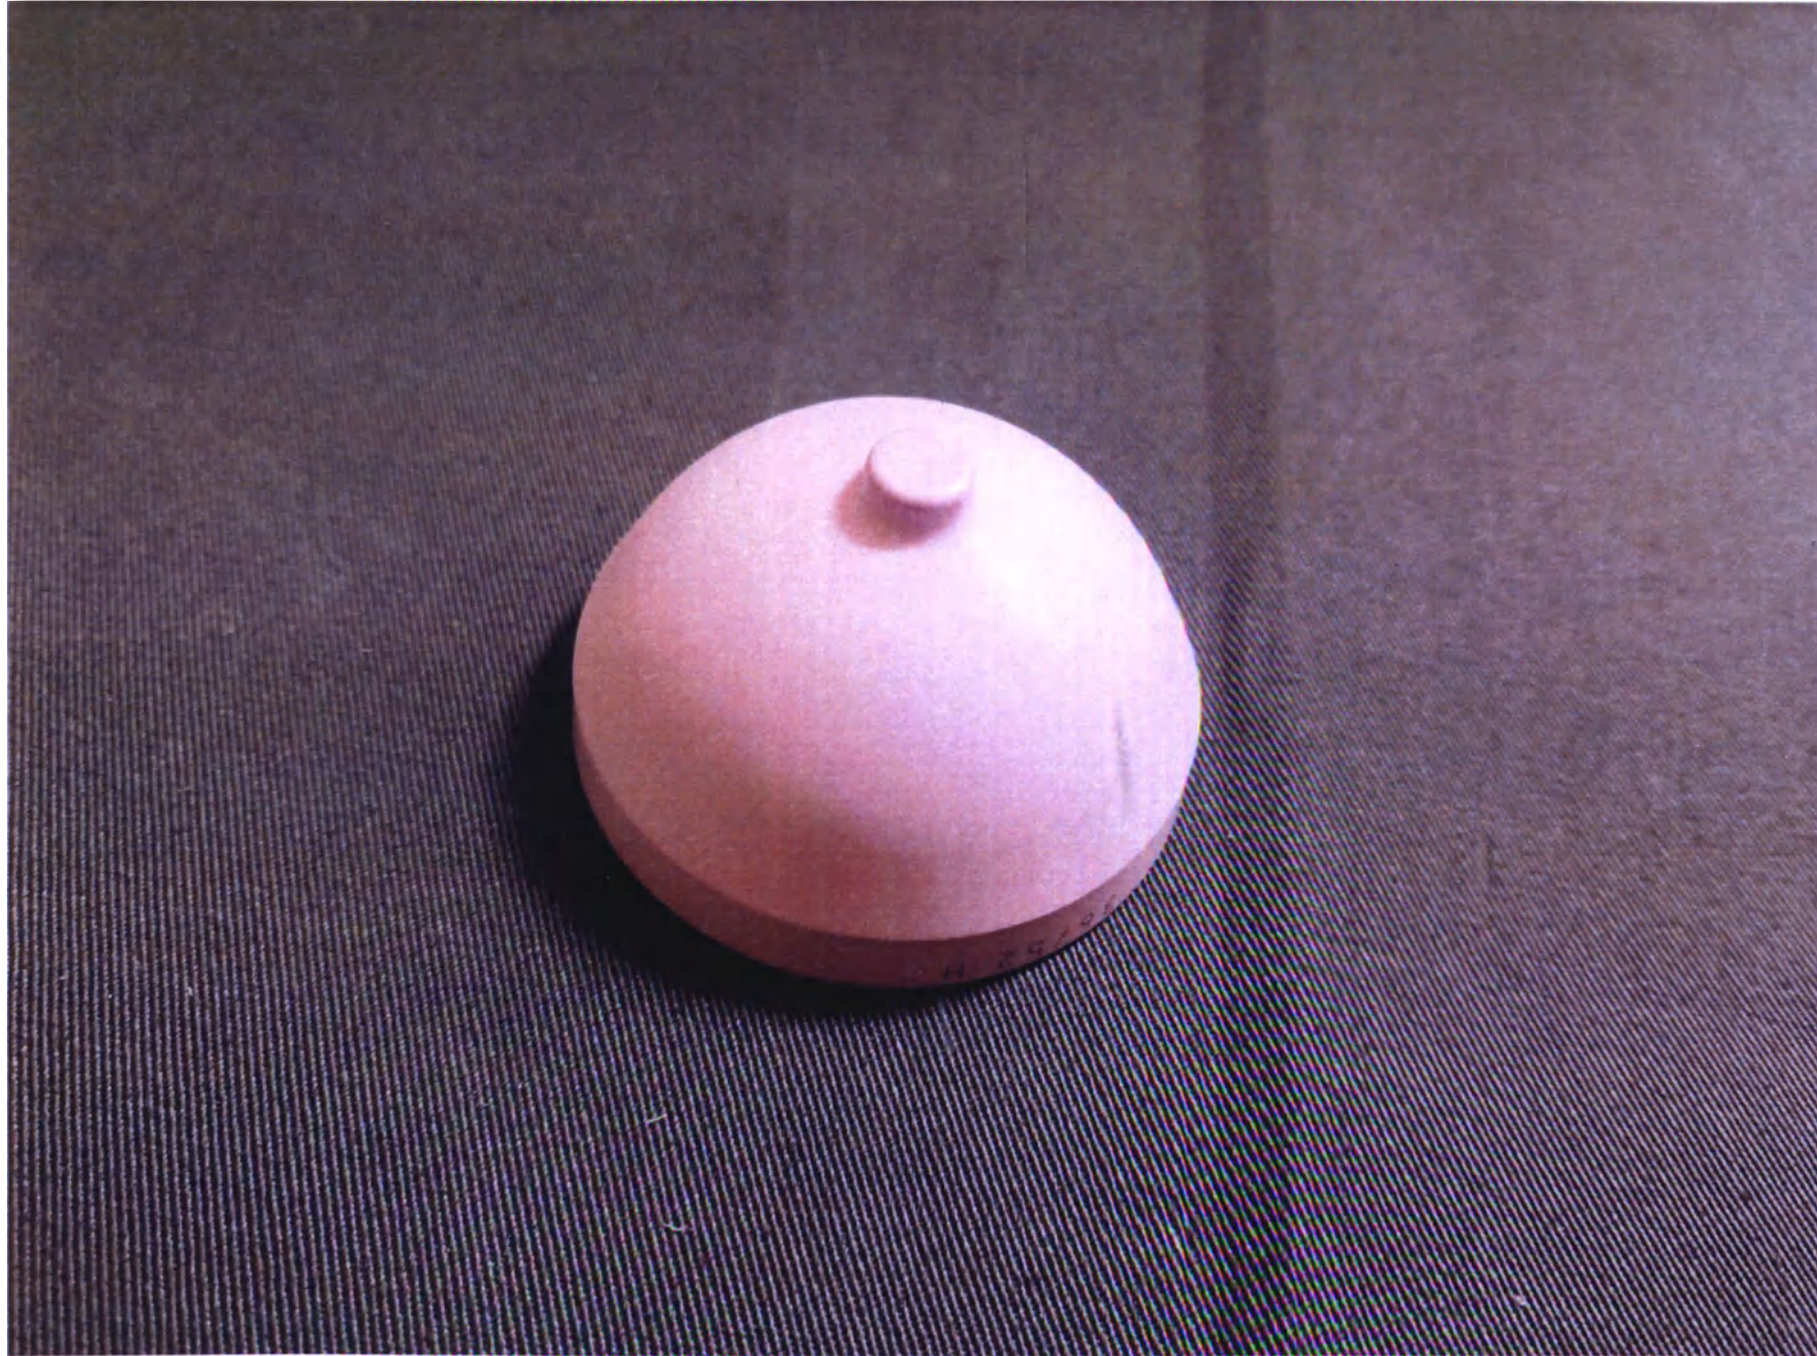


Рис. 1. Вкладыш керамический G7, размер: 36 мм. Н., вид сверху.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш керамический G7, размеры: 28 мм В, 32 мм С, 32 мм D, 32 мм Е, 32 мм F, 32 мм G, 32 мм H, 32 мм I, 36 мм Е, 36 мм F, 36 мм G, 36 мм I, 40 мм G, 40 мм H, 40 мм I.



Рис. 2. Вкладыш керамический G7, размер: 36 мм. Н., вид сбоку.
Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Вкладыш керамический G7, размеры: 28 мм В, 32 мм С, 32 мм D, 32 мм Е, 32 мм F, 32 мм G, 32 мм Н, 32 мм I, 36 мм Е, 36 мм F, 36 мм G, 36 мм I, 40 мм G, 40 мм Н, 40 мм I.



HDPE
D 011600637

CONTENTS **STERILE** IF PACKAGE
NOT OPENED OR DAMAGED.

CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.)
RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE
BY OR ON THE ORDER OF A
PHYSICIAN.

NOTE: SEE PACKAGE INSERT
FOR PRODUCT DESCRIPTION AND
INFORMATION FOR USE.

BIOMET REF 110003631

LOT 3030816

G7® Acetabular Liner

Neutral

Ceramic

Use G7 Compatible Shell And
Ceramic Head

Use-by: YYYY-MM-DD
2030-04-21

CERAMIC



(01) 0 0887868 27111 3 (17) 300421 (10) 3030816

CE
2797



36mm Head Size
H
Liner Size

Biomet UK Ltd.
Waterton Industrial Estate
Bridgend, South Wales
CF31 3XA, United Kingdom



zimmer

PEEL

Рис. 3. Пример маркировки стерильной упаковки

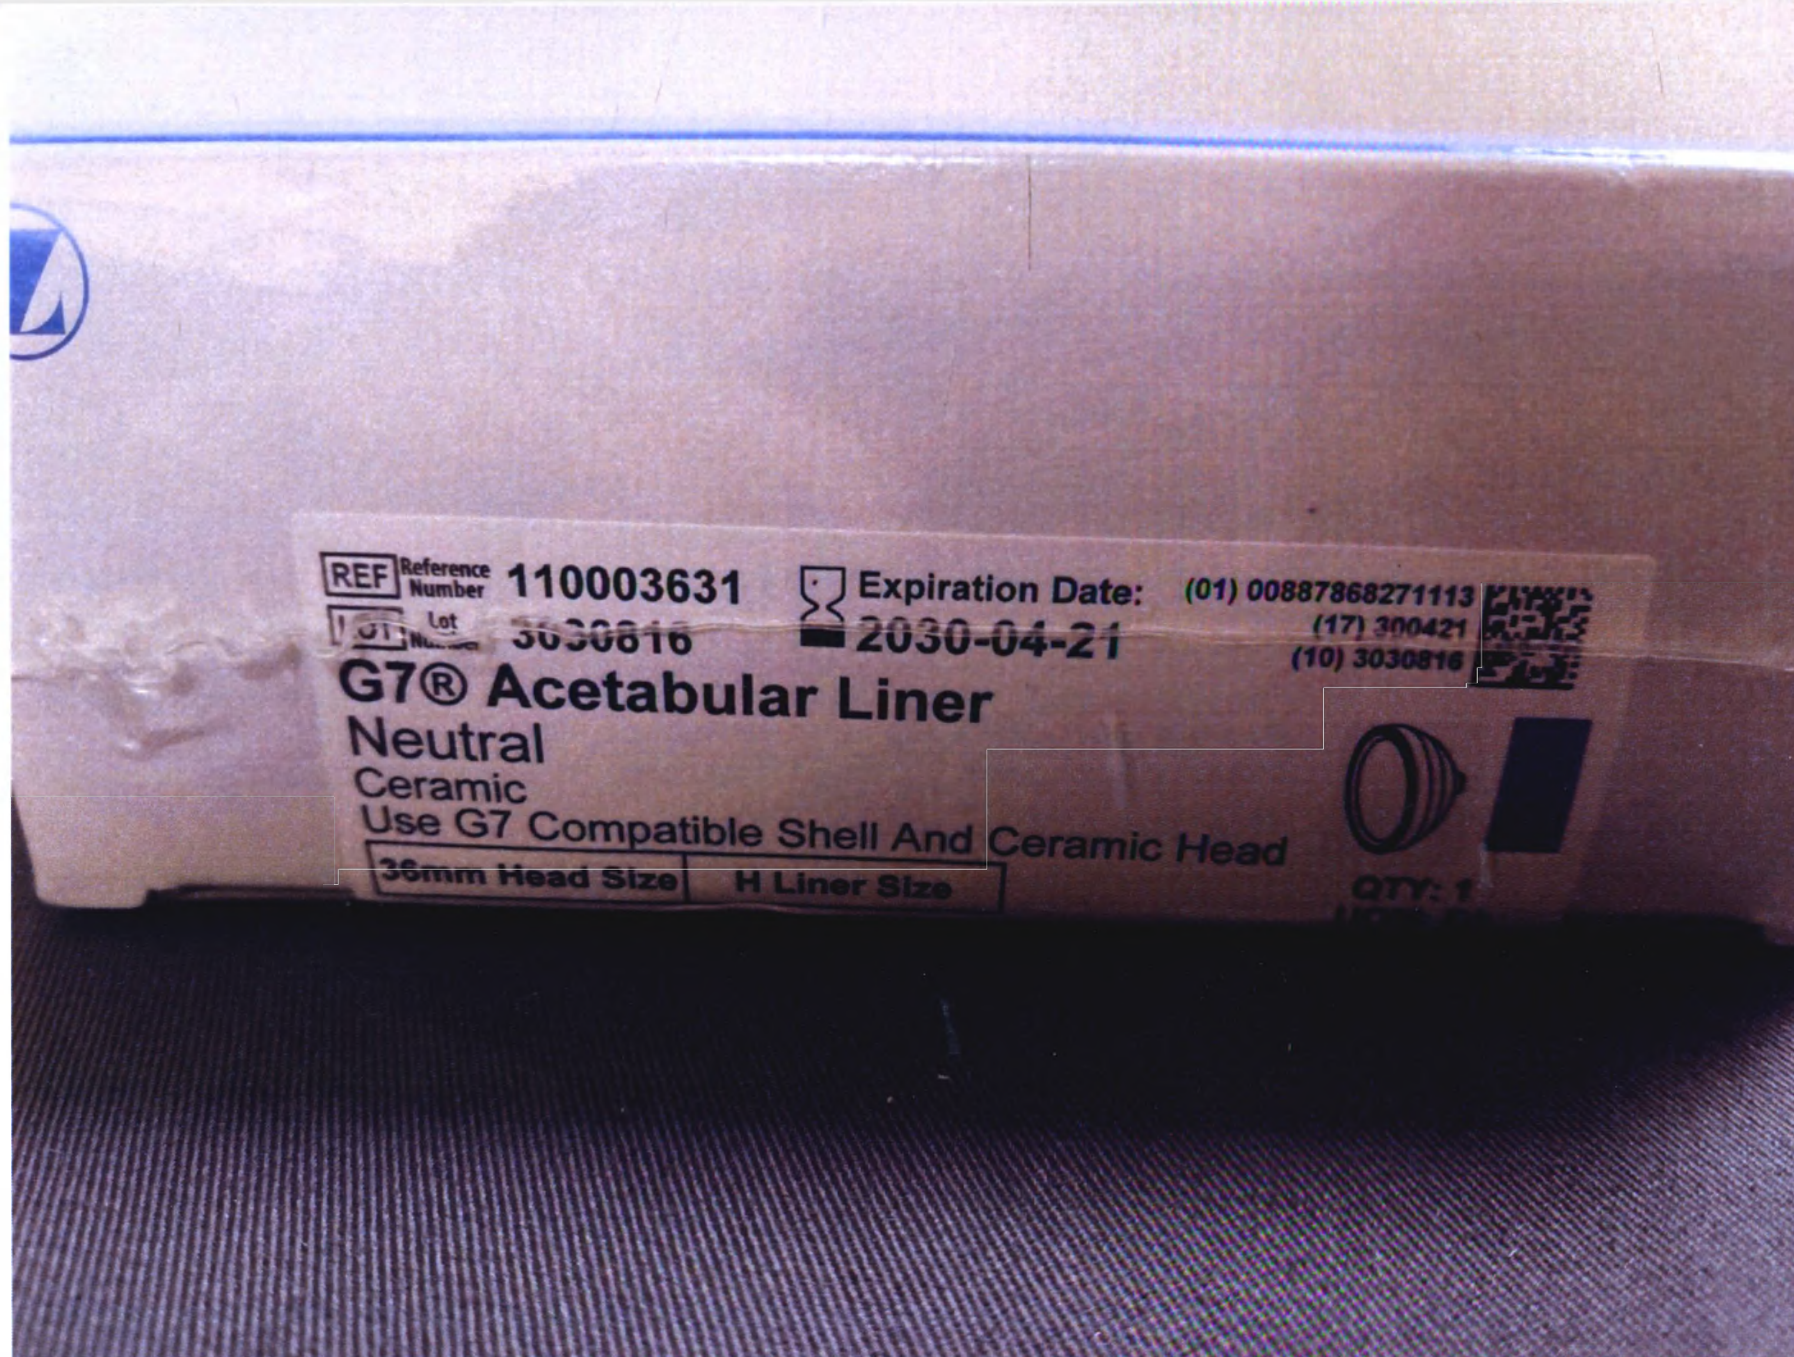


Рис. 4. Пример маркировки потребительской упаковки

BIOMETManufacture Date:
2020-04-21**CERAMIC**

- DE** G7 Pfannen Neutral Keramik G7 komp. Pfanne u. Keramikkopf verwenden
- FR** Liner pour coxyis G7 Neutre Céramique Utiliser coque+tête céra. compatibles G7
- ES** Camisa acetabular G7 Neutro cerámica Usar cúpula/cabeza cerámica compati G7
- IT** Inserto acetabolare G7 Neutro Ceramica Usare gusci e testa ceram. comp. con G7
- NL** G7 acetabulumvoering Neutraal Keramisch Gebruik een comp. G7 kom en keramische kop
- CS** Acetabulární vložka G7 Neutrální Keramická Použ. komp. pouzdro a keram. hlavici G7
- DA** G7 acetabulær liner Neutral Keramisk Brug G7 kompatibel shell og keramikhoved
- NO** G7 acetabulumforing Nøytral Keramisk Bruk G7-kompatibl skall og keramisk hode
- SV** G7 Acetabularliner Neutral Keramisk Använd G7 kompatibelt skal o keram huvud
- TR** G7 Asetabüler Liner Nötr Seramik G7 Uyumlu Kabuk ve Seramik Baş Kullanın
- PL** G7 Wkładka panewki Neutralna ceramiczna Stos. zgodną osłonę i głowę ceram. G7
- PT** Revestimento acetabular interior G7 Neutro Cerâmico Usar cabeça ceram e rev ext compat c/ G7
- EL** Κοτυλιαία επένδυση G7 Ουδέτερο Κεραμική Χρήση συμβ κελύφ και κεραμ κεφαλής G7
- FI** G7-Ionkkamaljan liukuosa Neutraali Keraaminen Käytä G7-yhteens kuorta ja keram päättä

**REF** 110003631**LOT** 3030816**STERILE**
Sterilized
Using
Irradiation**CE**
2797Biomet UK Ltd.
Waterton Industrial Estate
Bridgend, South Wales
CF31 3XA United Kingdom

Рис. 5. Пример маркировки потребительской упаковки

Вкладыш керамический G7, размер 28 мм В в составе:			
1. Вкладыш керамический G7, размер 28 мм В;			
2. Инструкция по применению;			
3. Этикетка пациента - не более 10 шт.			
Производитель:	Биомет Ю-Кей Лимитед	Соединенное Королевство	XXXXXX
Представитель производителя в РФ:		ООО «Зиммер СНГ»	
119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;			
Тел: (495) 980 08 95			
Регистрационное удостоверение №	XXX	от	ДД.ММ.ГГГГ
Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до:		см. упаковку	
		см. инструкцию	
		см. символы на упаковке	
Описание:	Вкладыш керамический G7, размер 28 мм В		

Рис. 6. Макет русскоязычной маркировки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И.

«7» июля

