

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ЭРБАРУС»

М. В. Иконников



20 23 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор электролитов ЕС 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями

Производитель: Erba Lachema s.r.o. Karásek 2219/1d, 62100 Brno, Czech Republic («Эрба Лахема с.р.о.», 62100, Чешская Республика, Брно, Карасек, 2219/1д)



Рис. 1. Анализатор электролитов EC90 (EC 90 Electrolyte Analyzer). Вид спереди



Рис. 2. Анализатор электролитов EC90 (EC 90 Electrolyte Analyzer). Вид сзади



Рис. 3. Анализатор электролитов EC90 (EC 90 Electrolyte Analyzer). Вид сзади

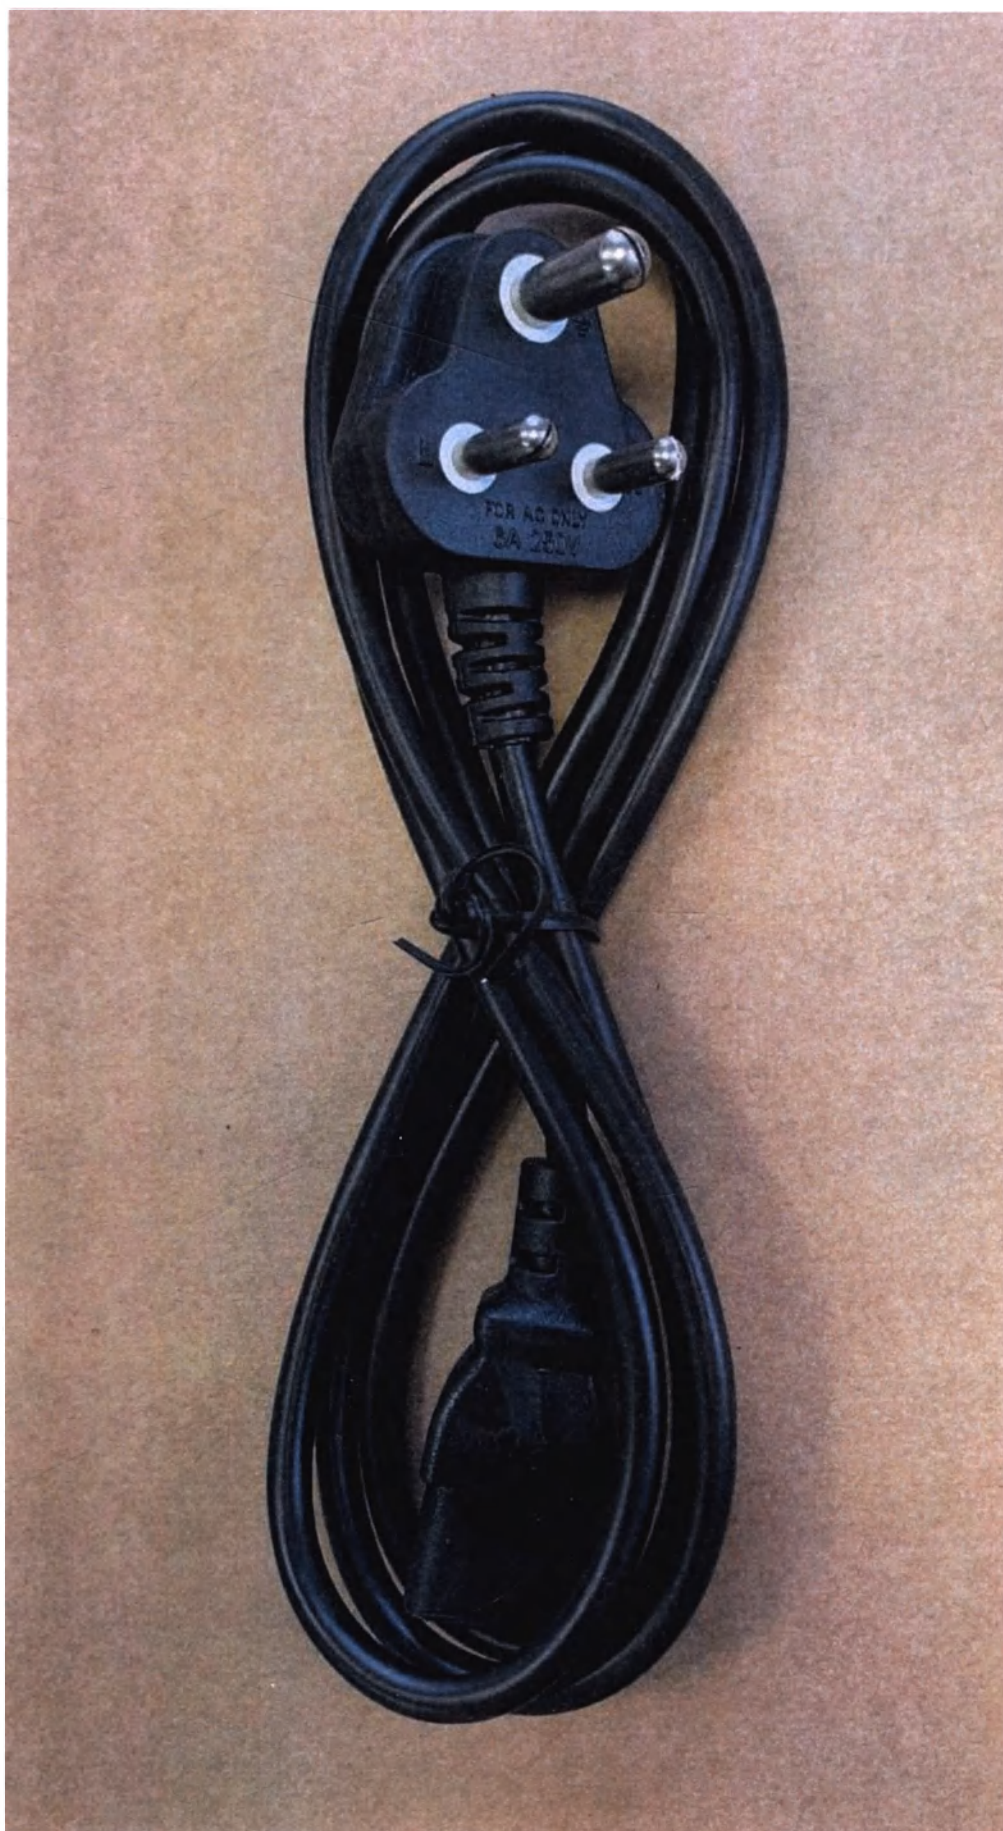


Рис. 4. Шнур питания Бразилия

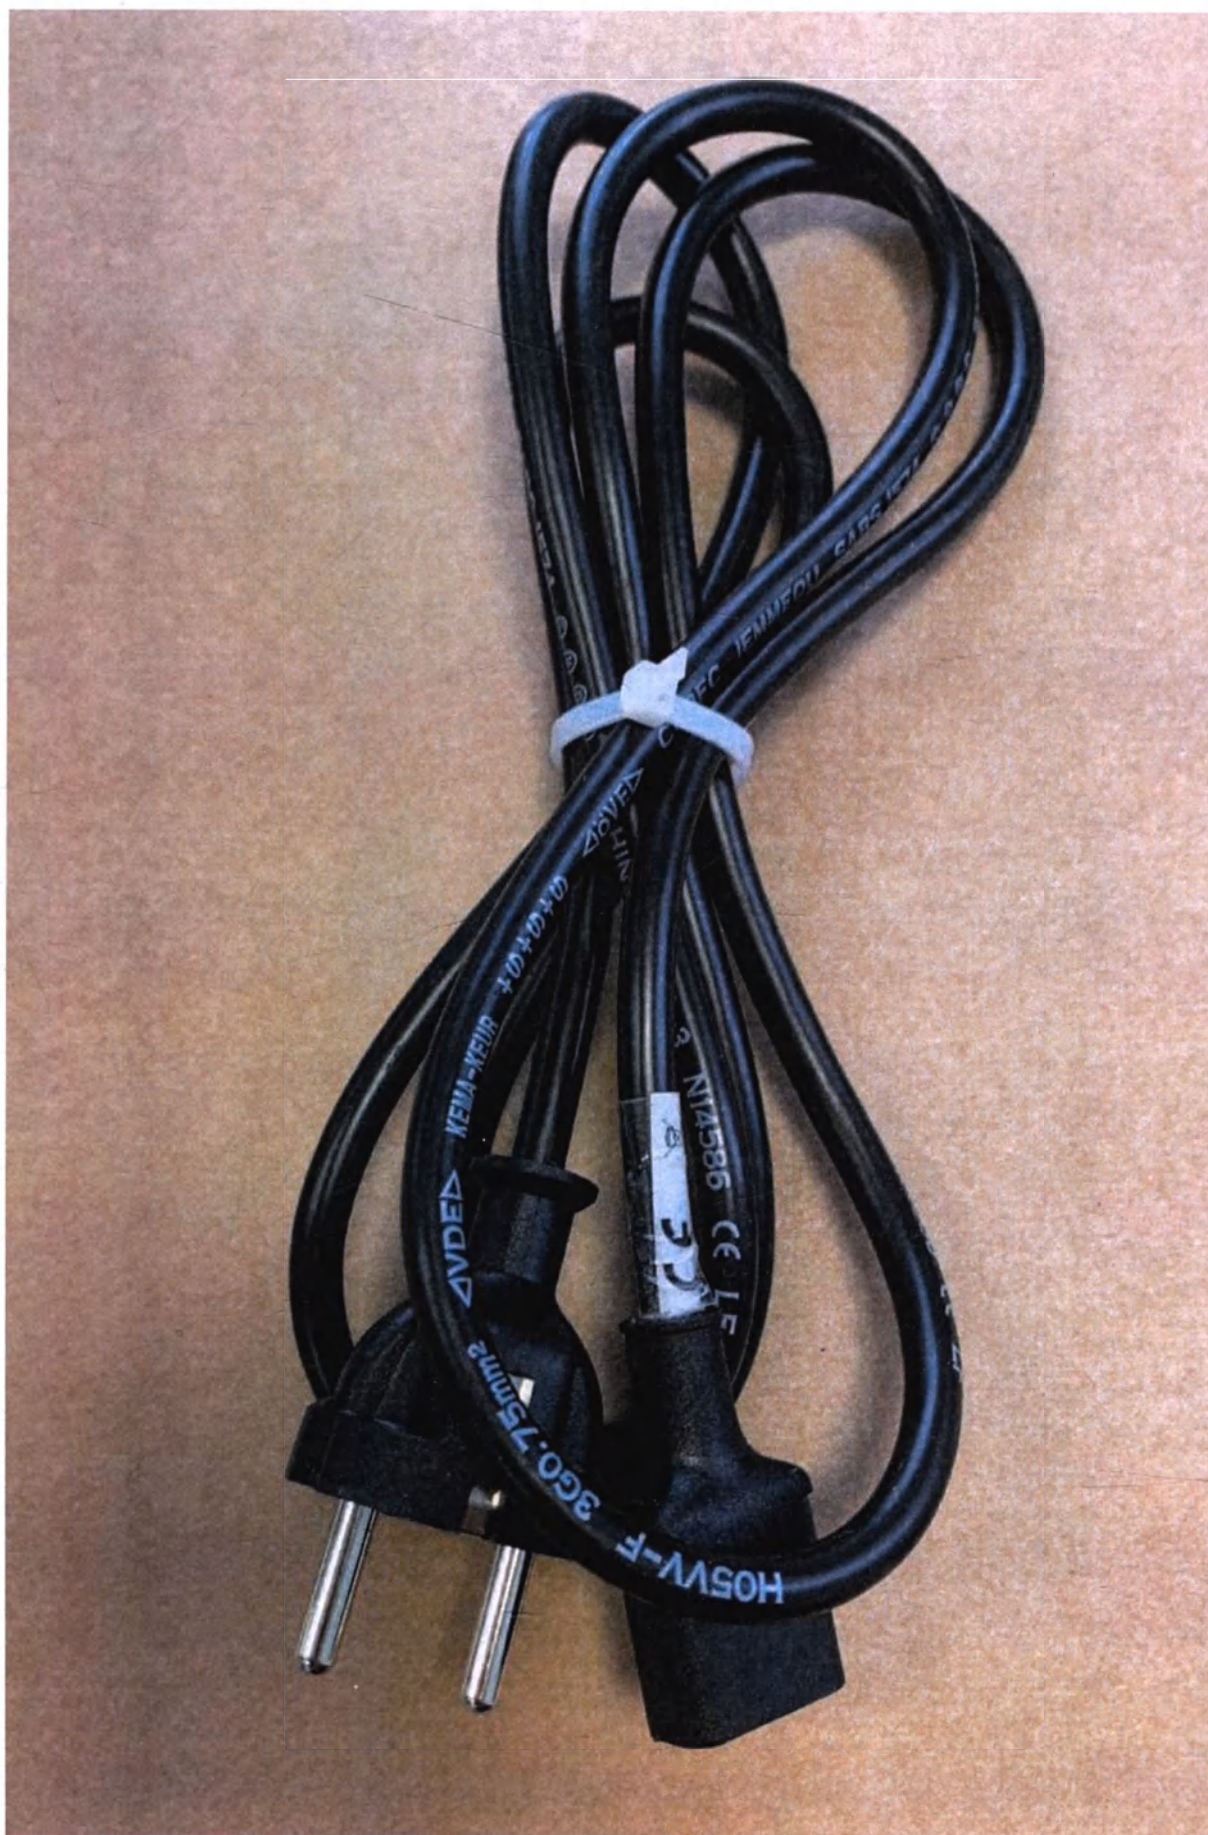


Рис. 5. Шнур питания Европа / Россия

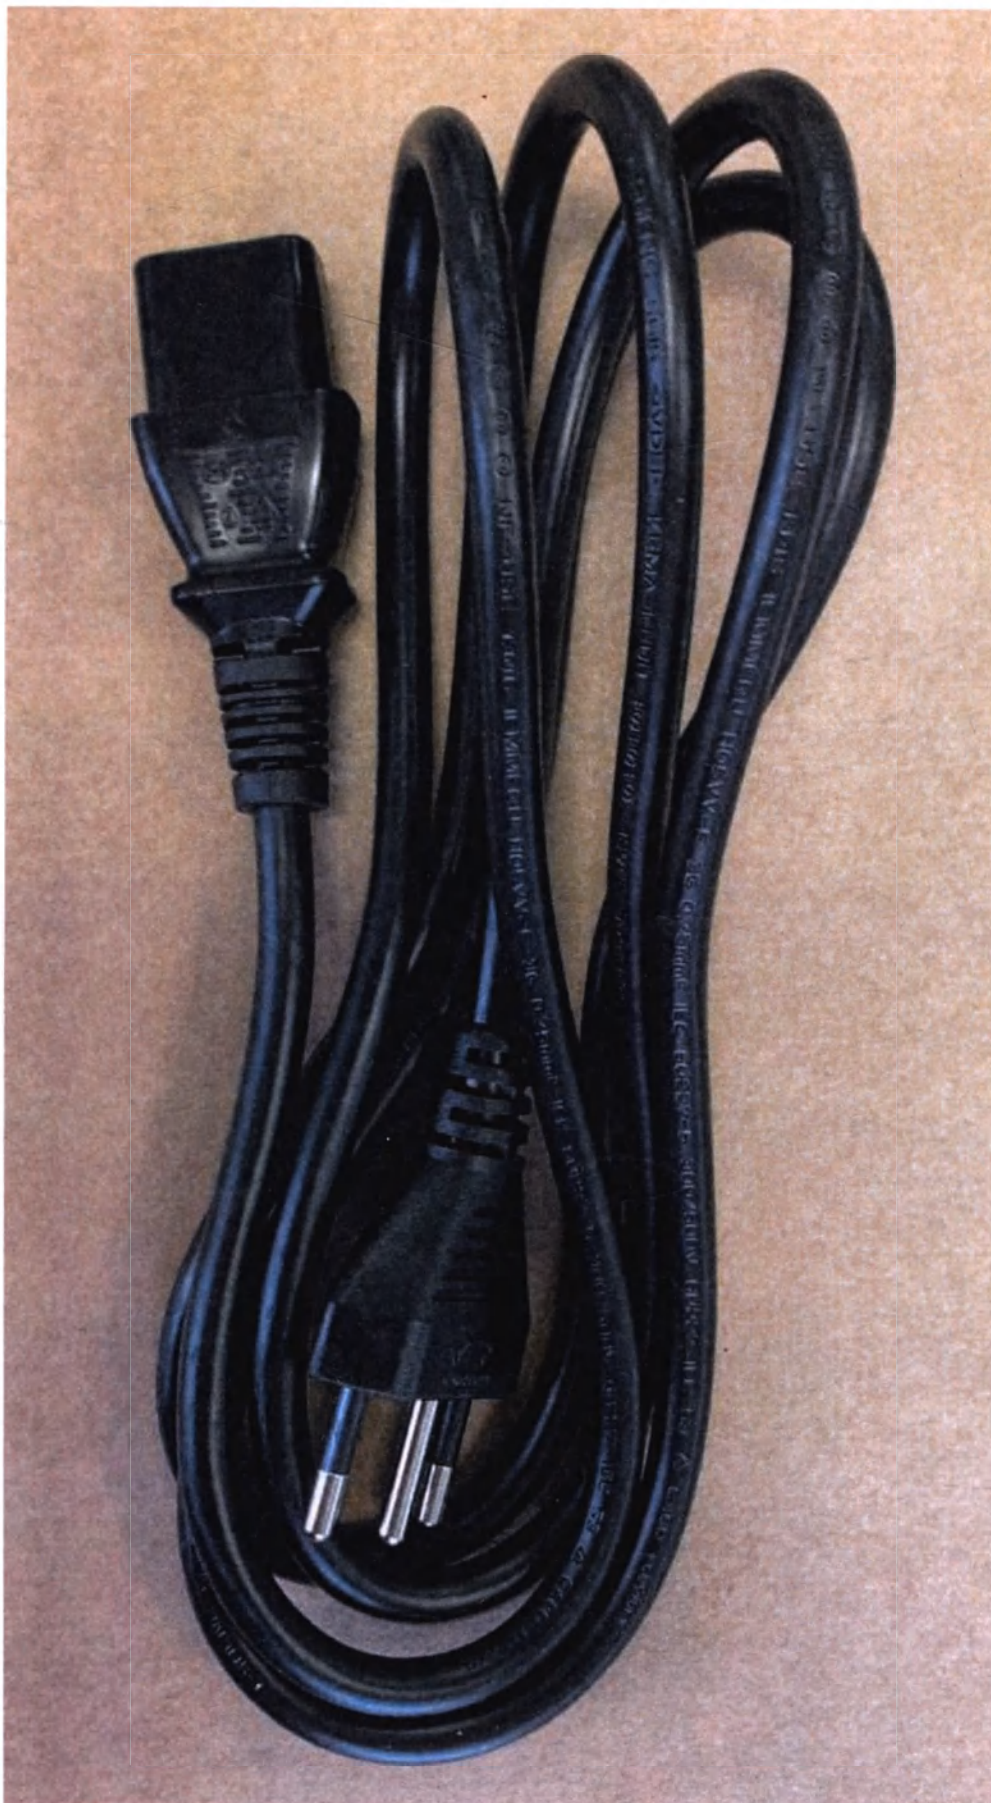


Рис. 6. Шнур питания Индия



Рис. 7. USB-накопитель


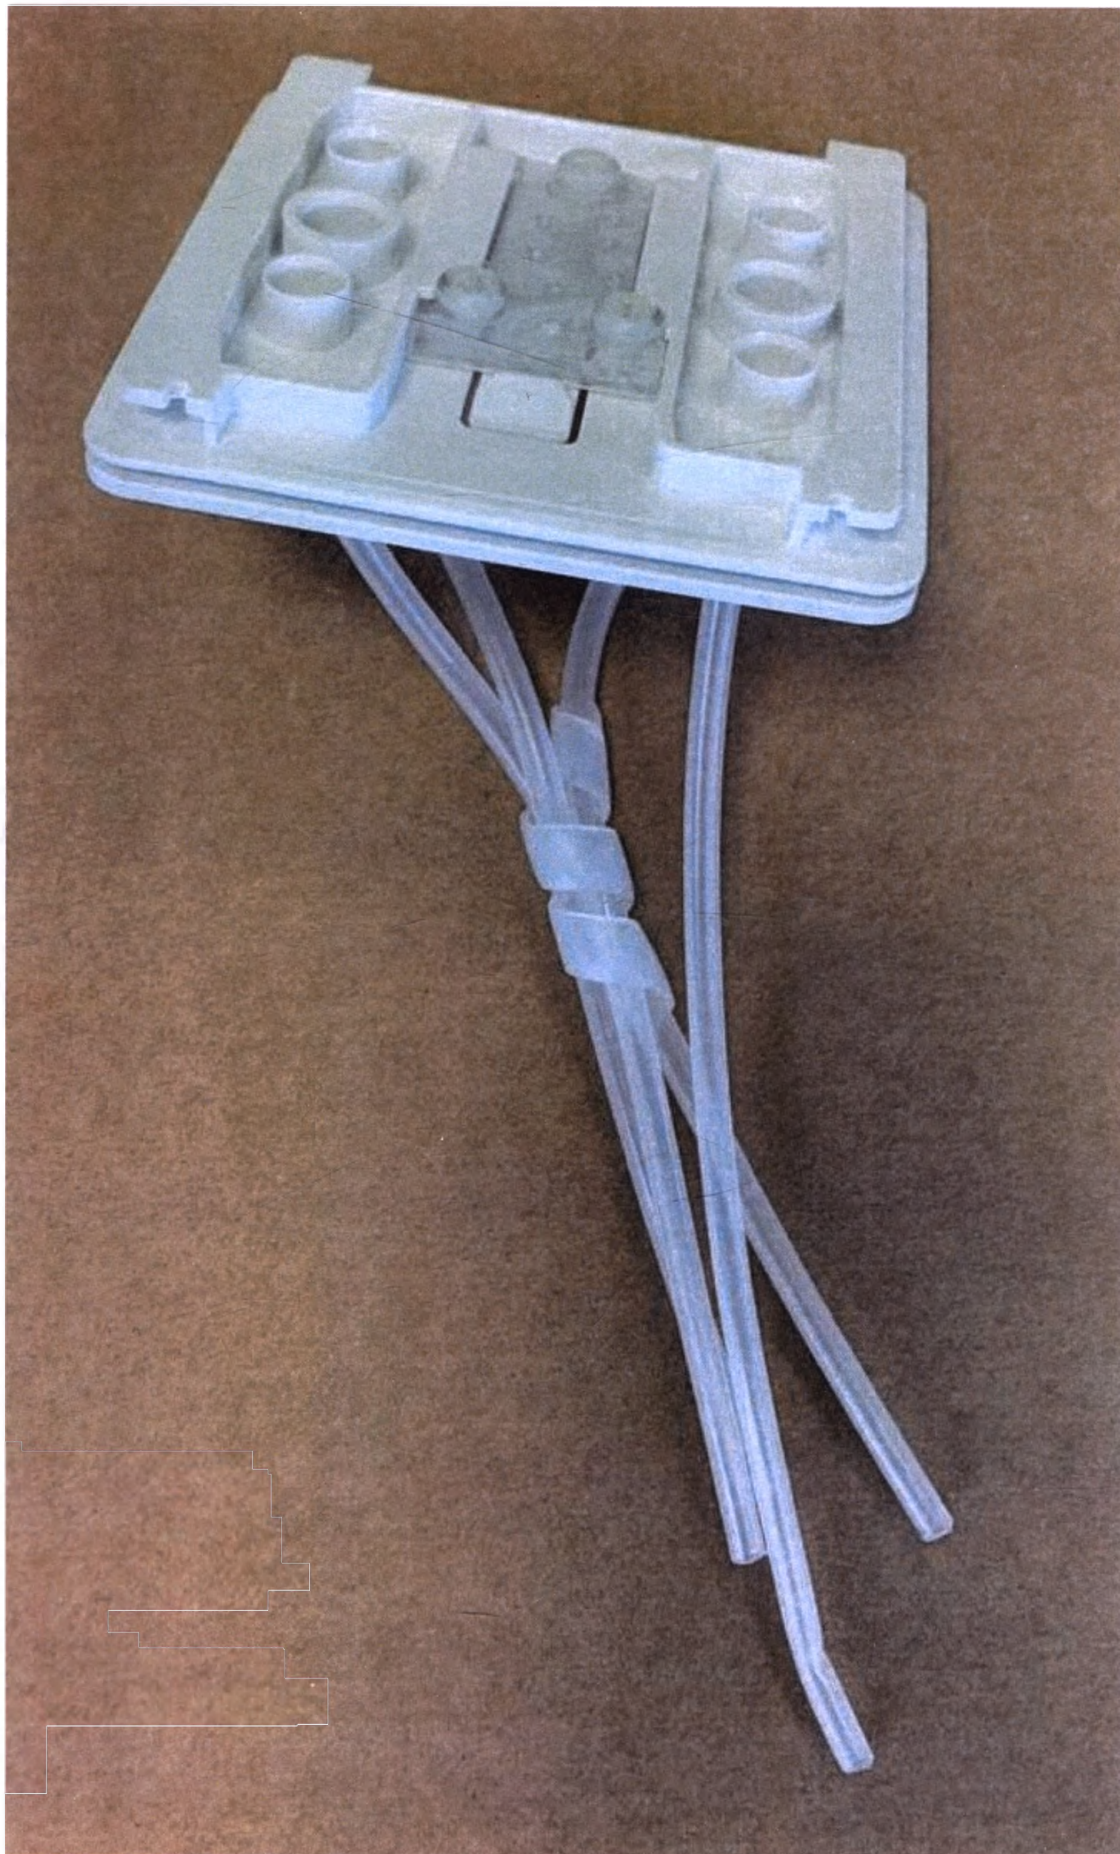


Рис. 8. Моечный аппарат




Рис. 9. Рулон бумаги для термопринтера

Анализатор электролитов EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями в индивидуальной упаковке

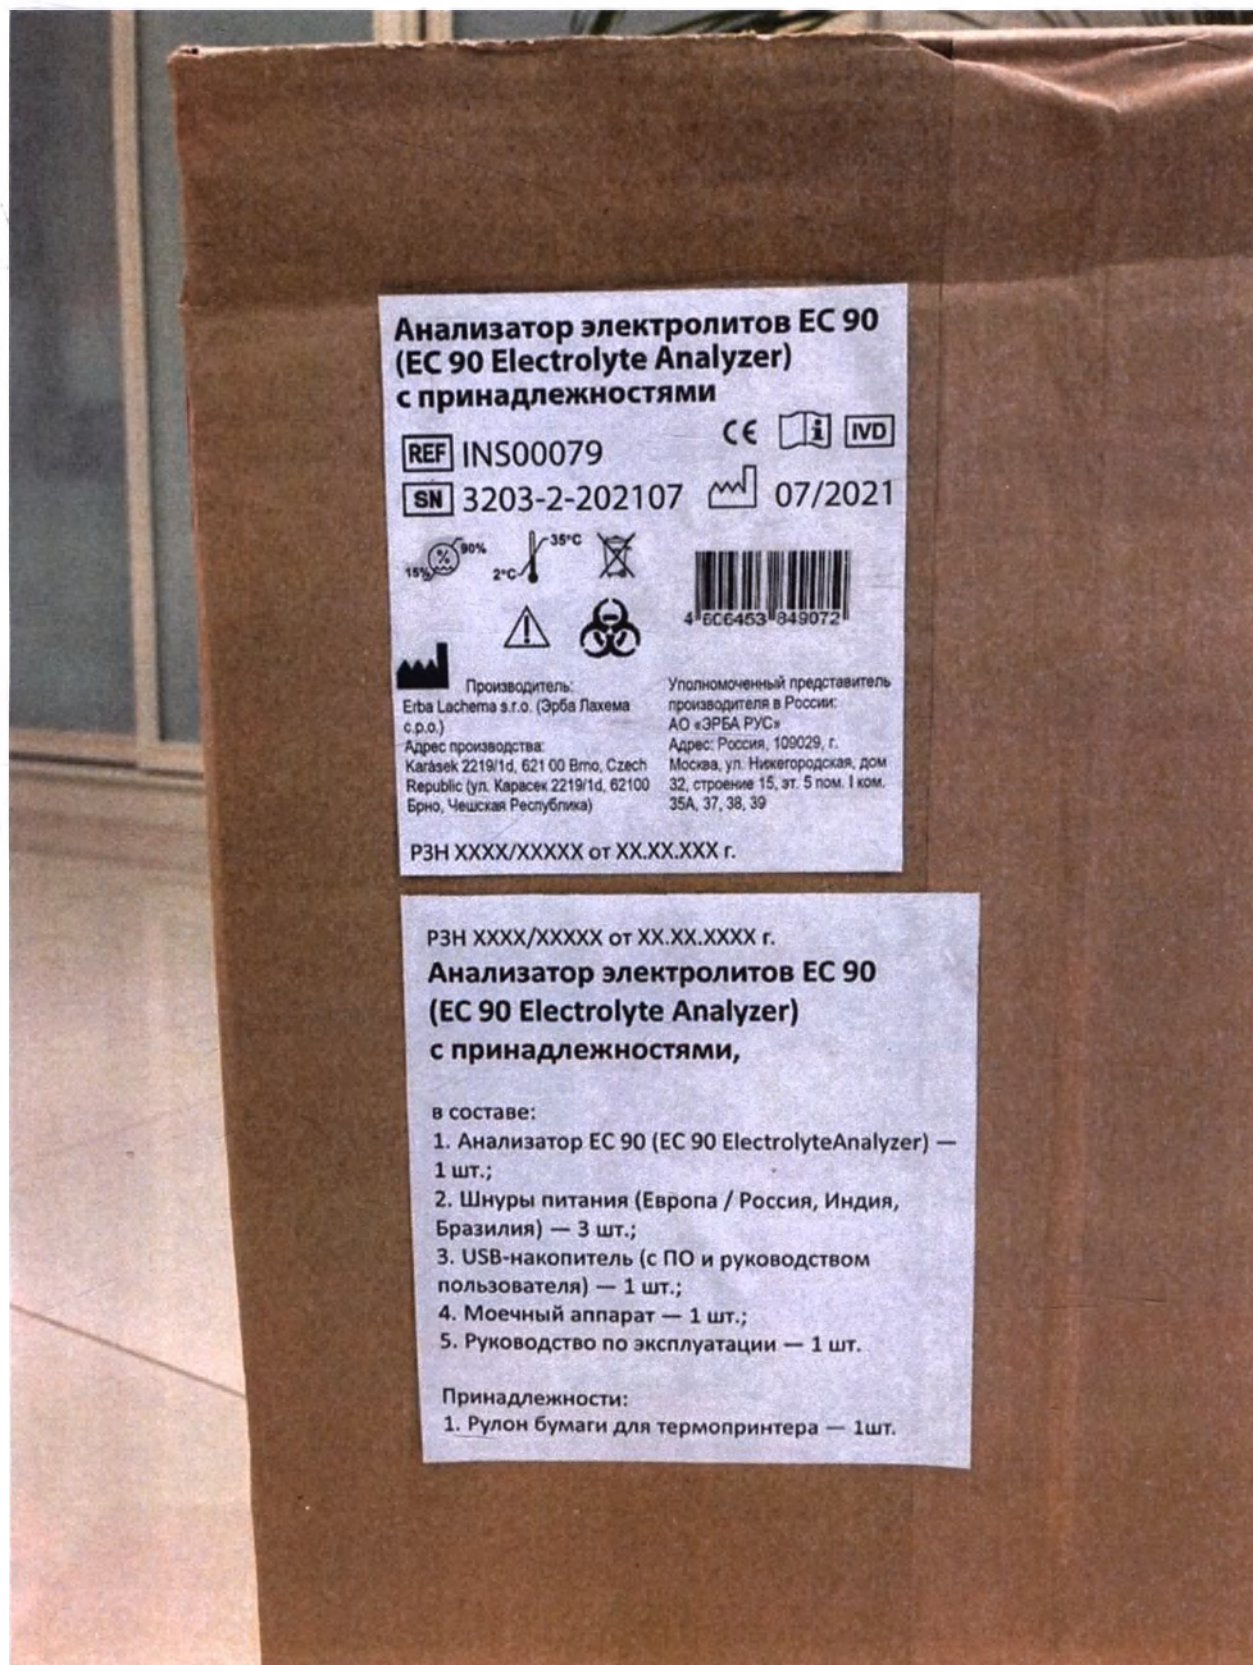

Анализатор электролитов EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями в транспортной упаковке



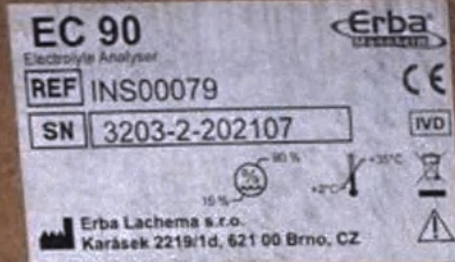

**Анализатор электролитов EC 90
(EC 90 Electrolyte Analyzer)
с принадлежностями**

REF INS00079
SN 3203-2-202107 07/2021



Масса брутто **37 кг**

Производитель:
Erba Lachema s.r.o. (Эрба Лакхема
с.р.о.)
Адрес производства:
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Czech
Republic (ул. Карасек 2219/1d, 62100
Брно, Чешская Республика)

Уполномоченный представитель
производителя в России:
АО «ЭРБА РУС»
Адрес: Россия, 109029, г.
Москва, ул. Нижегородская, дом
32, строение 15, эт. 5 пом. I ком.
35А, 37, 38, 39

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXX г.

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.
**Анализатор электролитов EC 90
(EC 90 Electrolyte Analyzer)
с принадлежностями,**

в составе:

1. Анализатор EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) — 1 шт.;
2. Шнуры питания (Европа / Россия, Индия, Бразилия) — 3 шт.;
3. USB-накопитель (с ПО и руководством пользователя) — 1 шт.;
4. Моечный аппарат — 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Принадлежности:

1. Рулон бумаги для термопринтера — 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) листов
цифрами прописью

Должность _____

Подпись _____

« 02 » мая 20 23 г. Иконников В.С.
М.П.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ЭРБА РУС»»

М. В. Иконников

« 02 » мая 2023 г.



МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Анализатор электролитов ЕС 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями

Производитель: Erba Lachema s.r.o. Karásek 2219/1d, 62100 Brno, Czech Republic («Эрба Лахема с.р.о.», 62100, Чешская Республика, Брно, ул. Карасек, 2219/1д)

Маркировка индивидуальная

EC 90


rozměr / size: (63,5 x 29,6) mm

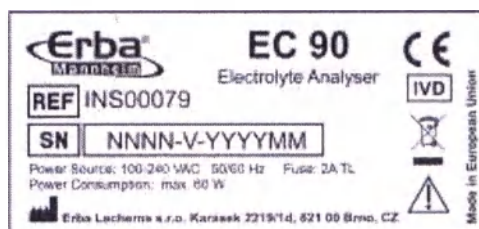

Маркировка транспортная

EC 90

rozměr/size: (70 x 41) mm

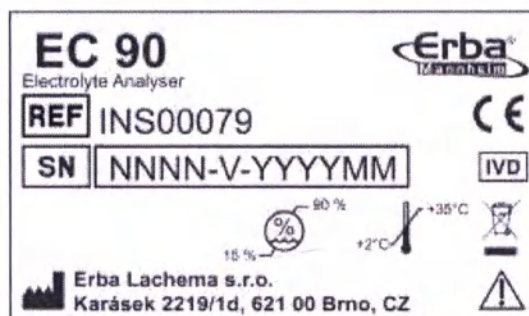

Маркировка транспортная на русском языке

На транспортную упаковку анализатора с принадлежностями наносится маркировка на русском языке на бумажном стикере. Транспортная маркировка на русском языке содержит: наименование и адрес производителя вместе с символом «Изготовитель», наименование и адрес Уполномоченного представителя производителя в России, наименование медицинского изделия, соответствующий символ и серийный номер, соответствующий символ и номер по каталогу, соответствующий символ и дата изготовления, номер регистрационного удостоверения, масса брутто, символы «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*», «Данное изделие соответствует основным требованиям соответствующей директивы ЕС», «Осторожно!», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не выбрасывать! Нужна специальная утилизация!», «Диапазон влажности», «Температурный диапазон», манипуляционные знаки «Хрупкое, обращаться осторожно», «Верх», «Беречь от влаги». На отдельном стикере указывается наименование, состав медицинского изделия и номер регистрационного удостоверения.

Макет маркировки транспортной упаковки анализатора Анализатор электролитов ЕС 90 с принадлежностями:

Анализатор электролитов ЕС 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями	
REF INS00079	CE  IVD
SN XXXXXXXXXX	 MM/ГГГГ
 90% 15%	 35°C 2°C
	
	
Масса брутто	X КГ
 Производитель: Erba Lachema s.r.o. (Эрба Лахема с.р.о.) Адрес производства: Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Czech Republic (ул. Карасек 2219/1d, 62100 Брно, Чешская Республика)	Уполномоченный представитель производителя в России: АО «ЭРБА РУС» Адрес: Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37, 38, 39
РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX	

РЗН XXXX-XXXXX от XX.XX.XXX

Анализатор электролитов EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями, в составе:

1. Анализатор EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) — 1 шт.;
2. Шнуры питания (Европа / Россия, Индия, Бразилия) — 3 шт.;
3. USB-накопитель (с ПО и руководством пользователя) — 1 шт.;
4. Моечный аппарат — 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Принадлежности:

1. Рулон бумаги для термопринтера — 1шт.

Маркировка индивидуальная на русском языке

На индивидуальную упаковку анализатора и принадлежностей наносится маркировка на русском языке на бумажном стикере. Индивидуальная маркировка на русском языке содержит: наименование и адрес производителя вместе с символом «Изготовитель», наименование и адрес Уполномоченного представителя производителя в России, наименование медицинского изделия, соответствующий символ и серийный номер, соответствующий символ и номер по каталогу, соответствующий символ и дата изготовления, символы «Медицинское изделие для диагностики *in vitro*», «Данное изделие соответствует основным требованиям соответствующей директивы ЕС», «Осторожно!», «Биологический риск», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не выбрасывать! Нужна специальная утилизация!», «Диапазон влажности», «Температурный диапазон», штрихкод, номер регистрационного удостоверения. На отдельном стикере указывается наименование, состав медицинского изделия и номер регистрационного удостоверения.

Анализатор электролитов EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями	
REF INS00079	CE  IVD
SN XXXXXXXXXX	 MM/ГГГГ
 15% - 90%  2°C - 35°C 	 4 607099 091375
 	
 Производитель: Erba Lachema a.s. (Эрба Лахема с.р.о.) Адрес производства: Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Czech Republic (ул. Карасек 2219/1d, 62100 Брно, Чешская Республика)	Уполномоченный представитель производителя в России: АО «ЭРБА РУС» Адрес: Россия, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, строение 15, эт. 5 пом. I ком. 35А, 37, 38, 39
РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXX	

РЗН XXXX-XXXXX от XX.XX.XXX


Анализатор электролитов EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) с принадлежностями, в составе:

1. Анализатор EC 90 (EC 90 Electrolyte Analyzer) — 1 шт.;
2. Шнуры питания (Европа / Россия, Индия, Бразилия) — 3 шт.;
3. USB-накопитель (с ПО и руководством пользователя) — 1 шт.;
4. Моечный аппарат — 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Принадлежности:

1. Рулон бумаги для термопринтера — 1шт.

Описание символов, нанесенных на маркировку медицинского изделия

Символ	Описание
	Дата изготовления
	Номер по каталогу
	Серийный номер
	Изготовитель
	Диапазон влажности
	Температурный диапазон
	Осторожно!
	Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Биологический риск
	По окончании срока службы продукт запрещено утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизация и переработка отходов должны соответствовать местным и национальным нормам.
	Данное изделие соответствует основным требованиям соответствующей директивы ЕС

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

7 (Семь) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность _____

Подпись _____ / Иконникова М.В.

« 02 » мая 20 23 г. М.П. _____

