


«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Лабтроник Рус»

 Пleshakov А.А.

«04» апреля 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система мониторинга CareSens Dual для количественного определения глюкозы или β -кетонов в образце цельной крови с принадлежностями»



Фото 1. Глюкометр для измерения глюкозы или β -кетонов в крови CareSens Dual (вид спереди и сзади)



Фото 3. Прокалывающее устройство CareSoft



Фото 2. Тест-полоска CareSens PRO для количественного определения глюкозы в образце цельной крови для системы мониторинга CareSens Dual



Фото 4. Ланцет CareSens



Фото 5. Батарея

i·sens

Буклет владельца

CareSens Dual

Система мониторинга глюкозы в крови
Система мониторинга β -кетонов в крови

- Простая передача данных через соединение Bluetooth
- Тест-полоски на основе GDH-FAD
- Эффективное управление диабетом с помощью маркировки символов

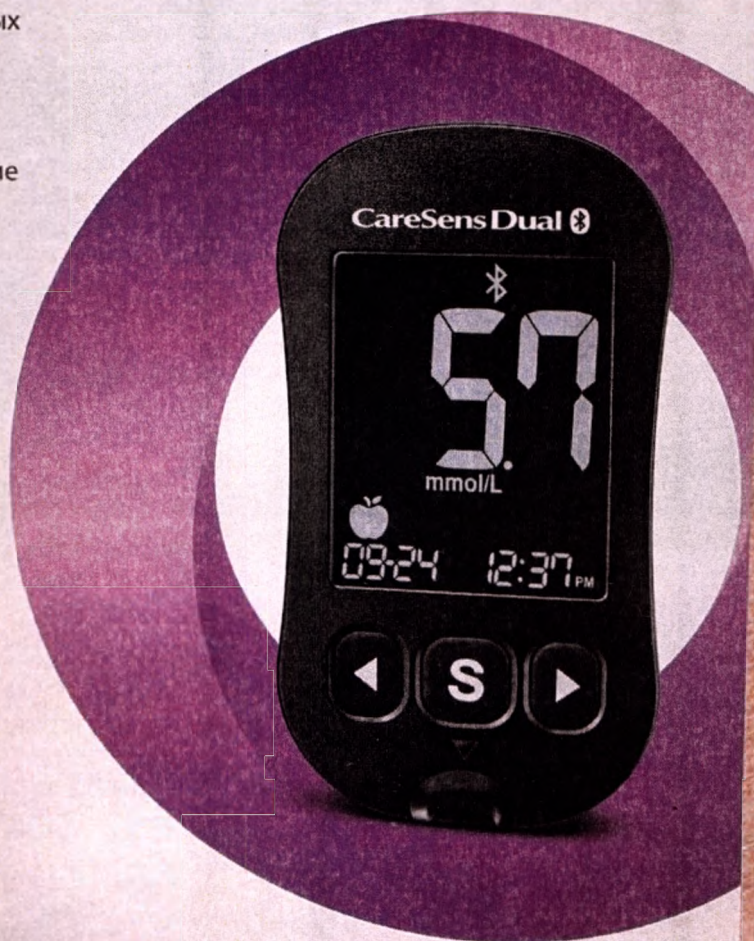


Фото 6. Руководство пользователя




Фото 7. Журнал учёта измерений

Information on the Lancing Device



i-SENS, Inc.

43, Banpo-daero, 28-gil, Seocho-gu,
Seoul 06646, Korea
www.i-sens.com



Medical Technology Promedt
Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80,
66386 St.Ingbert, Germany



PGZ1Z0349 REV0 05/2018

Фото 8. Вкладыш



Фото 9. Чехол с застежкой-молнией



Фото 10. Потребительская упаковка (общий вид)

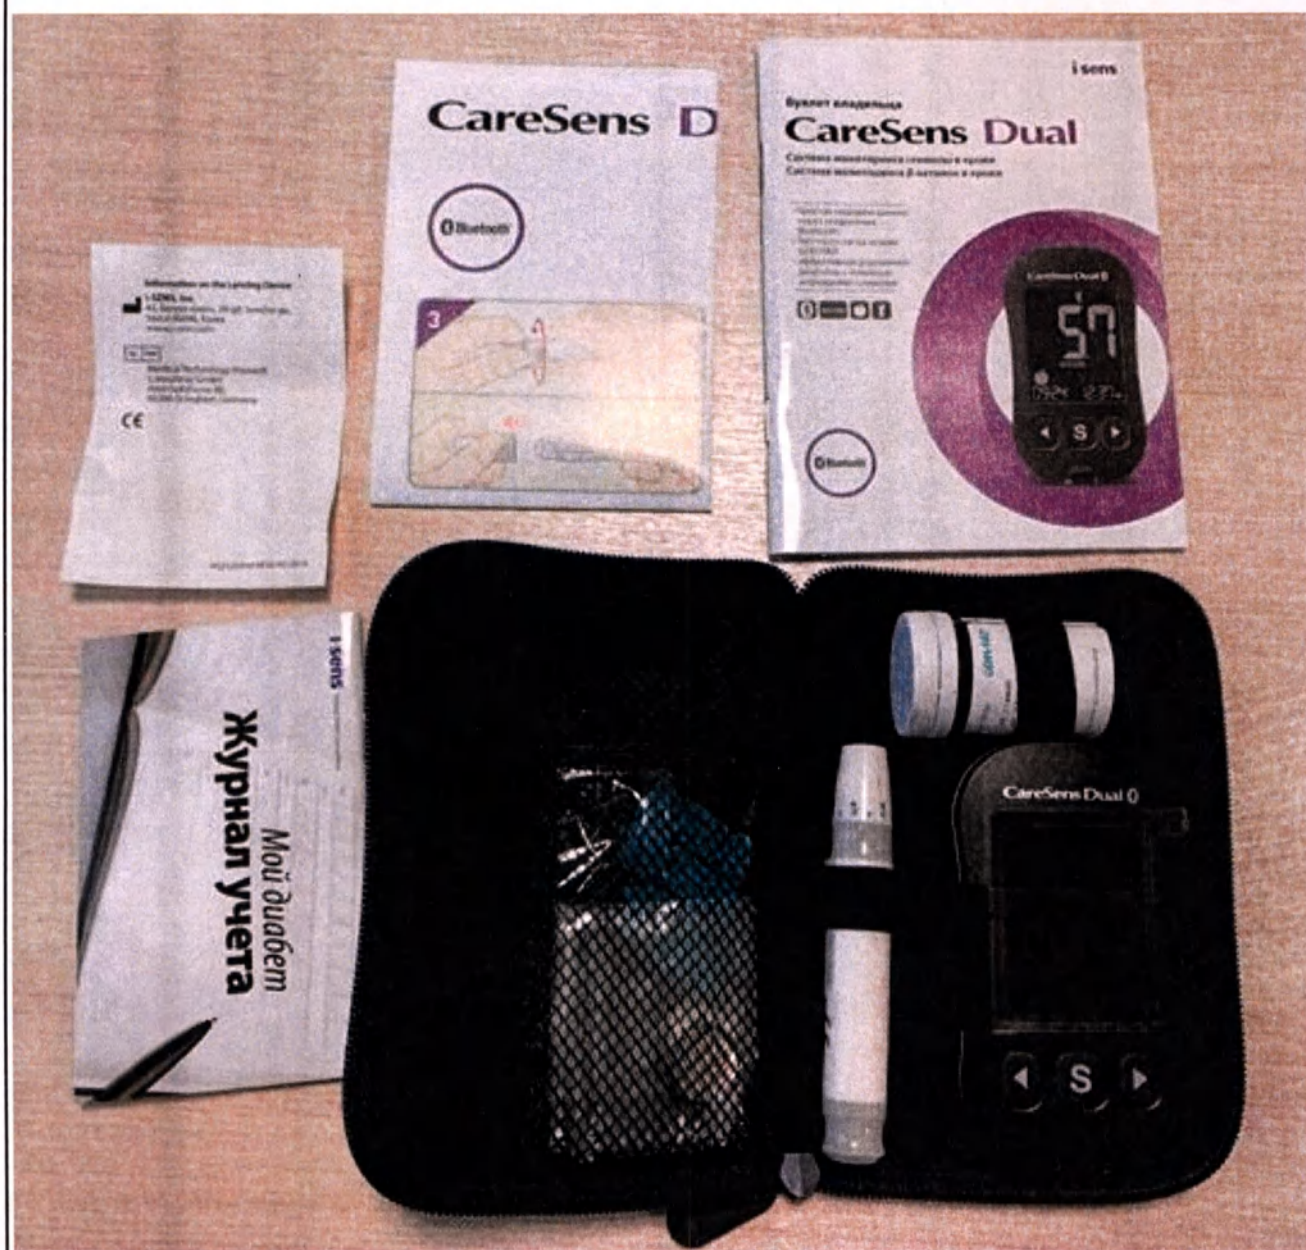


Фото 11. «Система мониторинга CareSens Dual для количественного определения глюкозы или β -кетонов в образце цельной крови» с принадлежностями (общий вид)

Система мониторинга CareSens Dual для количественного определения глюкозы или β -кетонов в образце цельной крови с принадлежностями

Состав: _____ для измерения глюкозы или β -кетонов

1. Глюкометр _____ для измерения глюкозы или β -кетонов в крови CareSens Dual – 1 шт.
2. Тест-полоска CareSens PRO для количественного определения глюкозы в образце цельной крови для системы мониторинга CareSens Dual – 10 шт.
3. Ланцет CareSens – 10 шт.
4. Прокалывающее устройство CareSoft – 1 шт.
5. Батарея – 2 шт.
6. Руководство пользователя – 1 шт.
7. Журнал учёта измерений – 1 шт.
8. Вкладыш – 1 шт.

Принадлежности:

1. Чехол с застежкой-молнией – 1 шт.

Номер регистрационного удостоверения в реестре Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: _____

LOT



CE



i-SENS, Inc. («ай-СЕНС, Инк.»), Республика Корея
43, Banpo-daero 28-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
94-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «Лабтроник Рус», Юридический адрес: 115230, город Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, этаж 8 пом. XV ком. 23. 8-495-333-555-77;

Адрес электронной почты: info@labtronic.ru

IVD



STERILE R

Произведено в Республике Корея

Фото 12. Пример русскоязычной маркировки



Фото 13. Транспортная упаковка (общий вид)



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 14
(четырнадцать) листах

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЛАБТРОНИК РУС»
ИЗДАШАКОВ А.А.