

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «БИНОВИ»

Шевчук С.А.

_____ 2023 г.



МАКЕТЫ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

**Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные
«BENOVY» нитриловые**

2023

Ниже приведены графические макеты упаковок медицинского изделия в различных дизайнах и отдельно увеличенный фрагмент с текстом.

Все варианты исполнения содержат несколько цветов перчаток, которым соответствуют дизайны упаковок, для примера представлены макеты в одном или нескольких цветах в различных дизайнах.

На упаковке медицинского изделия указана следующая информация на русском языке:

- **Наименование медицинского изделия.**
- **Назначение медицинского изделия.** Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей.
- **Краткое описание принципа действия медицинского изделия (для варианта исполнения №2).** ПОКРЫТИЕ OATMEAL – внутреннее увлажняющее покрытие перчаток коллоидной овсяной мукой. Концентрированный белково-крахмальный комплекс, обогащенный бета-глюканом овса, способен проникать в кожу, формируя увлажняющую пленку, и оказывать успокаивающий эффект для более комфортного ношения перчатки и облегчения различных кожных раздражений.
- **Условия транспортировки, хранения и утилизации медицинского изделия.** Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65 до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной инструкцией организации.
- **Материал:** нитрил.

Внимание!

- Перчатки не гарантируют 100% защиты рук от проколов, порезов и повреждений, вызванных воздействием химических веществ.
- При возникновении на коже аллергических реакций при использовании изделия рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником.
- **Инструкция по применению медицинского изделия.**

Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки.

Как надевать перчатки: Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой,

касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток.

Как снимать перчатки: Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. После использования перчатки необходимо утилизировать согласно правилам утилизации медицинских отходов. Тщательно вымыть руки.

- **Производитель (изготовитель):** Харталега Сдн. Бхд., Малайзия, C-G-9, Джалан Датаран SD1, Датаран SD PJU 9, Бандар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.
- **Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ:** ООО «БИНОВИ», Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1 литер Ж, помещ. 205, + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
- **Срок годности медицинского изделия.** Установленный срок годности медицинских смотровых нитриловых перчаток составляет 3 года. Не использовать по истечении срока годности.
- **Гарантии производителя.** Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (3 года) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

Дополнительно, вышеуказанная информация представлена на упаковке медицинского изделия на английском языке.

Также на упаковке медицинского изделия оставлены места для информации, которая будет нанесена после получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие с учетом конкретного типа и размера перчаток:

Размер XX

Количество XX пар

Импортер XXXX

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX

Дата изготовления XX-XXXX

LOT XXXX

Артикул XXXX

Штрих-код XXXXXXXXXXXXX

Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №1:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: васильковый, размер: XX.

Дизайн №1:



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: васильковый, размер: XX.

RUS

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной инструкцией организации.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. **Как надевать перчатки:** Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиям использования перчаток. **Как снимать перчатки:** Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатая ее по руке, и вложить в первую перчатку. После использования перчатки необходимо утилизировать согласно правилам утилизации медицинских отходов. Тщательно вымыть руки.

■ Харталега Сдн. Бхд., Малайзия, C-G-9, Джалан Датан SD1, Датан SD PJU 9, Бандр Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «БИНОВИ», Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1 литер Ж, помещ. 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

ИМПОРТЕР: XXXX.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: Установленный срок годности медицинских смотровых нитриловых перчаток составляет 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (3 года) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile «BENOVY» nitrile, design version: Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile «BENOVY» nitrile finger textured powder free with single chlorination (beaded cuff); color: violet blue, size: XX.

ENG

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE. Disposable gloves are designed to protect health worker's hands during the examination/treatment of a patient or for other sanitary purposes.

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE. The transportation of the device may be made by all means of transport (sea, land, railway or air transport) according to the rules of transportation, which are applied to such means of transport. During transportation, the storage conditions should not be violated. Devices should be stored in a dry place protected from direct sunlight, heat, ignition and

ultraviolet sources, as well as ozone, at temperature from 0°C to 25°C and relative humidity of air – from 65% to 85%. Care should be taken with devices stored at temperature below 15°C because they may become stiff and susceptible to deformation in case of careless use. After storage at a low temperature, gloves must be warmed to 30°C throughout the device before use. Disposal of the medical device in the Russian Federation is carried out by the medical organization as class B waste in accordance with SanPiN 2.1.3684-21 and approved guideline of the organization.

MATERIAL: nitrile.

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PUNCTURES, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTHCARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS, WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT. Preliminary hygienic treatment of your hands is required before use of the gloves (treat hands with skin antiseptic or wash with soap and water). Gloves are put on dry hands only. **How to put the gloves on:** Take a glove from the box. It is recommended to touch the bounded surface of the glove corresponding to the wrist (upper edge of the cuff). Pull on the first glove. Take the second glove with your bare hand, touching the bounded surface of the glove corresponding to the wrist. To avoid touching the skin of the forearm with a gloved hand, rotate the outer surface of the glove to be put on with folded fingers in the glove so that you could pull the glove over the other hand. Having put the gloves on, it is required to touch only those objects provided for by the indications for use and conditions of the use of the gloves. **How to take the gloves off:** To take a glove off, pick it up at the level of the wrist without touching the skin of the forearm and pull it off your hand, turning it inside out. Holding the removed glove with the gloved hand, it is necessary to place the fingers of your bare hand between the glove and wrist. Remove the second glove by rolling it down the hand and put into the first glove. After use, the gloves should be disposed of, in accordance with the recommendations related to the disposal of medical waste. Wash the hands thoroughly.

■ Hartalega Sdn. Bhd., Malaysia, C-G-9, Jalan Dataran SD1, Dataran SD PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER (PRODUCER) ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: «BENOVY» Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy per., liter J, office 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

IMPORTER: XXXX.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE. The established shelf life of the medical examination nitrile gloves is 3 years. Do not use after expiry date.

MANUFACTURER'S WARRANTIES. The manufacturer guarantees preservation of all the parameters and characteristics of the medical device taking into account acceptable quality level (AQL), as well as the quality of the medical gloves within all shelf life (3 years) from the date of manufacture upon the condition of package integrity, observance of transportation, storage and operation conditions in accordance with the instruction.

Артикул: XXXXXXXXXX



www.benovy.ru




XX-XXXX

XXXX



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: фиолетовый, размер: XX.

Дизайн №2:

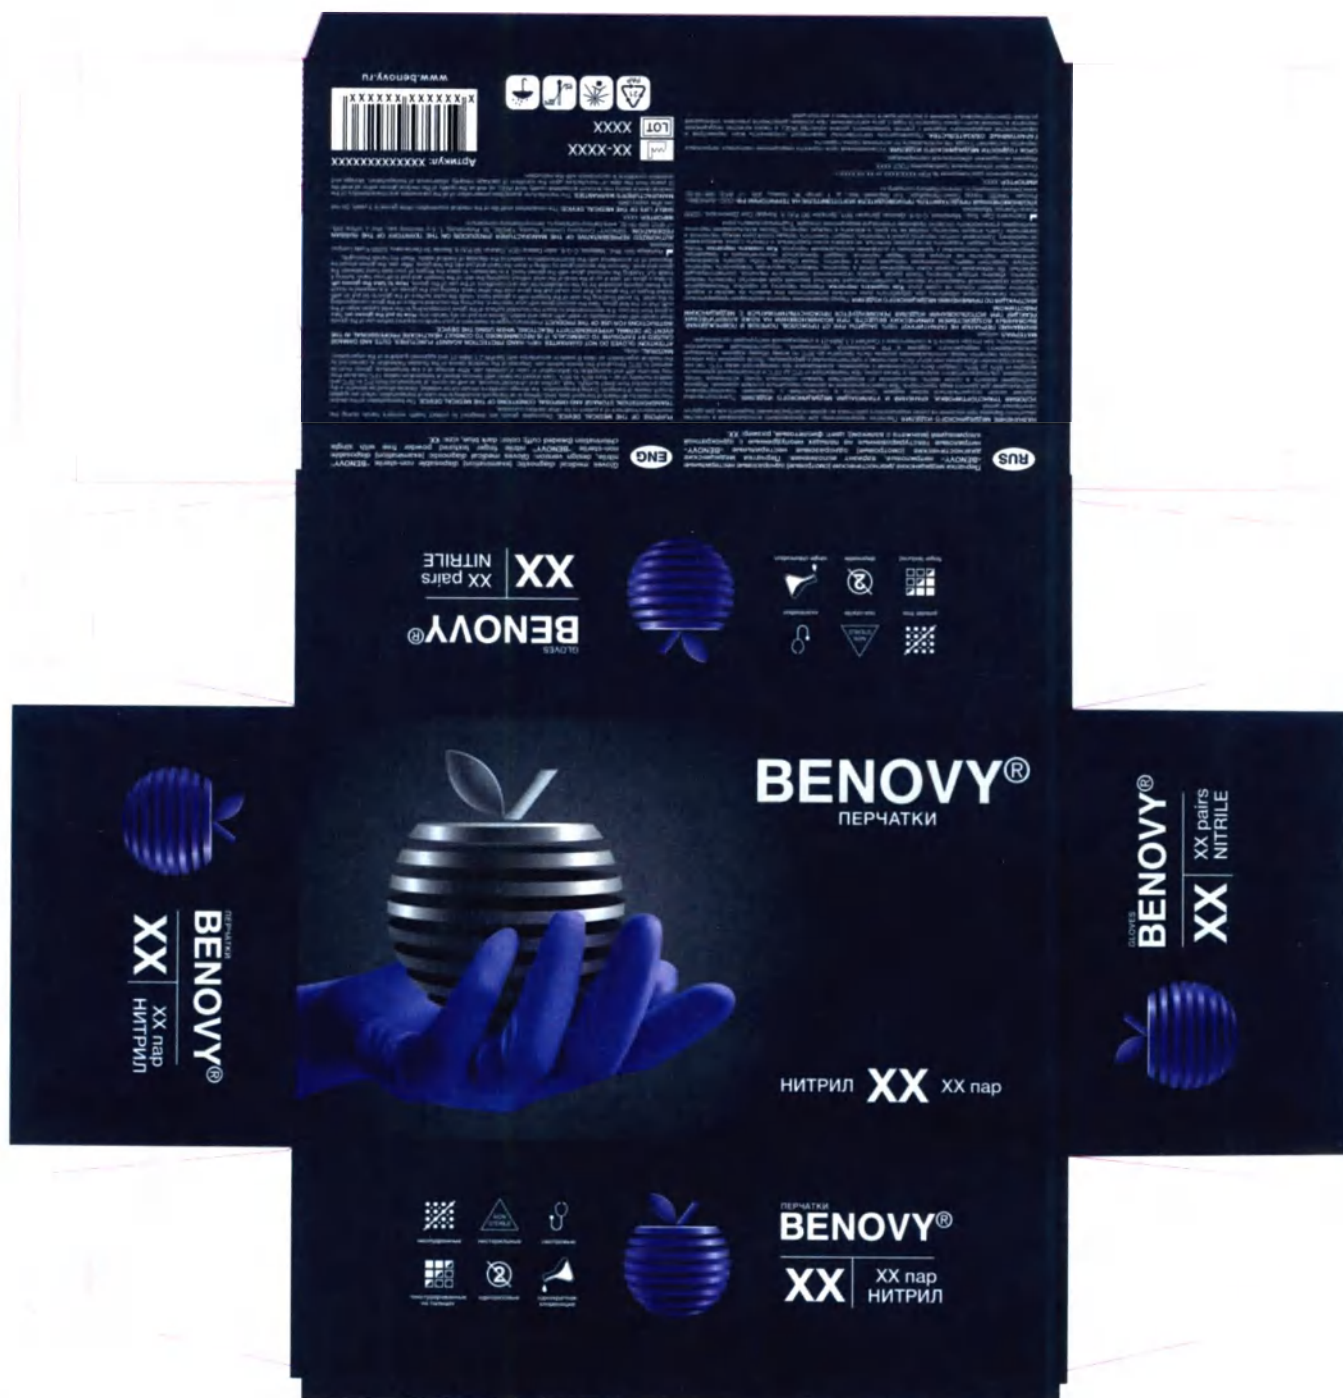

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: темно-синий, размер: XX.

Дизайн №3:



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: темно-синий, размер: XX.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной инструкцией организации.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. **Как надевать перчатки:** Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. **Как снимать перчатки:** Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. После использования перчатки необходимо утилизировать согласно правилам утилизации медицинских отходов. Тщательно вымыть руки.

Харталега Сдн, Бхд., Малайзия, С-Г-9, Джалан Датаран SD1, Датаран SD PJU 9, Бандар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «БИНОВИ», Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1 литер Ж, помещ. 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

ИМПОРТЕР: XXXX.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: Установленный срок годности медицинских смотровых нитриловых перчаток составляет 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (3 года) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile «BENOVY» nitrile, design version: Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile «BENOVY» nitrile finger textured powder free with single chlorination (beaded cuff); color: cobalt blue, size: XX.

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE. Disposable gloves are designed to protect health worker's hands during the examination/treatment of a patient or for other sanitary purposes.

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE. The transportation of the device may be made by all means of transport (sea, land, railway or air transport) according to the rules of transportation, which are applied to such means of transport. During transportation, the storage conditions should not be violated. Devices should be stored in a dry place protected from direct sunlight, heat, ignition and ultraviolet sources, as well as ozone, at temperature from 0°C to 25°C and relative humidity of air – from 65% to 85%. Care should be taken with devices stored at temperature below 15°C because they may become stiff and susceptible to deformation in case of careless use. After storage at a low temperature, gloves must be warmed to 30°C throughout the device before use. Disposal of the medical device in the Russian Federation is carried out by the medical organization as class B waste in accordance with SanPIN 2.1.3684-21 and approved guideline of the organization.

MATERIAL: nitrile.

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PUNCTURES, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTHCARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS, WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT. Preliminary hygienic treatment of your hands is required before use of the gloves (treat hands with skin antiseptic or wash with soap and water). Gloves are put on dry hands only. **How to put the gloves on:** Take a glove from the box. It is recommended to touch the bounded surface of the glove corresponding to the wrist (upper edge of the cuff). Pull on the first glove. Take the second glove with your bare hand, touching the bounded surface of the glove corresponding to the wrist. To avoid touching the skin of the forearm with a gloved hand, rotate the outer surface of the glove to be put on with folded fingers in the glove so that you could pull the glove over the other hand. Having put the gloves on, it is required to touch only those objects provided for by the indications for use and conditions of the use of the gloves. **How to take the gloves off:** To take a glove off, pick it up at the level of the wrist without touching the skin of the forearm and pull it off your hand, turning it inside out. Holding the removed glove with the gloved hand, it is necessary to place the fingers of your bare hand between the glove and wrist. Remove the second glove by rolling it down the hand and put into the first glove. After use, the gloves should be disposed of, in accordance with the recommendations related to the disposal of medical waste. Wash the hands thoroughly.

Харталега Сдн, Бхд., Малайзия, С-Г-9, Джалан Датаран SD1, Датаран SD PJU 9, Бандар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER (PRODUCER) ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: «BENOVY» Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy per., liter J, office 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

IMPORTER: XXXX.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE: The established shelf life of the medical examination nitrile gloves is 3 years. Do not use after expiry date.

MANUFACTURER'S WARRANTIES. The manufacturer guarantees preservation of all the parameters and characteristics of the medical device taking into account acceptable quality level (AQL), as well as the quality of the medical gloves within all shelf life (3 years) from the date of manufacture upon the condition of package integrity, observance of transportation, storage and operation conditions in accordance with the instruction.



XX-XXXX

XXXX



Артикул: XXXXXXXXXXXXX




www.benovy.ru

Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №2:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» Moisturizing (с увлажнителем) нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией с внутренним увлажняющим покрытием Oatmeal (манжета с валиком); цвет: серо-голубой, размер: XX.

Дизайн №2:

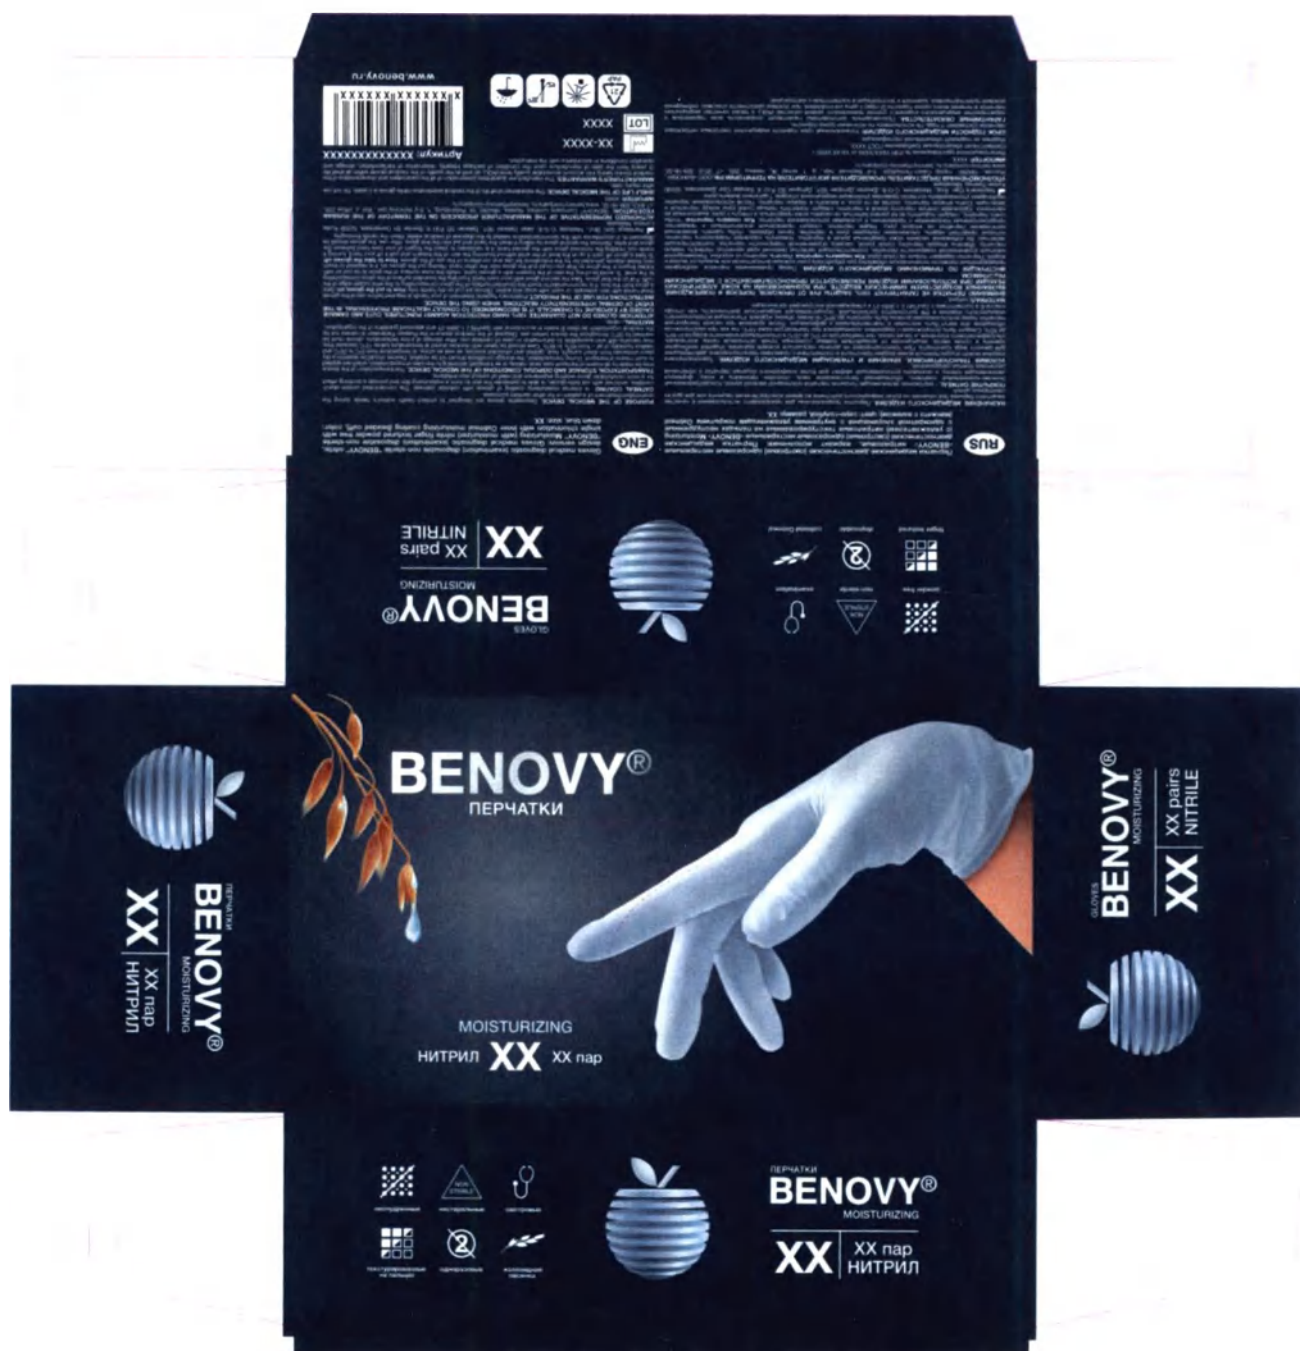

RUS

Перчатки медицинские диагностические (испытательные) одноразовые нестерильные BENOVY нитриловые, вариант исполнения Перчатки медицинские диагностические (испытательные) одноразовые нестерильные BENOVY Moisturizing (с увлажнителем) нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией с внутренним увлажняющим покрытием Oatmeal (манжета с пальчиком), цвет: серо-голубой, размер: XX.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ПОКРЫТИЕ OATMEAL

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ТРЕЩИН, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Как надевать перчатки

Как снимать перчатки

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И КОМПЕТЕНТНА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

ИМПОРТЕР

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ENG

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile BENOVY nitrile design version. Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile BENOVY Moisturizing (with moisturizer) nitrile finger textured powder free with single chlorination with inner Oatmeal moisturizing coating (beaded cuff, color: dawn blue, size: XX.

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE

OATMEAL COATING

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE

MATERIAL

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PINN, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTH CARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT

How to wear gloves

How to remove gloves

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER, PRODUCER, ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

IMPORTER

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE

MANUFACTURER'S WARRANTIES



XX-XXXX



XXXX



Артикул: XXXXXXXXXXXXX



www.benovy.ru

Дизайн №3:



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» Moisturizing (с увлажнителем) нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией с внутренним увлажняющим покрытием Oatmeal (манжета с валиком); цвет: серо-голубой, размер: XX.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей.

ПОКРЫТИЕ OATMEAL – внутреннее увлажняющее покрытие перчаток коллоидной овсяной мукой. Концентрированный белково-крахмальный комплекс, обогащенный бета-глюканом овса, способен проникать в кожу, формируя увлажняющую пленку, и оказывать успокаивающий эффект для более комфортного ношения перчатки и облегчения различных кожных раздражений.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной инструкцией организации.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. **Как надевать перчатки:** Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. **Как снимать перчатки:** Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и положить в первую перчатку. После использования перчатки необходимо утилизировать согласно правилам утилизации медицинских отходов. Тщательно вымыть руки.

■ Hartalega Sdn. Bhd., Малайзия, C-G-9, Джалан Датан SD1, Датан SD PJU 9, Бандар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «БИНОВИ», Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1 литер Ж, помещ. 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

ИМПОРТЕР: XXXX.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: Установленный срок годности медицинских смотровых нитриловых перчаток составляет 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (3 года) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" nitrile, design version: Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" Moisturizing (with moisturizer) nitrile finger textured powder free with single chlorination with inner Oatmeal moisturizing coating (beaded cuff), color: dawn blue, size: XX.

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE. Disposable gloves are designed to protect health worker's hands during the examination/treatment of a patient or for other sanitary purposes.

OATMEAL COATING is internal moisturising coating of gloves with colloidal oatmeal. The concentrated protein-starch complex, enriched with oat beta-glucan, is able to penetrate the skin to form a moisturising film and provide a soothing effect for a more comfortable glove-wearing experience and relief of various skin irritations.

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE. The transportation of the device may be made by all means of transport (sea, land, railway or air transport) according to the rules of transportation, which are applied to such means of transport. During transportation, the storage conditions should not be violated. Devices should be stored in a dry place protected from direct sunlight, heat, ignition and ultraviolet sources, as well as ozone, at temperature from 0°C to 25°C and relative humidity of air – from 65% to 85%. Care should be taken with devices stored at temperature below 15°C because they may become stiff and susceptible to deformation in case of careless use. After storage at a low temperature, gloves must be warmed to 30°C throughout the device before use. Disposal of the medical device in the Russian Federation is carried out by the medical organization as class B waste in accordance with SanPiN 2.1.3684-21 and approved guideline of the organization.

MATERIAL: nitrile.

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PUNCTURES, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTHCARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS, WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT. Preliminary hygienic treatment of your hands is required before use of the gloves (treat hands with skin antiseptic or wash with soap and water). Gloves are put on dry hands only. **How to put the gloves on:** Take a glove from the box. It is recommended to touch the bounded surface of the glove corresponding to the wrist (upper edge of the cuff). Pull on the first glove. Take the second glove with your bare hand, touching the bounded surface of the glove corresponding to the wrist. To avoid touching the skin of the forearm with a gloved hand, rotate the outer surface of the glove to be put on with folded fingers in the glove so that you could pull the glove over the other hand. Having put the gloves on, it is required to touch only those objects provided for by the indications for use and conditions of the use of the gloves. **How to take the gloves off:** To take a glove off, pick it up at the level of the wrist without touching the skin of the forearm and pull it off your hand, turning it inside out. Holding the removed glove with the gloved hand, it is necessary to place the fingers of your bare hand between the glove and wrist. Remove the second glove by rolling it down the hand and put into the first glove. After use, the gloves should be disposed of, in accordance with the recommendations related to the disposal of medical waste. Wash the hands thoroughly.

■ Hartalega Sdn. Bhd., Malaysia, C-G-9, Jalan Dataran SD1, Dataran SD PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER (PRODUCER) ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: "BENOVY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhny per., liter J, office 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

IMPORTER: XXXX.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE: The established shelf life of the medical examination nitrile gloves is 3 years. Do not use after expiry date.

MANUFACTURER'S WARRANTIES. The manufacturer guarantees preservation of all the parameters and characteristics of the medical device taking into account acceptable quality level (AQL), as well as the quality of the medical gloves within all shelf life (3 years) from the date of manufacture upon the condition of package integrity, observance of transportation, storage and operation conditions in accordance with the instruction.



XX-XXXX



XXXX



Артикул: XXXXXXXXXXXXX



www.benovy.ru

В случае необходимости графические макеты упаковок медицинского изделия в различных дизайнах могут быть выполнены в универсальном варианте (для всех размеров).

Ниже приведены универсальные графические макеты упаковок медицинского изделия в различных дизайнах и отдельно увеличенный фрагмент с текстом.

Также на упаковке медицинского изделия оставлены места для информации, которая будет нанесена после получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие с учетом конкретного типа перчаток:

Количество XX пар

Импортер XXXX

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX

Дата изготовления XX-XXXX

LOT XXXX

Артикул XXXX

Штрих-код XXXXXXXXXXXXX

Соответствующая комбинация размера, артикула и штрих-кода должна быть обозначена какой-либо отметкой.

Макет упаковки медицинского изделия (универсальный), вариант исполнения №1:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: васильковый, размер: XS, S, M, L, XL.

Дизайн №1:



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: васильковый, размер: XS, S, M, L, XL.

RUS

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной инструкцией организации.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. **Как надевать перчатки:** Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надяв перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток.

Как снимать перчатки: Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. После использования перчатки необходимо утилизировать согласно правилам утилизации медицинских отходов. Тщательно вымыть руки.

Харталега Сдн. Бхд., Малайзия, C-G-9, Джалан Датан SD1, Датан SD PJU 9, Бандар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «БИНОВИ», Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1 литер Ж, помещ. 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

ИМПОРТЕР: XXXX.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: Установленный срок годности медицинских смотровых нитриловых перчаток составляет 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (3 года) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile «BENOVY» nitrile, design version: Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile «BENOVY» nitrile finger textured powder free with single chlorination (beaded cuff); color: violet blue, size: XS, S, M, L, XL.

ENG

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE. Disposable gloves are designed to protect health worker's hands during the examination/treatment of a patient or for other sanitary purposes.

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE. The transportation of the device may be made by all means of transport (sea, land, railway or air transport) according to the rules of transportation, which are applied to such means of transport. During transportation, the storage conditions should not be violated. Devices should be stored in a dry place protected from direct sunlight, heat, ignition and

ultraviolet sources, as well as ozone, at temperature from 0°C to 25°C and relative humidity of air – from 65% to 85%. Care should be taken with devices stored at temperature below 15°C because they may become stiff and susceptible to deformation in case of careless use. After storage at a low temperature, gloves must be warmed to 30°C throughout the device before use. Disposal of the medical device in the Russian Federation is carried out by the medical organization as class B waste in accordance with SanPiN 2.1.3684-21 and approved guideline of the organization.

MATERIAL: nitrile.

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PUNCTURES, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTHCARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS, WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT. Preliminary hygienic treatment of your hands is required before use of the gloves (treat hands with skin antiseptic or wash with soap and water). Gloves are put on dry hands only. **How to put the gloves on:** Take a glove from the box. It is recommended to touch the bounded surface of the glove corresponding to the wrist (upper edge of the cuff). Pull on the first glove. Take the second glove with your bare hand, touching the bounded surface of the glove corresponding to the wrist. To avoid touching the skin of the forearm with a gloved hand, rotate the outer surface of the glove to be put on with folded fingers in the glove so that you could pull the glove over the other hand. Having put the gloves on, it is required to touch only those objects provided for by the indications for use and conditions of the use of the gloves. **How to take the gloves off:** To take a glove off, pick it up at the level of the wrist without touching the skin of the forearm and pull it off your hand, turning it inside out. Holding the removed glove with the gloved hand, it is necessary to place the fingers of your bare hand between the glove and wrist. Remove the second glove by rolling it down the hand and put into the first glove. After use, the gloves should be disposed of, in accordance with the recommendations related to the disposal of medical waste. Wash the hands thoroughly.

Харталега Сдн. Бхд., Малайзия, C-G-9, Джалан Датан SD1, Датан SD PJU 9, Бандар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER (PRODUCER) ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: «BENOVY» Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy per., liter J, office 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

IMPORTER: XXXX.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE. The established shelf life of the medical examination nitrile gloves is 3 years. Do not use after expiry date.

MANUFACTURER'S WARRANTIES. The manufacturer guarantees preservation of all the parameters and characteristics of the medical device taking into account acceptable quality level (AQL), as well as the quality of the medical gloves within all shelf life (3 years) from the date of manufacture upon the condition of package integrity, observance of transportation, storage and operation conditions in accordance with the instruction.



XX-XXXX
XXXX



www.benovy.ru

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: фиолетовый, размер: XS, S, M, L, XL.

Дизайн №2:



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные "BENOVY" нитриловые, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные "BENOVY" нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: фиолетовый, размер: XS, S, M, L, XL.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Как надевать перчатки

Как снимать перчатки

УПОМОЩЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПОСТАВЩИКА НА ТЕРРИТОРИИ РФ

ИМПОРТЕР

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ENG

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" nitrile, design version: Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" nitrile finger textured powder free with single chlorination (beaded cuff), color: dark blue, size: XS, S, M, L, XL.

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE

MATERIAL

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PUNCTURES, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTHCARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT

How to put the glove on

How to take the glove off

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER (PRODUCER) ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

IMPORTER

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE

MANUFACTURER'S WARRANTIES



XX-XXXX



XXXX



www.benovy.ru

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: темно-синий, размер: XS, S, M, L, XL.

Дизайн №3:



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией (манжета с валиком); цвет: темно-синий, размер: XS, S, M, L, XL.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной инструкцией организации.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. **Как надевать перчатки:** Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. **Как снимать перчатки:** Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. После использования перчатки необходимо утилизировать согласно правилам утилизации медицинских отходов. Тщательно вымыть руки.

Харталега Сдн. Бхд., Малайзия, С-Г-9, Джалан Датан SD1, Датан SD PUJ 9, Бансар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «БИНОВИ», Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1 литер Ж, помещ. 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

ИМПОРТЕР: XXXX.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: Установленный срок годности медицинских смотровых нитриловых перчаток составляет 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (3 года) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" nitrile, design version: Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" nitrile finger textured powder free with single chlorination (beaded cuff); color: cobalt blue, size: XS, S, M, L, XL.

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE. Disposable gloves are designed to protect health worker's hands during the examination/treatment of a patient or for other sanitary purposes.

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE. The transportation of the device may be made by all means of transport (sea, land, railway or air transport) according to the rules of transportation, which are applied to such means of transport. During transportation, the storage conditions should not be violated. Devices should be stored in a dry place protected from direct sunlight, heat, ignition and ultraviolet sources, as well as ozone, at temperature from 0°C to 25°C and relative humidity of air – from 65% to 85%. Care should be taken with devices stored at temperature below 15°C because they may become stiff and susceptible to deformation in case of careless use. After storage at a low temperature, gloves must be warmed to 30°C throughout the device before use. Disposal of the medical device in the Russian Federation is carried out by the medical organization as class B waste in accordance with SanPIN 2.1.3684-21 and approved guideline of the organization.

MATERIAL: nitrile.

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PUNCTURES, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTHCARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS, WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT. Preliminary hygienic treatment of your hands is required before use of the gloves (treat hands with skin antiseptic or wash with soap and water). Gloves are put on dry hands only. **How to put the gloves on:** Take a glove from the box. It is recommended to touch the bounded surface of the glove corresponding to the wrist (upper edge of the cuff). Pull on the first glove. Take the second glove with your bare hand, touching the bounded surface of the glove corresponding to the wrist. To avoid touching the skin of the forearm with a gloved hand, rotate the outer surface of the glove to be put on with folded fingers in the glove so that you could pull the glove over the other hand. Having put the gloves on, it is required to touch only those objects provided for by the indications for use and conditions of the use of the gloves. **How to take the gloves off:** To take a glove off, pick it up at the level of the wrist without touching the skin of the forearm and pull it off your hand, turning it inside out. Holding the removed glove with the gloved hand, it is necessary to place the fingers of your bare hand between the glove and wrist. Remove the second glove by rolling it down the hand and put into the first glove. After use, the gloves should be disposed of, in accordance with the recommendations related to the disposal of medical waste. Wash the hands thoroughly.

Hartalega Sdn. Bhd., Malaysia, C-G-9, Jalan Dataran SD1, Dataran SD PUJ 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER (PRODUCER) ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: "BENOVY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy per., liter J, office 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

IMPORTER: XXXX.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE: The established shelf life of the medical examination nitrile gloves is 3 years. Do not use after expiry date.

MANUFACTURER'S WARRANTIES. The manufacturer guarantees preservation of all the parameters and characteristics of the medical device taking into account acceptable quality level (AQL), as well as the quality of the medical gloves within all shelf life (3 years) from the date of manufacture upon the condition of package integrity, observance of transportation, storage and operation conditions in accordance with the instruction.



XX-XXXX
XXXX



www.benovy.ru

Макет упаковки медицинского изделия (универсальный), вариант исполнения №2:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» Moisturizing (с увлажнителем) нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией с внутренним увлажняющим покрытием Oatmeal (манжета с валиком); цвет: серо-голубой, размер: XS, S, M, L, XL.

Дизайн №2:



Дизайн №3:



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» нитриловые, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные «BENOVY» Moisturizing (с увлажнителем) нитриловые текстурированные на пальцах неопудренные с однократной хлоринацией с внутренним увлажняющим покрытием Oatmeal (манжета с валиком); цвет: серо-голубой, размер: XS, S, M, L, XL.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей.

ПОКРЫТИЕ OATMEAL – внутреннее увлажняющее покрытие перчаток коллоидной овсяной мукой. Концентрированный белково-крахмальный комплекс, обогащенный бета-глюканом овса, способен проникать в кожу, формируя увлажняющую пленку, и оказывать успокаивающий эффект для более комфортного ношения перчаток и облегчения различных кожных раздражений.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, источников тепла, возгорания, ультрафиолетового излучения, а также озона, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и утвержденной инструкцией организации.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА КОЖЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. **Как надевать перчатки:** Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. **Как снимать перчатки:** Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. После использования перчатки необходимо утилизировать согласно правилам утилизации медицинских отходов. Тщательно вымыть руки.

■ Hartalega Sdn. Bhd., Малайзия, C-G-9, Джалан Датаран SD1, Датаран SD PJU 9, Бандар Сри Дамансара, 52200 Куала-Лумпур, Малайзия.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «БИНОВИ», Россия, 194292, город Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., д. 1 литер Ж, помещ. 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

ИМПОРТЕР: XXXX.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует обязательным требованиям ГОСТ XXXX.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: Установленный срок годности медицинских смотровых нитриловых перчаток составляет 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Производитель (изготовитель) гарантирует сохранность всех параметров и характеристик медицинского изделия с учетом приемлемого уровня качества (AQL), а также качество медицинских перчаток в течение всего срока годности (3 года) с даты изготовления, при условии целостности упаковки, соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" nitrile, design version: Gloves medical diagnostic (examination) disposable non-sterile "BENOVY" Moisturizing (with moisturizer) nitrile finger textured powder free with single chlorination with inner Oatmeal moisturizing coating (beaded cuff), color: dawn blue, size: XS, S, M, L, XL.

PURPOSE OF THE MEDICAL DEVICE. Disposable gloves are designed to protect health worker's hands during the examination/treatment of a patient or for other sanitary purposes.

OATMEAL COATING is internal moisturising coating of gloves with colloidal oatmeal. The concentrated protein-starch complex, enriched with oat beta-glucan, is able to penetrate the skin to form a moisturising film and provide a soothing effect for a more comfortable glove-wearing experience and relief of various skin irritations.

TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL CONDITIONS OF THE MEDICAL DEVICE. The transportation of the device may be made by all means of transport (sea, land, railway or air transport) according to the rules of transportation, which are applied to such means of transport. During transportation, the storage conditions should not be violated. Devices should be stored in a dry place protected from direct sunlight, heat, ignition and ultraviolet sources, as well as ozone, at temperature from 0°C to 25°C and relative humidity of air – from 65% to 85%. Care should be taken with devices stored at temperature below 15°C because they may become stiff and susceptible to deformation in case of careless use. After storage at a low temperature, gloves must be warmed to 30°C throughout the device before use. Disposal of the medical device in the Russian Federation is carried out by the medical organization as class B waste in accordance with SanPIN 2.1.3684-21 and approved guideline of the organization.

MATERIAL: nitrile.

ATTENTION! GLOVES DO NOT GUARANTEE 100% HAND PROTECTION AGAINST PUNCTURES, CUTS AND DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO CHEMICALS. IT IS RECOMMENDED TO CONSULT HEALTHCARE PROFESSIONAL IN THE EVENT OF DERMAL HYPERSENSITIVITY REACTIONS, WHEN USING THE DEVICE.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRODUCT. Preliminary hygienic treatment of your hands is required before use of the gloves (treat hands with skin antiseptic or wash with soap and water). Gloves are put on dry hands only. **How to put the gloves on:** Take a glove from the box. It is recommended to touch the bounded surface of the glove corresponding to the wrist (upper edge of the cuff). Pull on the first glove. Take the second glove with your bare hand, touching the bounded surface of the glove corresponding to the wrist. To avoid touching the skin of the forearm with a gloved hand, rotate the outer surface of the glove to be put on with folded fingers in the glove so that you could pull the glove over the other hand. Having put the gloves on, it is required to touch only those objects provided for by the indications for use and conditions of the use of the gloves. **How to take the gloves off:** To take a glove off, pick it up at the level of the wrist without touching the skin of the forearm and pull it off your hand, turning it inside out. Holding the removed glove with the gloved hand, it is necessary to place the fingers of your bare hand between the glove and wrist. Remove the second glove by rolling it down the hand and put into the first glove. After use, the gloves should be disposed of, in accordance with the recommendations related to the disposal of medical waste. Wash the hands thoroughly.

■ Hartalega Sdn. Bhd., Malaysia, C-G-9, Jalan Dataran SD1, Dataran SD PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER (PRODUCER) ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: "BENOVY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy per., liter J, office 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

IMPORTER: XXXX.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE: The established shelf life of the medical examination nitrile gloves is 3 years. Do not use after expiry date.

MANUFACTURER'S WARRANTIES. The manufacturer guarantees preservation of all the parameters and characteristics of the medical device taking into account acceptable quality level (AQL), as well as the quality of the medical gloves within all shelf life (3 years) from the date of manufacture upon the condition of package integrity, observance of transportation, storage and operation conditions in accordance with the instruction.



XX-XXXX

XXXX



www.benovy.ru



Всего прошито и скреплено
печатью 24 листа /ОВ/
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ШЕВЧУК С.А.