


Фотографические изображения

Набор модульных стент-графтов Алёна по ТУ 32.50.22-026-01897989-2021



Стент-графт для аорты, с системой доставки L 7,0 см., Ø 3,0 см.

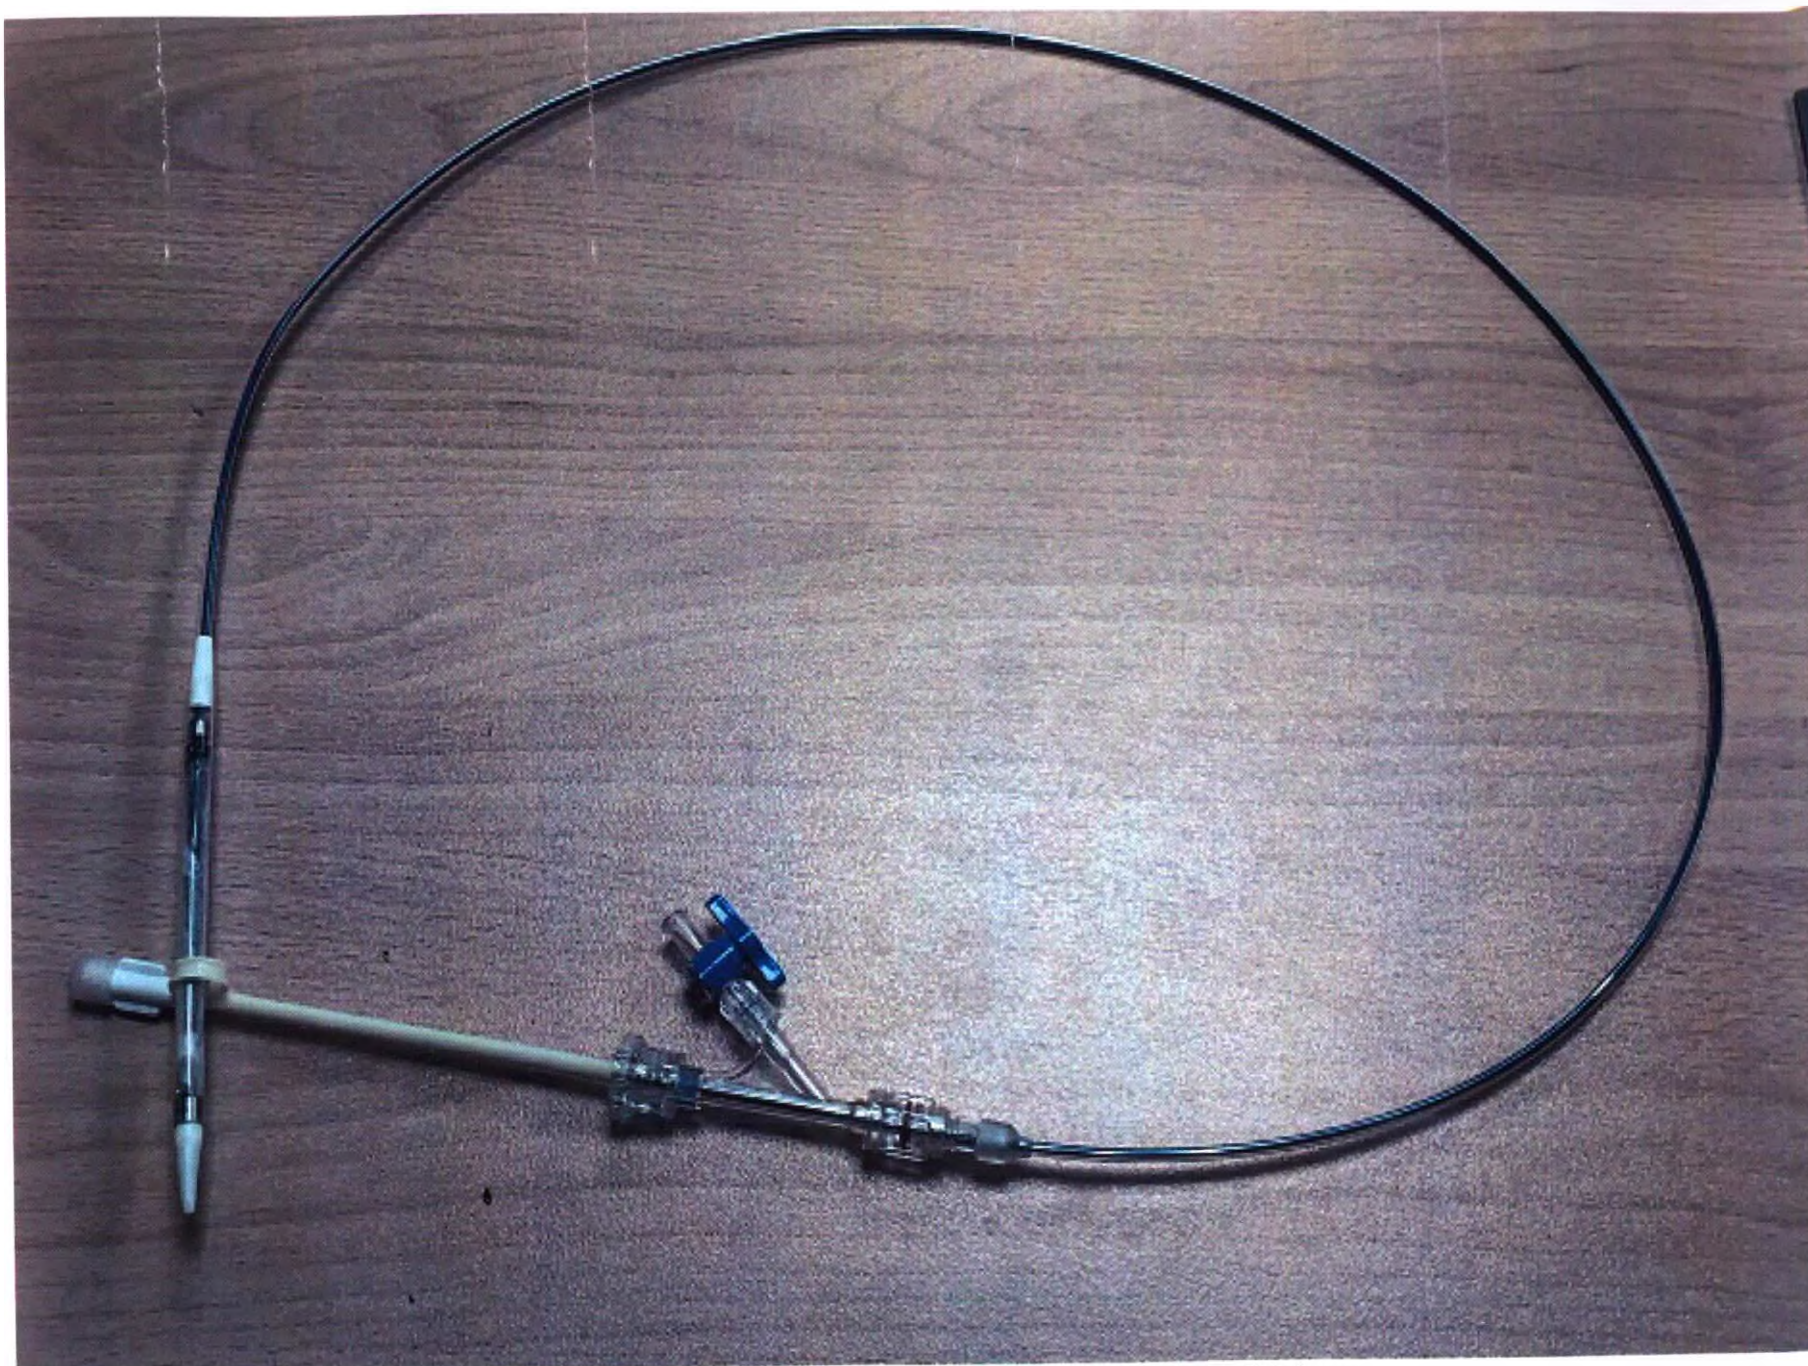


Стент-графт для аорты, с системой доставки L 7,0 см., Ø 3,0 см.



Стент-графт для аорты, с системой доставки L 8,0 см, Ø 2,0 см.



Стент-графт для аорты, с системой доставки L 8,0 см, Ø 2,0 см.

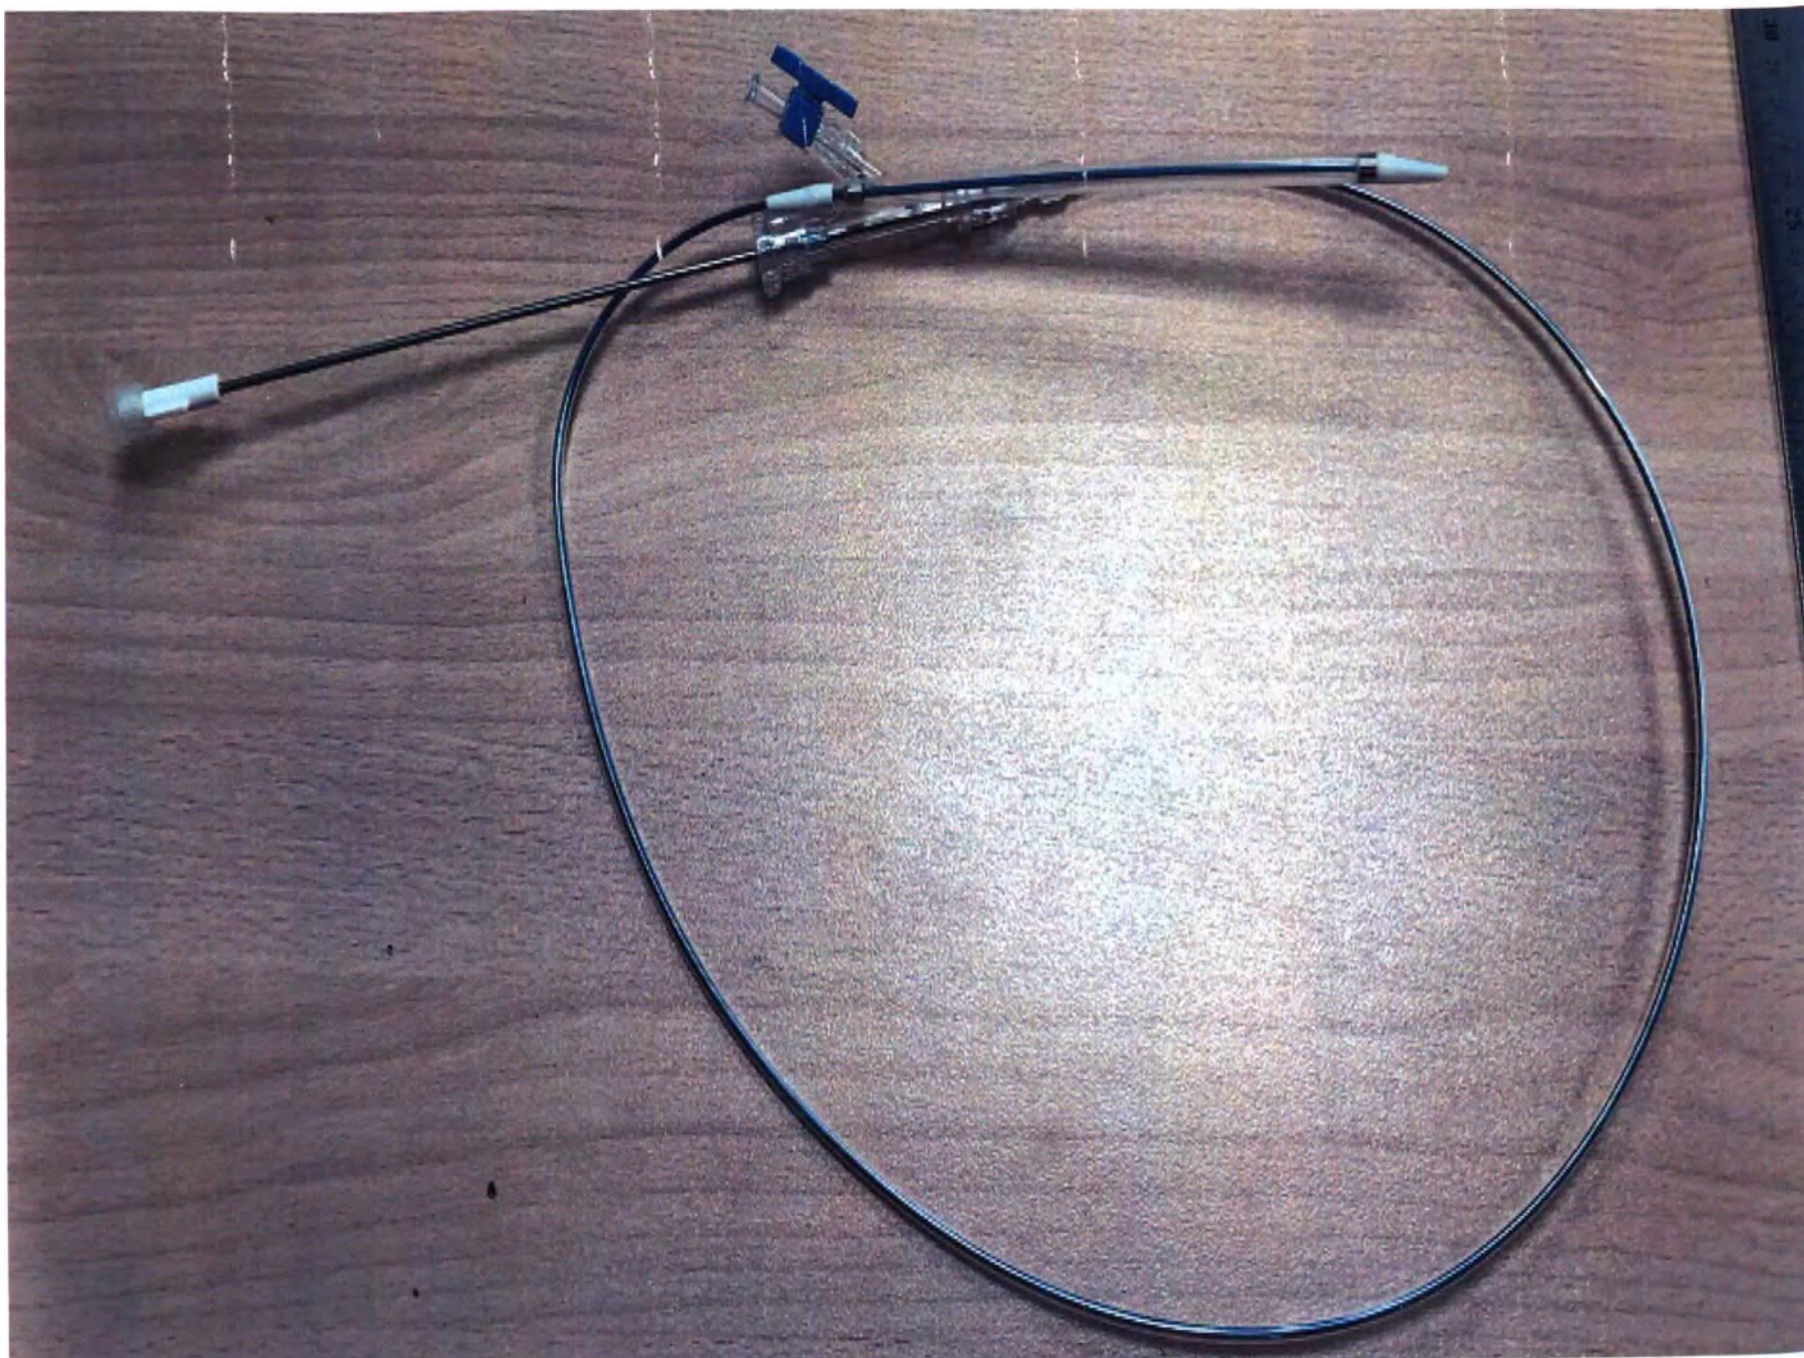

Стент-графт для аорты, с системой доставки L 10,0 см., Ø 4,0 см.



Стент-графт для аорты, с системой доставки L 10,0 см., Ø 4,0 см.

Набор модульных стент-графтов Алёна по ТУ 32.50.22-026-01897989-2021
Стент-графт для аорты, с системой доставки
L 7,0 см., Ø 3,0 см. ☒ L 8,0 см., Ø 2,0 см. ☐ L 10,0 см., Ø 4,0 см. ☐

СТЕНТ-ГРАФТ

НЕТОКСИЧНО



РУ № _____ от _____

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России

197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Ленинградская, д. 70
тел. (812) 596-84-62, факс (812) 596-67-05
info@rcrst.ru


24.05.2021 23.05.2026

LOT 240521AO




Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова


Пример нанесения маркировки на стент-графт для аорты, с системой доставки

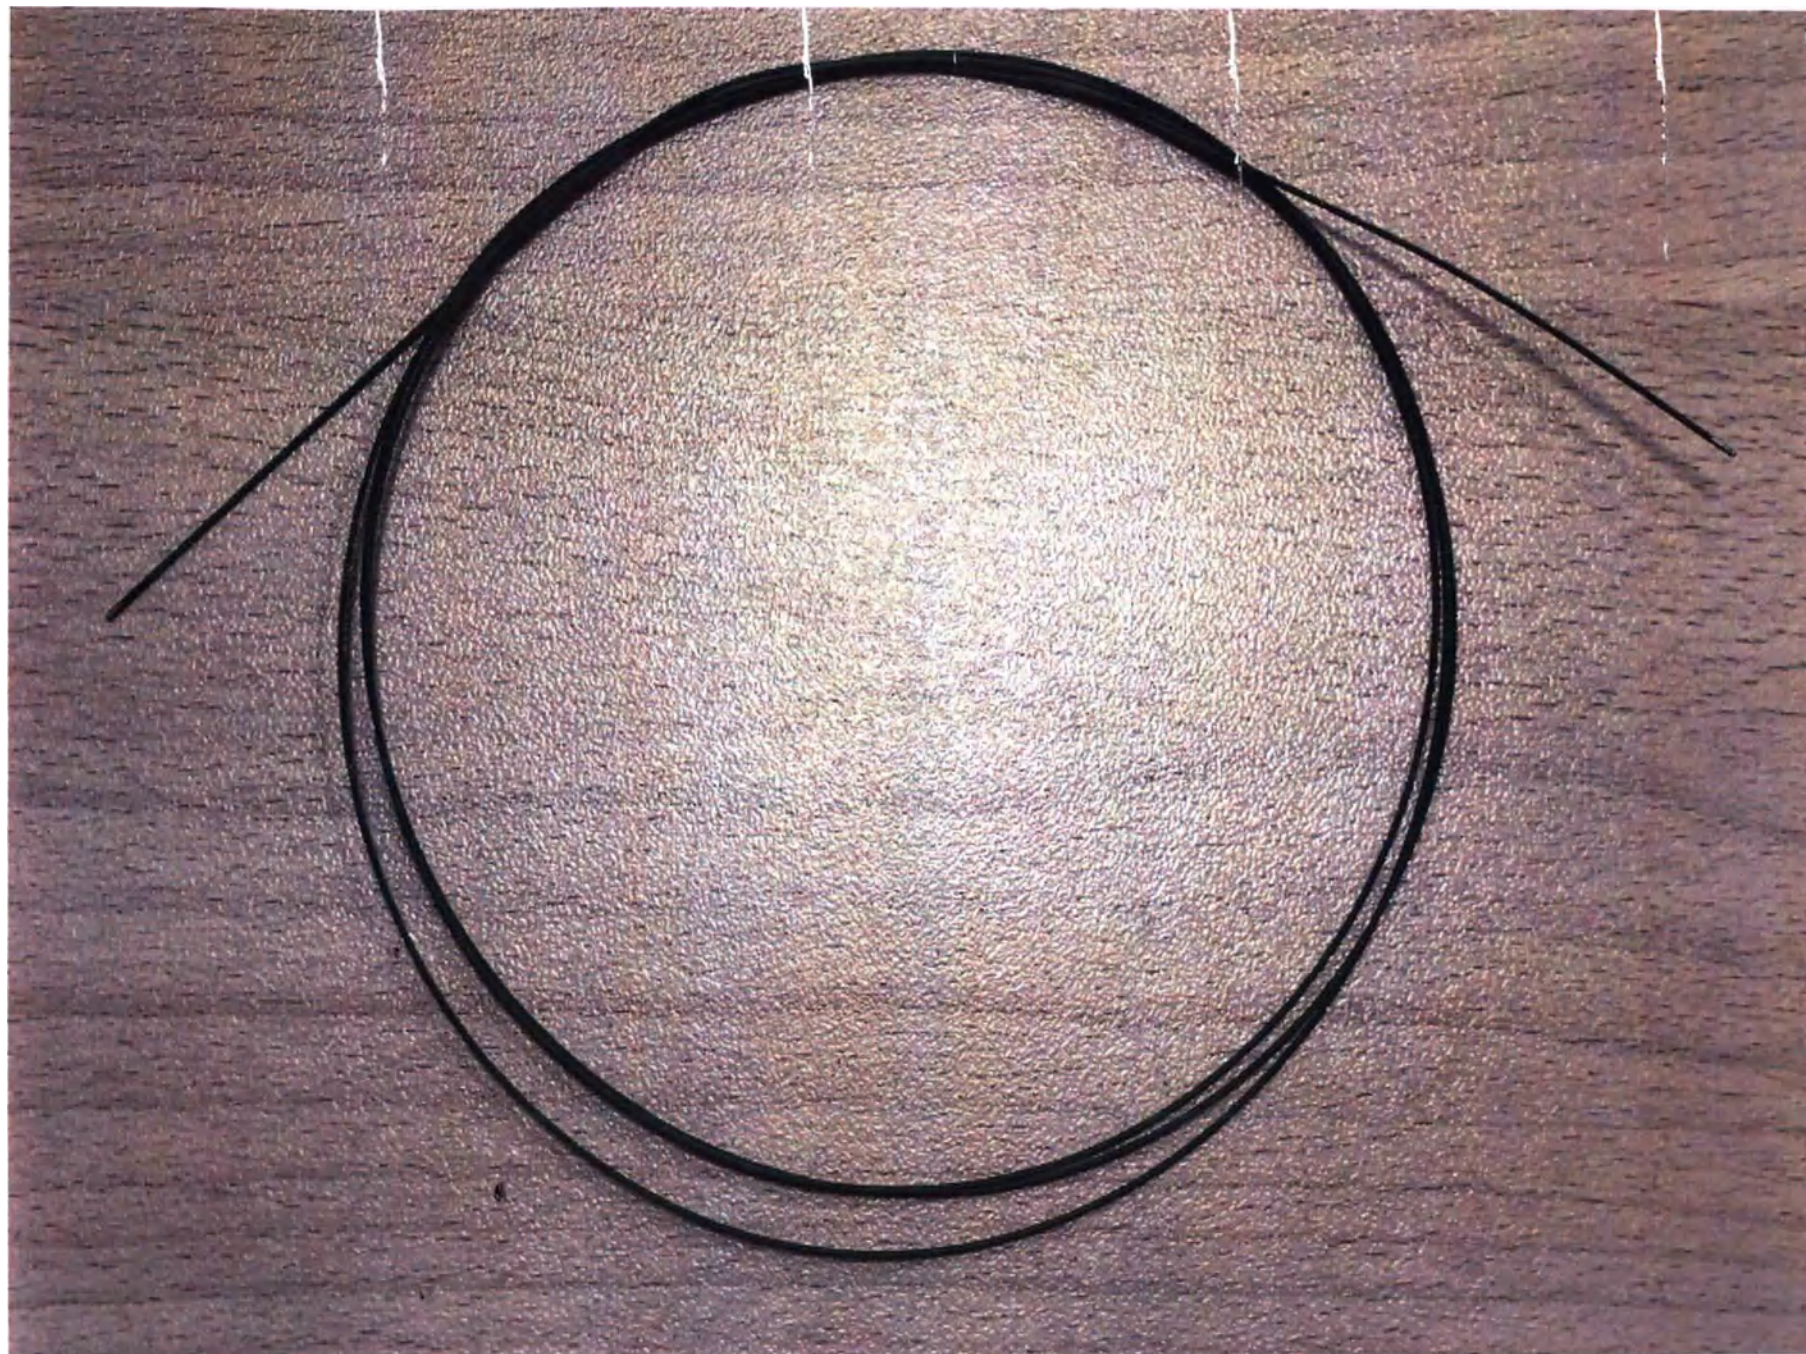

Проводник L 150 см., Ø 0,08 см.

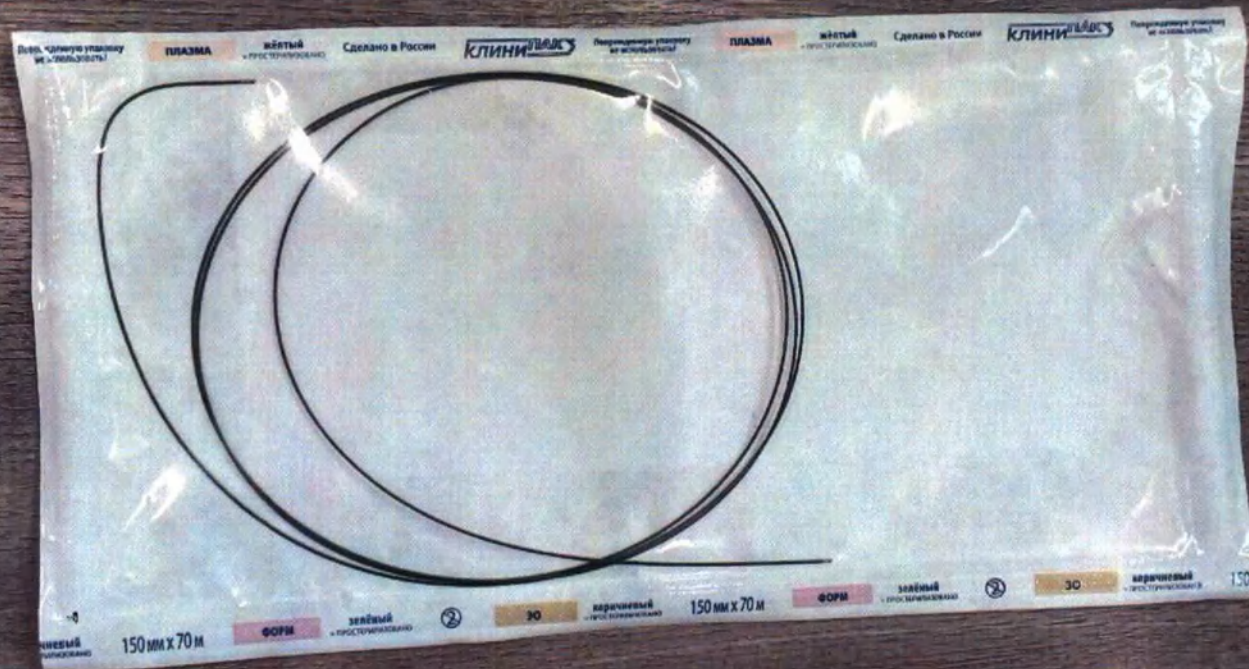


Проводник L 150 см., Ø 0,08 см.

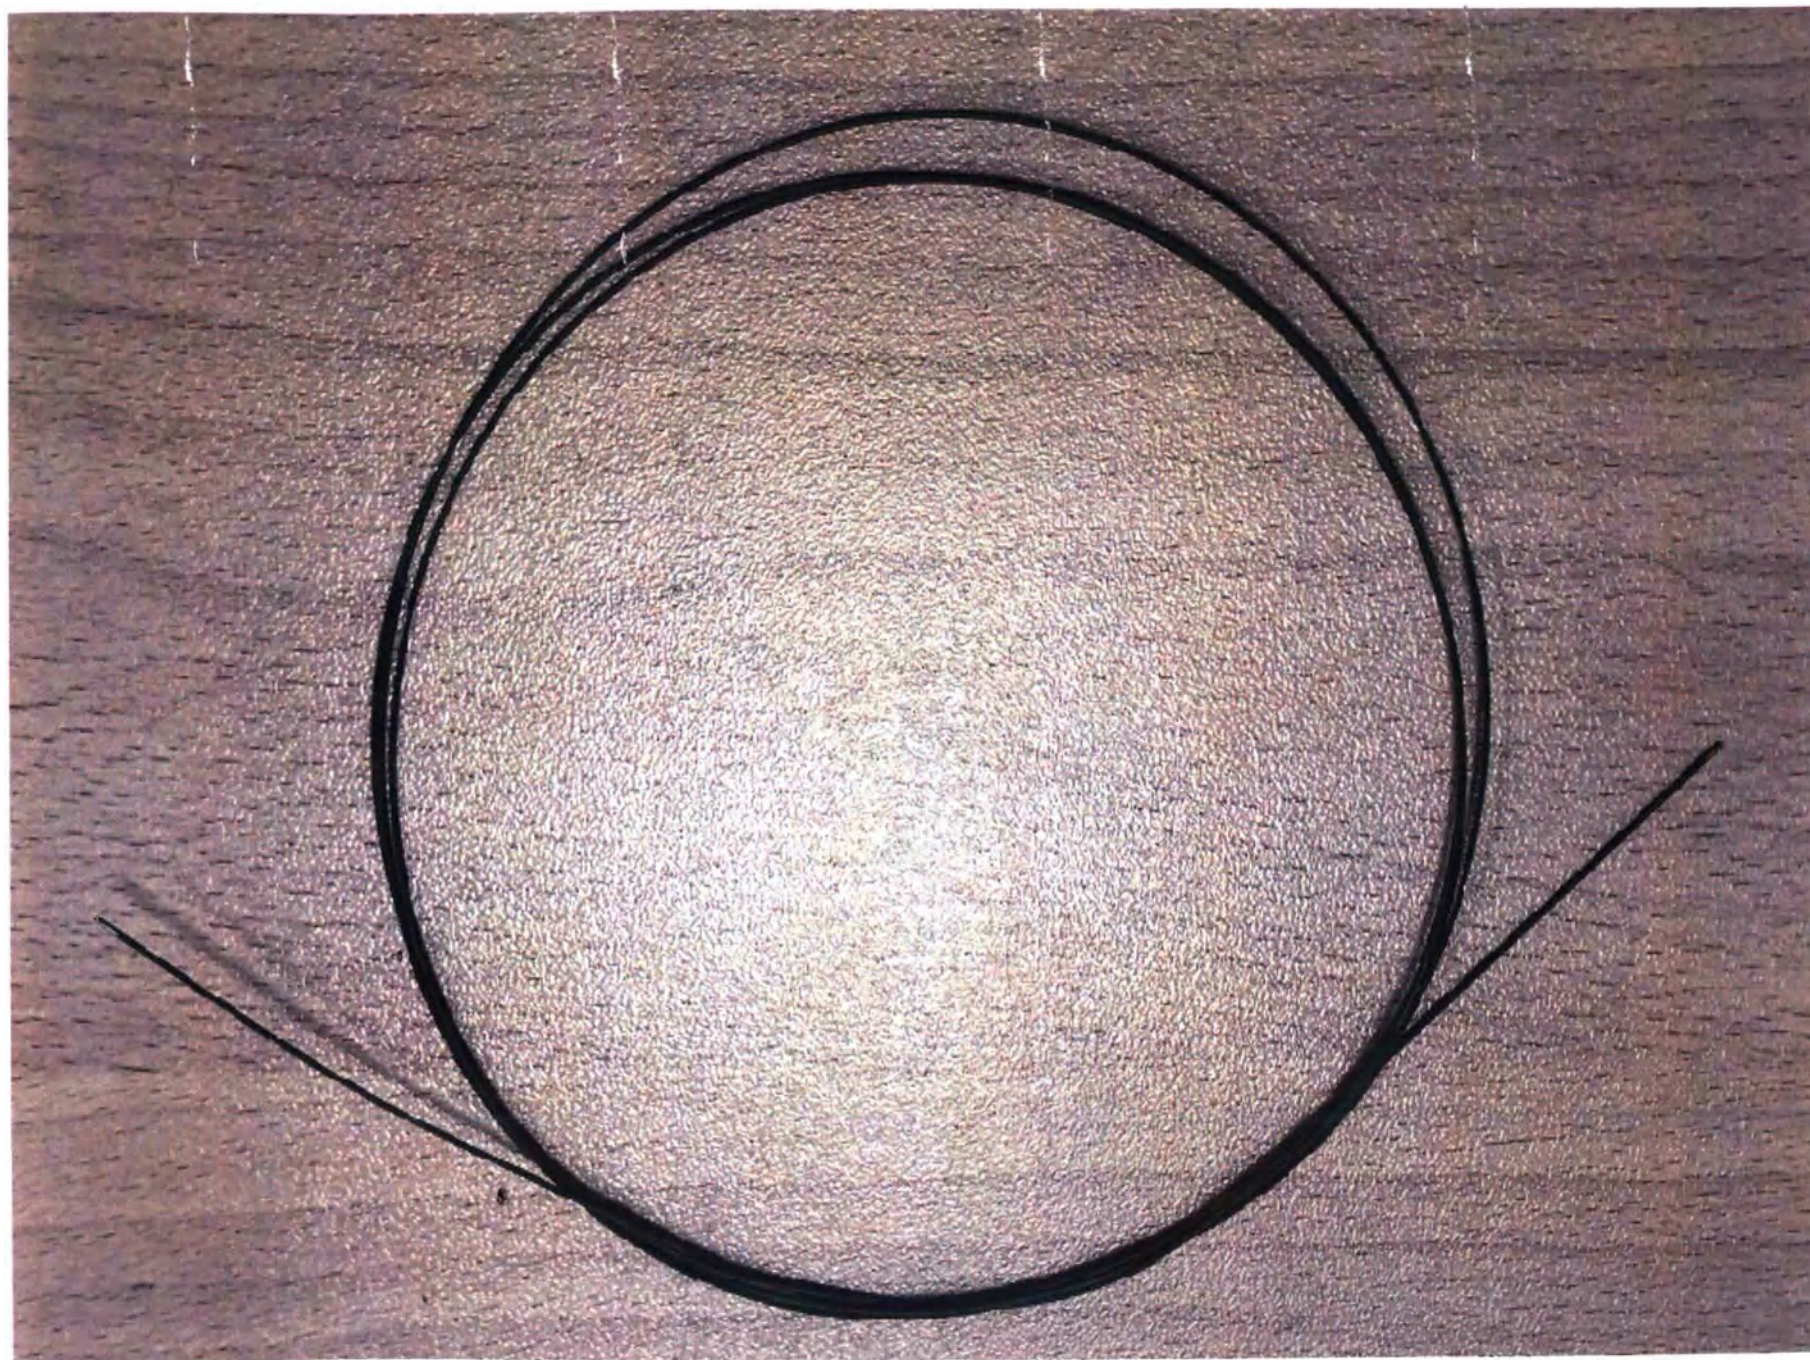


Проводник L 150 см., $\varnothing$ 0,09 см.



Проводник L 150 см., Ø 0,09 см.

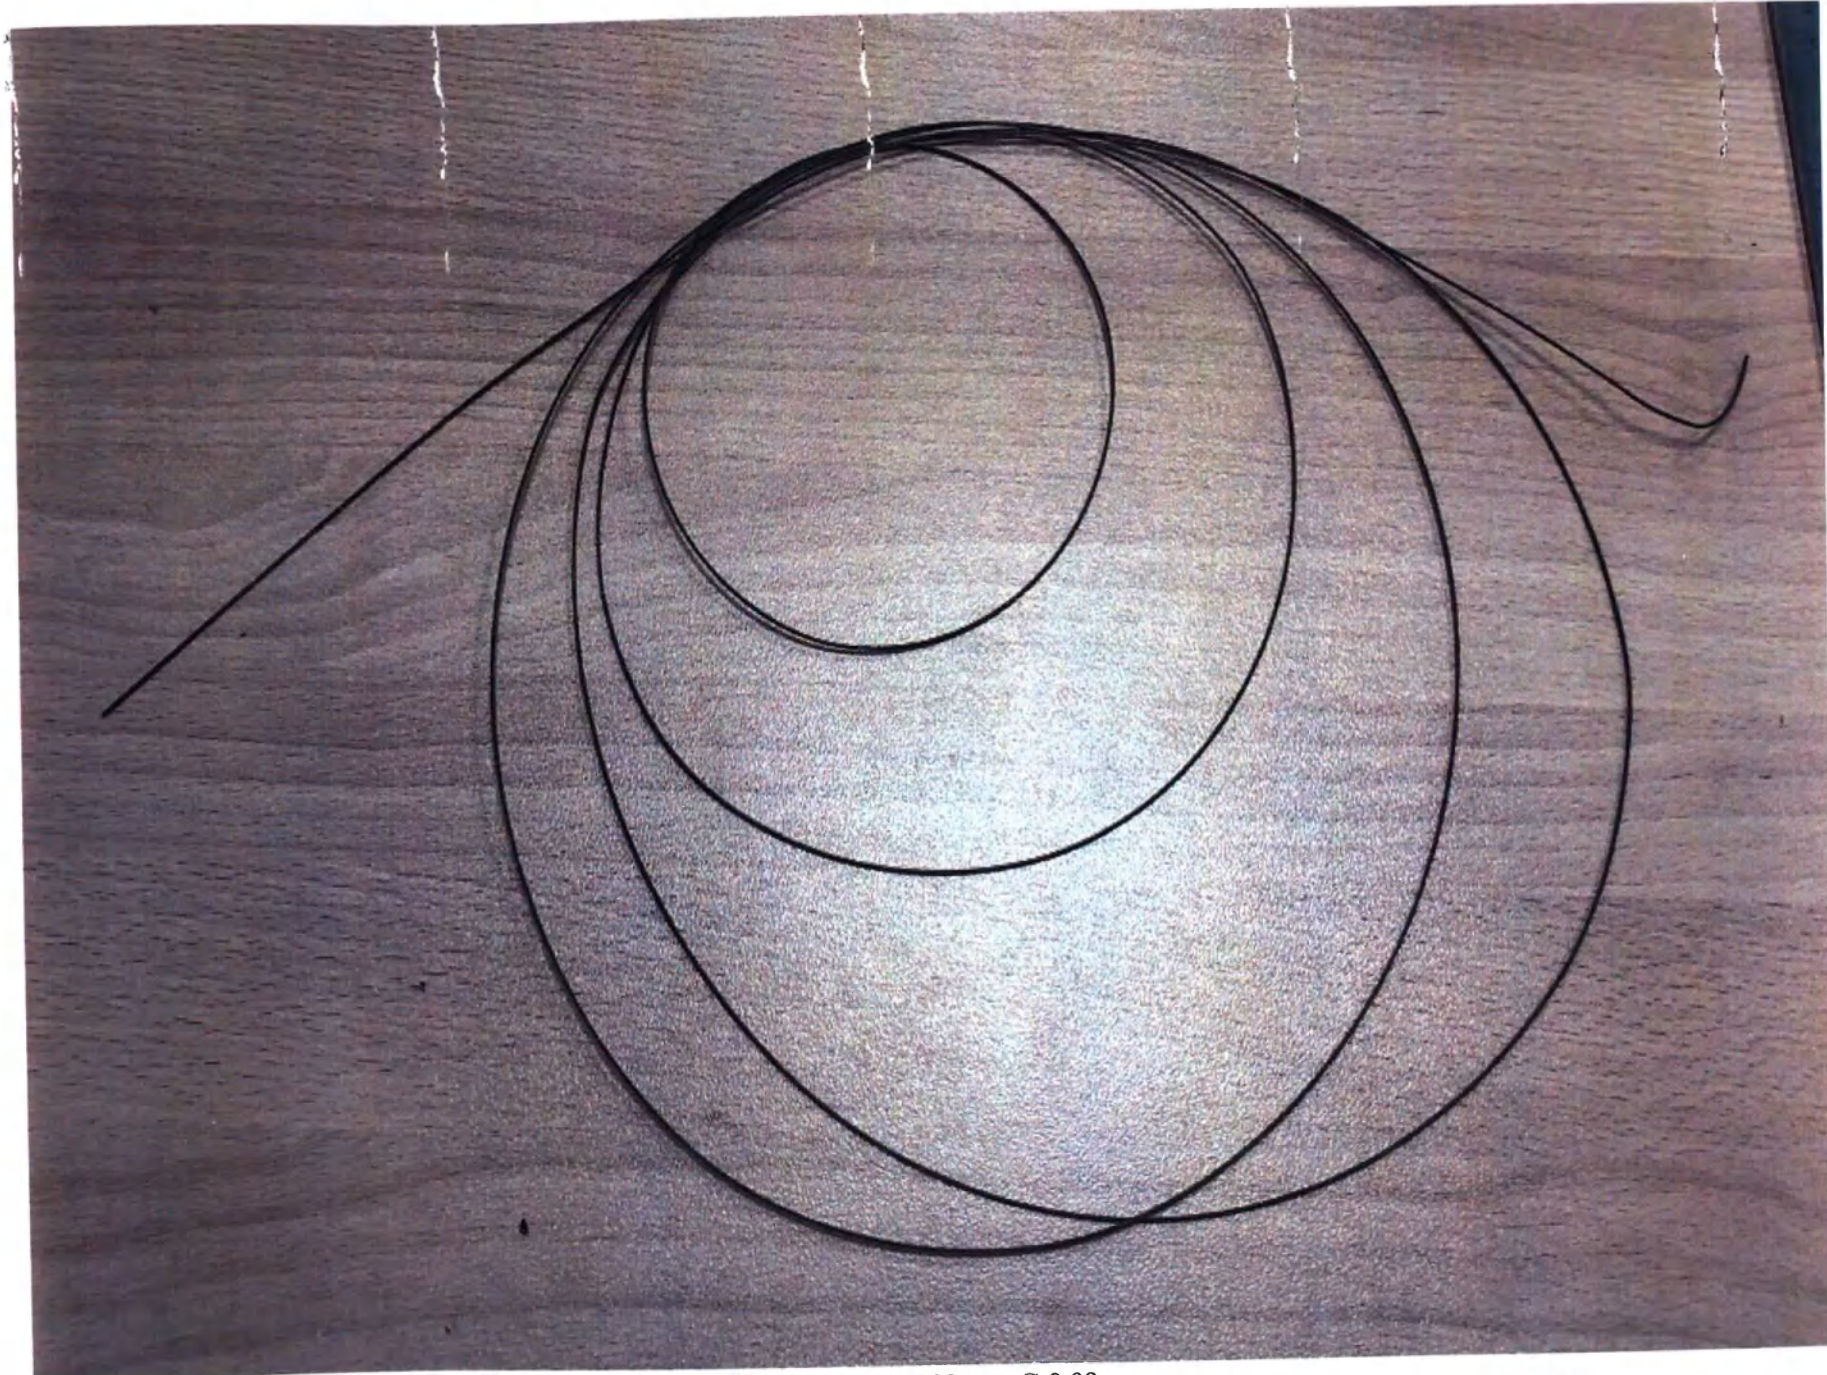

Проводник L 300 см., Ø 0,09 см.

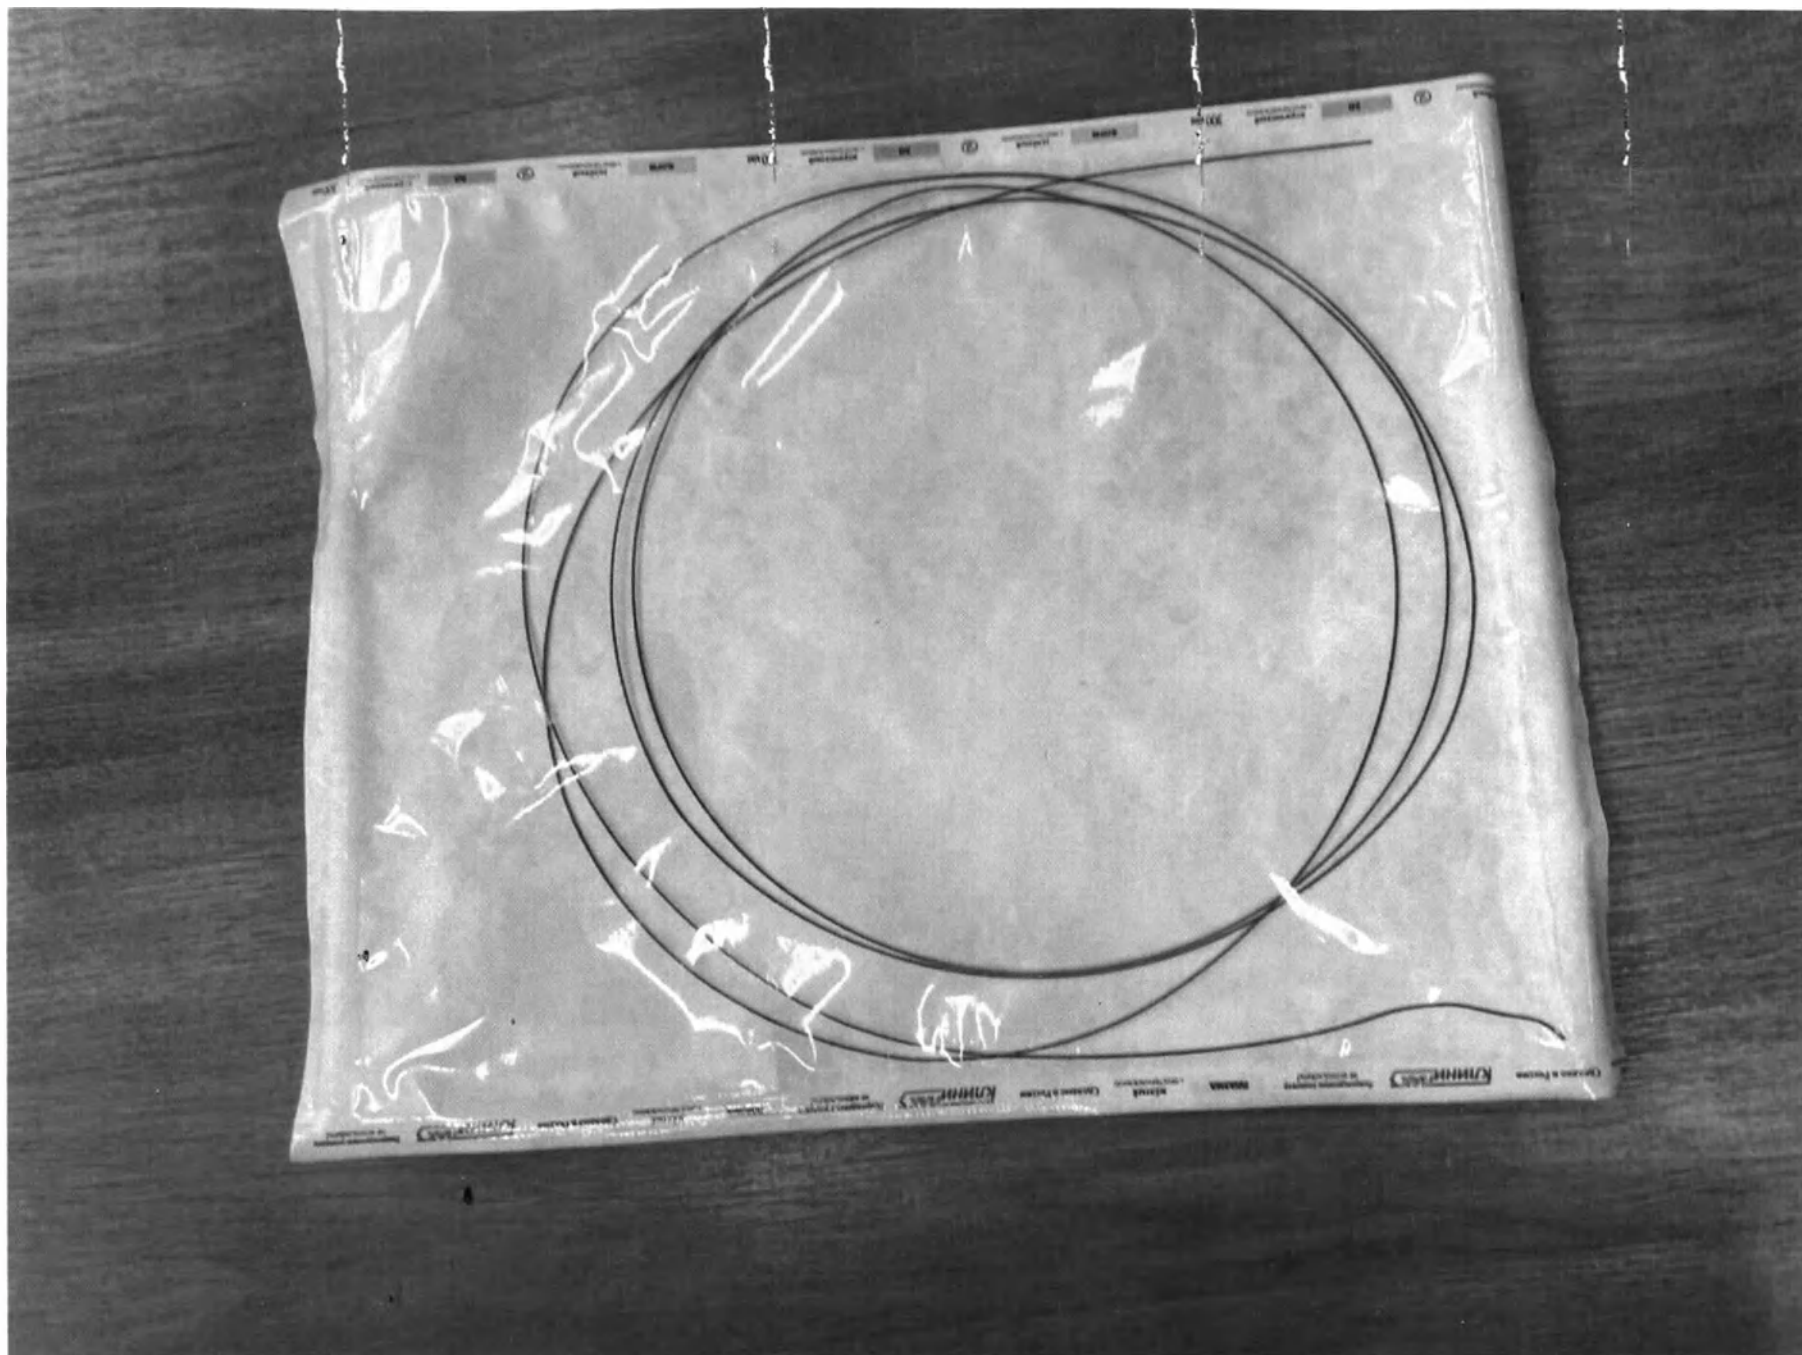

Проводник L 300 см., Ø 0,09 см.

Набор модульных стент-графтов Алёна по ТУ 32.50.22-026-01897989-2021

Стент-графт для аорты, с системой доставки

L 7,0 см., Ø 3,0 см. ☐ L 8,0 см., Ø 2,0 см. ☐ L 10,0 см., Ø 4,0 см. ☐

Проводник

L 150 см., Ø 0,08 см. ☐ L 150 см., Ø 0,09 см. ☐ L 300 см., Ø 0,09 см. ☐

Стикер – 4 шт.

Инструкция по применению



нетоксично

РУ № _____ от _____



ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России

197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Ленинградская, д. 70
тел. (812) 596-84-62, факс (812) 596-67-05
inforrcrst.ru



24.05.2021



23.05.2026



240521AO



Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова

Макет маркировки

Набор модульных стент-графтов Алёна по ТУ 32.50.22-026-01897989-2021

Стент-графт для аорты, с системой доставки

L 7,0 см., Ø 3,0 см. ☒ L 8,0 см., Ø 2,0 см. ☐ L 10,0 см., Ø 4,0 см. ☐

Проводник

L 150 см., Ø 0,08 см. ☒ L 150 см., Ø 0,09 см. ☐ L 300 см., Ø 0,09 см. ☐

Стикер – 4 шт.

Инструкция по применению



нетоксично

РУ N° _____ от _____

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России

197758, Санкт-Петербург, поселок Глясочный, ул. Ленинградская, д. 70
тел. (812) 596-84-62, факс (812) 596-67-05
info@rcrst.ru

24.05.2021 23.05.2026

LOT 240521AO



Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий
имени академика А.М. Гранова

Пример нанесения маркировки

Набор модульных стент-графтов Алёна по ТУ 32.50.22-026-01897989-2021

Стент-графт для аорты, с системой доставки

L 7,0 см.,
Ø 3,0 см.



L 8,0 см.,
Ø 2,0 см.



L 10,0 см.,
Ø 4,0 см.



Проводник

L 150 см.,
Ø 0,08 см.



L 150 см.,
Ø 0,09 см.



L 300 см.,
Ø 0,09 см.



LOT



ФГБУ «РНИЦХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России
197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Ленинградская, д. 70
тел. (812) 596-84-62, факс (812) 596-67-05
info@rncrst.ru

РУ № _____ от _____

Макет стикера

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
«Набор модульных септ-графтов Аэлис по ТУ 32.50.22-026-01897989-2021»

2022 г.

Макет инструкции

В настоящем документе прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

(2) листов

Директор

Д.Н. Майстренко

