

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева



« 24 » марта 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Компоненты для эндопротезирования вертлужной впадины в вариантах исполнения»

2023



Рис. 1. Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размер 44EE/C)
Имеют идентичный вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размеры: 44EE/C, 46FF/C, 48GG/C

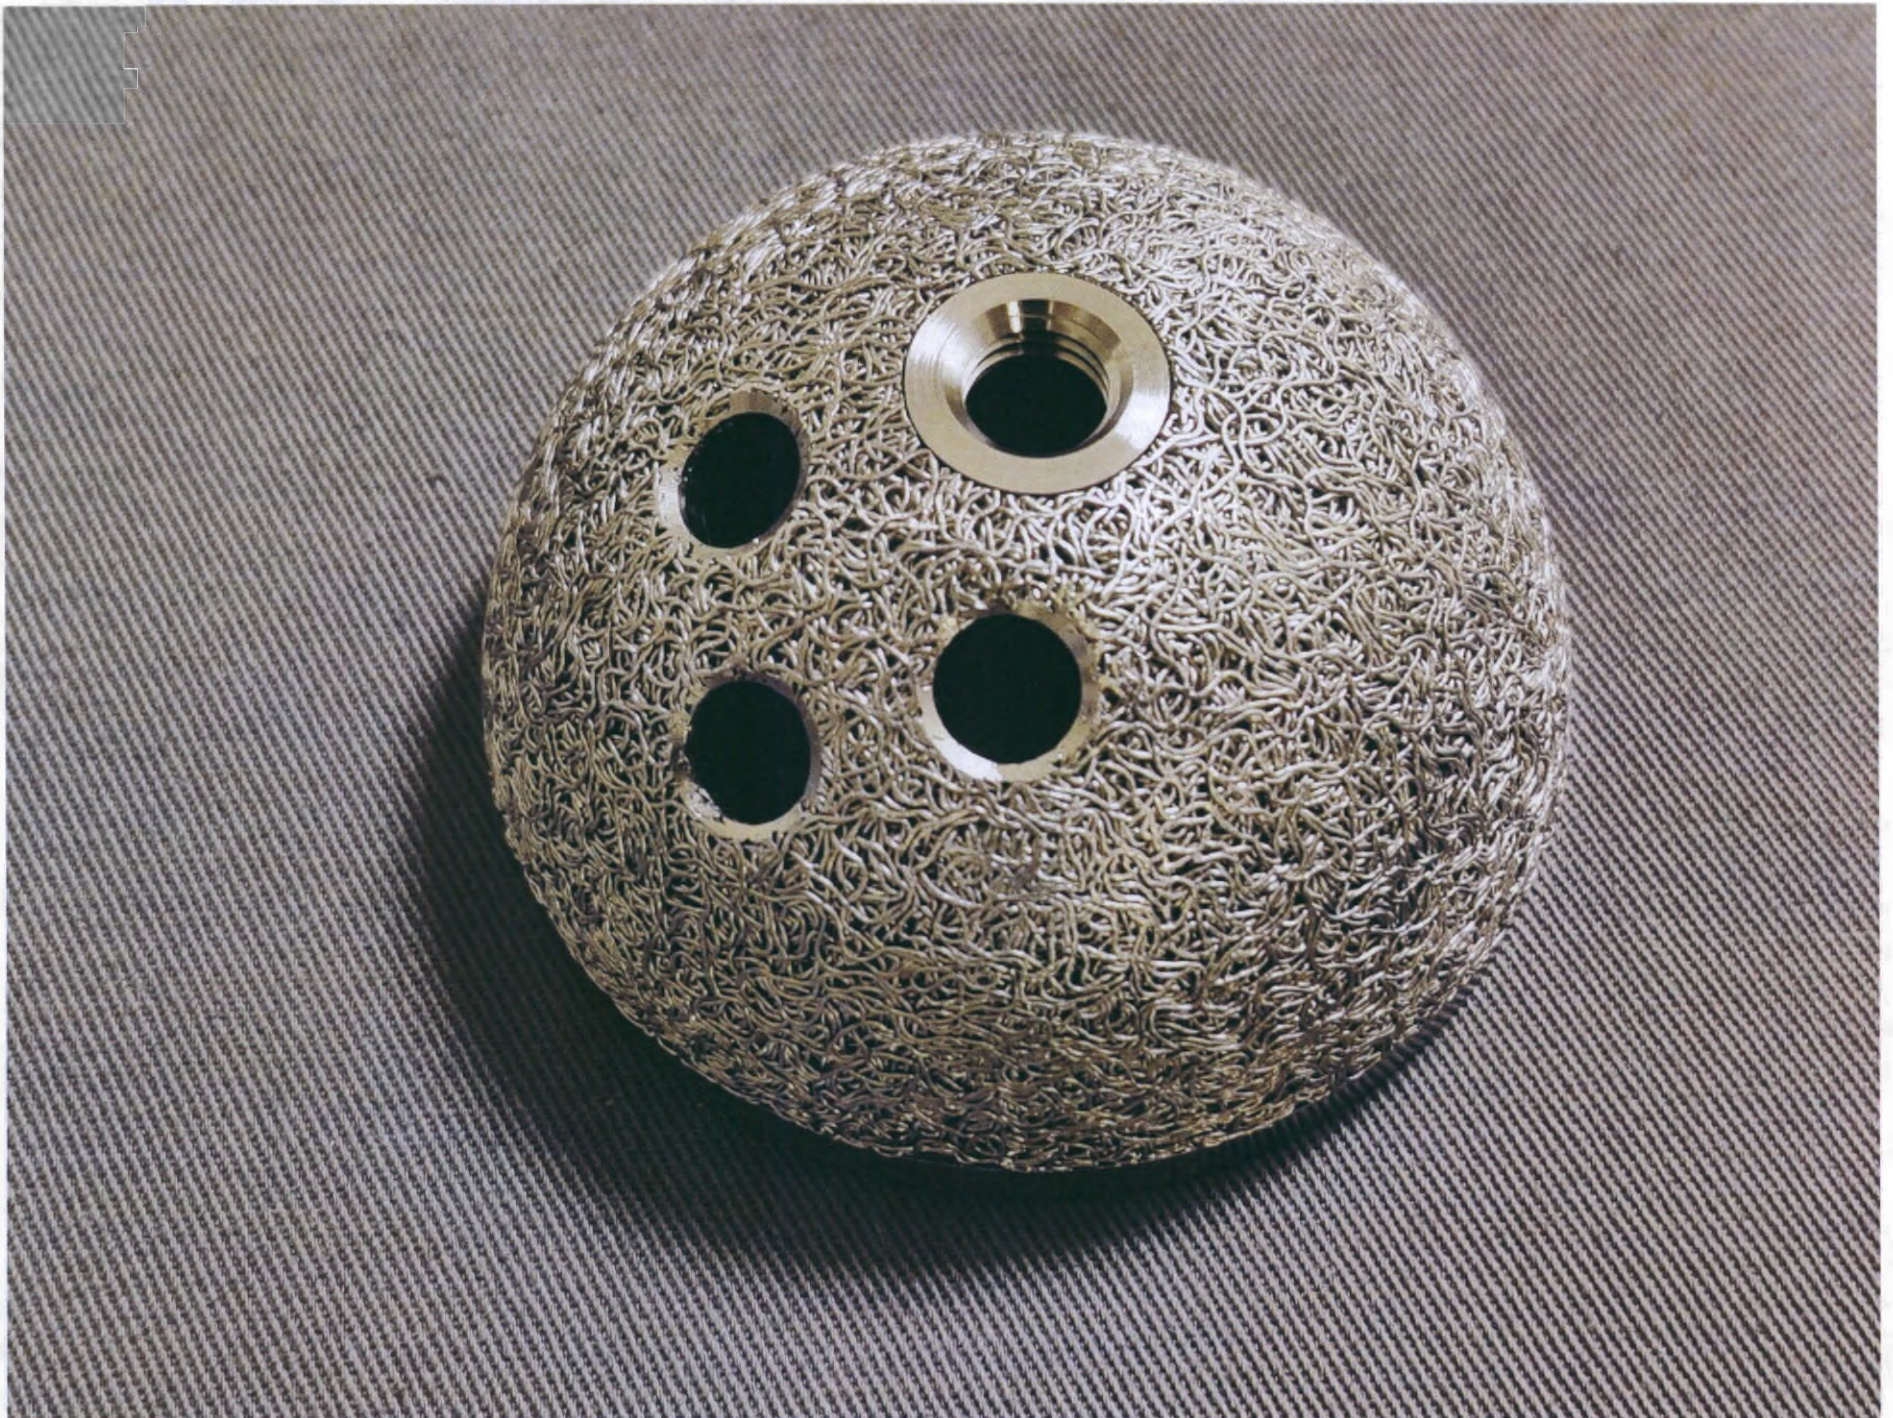


Рис. 2. Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размер 58LL/C)

Имеют идентичный вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размеры: 50HH/C, 52II/C, 54JJ/C, 56KK/C,



Рис. 3. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер 40CC/M)



Рис. 4. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер 46FF/M)



Рис. 5. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер 50НН/М)



Рис. 6. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер 54JJ/M)



Рис. 7. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер 58LL/M)



Рис. 8. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер 60MM/M)

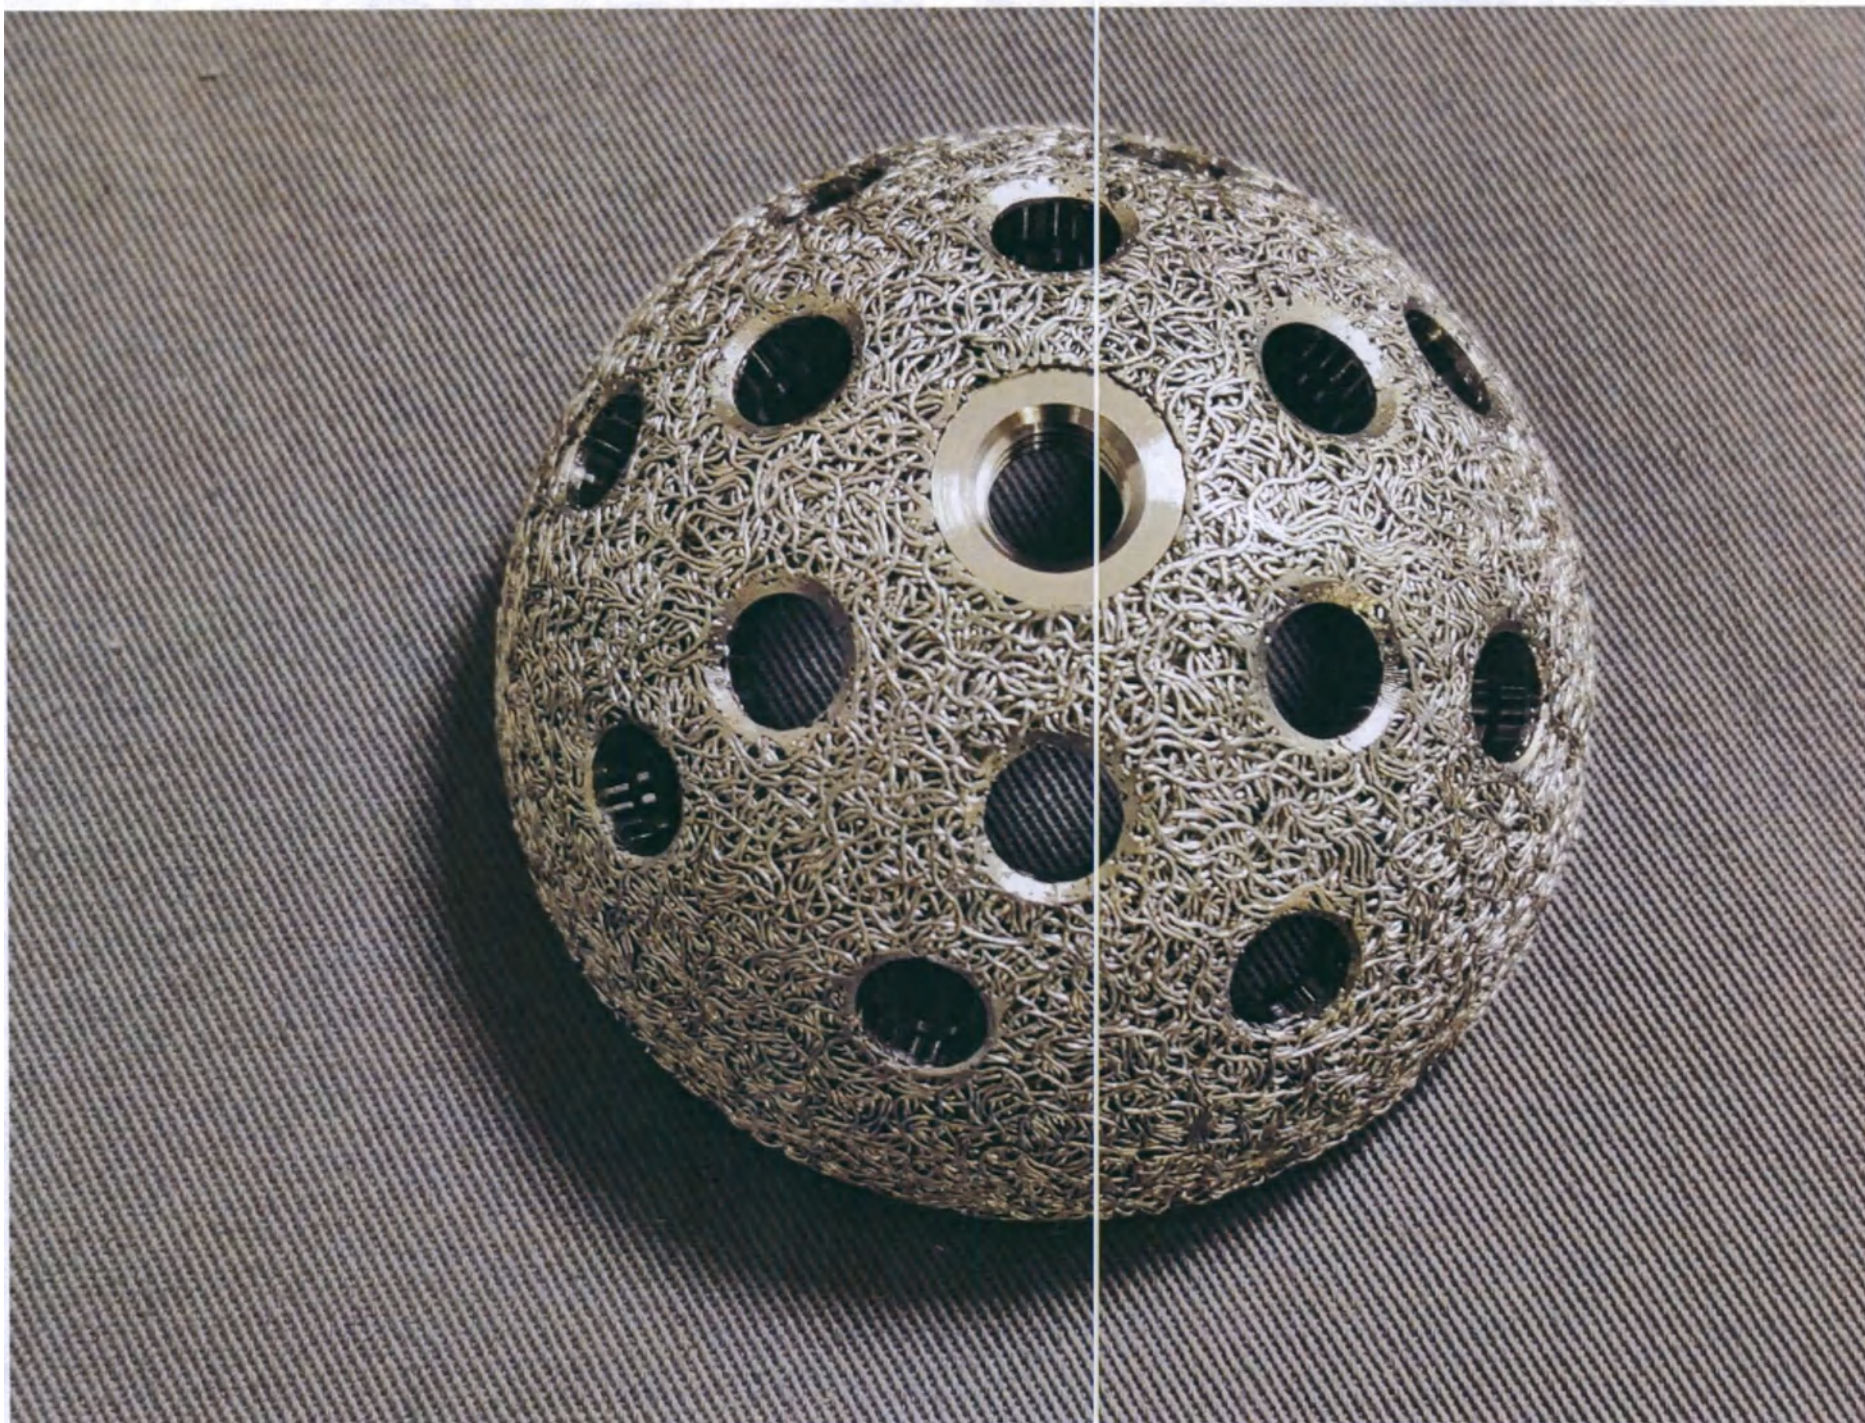


Рис. 9. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер



Рис. 10. Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый (представлено изображение Компонент вертлужный Fiber Metal многодырчатый, размер 6400/М)



**Рис. 11. Винт костный FM-SC, диаметр 6,5 мм (представлено изображение Винт костный FM-SC, диаметр 6,5 мм, длина 25 мм.)
Имеют идентичный вид, отличаются размерным рядом: Винт костный FM-SC, диаметр 6,5 мм, длины: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм.**



Рис. 12. Пробка ацетабулярная полюсная FM-PL/H




Рис. 13. Пробка ацетабулярная винтовая FM-PL/S (3 штуки в упаковке)



Рис. 14. Пример маркировки стерильной упаковки



Рис. 15. Пример маркировки стерильной упаковки

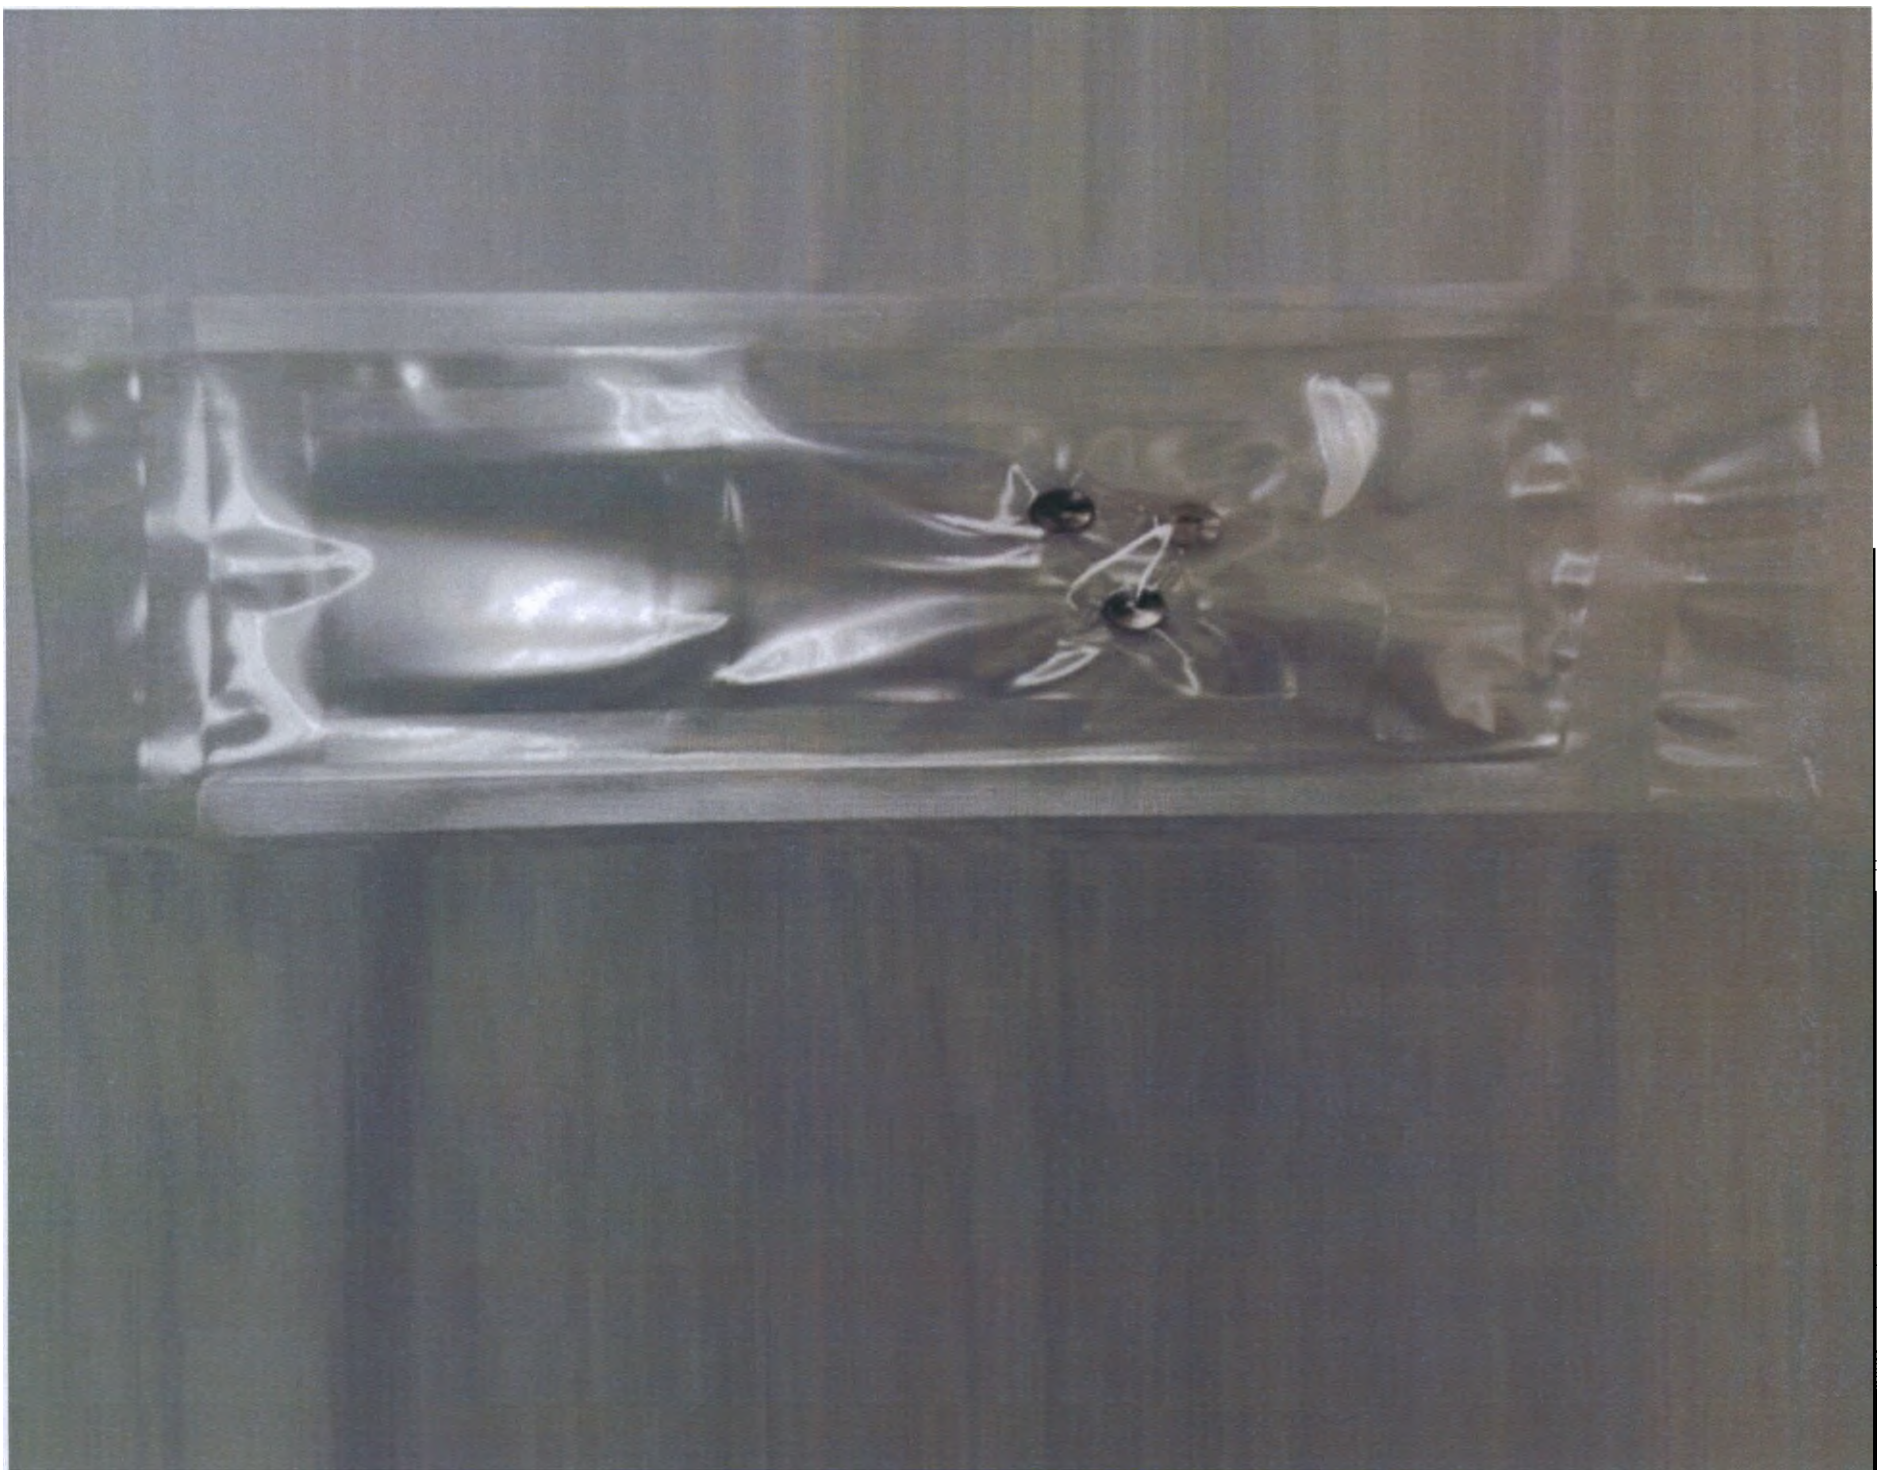

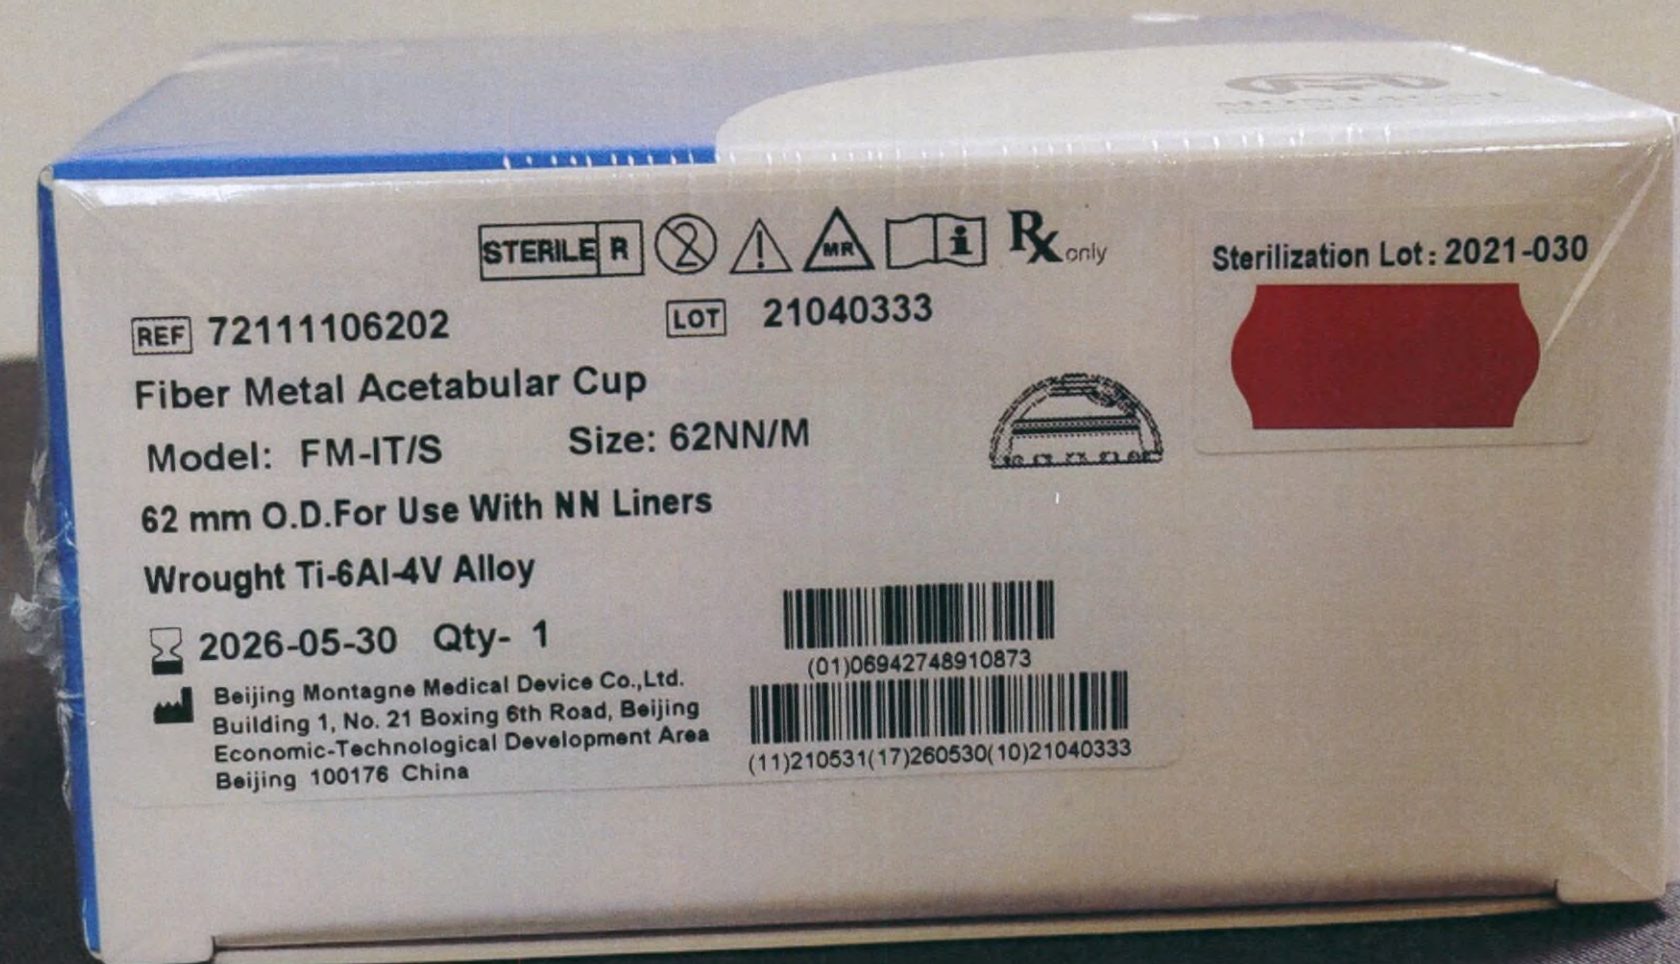


Рис. 17. Пример маркировки вторичной упаковки

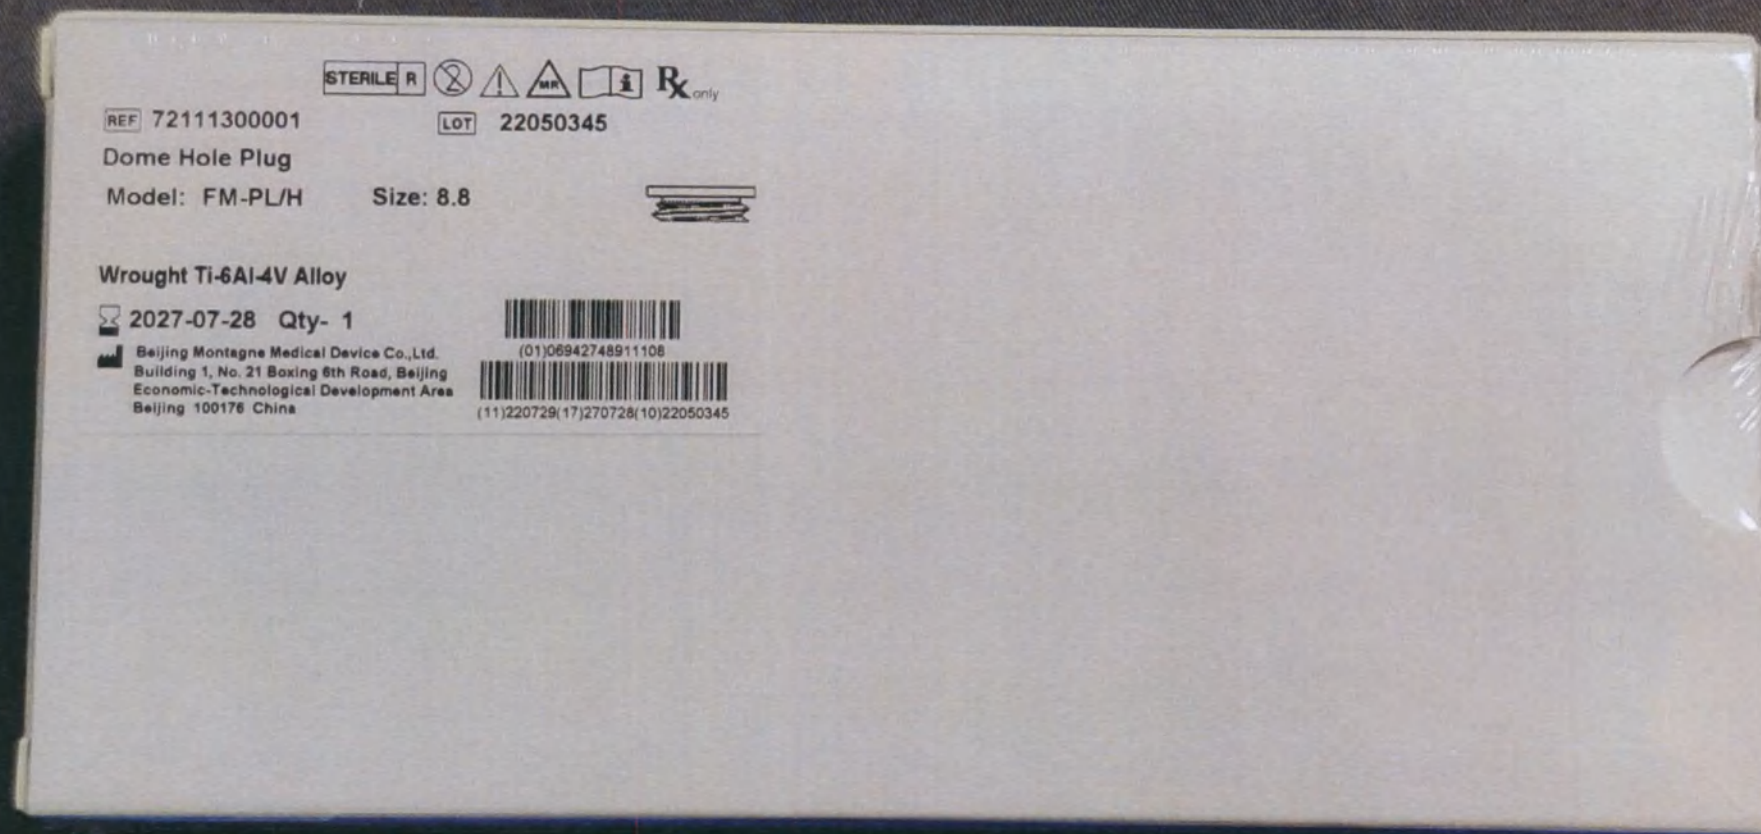


Рис. 18. Пример маркировки вторичной упаковки

产品名称: 髌关节假体组件-髌臼外杯及配件

STERILE R



型号描述: 钛丝髌臼外杯

产品编码: 72111104401

型号: FM-IT/S

产品批号: 12345678

规格: 44EE/C

生产日期: 2022-08-09

材料代号: T



失效日期: 2027-08-08

数量: 1

合格

生产许可证编号: 京食药监械生产许20000005号

其它内容详见说明书

注册证编号: 国械注准20173131367



(01)06942748910897



生产企业: 北京蒙太因医疗器械有限公司

生产地址: 北京经济技术开发区博兴六路21号院1号楼

注册人住所: 北京市北京经济技术开发区博兴六路21号院1号楼

联系电话: 010-50879200



(11)220809(17)270808(10)12345678

Рис. 19. Пример маркировки вторичной упаковки



Рис. 20. Пример макета наклейки пациента

Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размер 44EE/C

Производитель: **Бэйцзин Монтань** **Китай** **XXXXXX**
 Медикал Девайс Ко., Лтд.

Представитель производителя в РФ: **ООО «Зиммер СНГ»**

119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;

Тел: (495) 980 08 95

Регистрационное удостоверение № **XXX** **от** **ДД.ММ.ГГГГ**

Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до: **см. упаковку**

см. инструкцию

Для использования без цемента

см. символы на упаковке

Описание: **Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размер 44EE/C**

Рис. 21. Пример макета русскоязычной маркировки



Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размер 54JJ/C


Производитель: Бэйцзин Монтань
Медикал Девайс Ко., Лтд. Китай XXXXXX
XXXXXX

Адрес: Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd. Building 1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing
Economic-Technological Development Area Beijing 100176 China

Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ»

Россия, 119048, Москва, ул. Усачева, дом 29, корп. 9 помещение 15

Тел: (495) 980 08 95



Регистрационное

удостоверение №: XXX XXXX/XXXXX

от: DD.MM.YYYY

Дата изготовления / Назначение / Годен до: см. символы на упаковке
см. упаковку см. инструкцию

Для использования без цемента

Описание: Компонент вертлужный Fiber Metal кластерный, размер
54JJ/C



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 23 (двадцать три) листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И. А.И. Камнев

2023 г.

