




«Набор реагентов для выявления мутаций гена *EGFR* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени "Real-time-PCR-EGFR-4R" по ТУ 21.20.23-006-57201404-2020» вариант исполнения – Набор реагентов на 12 реакций "Real-time-PCR-EGFR-4R (12)", серия 050922

Фотографии общего вида медицинского изделия (упаковка, пробирки с реагентами, инструкция и паспорт)

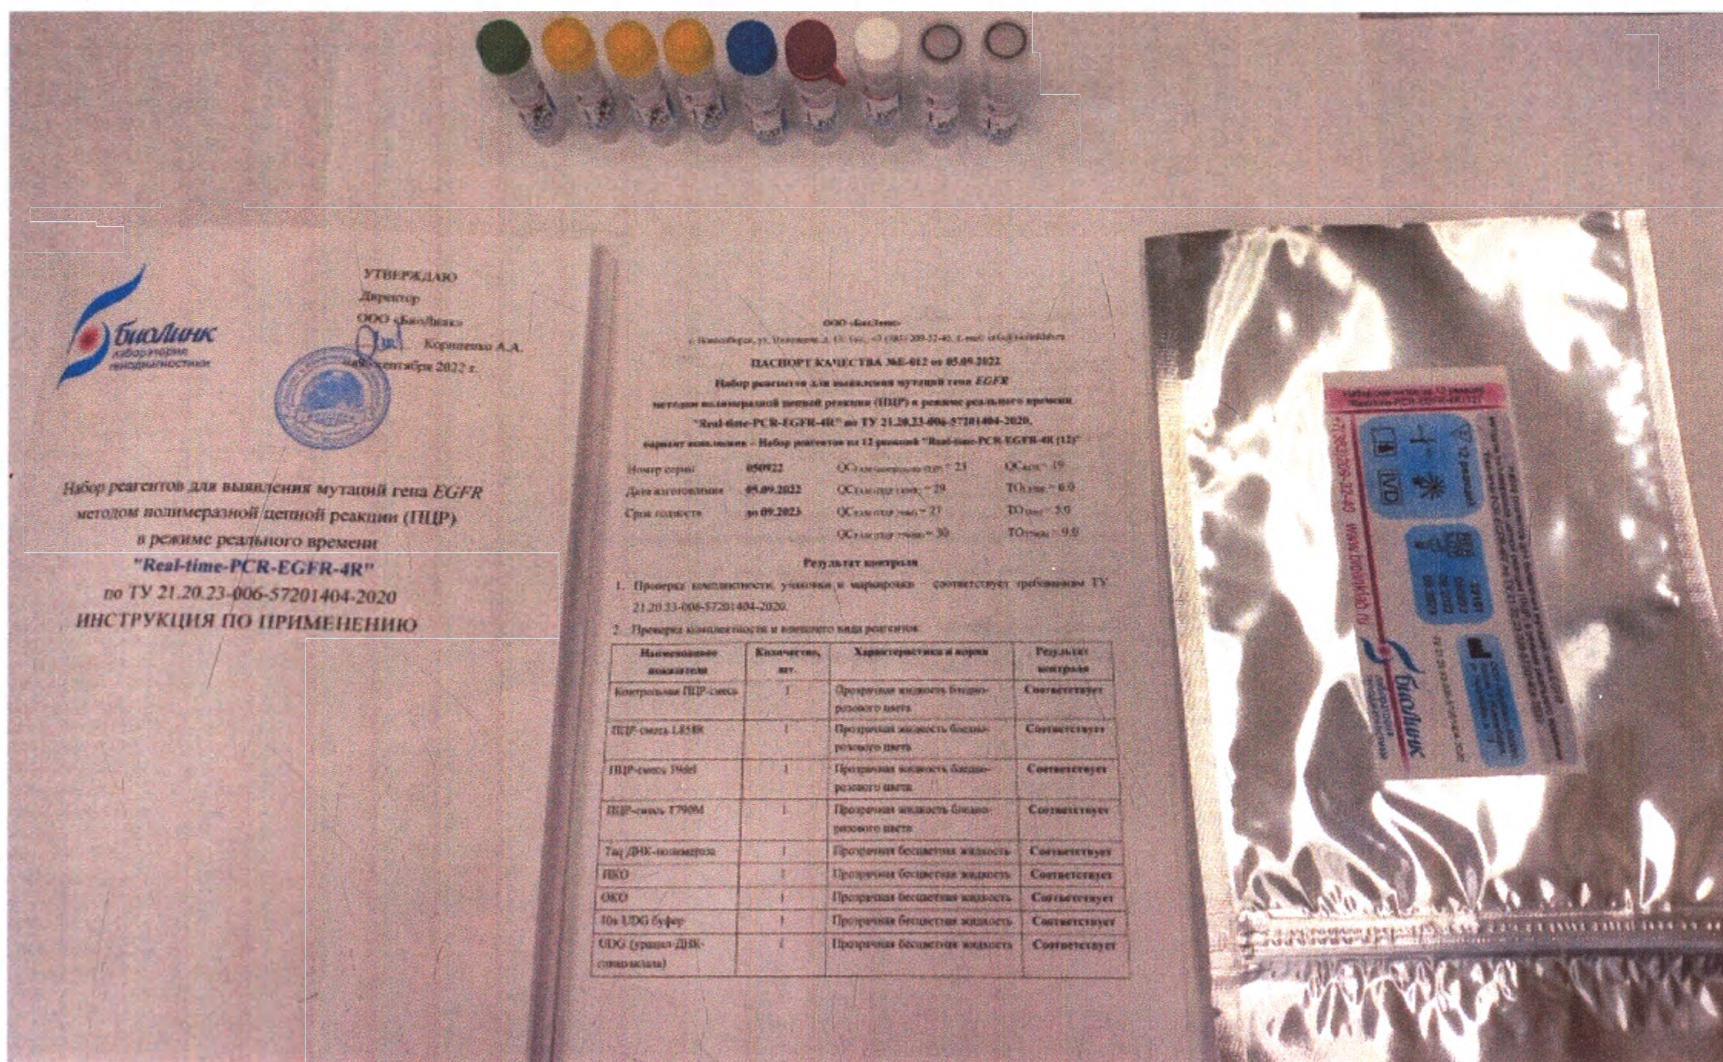

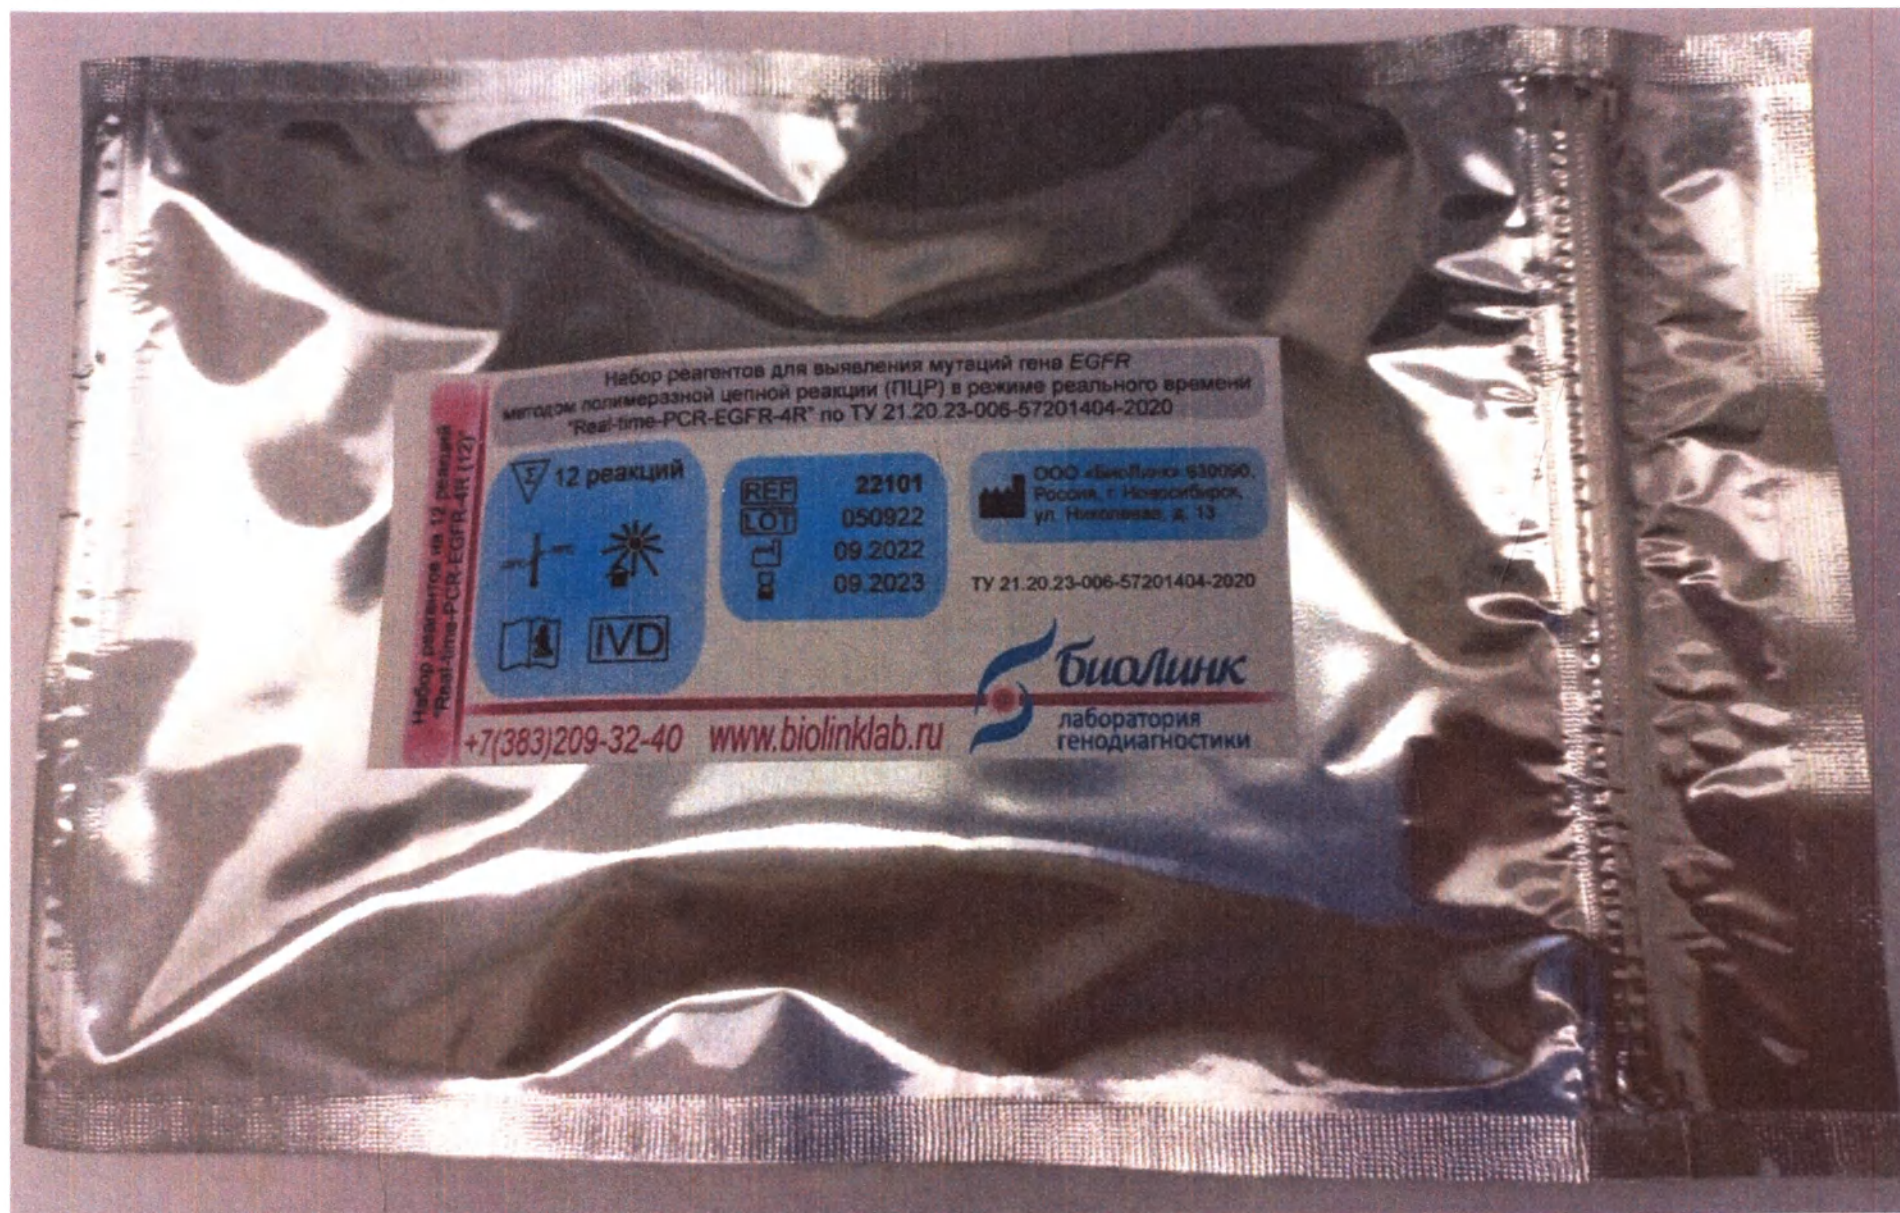

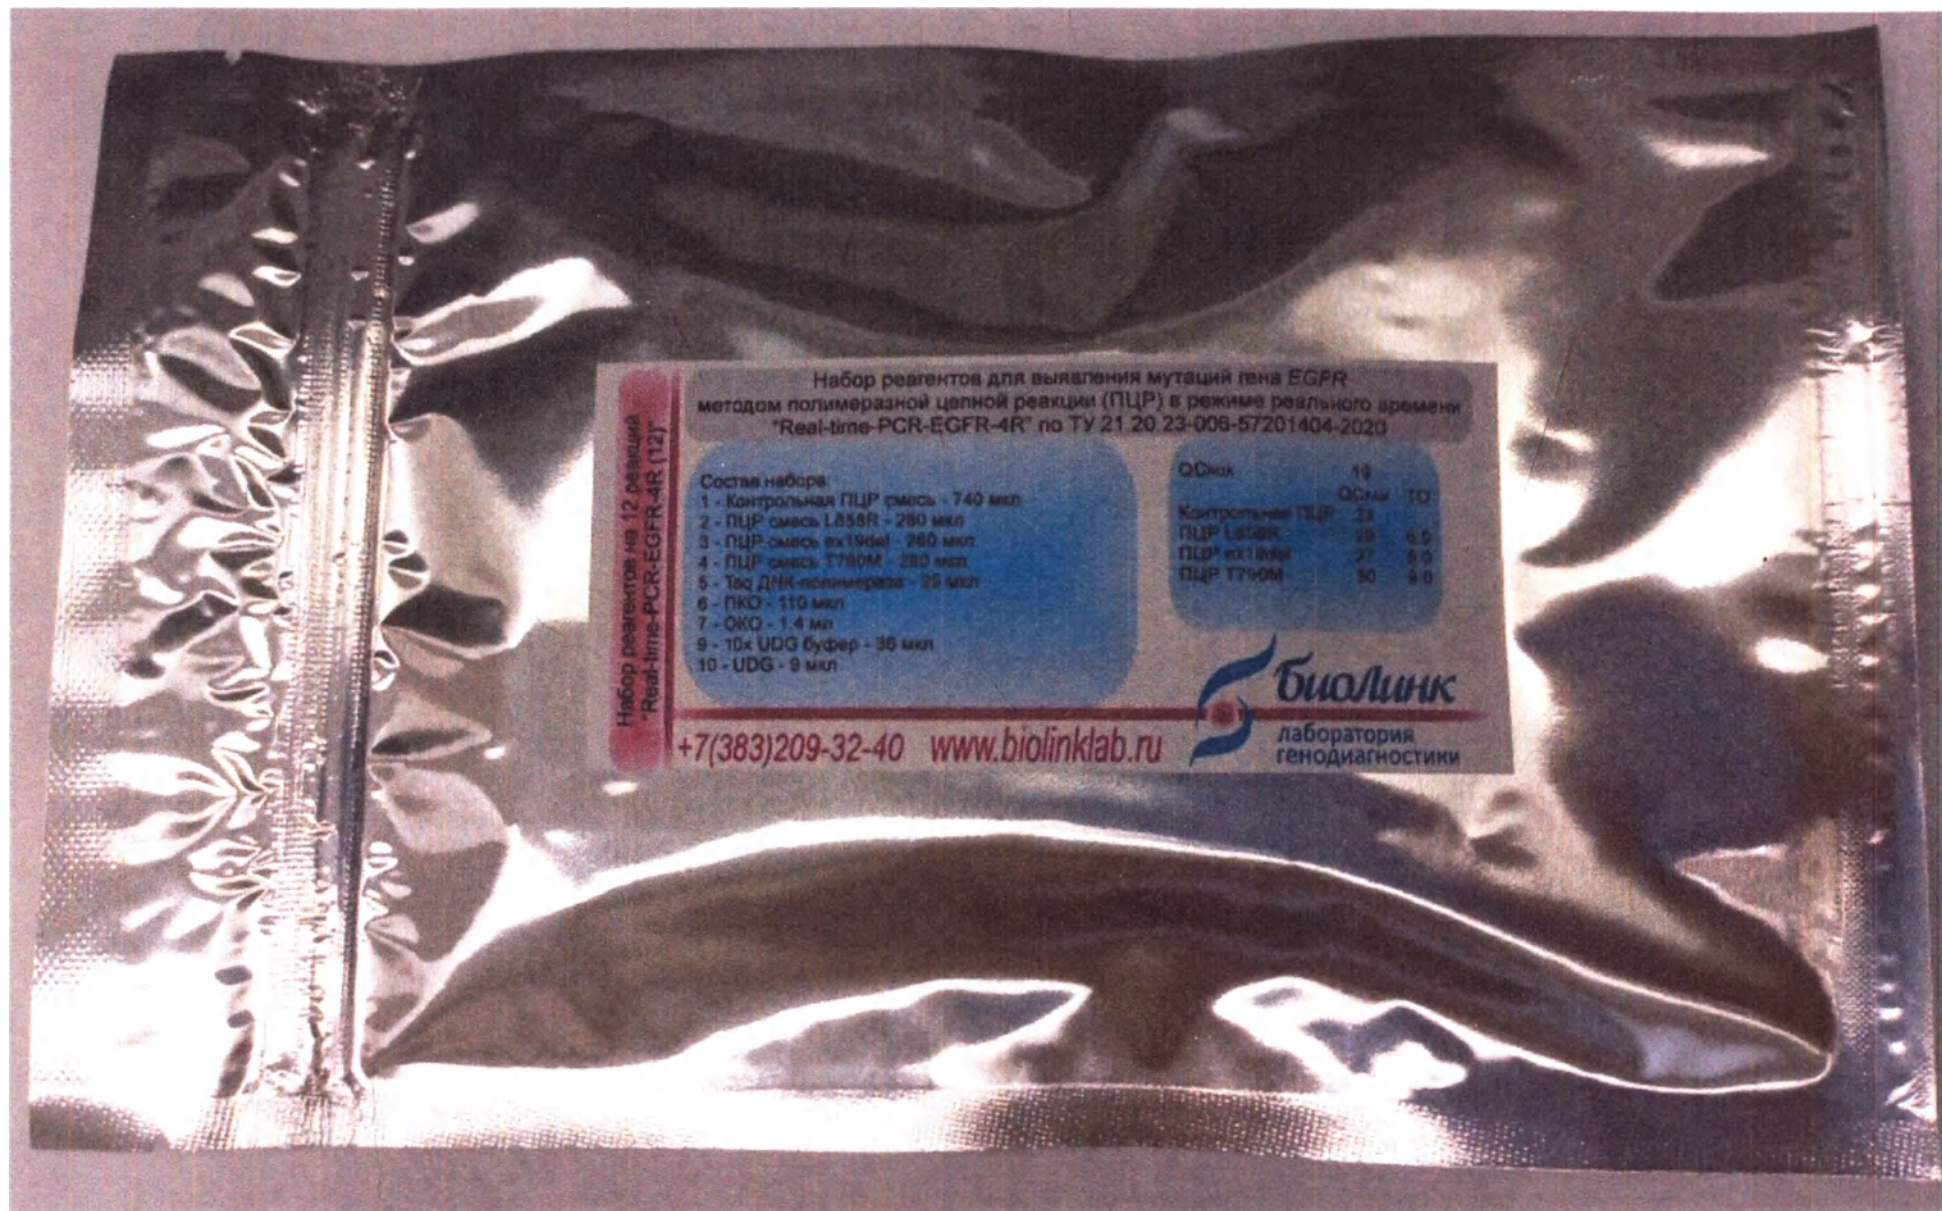



Внешний вид пробирок с реагентами




«Набор реагентов для выявления мутаций гена *EGFR* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени "Real-time-PCR-EGFR-4R" по ТУ 21.20.23-006-57201404-2020» вариант исполнения – Набор реагентов на 36 реакций "Real-time-PCR-EGFR-4R (36)", серия 020922


Фотографии общего вида медицинского изделия (упаковка, пробирки с реагентами, инструкция и паспорт)

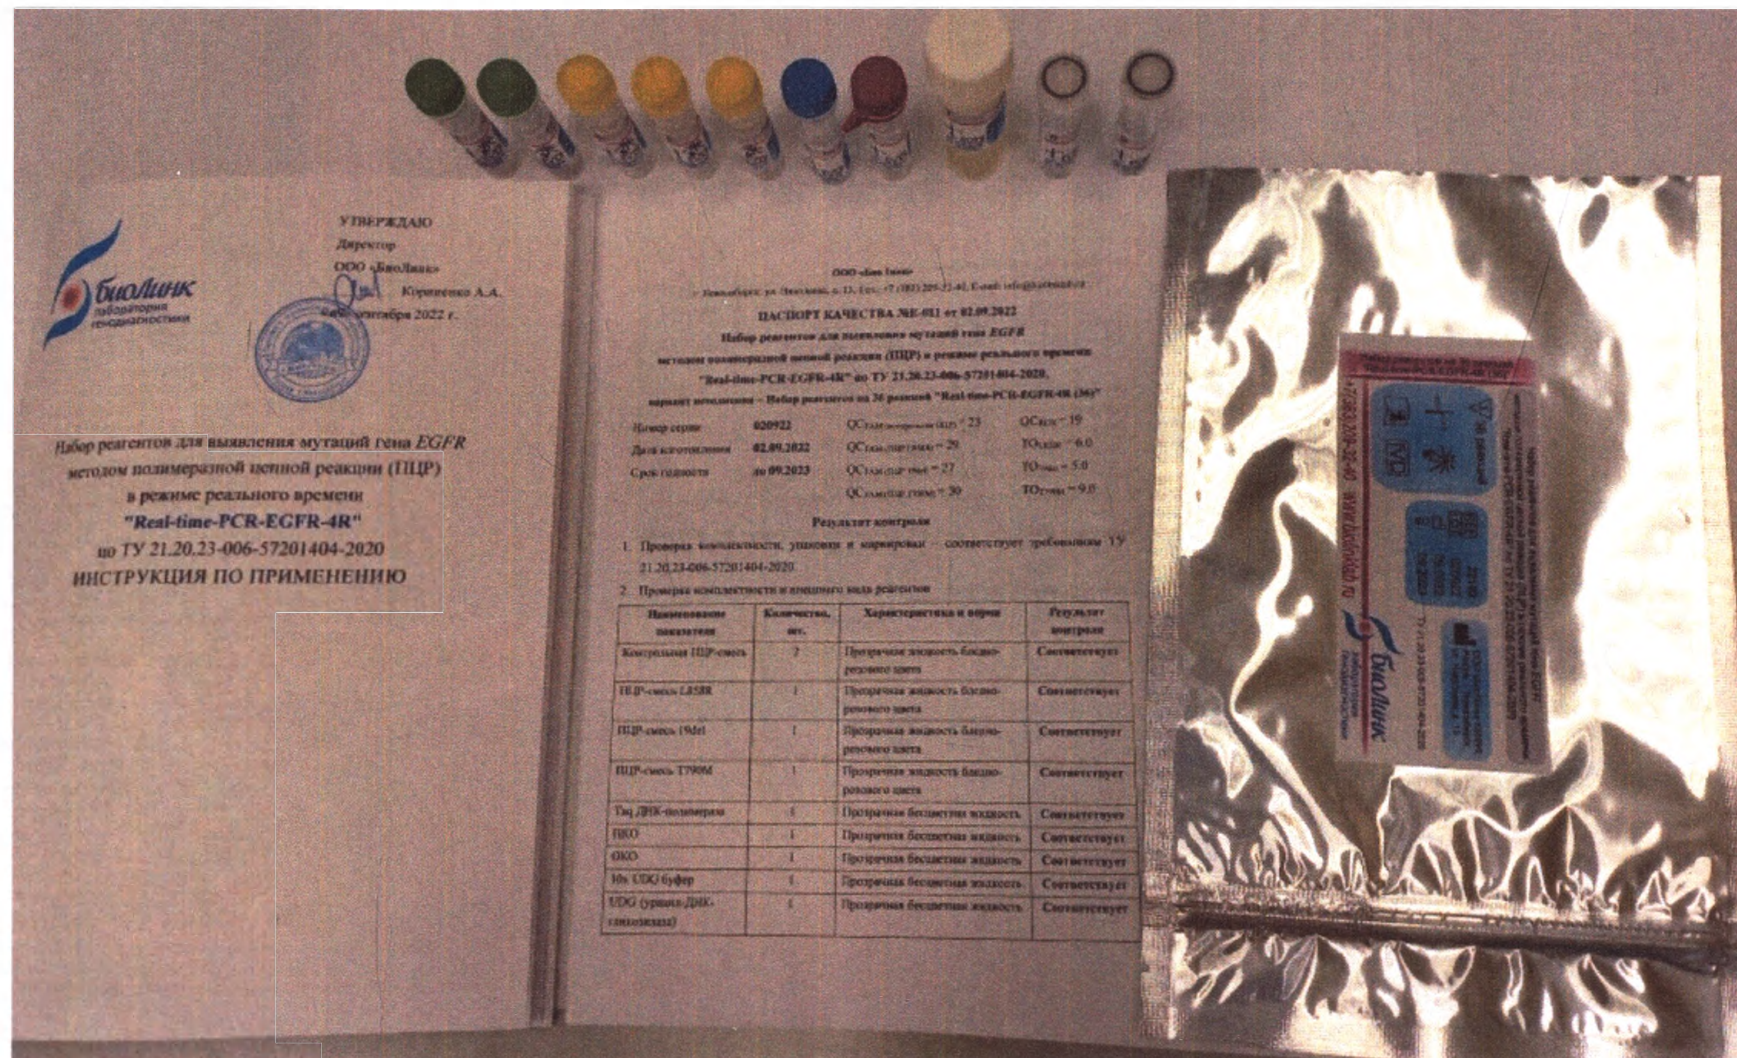

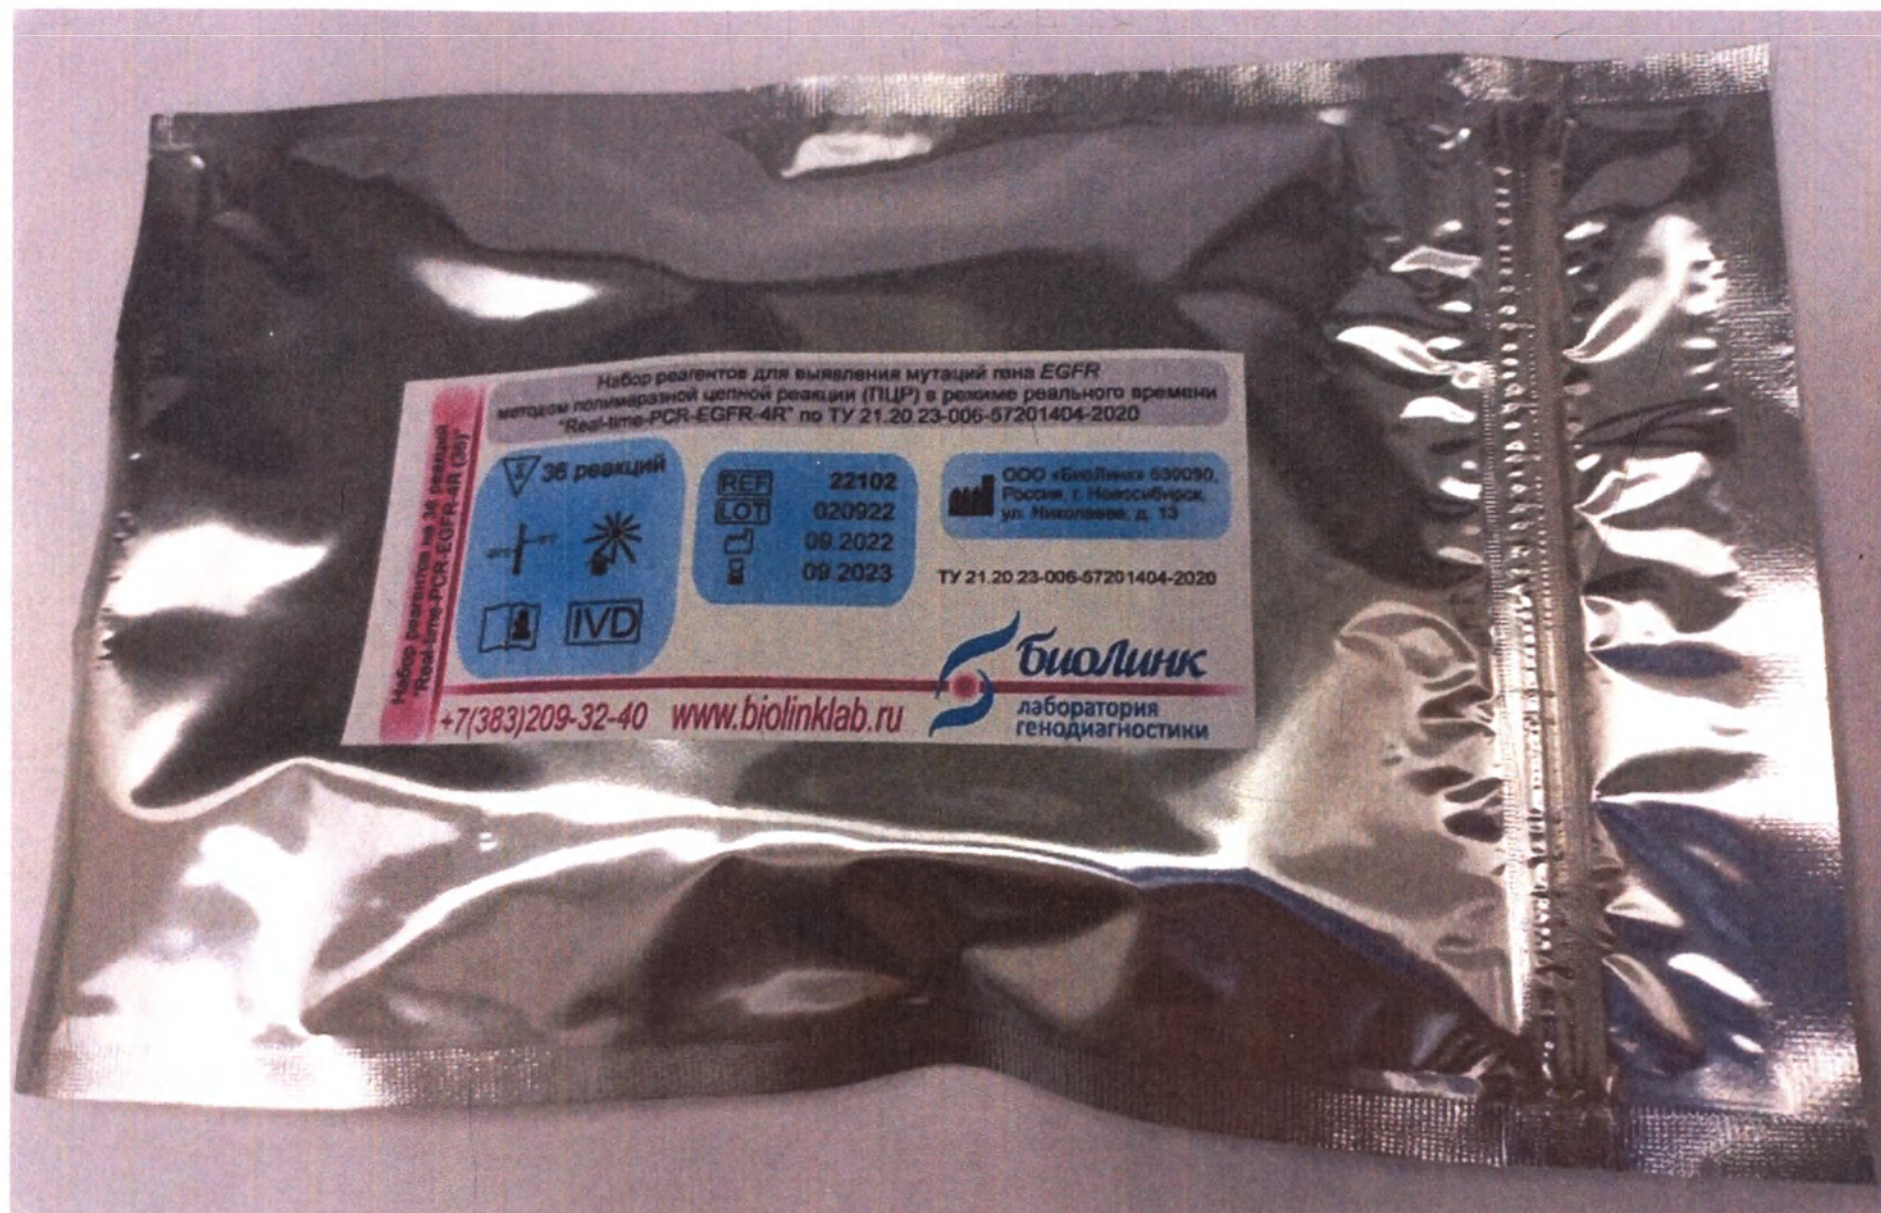

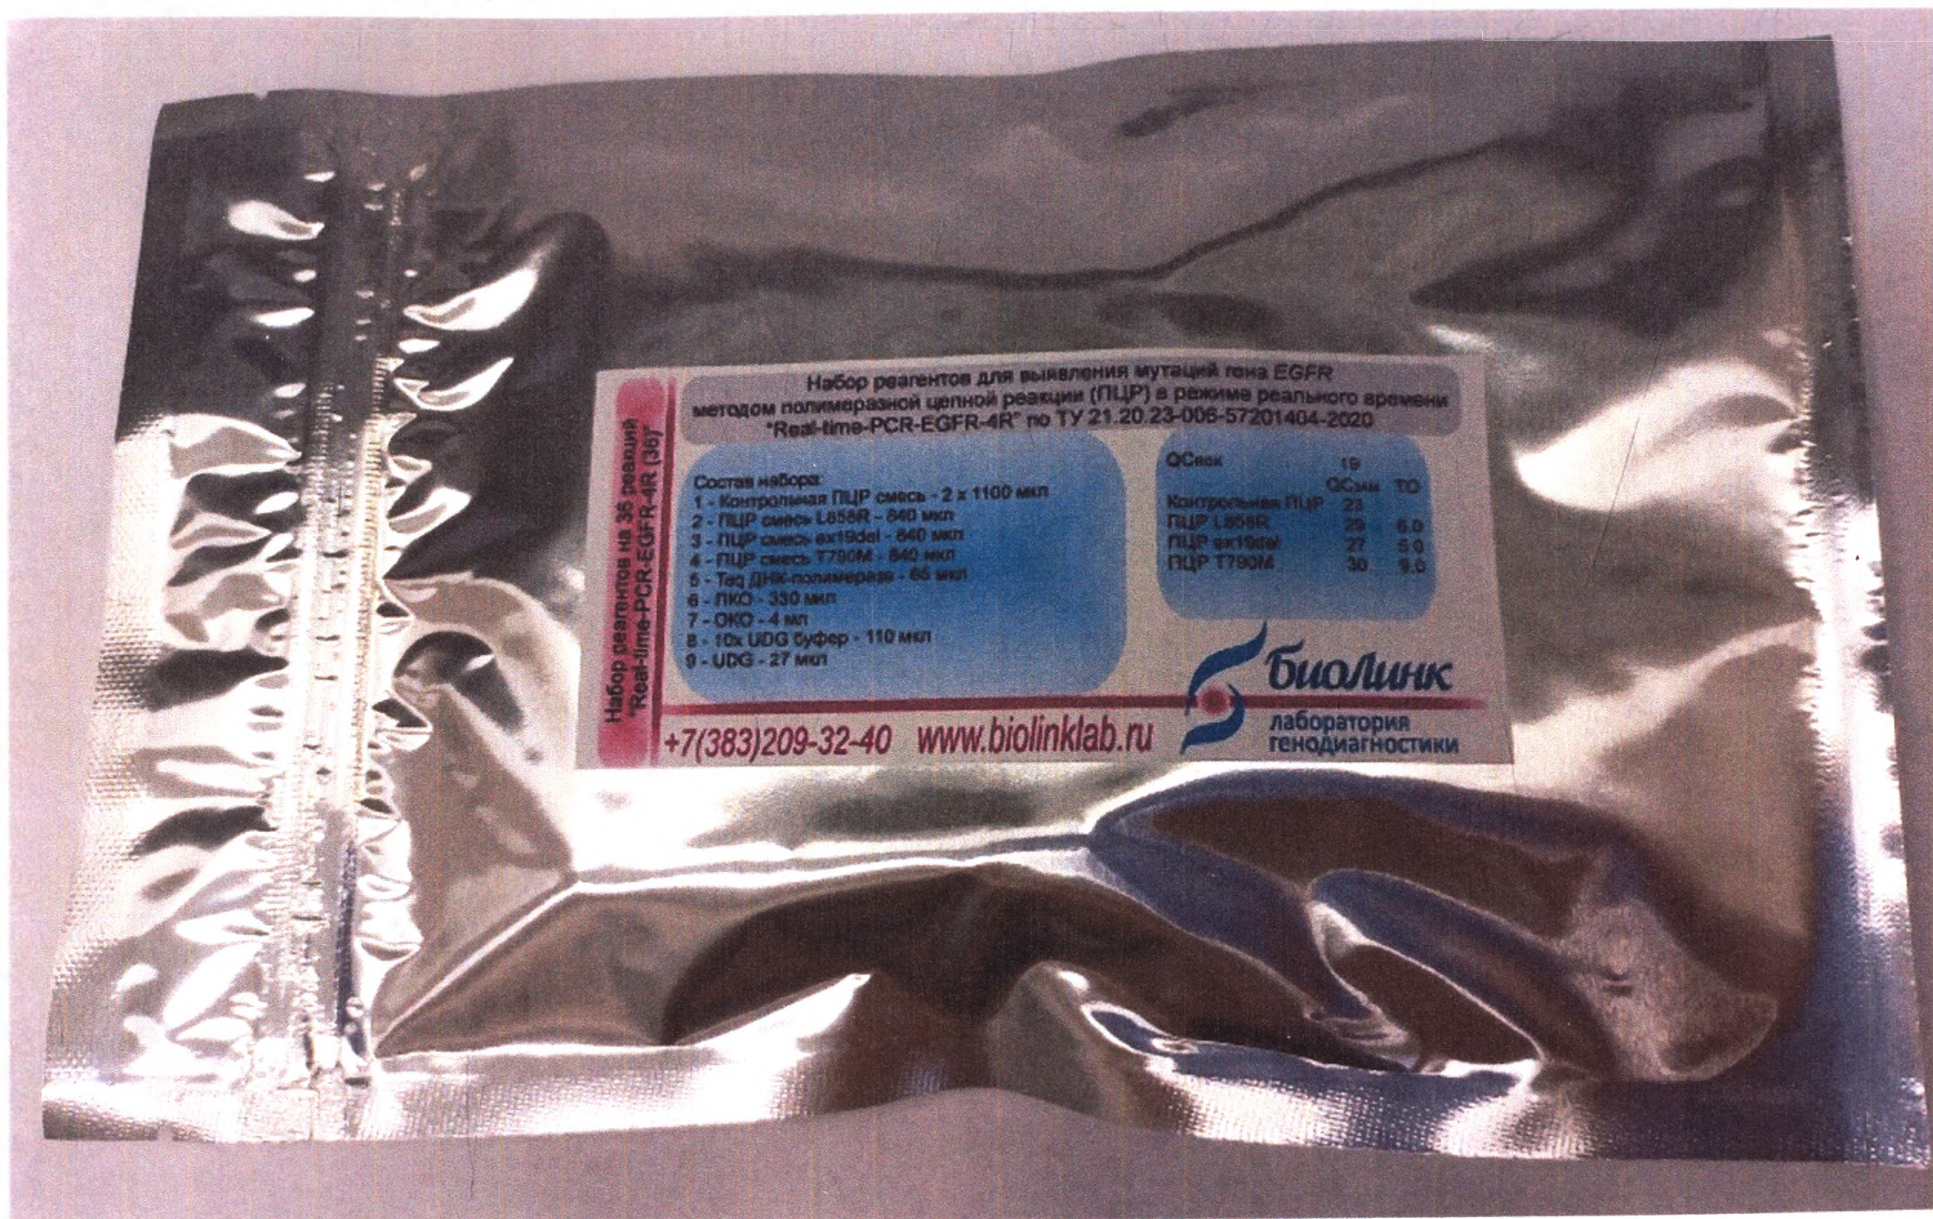

Внешний вид пробирок с реагентами

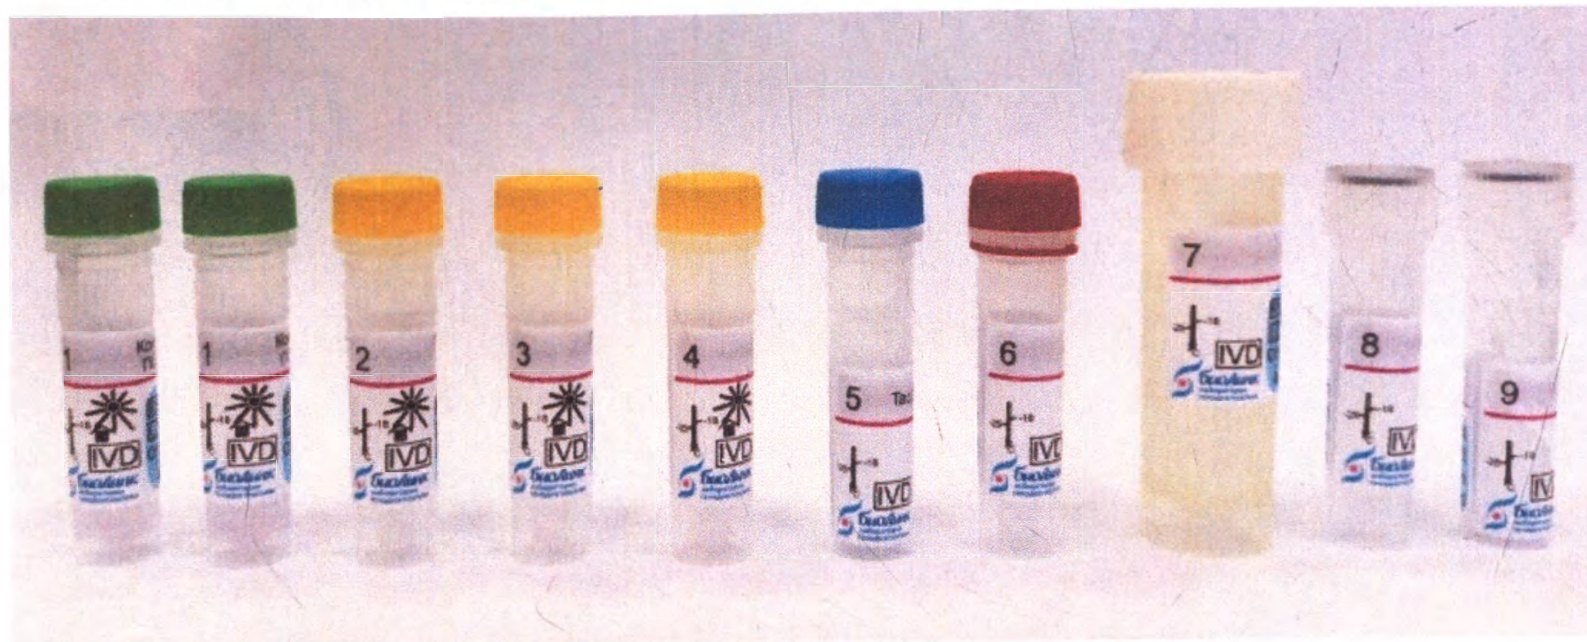

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8

листов

Директор ООО «БИОЛИНК»

/ Корниенко А. А. /



2022 г.