

Российская Федерация,
142608, Московская область,
город Орехово-Зуево,
улица Урицкого, д. 67
тел.: (496) 423-69-09
www.pnevmopribor-oz.ru
email: e.pnevmopribor@gmail.com



ИНН 5034009106
КПП 503401001
ОКПО 13350894
p/c 4070 2810 1015 9000 0389
к/с 3010 1810 1452 5000 0411
в Филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044 525411



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Пневмоприбор»

А.В. Пушков

«16» марта 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ
«ПульсАр-100», С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
ПО ТУ 32.50.21-001-13350894-2020

2021 г.

Наименование медицинского изделия (с указанием входящих комплектующих, необходимых для применения медицинского изделия по назначению):

1. «Аппарат искусственной вентиляции легких «ПульсАр-100», с принадлежностями по ТУ 32.50.21-001-13350894-2020», в составе:

1.1. Блок ИВЛ ИВЛД.5157.020 – 1 шт.;

1.2. Система подачи медицинских газов СИМГ по ТУ 9452-012-13350894-2011, в составе: шланг кислородный ПК, производства ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2012/14094 – не более 3 шт. (при необходимости);

1.3. Редуктор кислородный КР-1, производства ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2009/04014 – не более 3 шт. (при необходимости);

1.4. Система подачи медицинских газов СИМГ по ТУ 9452-012-13350894-2011, в составе: баллон для медицинского кислорода с вентилем БК-2, производства ООО «Пневмоприбор», Россия, РУ № ФСР 2012/14094 – не более 2 шт. (при необходимости);

1.5. Дыхательные контуры анестезиологические и реанимационные для взрослых, для детей, с обогревом или без с принадлежностями, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. *или* Клапан и контур пациента, производства WHINMAN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG, Германия, РУ № РЗН 2014 2214 – не более 20 шт.;

1.6. Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. (при необходимости) *или* Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры-теплообменники в комплекте с соединителями или без, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. (при необходимости) *или* Фильтры дыхательные, производства «НипАир Медикал», Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 – не более 20 шт. (при необходимости).

1.7. Маски лицевые полимерные, Б2-95 (детская), производства ЗАО НПКФ «Метом», Россия, РУ № ФСР № 2007/01323 – не более 20 шт. *или* Анестезиологические маски QuadraLite, размер 2, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. *или* Экономичные анестезиологические лицевые маски, размер 2, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт.

1.8. Маски лицевые полимерные, Б2-125 (средняя), производства ЗАО НПКФ «Метом», Россия, РУ № ФСР № 2007/01323 – не более 20 шт. *или* Анестезиологические маски QuadraLite, размер 4, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. *или* Экономичные анестезиологические лицевые маски, размер 4, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт.

1.9. Маски лицевые полимерные, Б2-145 (крупная), производства ЗАО НПКФ «Метом», Россия, РУ № ФСР № 2007/01323 – не более 20 шт. *или* Анестезиологические маски QuadraLite, размер 5, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. *или* Экономичные анестезиологические лицевые маски, размер 5, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт.

1.10. Держатели-фиксаторы: для масок – эластомерные головные, кольцо: для детей, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 10 шт. (при необходимости)

1.11. Держатели-фиксаторы для масок – эластомерные головные, кольцо: для взрослых, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. (при необходимости);

1.12. Дыхательный контур для режима FSV (при необходимости), в составе:

1.12.1. Дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без: шланги для дыхательных контуров, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 10 шт.

1.12.2. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: прямые, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт.

1.12.3. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: угловые, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 10 шт.

1.12.4. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Т-образные, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 10 шт.

1.12.5. Дыхательные клапаны: клапаны переверсивные, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 10 шт.;

1.12.6. Дыхательные мешки объёмом: 2.0 л, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 10 шт.

1.13. Дыхательные клапаны: клапаны PEEP, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. (при необходимости);

1.14. Реанимационные системы: адаптер клапана PEEP, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 20 шт. (при необходимости);

1.15. Дыхательные мешки объёмом: 2.0 л, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 – не более 2 шт. *или* Мешки резервные дыхательные, производства «IntAир Медикал», Франция, РУ № ФСЗ 2009/03742 – не более 2 шт.;

1.16. Источник питания AC-DC, MPP15 Medical, вход 100 – 240V AC, 50...60Гц, выход 12В/1,25А, модель FW7555-12, фирма I RIWO, Германия – 1 шт. *или* Источник питания 10,0-14,9 VDC, max 1,6 А, 47...63 Гц, модель 3823-12, фирма MASCOT, Эстония/ *или* Источник питания 9,0-10,0 VDC, max 1,33А, 50...60 Гц, модель 3823-90, фирма MASCOT, Эстония;

1.17. Руководство по эксплуатации на аппарат – 1 шт.

1.18. Паспорт на аппарат – 1 шт.

Принадлежности:

1. Футляр ППТД.4161.013 – 1 шт. (при необходимости).


2. Кабель питания от бортовой сети автомобиля, 12 В, ППТД.6644.003 – 1 шт. (при необходимости);

3. Кольцо – 2 шт. (при необходимости).



Фотография 1 – Общий вид аппарата в футляре

1 - блок ИВЛ (см. фотографии 2); 2 - дыхательный клапан (см. фотографии 6 или фотографии 7); 3 - клапан редуктор (см. фотографии 3 и 4); 4 - кислородный ШК (см. фотографии 4); 5 - клапан медицинского кислорода (см. фотографии 8); 6 - футляр (см. фотографии 24)

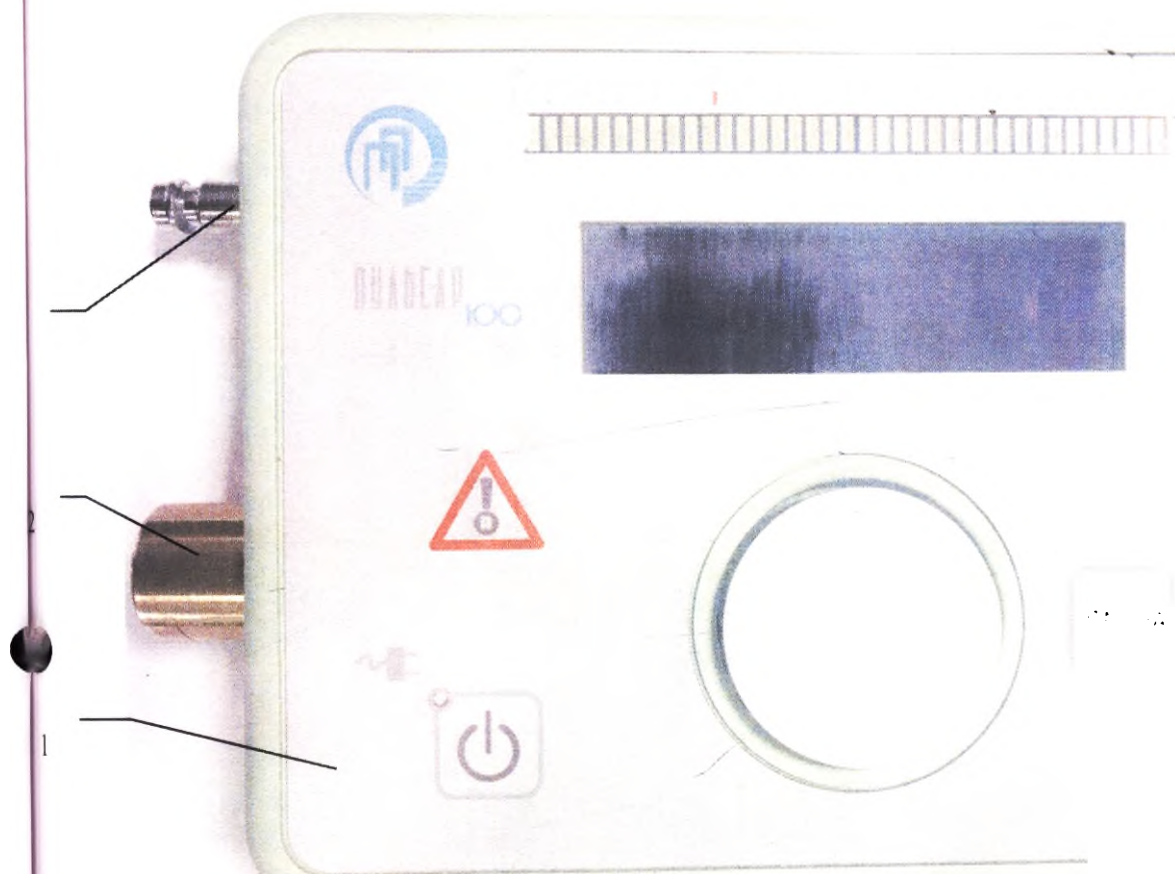


Фотография 2 – Блок ПБ-1

1 – шуруп крепления;


2 – шуруп 22 мм для крепления к объекту контроля контура;

3 – шуруп для подключения.

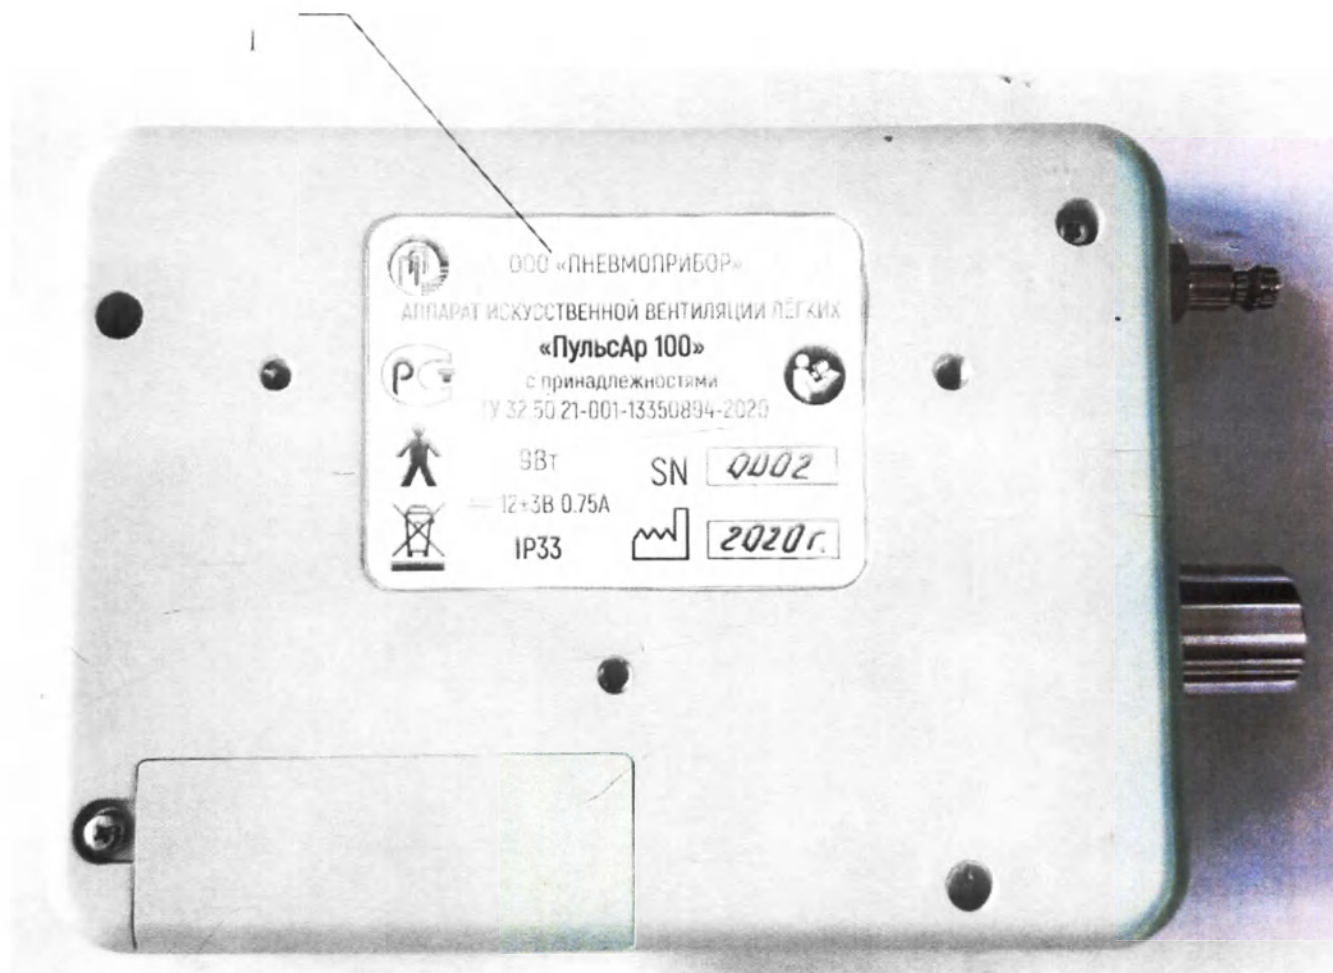


Фотография 3 – Блок ПВЛ (задняя сторона – маркировка)

1 – этикетка

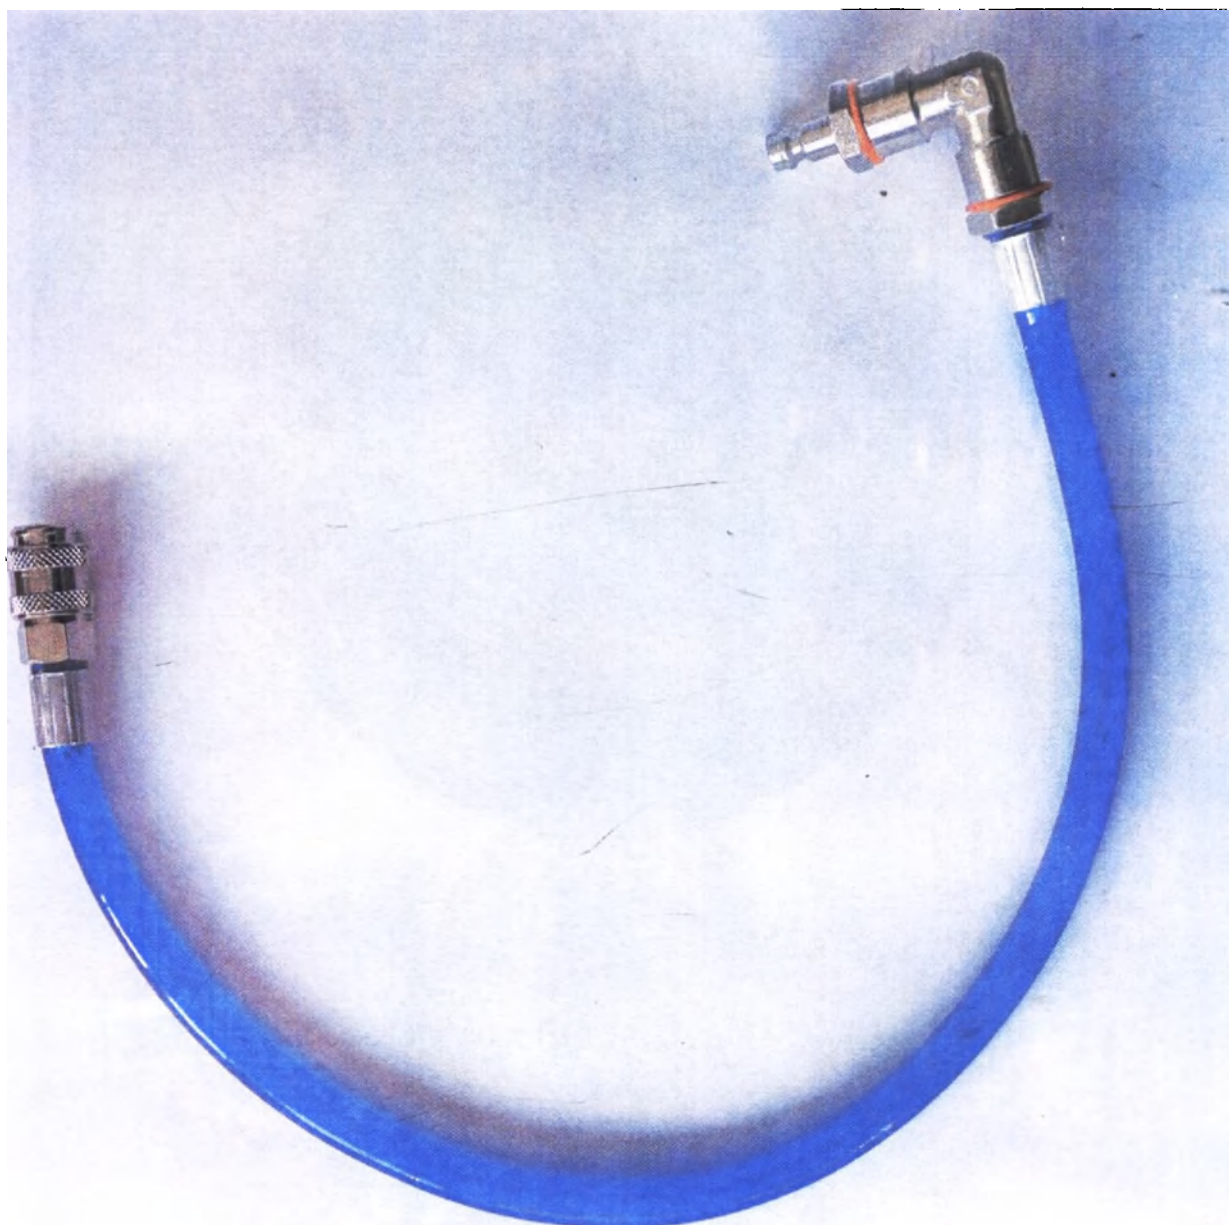


Фотография 4 – Система подачи медицинских газов СИМП по ТУ 9452-012-13350894-2011,
с системой подачи кислорода ГИТ,
производства ООО «СЗД «Добрибор» Россия, Г.А. №А 000000014094

Фомосрафна 5 - Редькмор кне топорна RP 1
производства ООО "Цирми" г. Москва, Россия. Р.А. № 09.04014

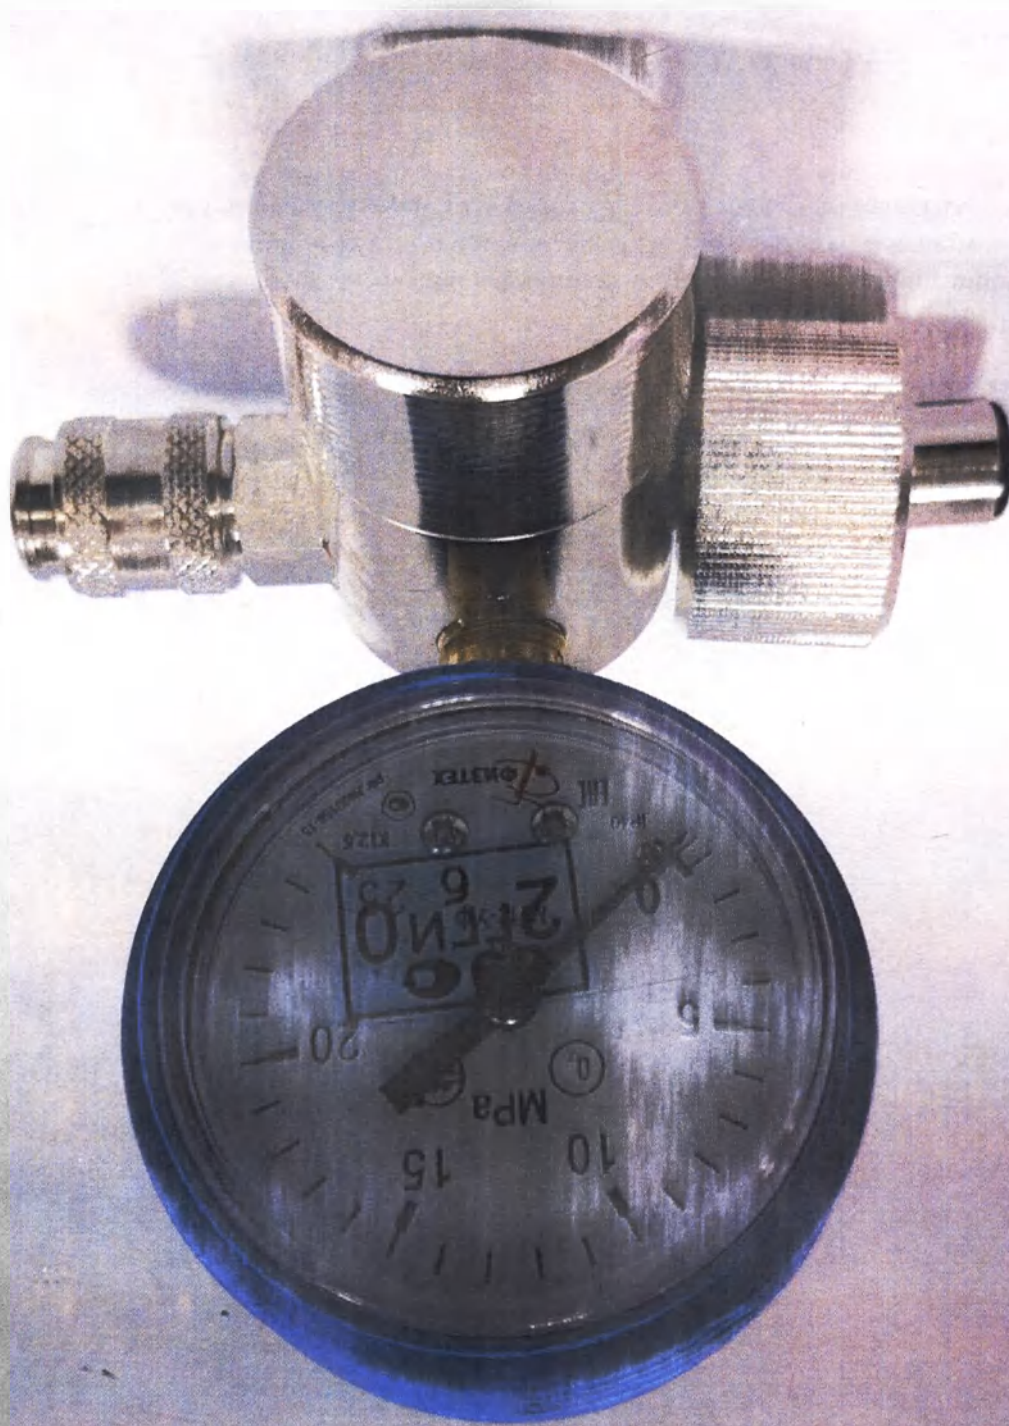



Фотография 6 — Дыхательная контуры анестезиологические и реанимационные для взрослых (с и без резервуара или без спринок) для оказания производства «Интерсоединка, Инд.» Соединенное Королевства, ТЭ № ФС 3 2009/03551

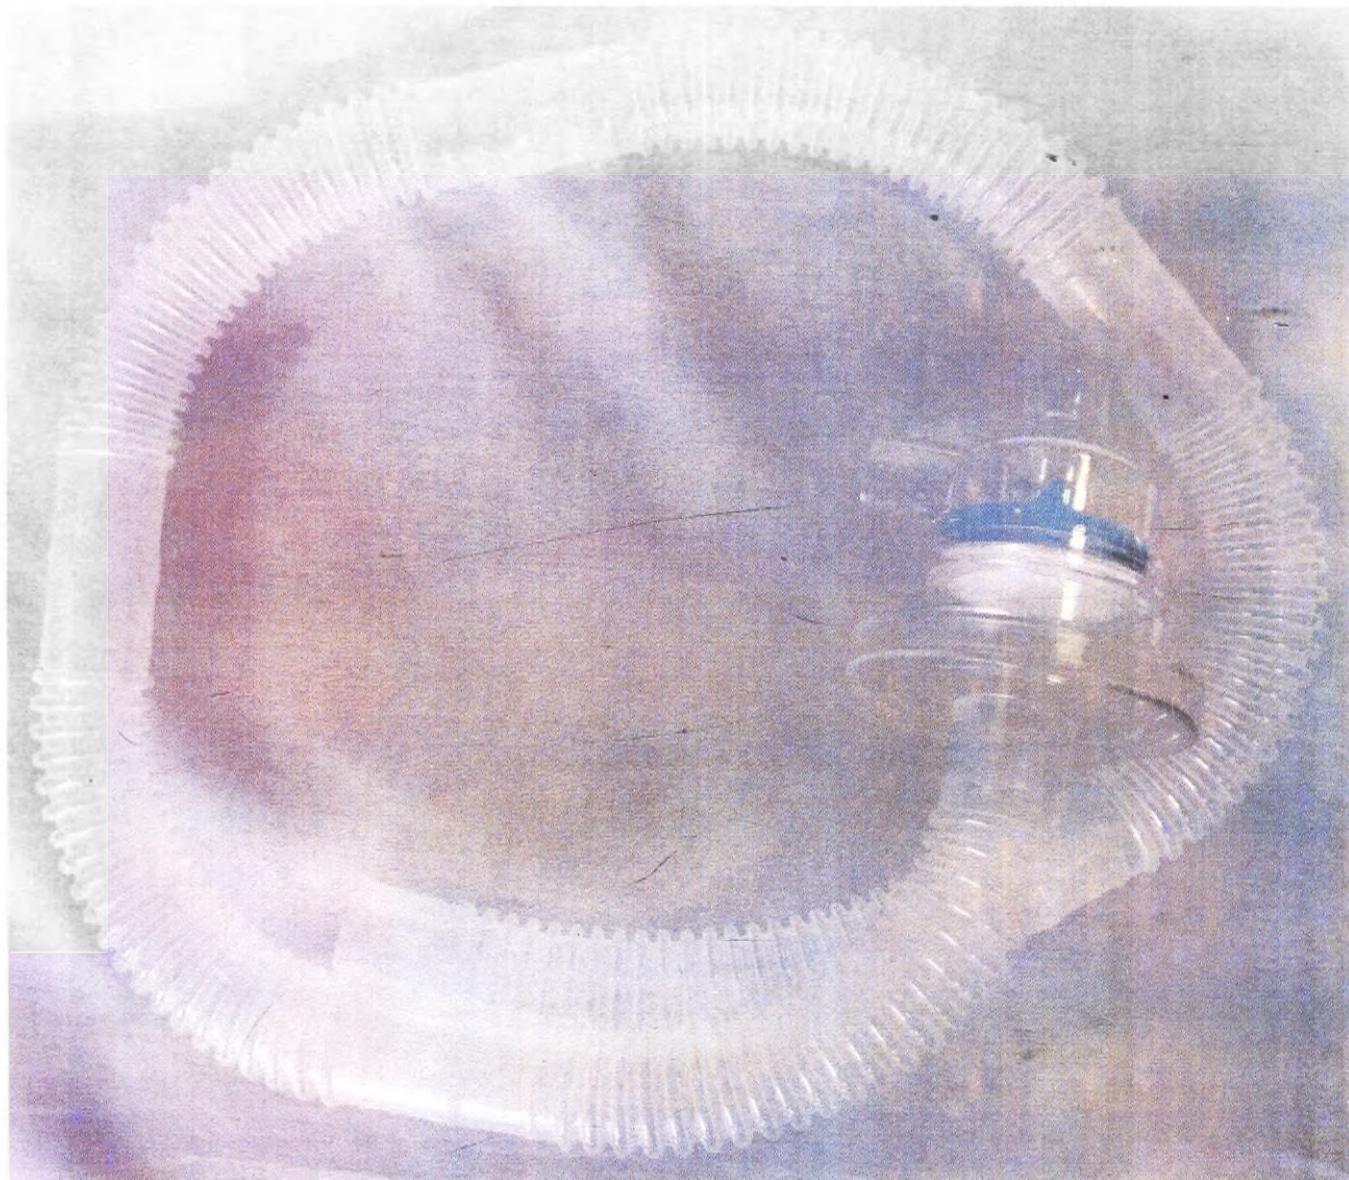


Фотография 7 – Клапан и контроллер пациента, производства WILMANN Emergency Medical Technology GmbH – Co. KG, Германия, РУ № РЗН 2014.2214



Фотография 8 – Система подачи медицинских газов СПМГ по ТУ 9452-012-13350894-2011,
 в составе: баллон для медицинского кислорода с вентилем БК-2,
 производства ООО «Пневмоприбор». Россия, РУ № ФСР 2012/14094




Фотография 9 – Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без, производства «Интерсоджестик Лтд», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2019 03551

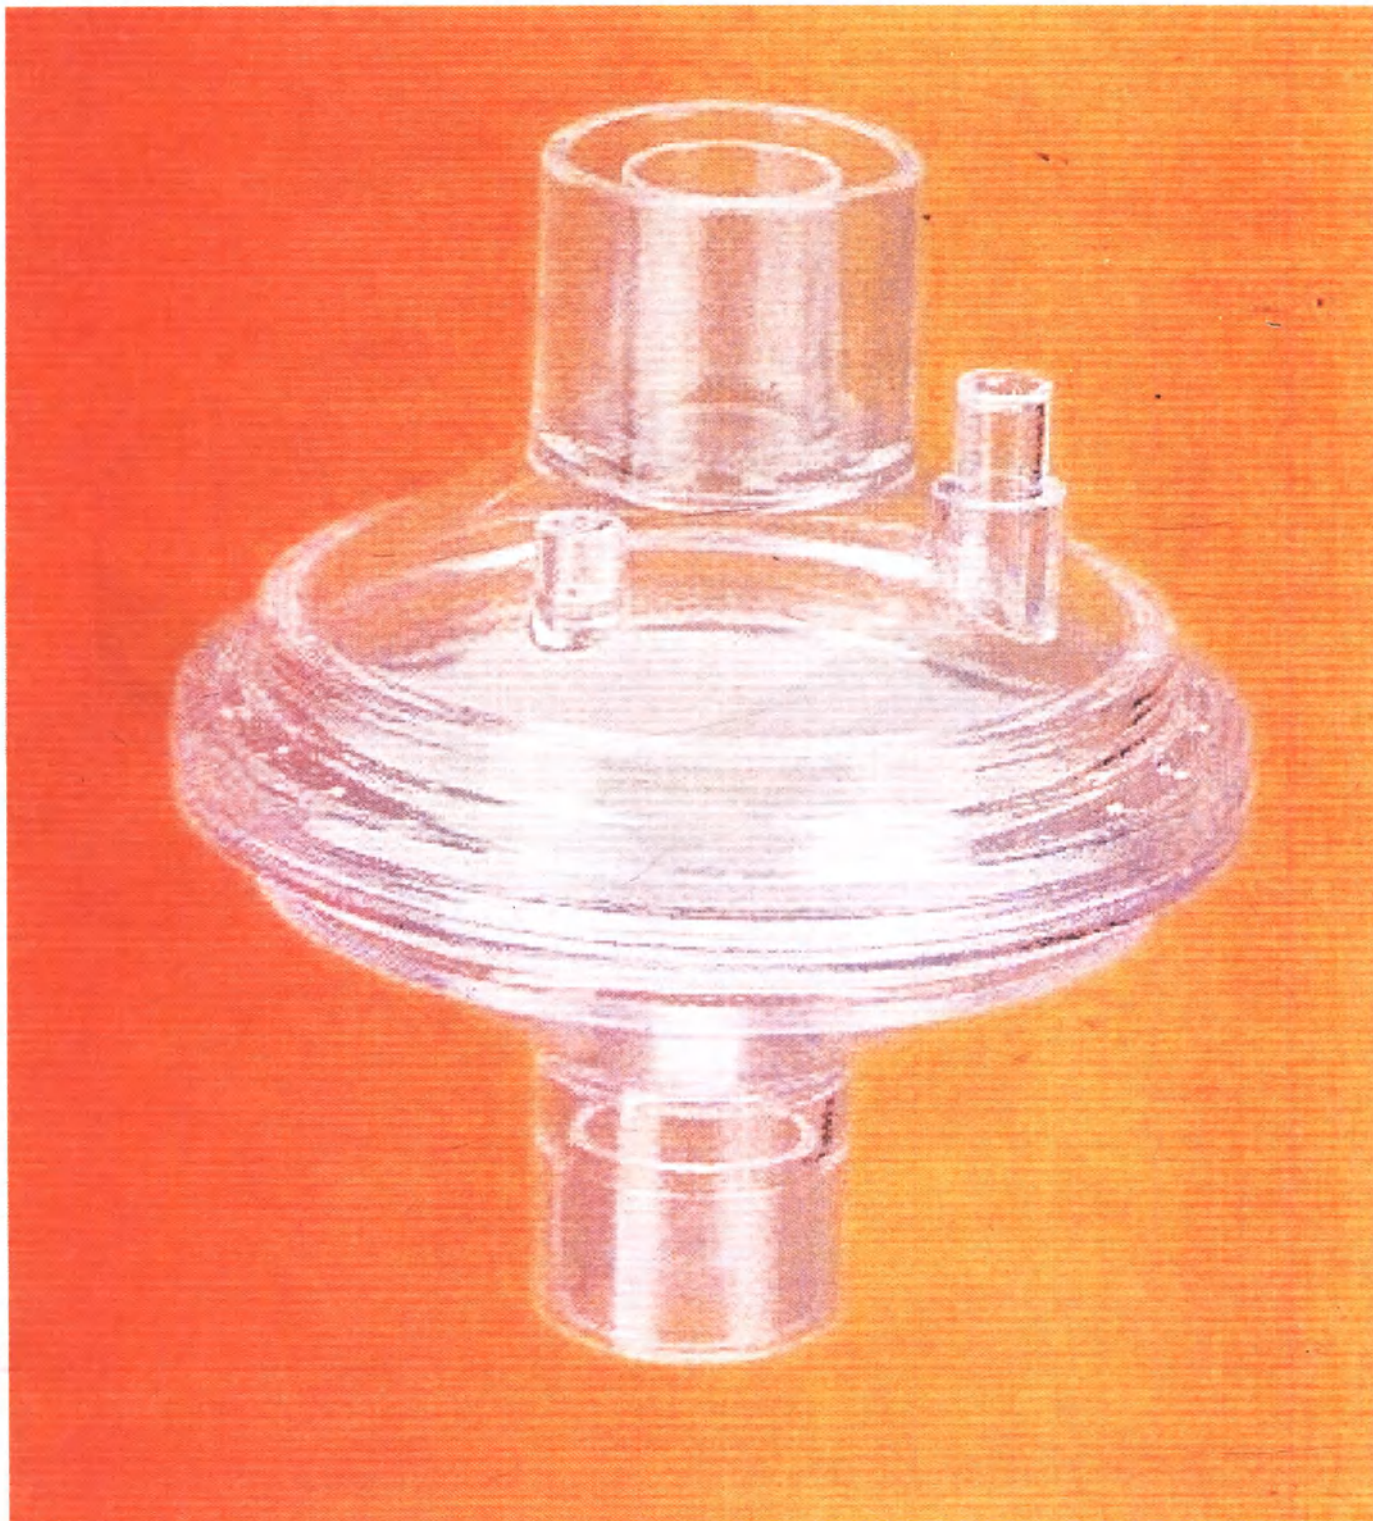

*Фотография 10 – Фильтр для очистки
продукции от компании Медикал, Франция, RU. № 009 03742*




*Фотография 11 – Дыхательные вирус-бактериостатические
фильтры-тепловыделительники в комплекте с соединителями и/или без,
производства «Интерсёрджикс, Инд.»
Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009 03551*

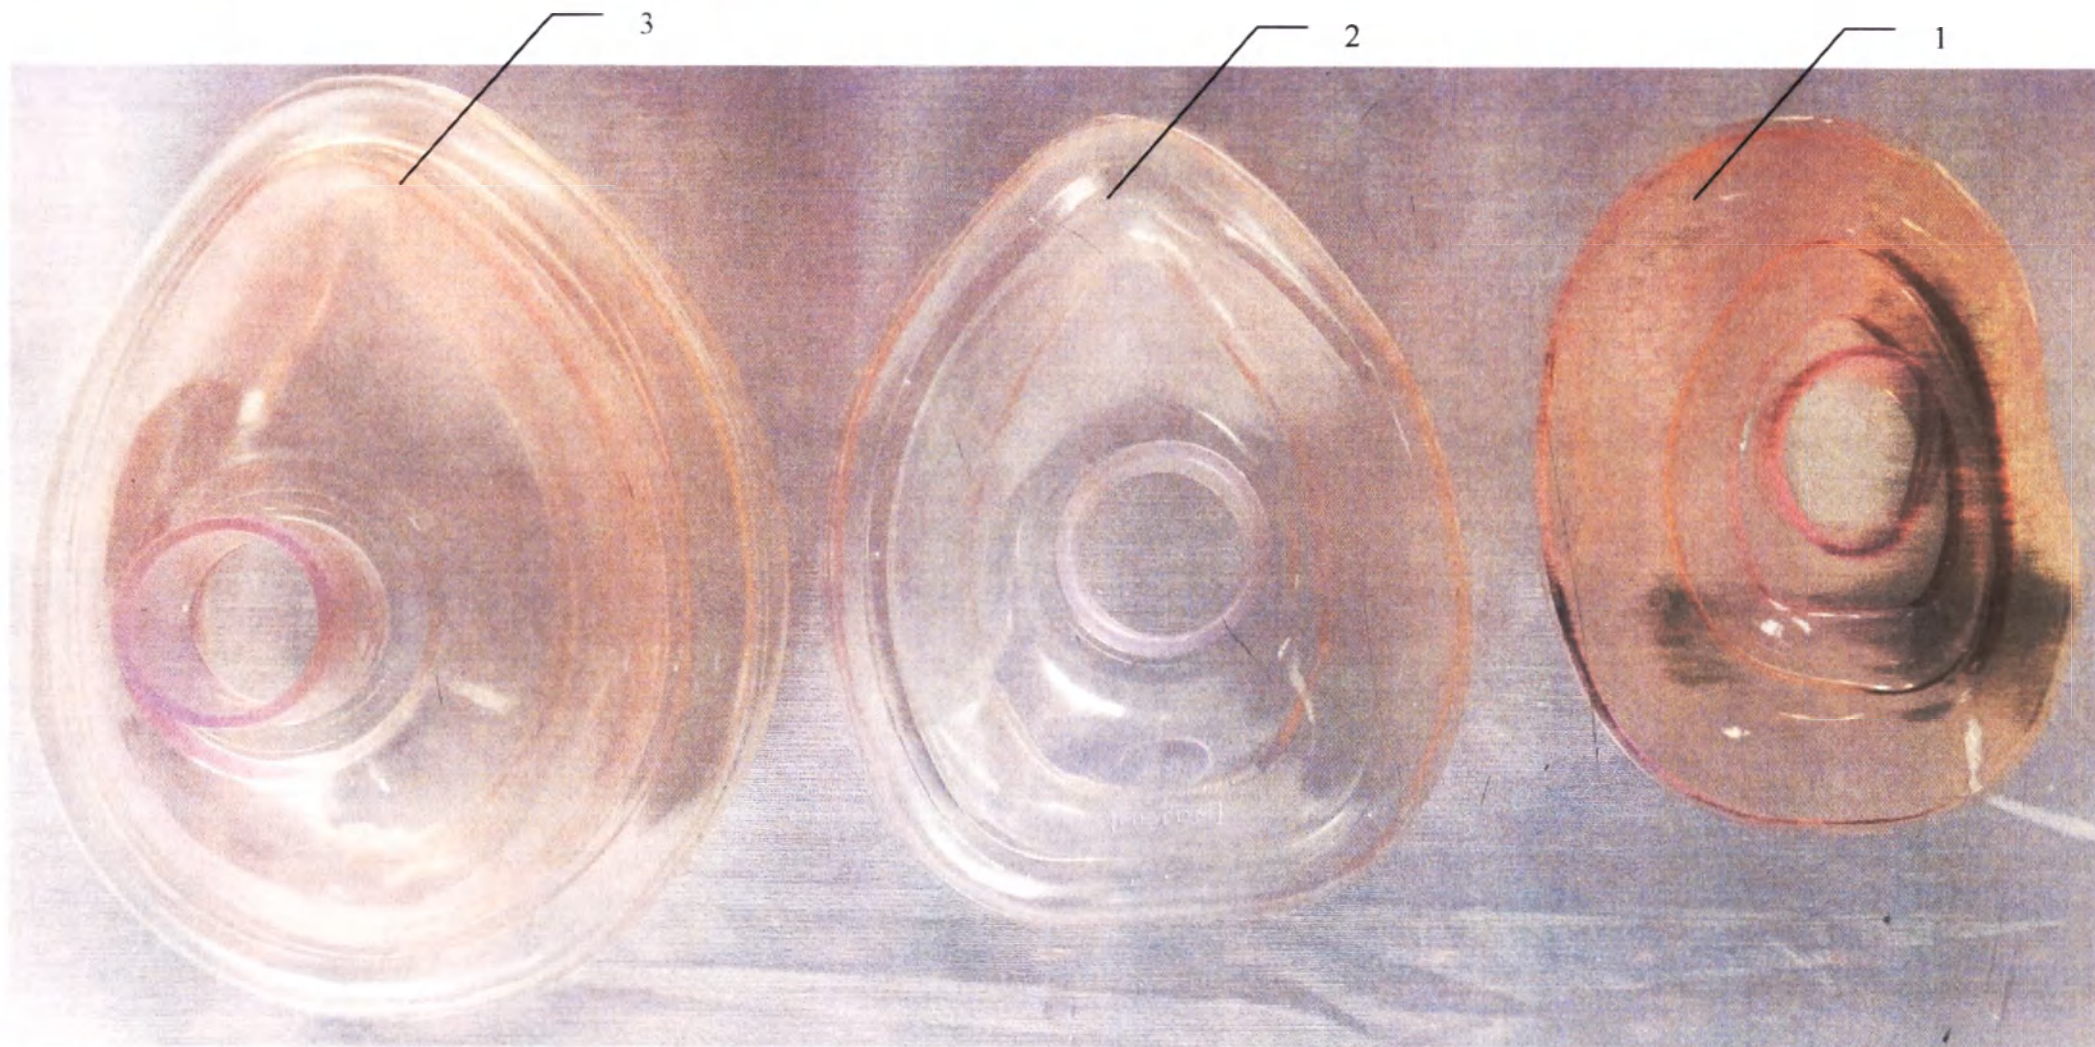


Фотография 12 – Маски лицевые полимерные, производства ЗАО НПКФ «Метом», Россия, РУ № ФСР № 2007/01323:

1 – тип Б2-95 (детская); 2 – тип Б2-125 (средняя); 3 – тип Б2-145 (крупная)

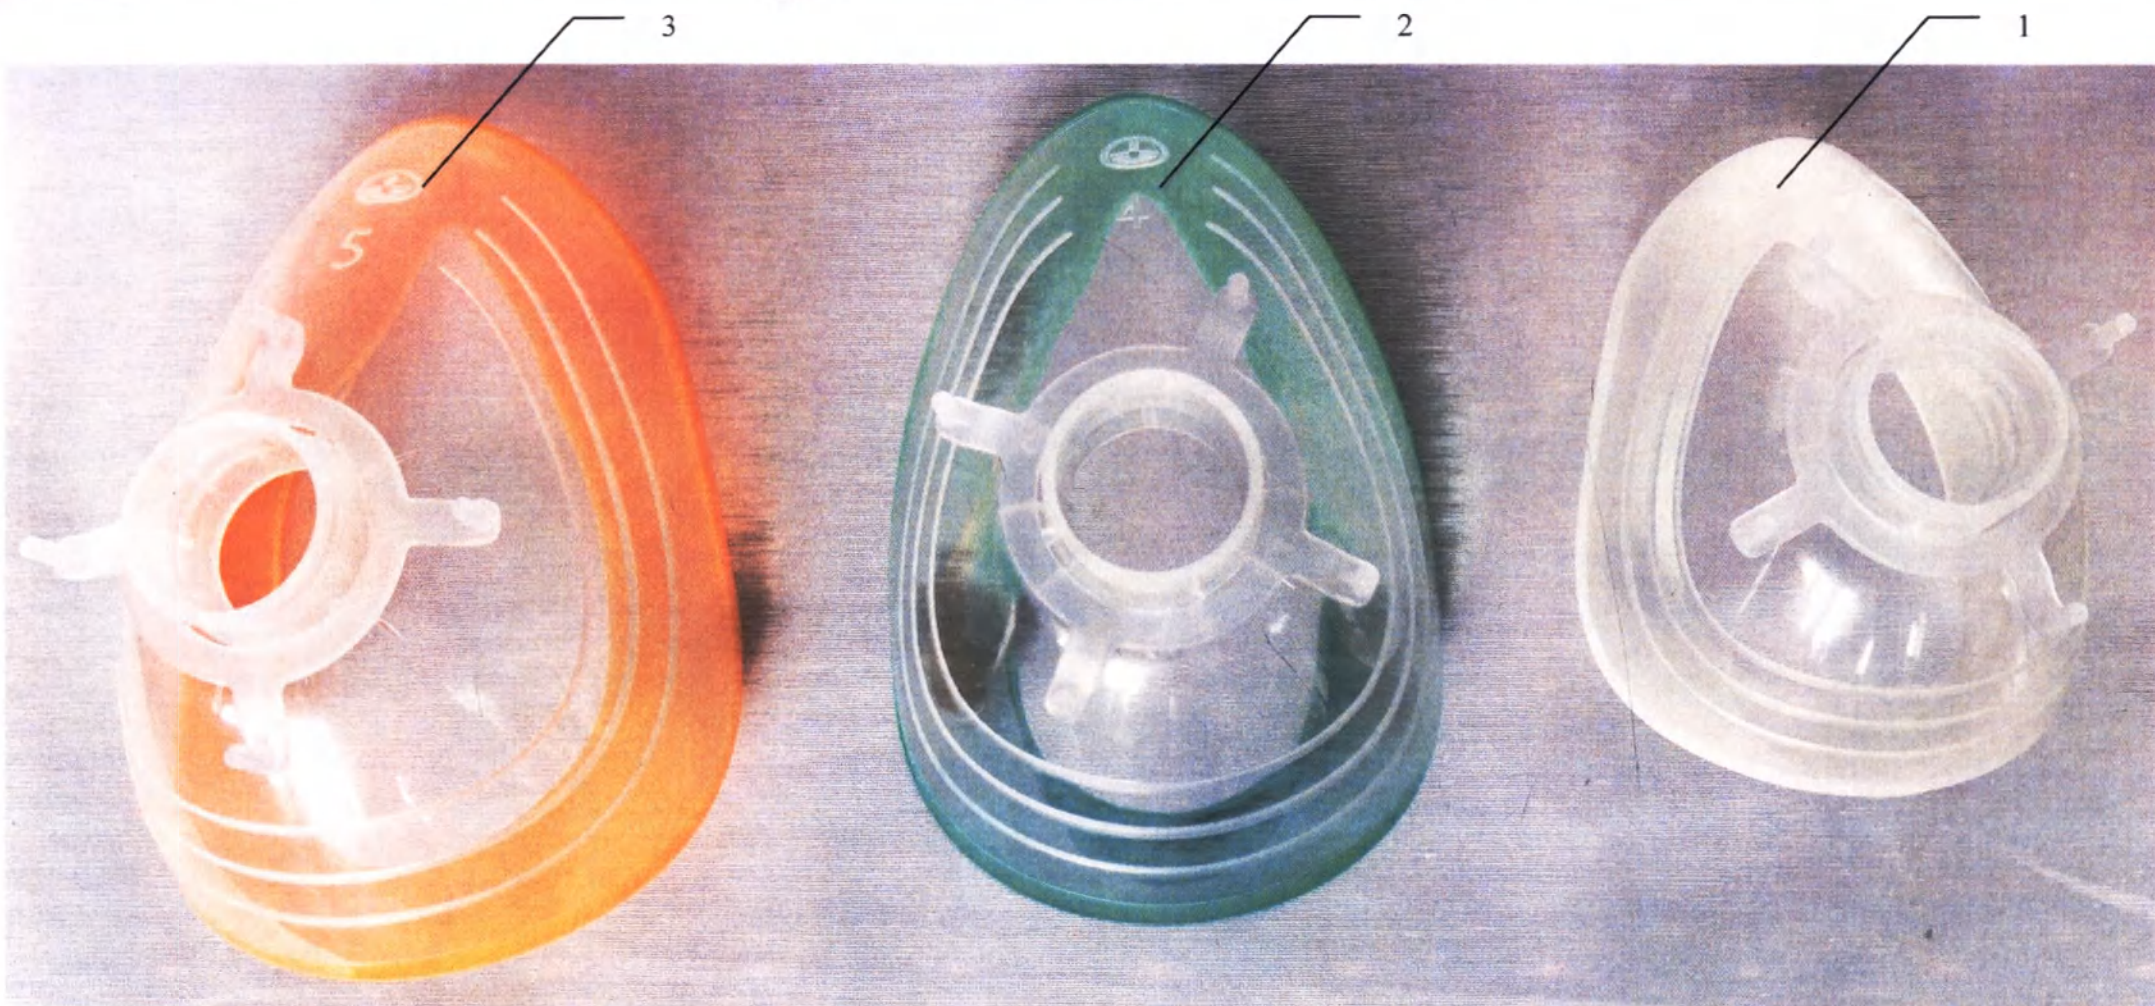


*Фотография 13 – Анестезиологические маски QuadraLite, производства «Интерседжикал Лтд.»,
Соединенное Королевство. РУ № ФСЗ 2009/03551;*

1 – размер 2; 2 – размер 4; 3 – размер 5

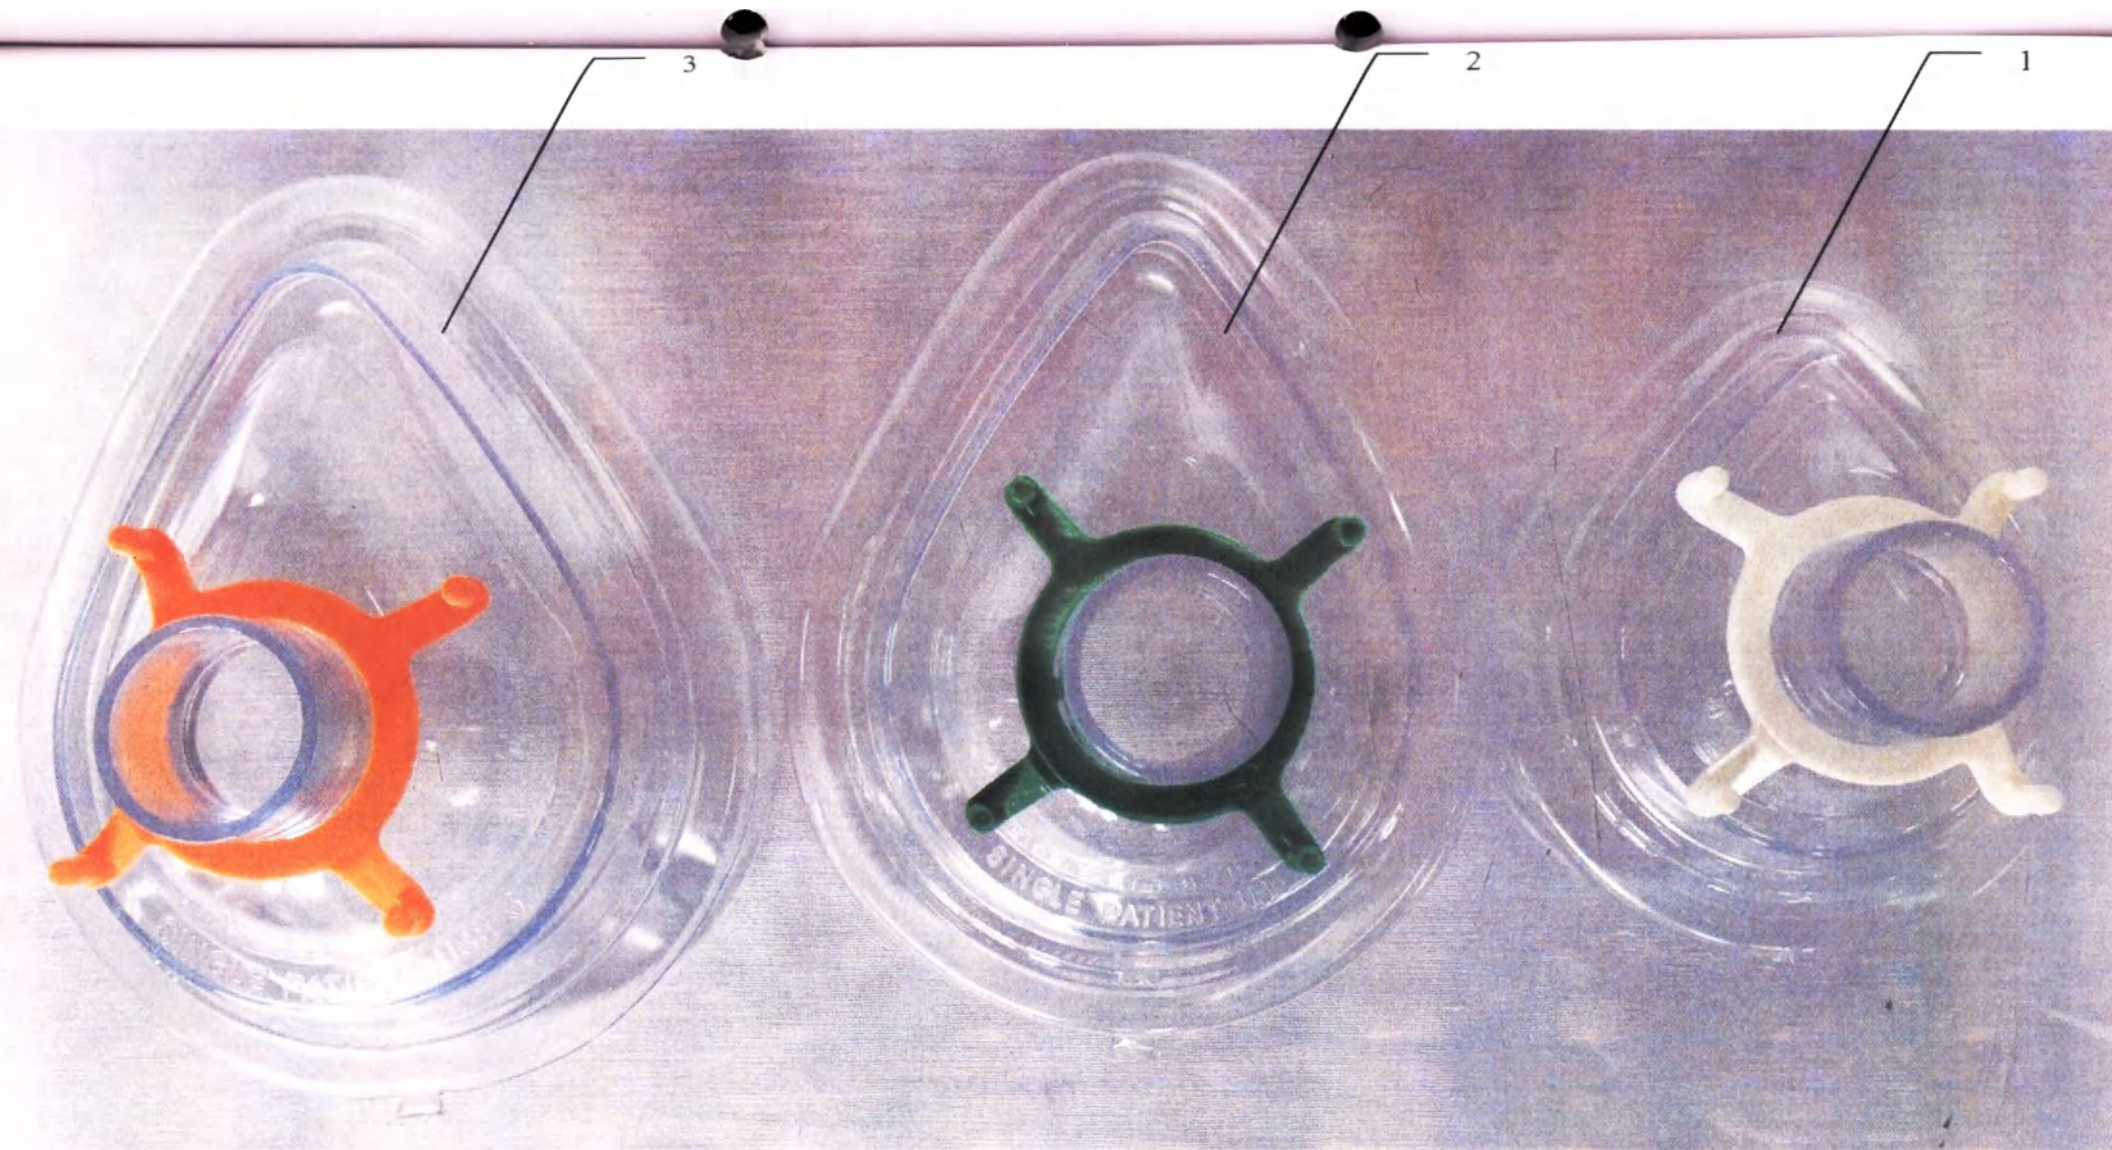


*Фотография 14 – Экономичные анестезиологические лицевые маски, производства «Интерседжикал Лтд.»,
Соединенное Королевство. РУ № ФСЗ 2009/03551;*


1 – размер 2; 2 – размер 4; 3 – размер 5

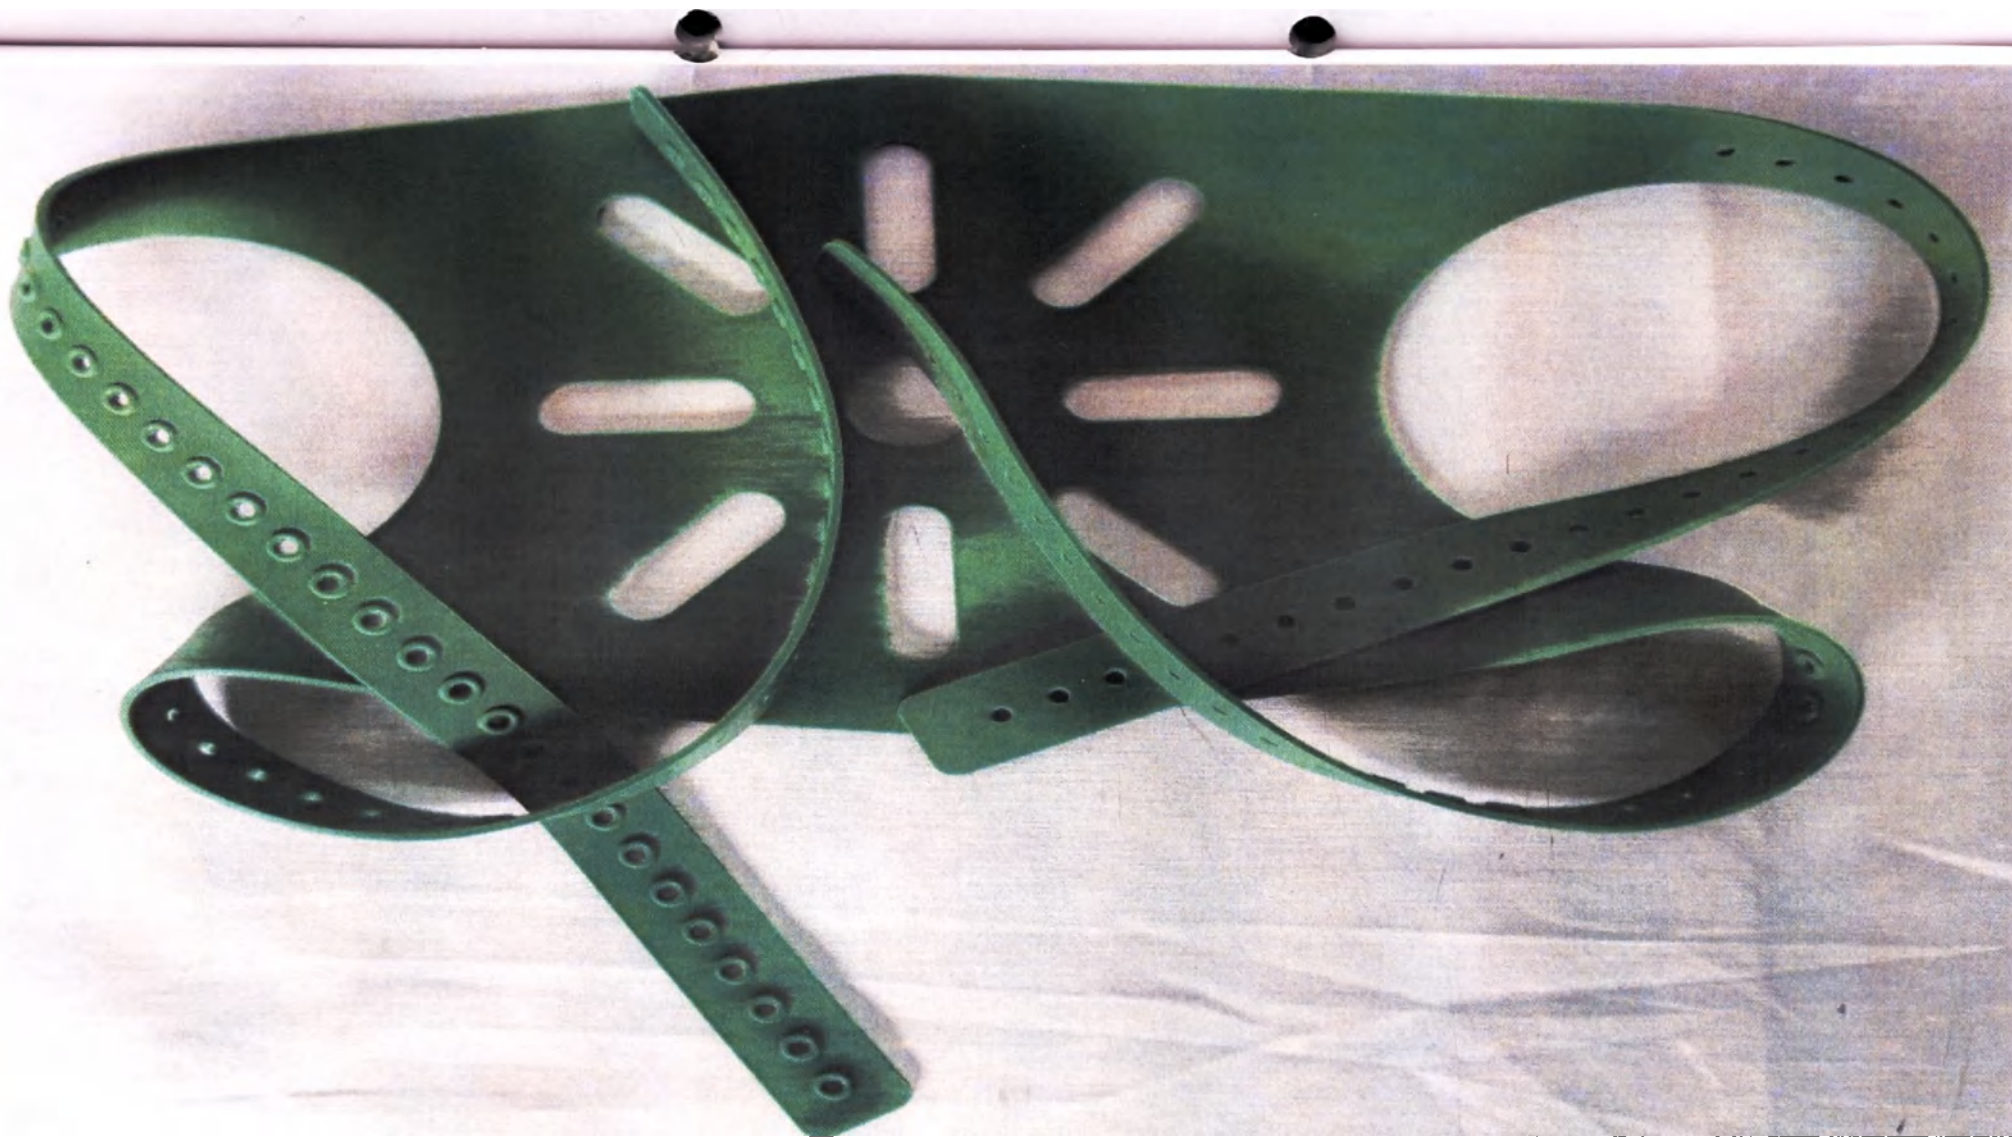

Фотография 15 – Держатели-фиксаторы: для масок – эластомерные головные, кольцо: для взрослых, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551

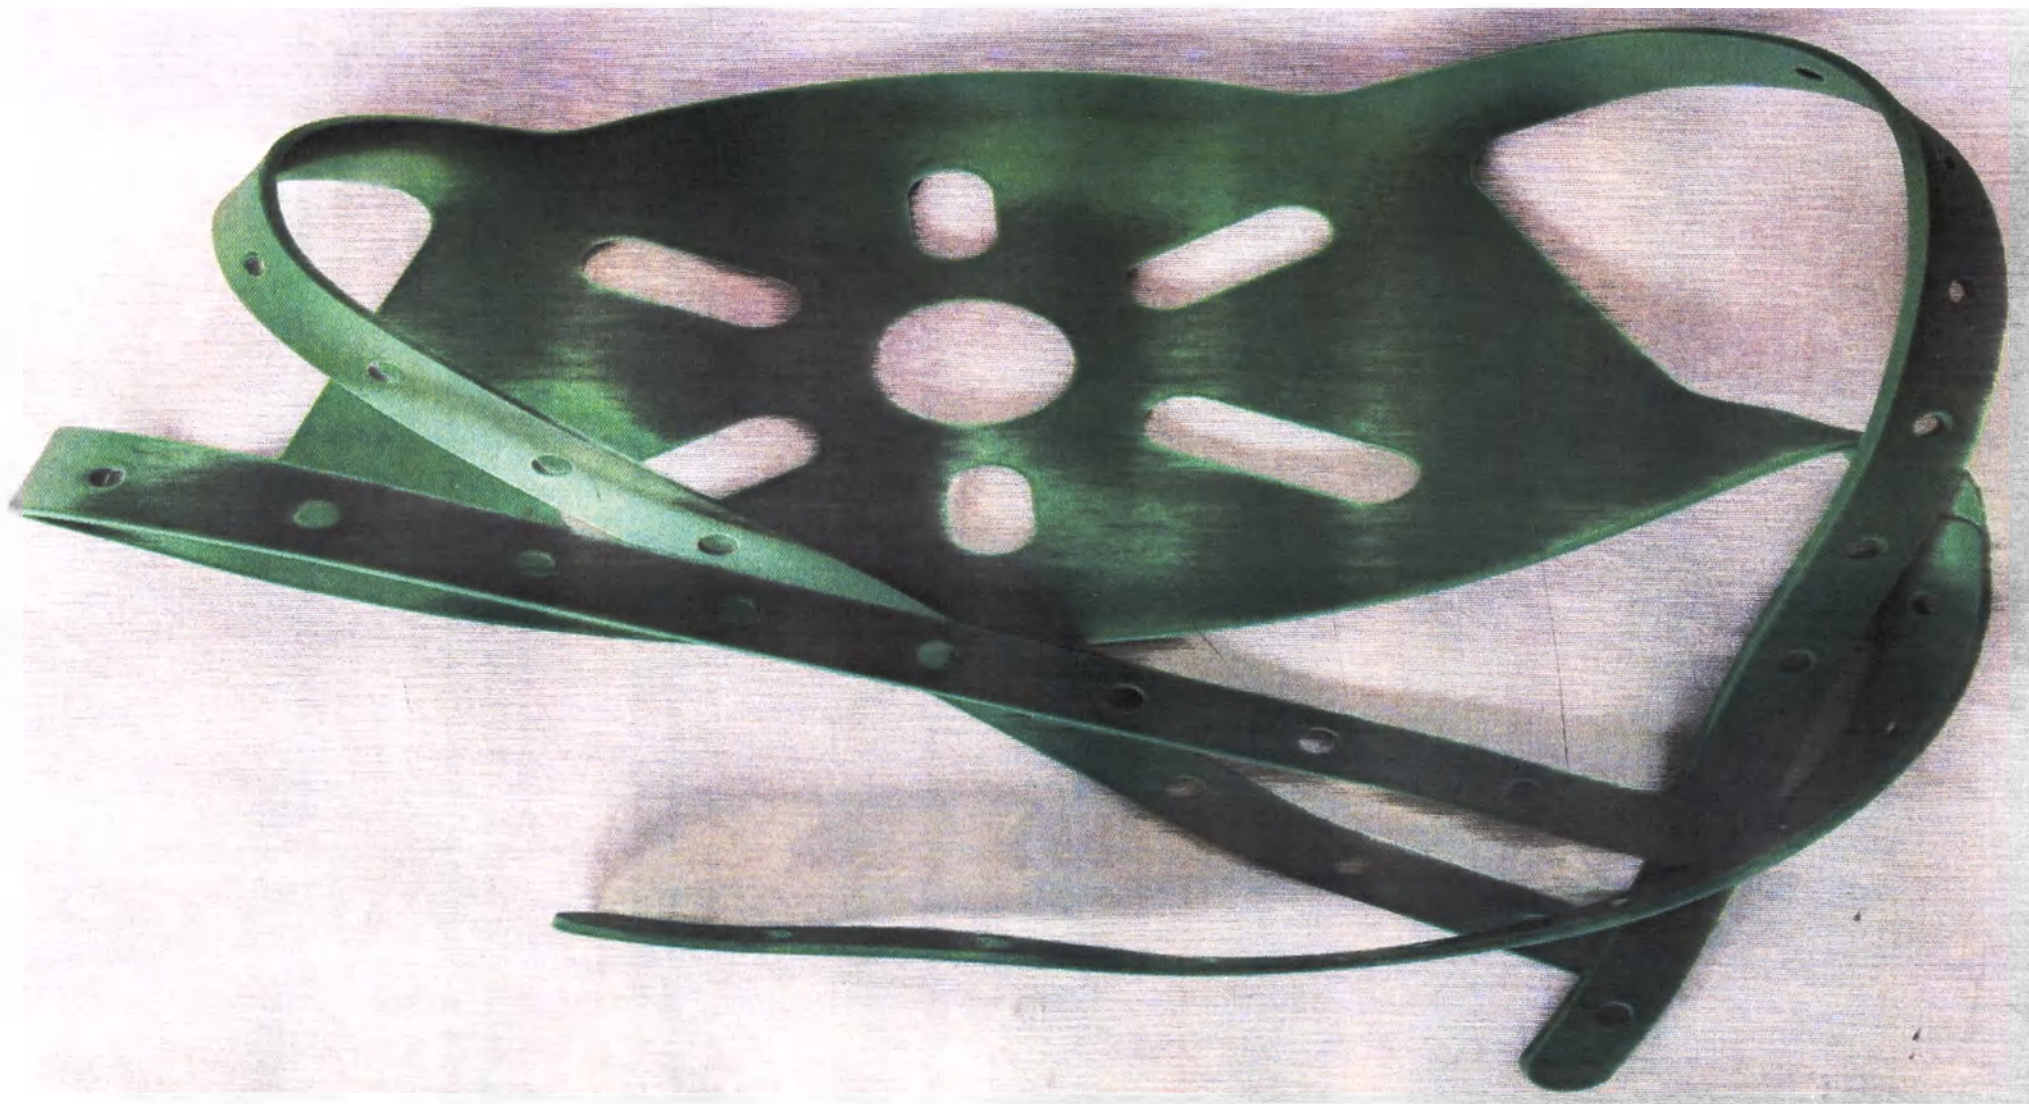


Фотография 16 – Держатели-фиксаторы: для масок – эластомерные головные, кольцо: для детей, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551

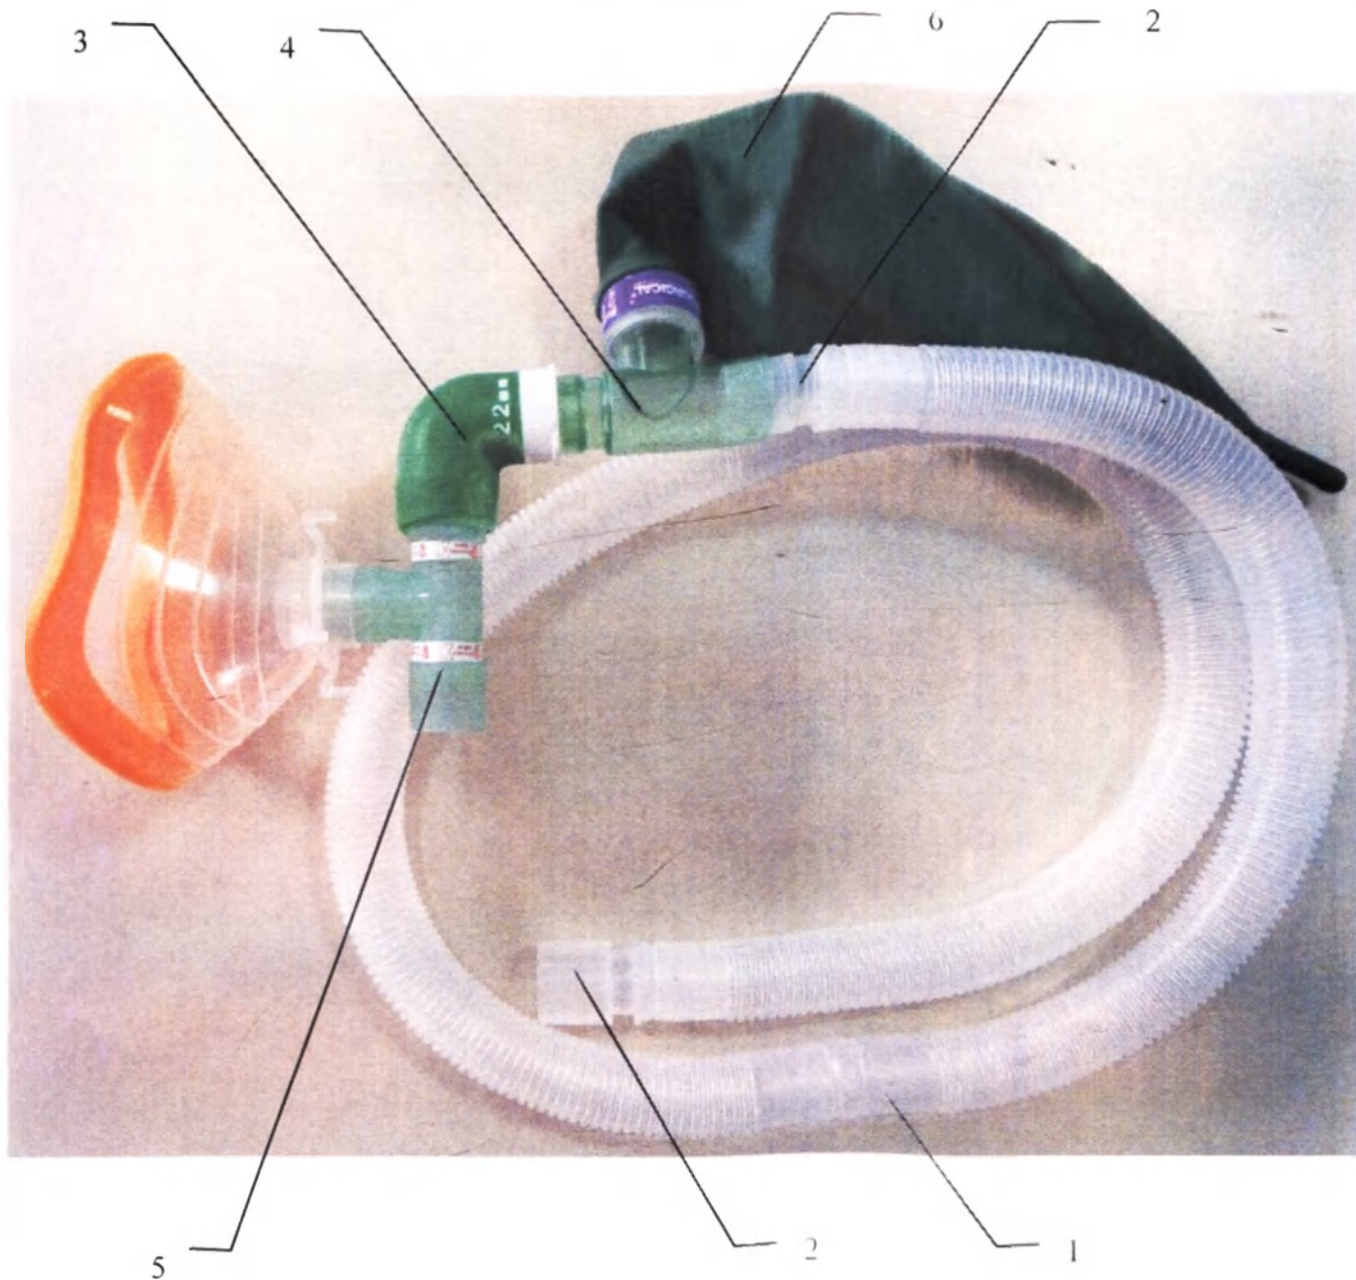


Фотография 17 – Дыхательный контур для режима FSV, в составе:


1 – Дыхательные шланги в комплекте с соединителями или без шланги для дыхательных контуров, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551; 2 – Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: прямые, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551; 3 – Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: угловые, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551; 4 – Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Т-образные, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551; 5 – Дыхательные клапаны обратные производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551; 6 – Дыхательные мешки объемом: 2.0 л, производства «Интерседжикал Лтд.», Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551

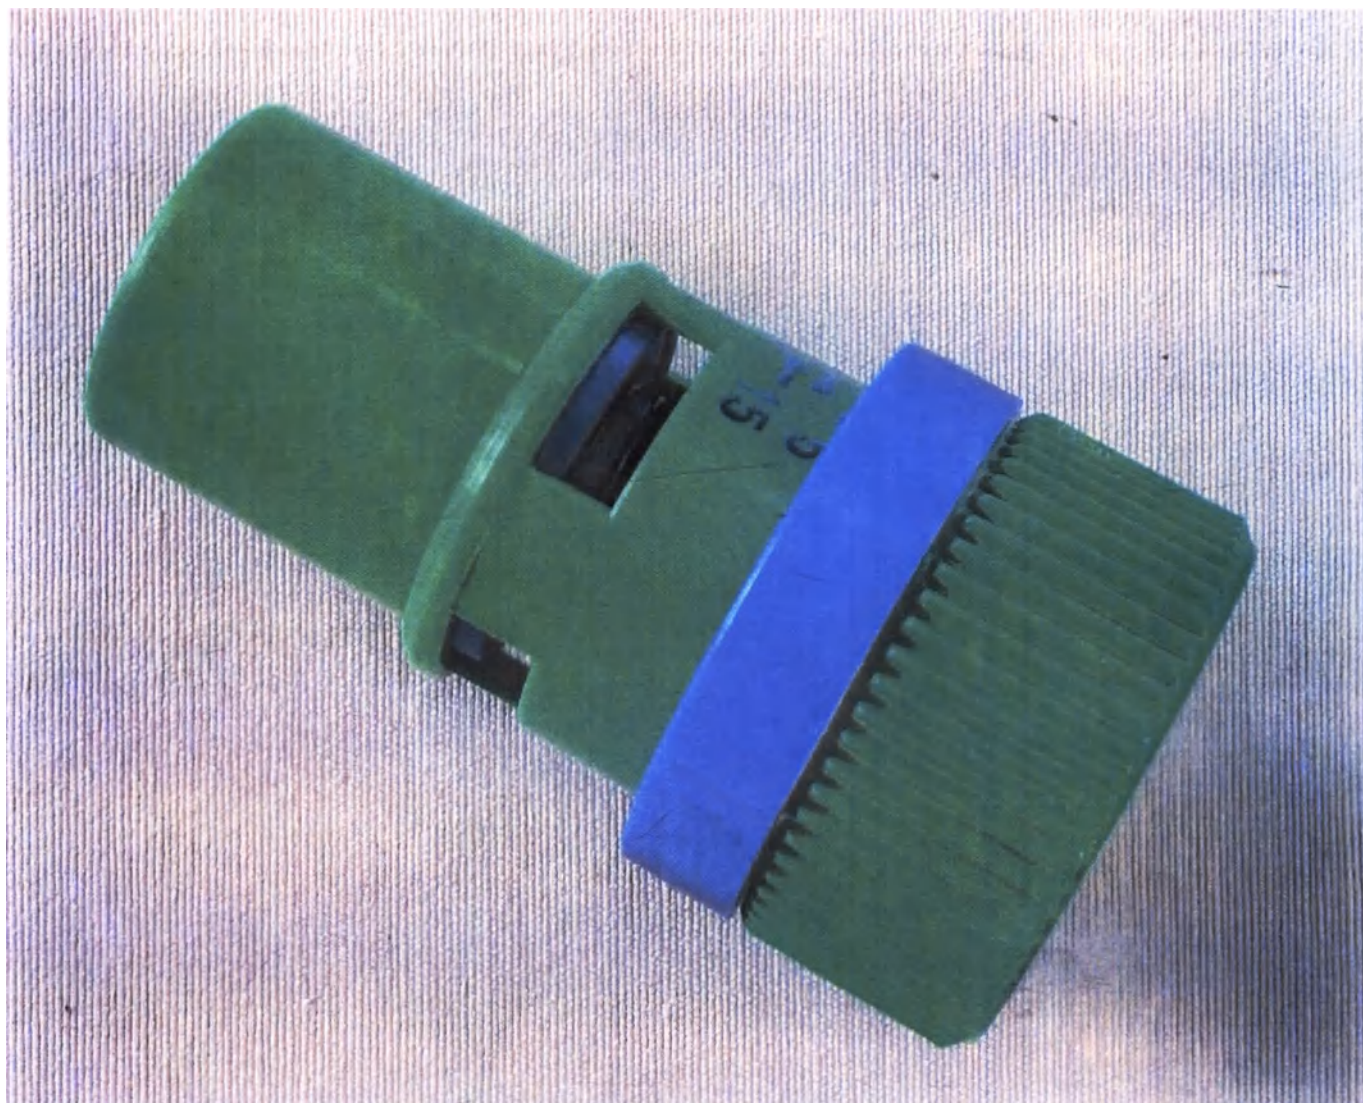

**Фотография 18 – Дыхательные клапаны: клапаны РЕЕР,
производства «Интерседжикал Лтд.»
Соединенное Королевство. РУ № ФСЗ 2009 03551**

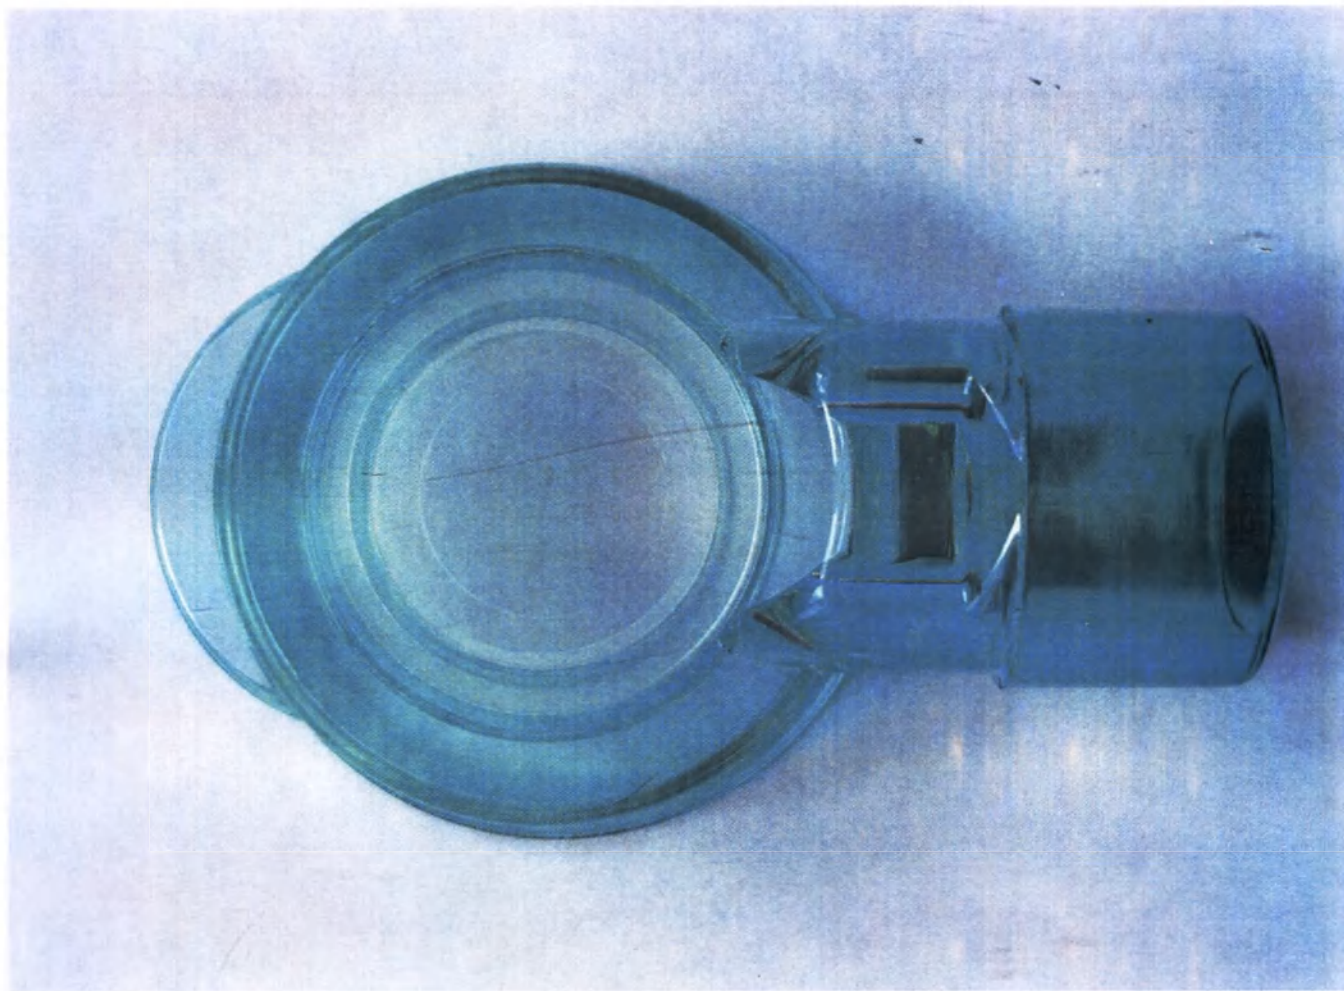


Фотография 19 – Ресанимационные системы подтиркула РЕР
производства «Интерседжикал Лтд.»
Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551

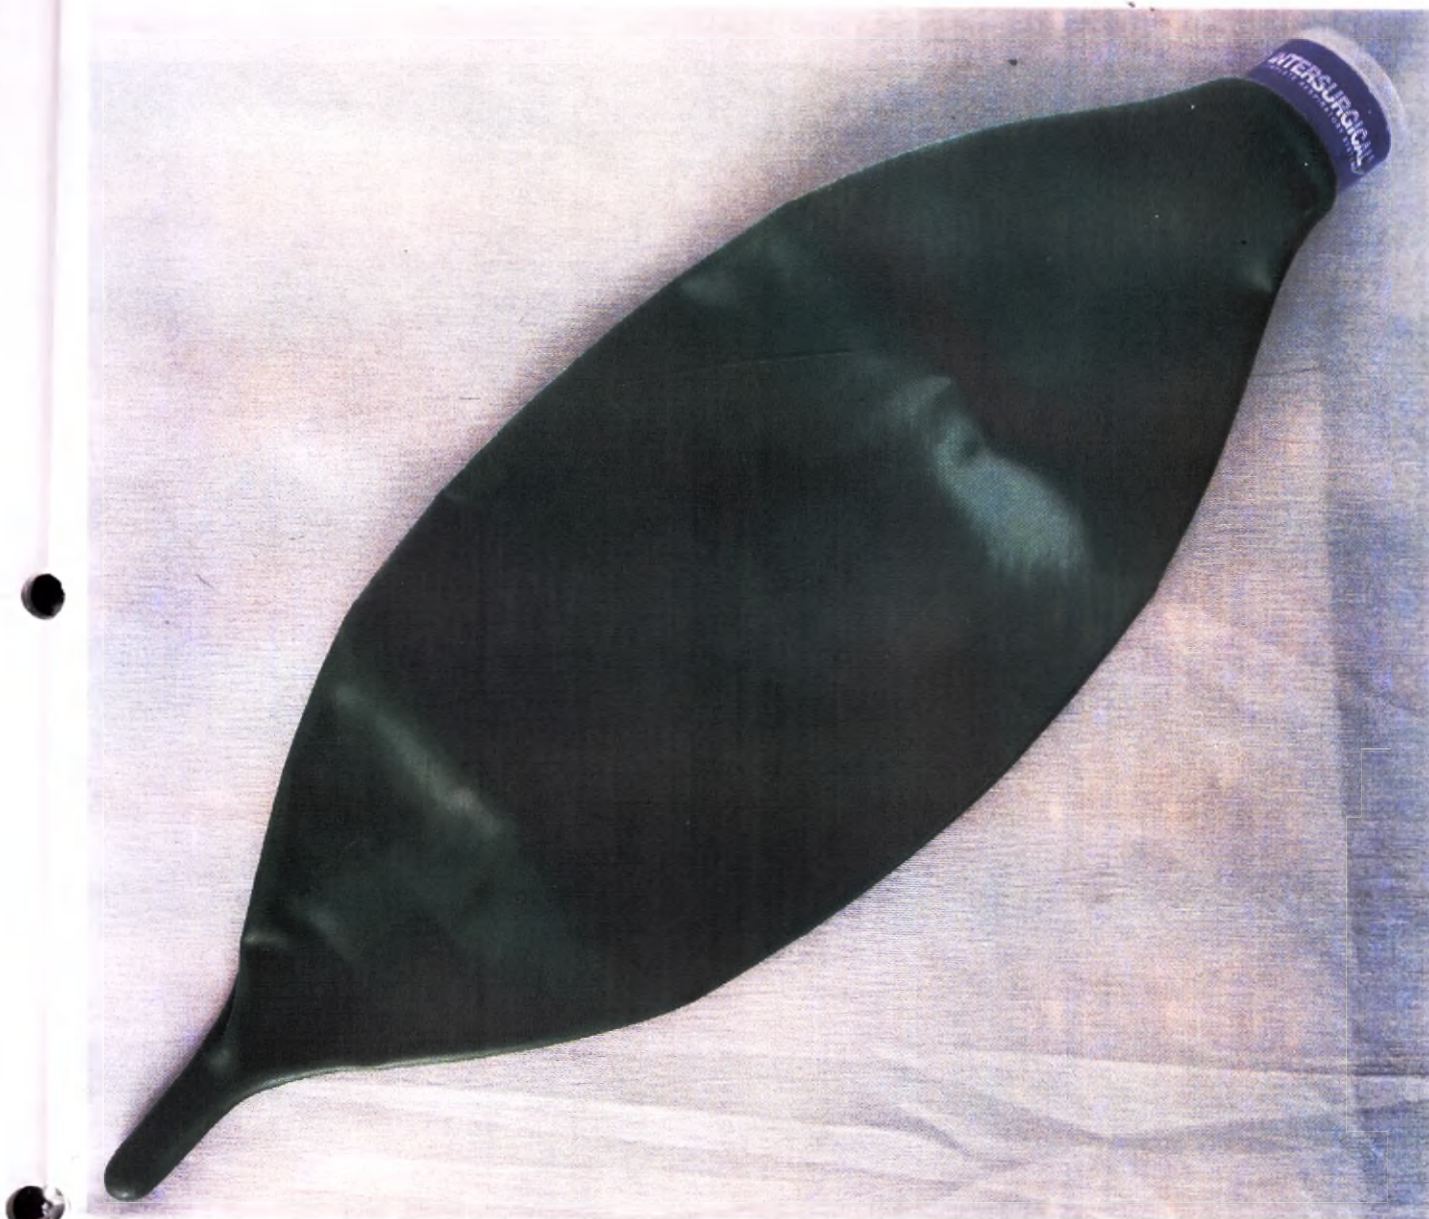

Фотография 20 – Дыхательные мешки объёмом: 2,0 л. производства «Интерседжикал Лтд.» Соединенное Королевство. РУ № ФСЗ 2009 03551



*Фотография 21 – Мешки резервные дыхательные,
производства «Пит.Айр Медикал», Франция. РУ № ФСЗ 2009.03742*

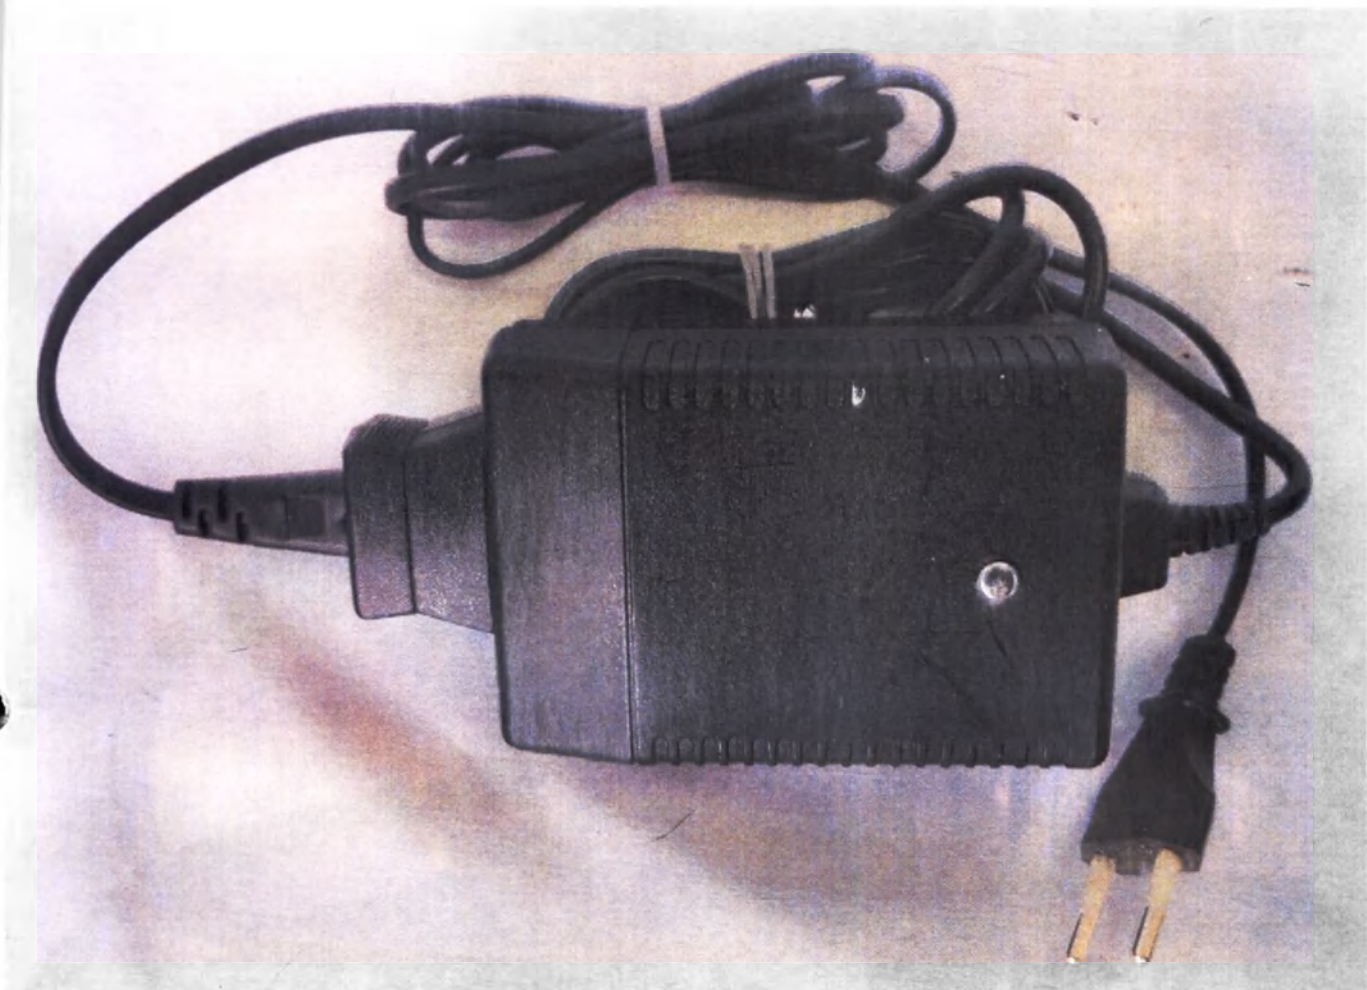

Фотография 22 *Источник питания AC-DC, MPP15 Medical, вход 100...240V AC, 50...60Гц, выход 12В/1,25А, фирма FRIVO, Германия*




**Фотография 23 – Источник питания 10,0-14,9 VDC, max 1,6 А, 47...63 Гц,
фирма MASCOT, Эстония; или Источник питания 9,0-10,0 VDC, max 1,33 А, 50...60 Гц,
фирма MASCOT, Эстония**



Фотография 24 -- Принадлежность: Футбольный клуб "Спартак"



Фотография 25 – Принадлежности: Кабель питания от бортовой сети автомобиля,
12/3В. ППТД.6644 003

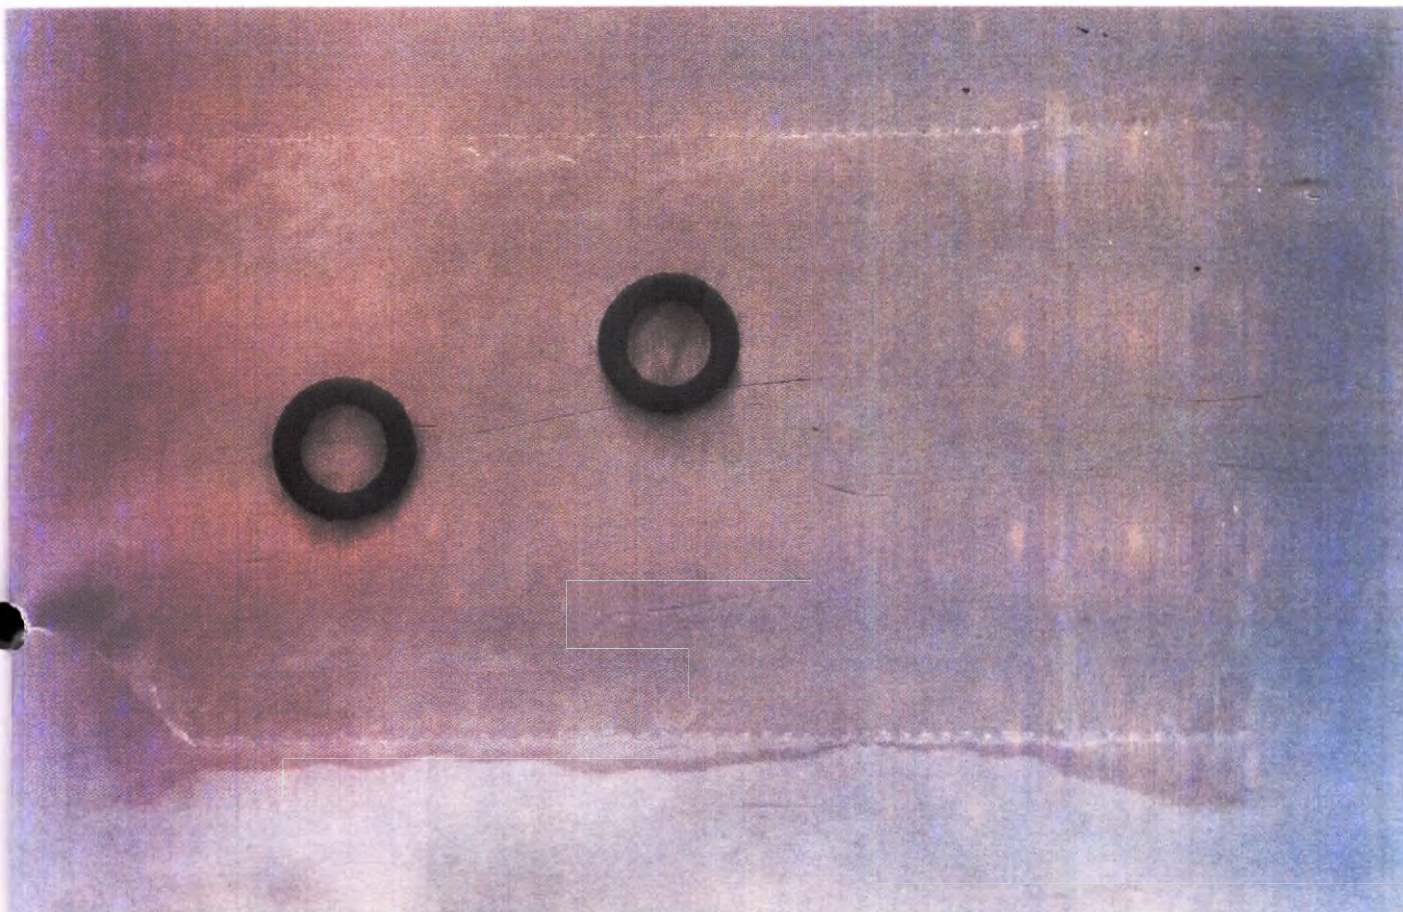

Фотография 26 – Принадлежности: Кольцо (2 шт.)

Всего прошито пронумеровано и
скреплено печатью _____
листов.

Генеральный директор
Пушков А.В.

/ _____

