

Фотографические изображения МИ

«Анализатор гемостаза автоматический cobas t для диагностики in vitro с принадлежностями, варианты исполнения: cobas t 511 coagulation analyzer, cobas t 711 coagulation analyzer»

Анализатор гемостаза автоматический cobas t для диагностики in vitro с принадлежностями, вариант исполнения: cobas t 511 coagulation analyzer, общий вид



I. Анализатор гемостаза автоматический cobas t для диагностики in vitro с принадлежностями, вариант исполнения: cobas t 511 coagulation analyzer


1. Блок основной (cobas t 511 coagulation analyzer), не более 1 шт



2. Автозагрузчик (cobas t 511 Sampling Unit), не более 1 шт.



3. Набор для запуска sobas t 511, в составе:
3.1 Предохранитель 6.3x32 32A 150B, 10 шт.

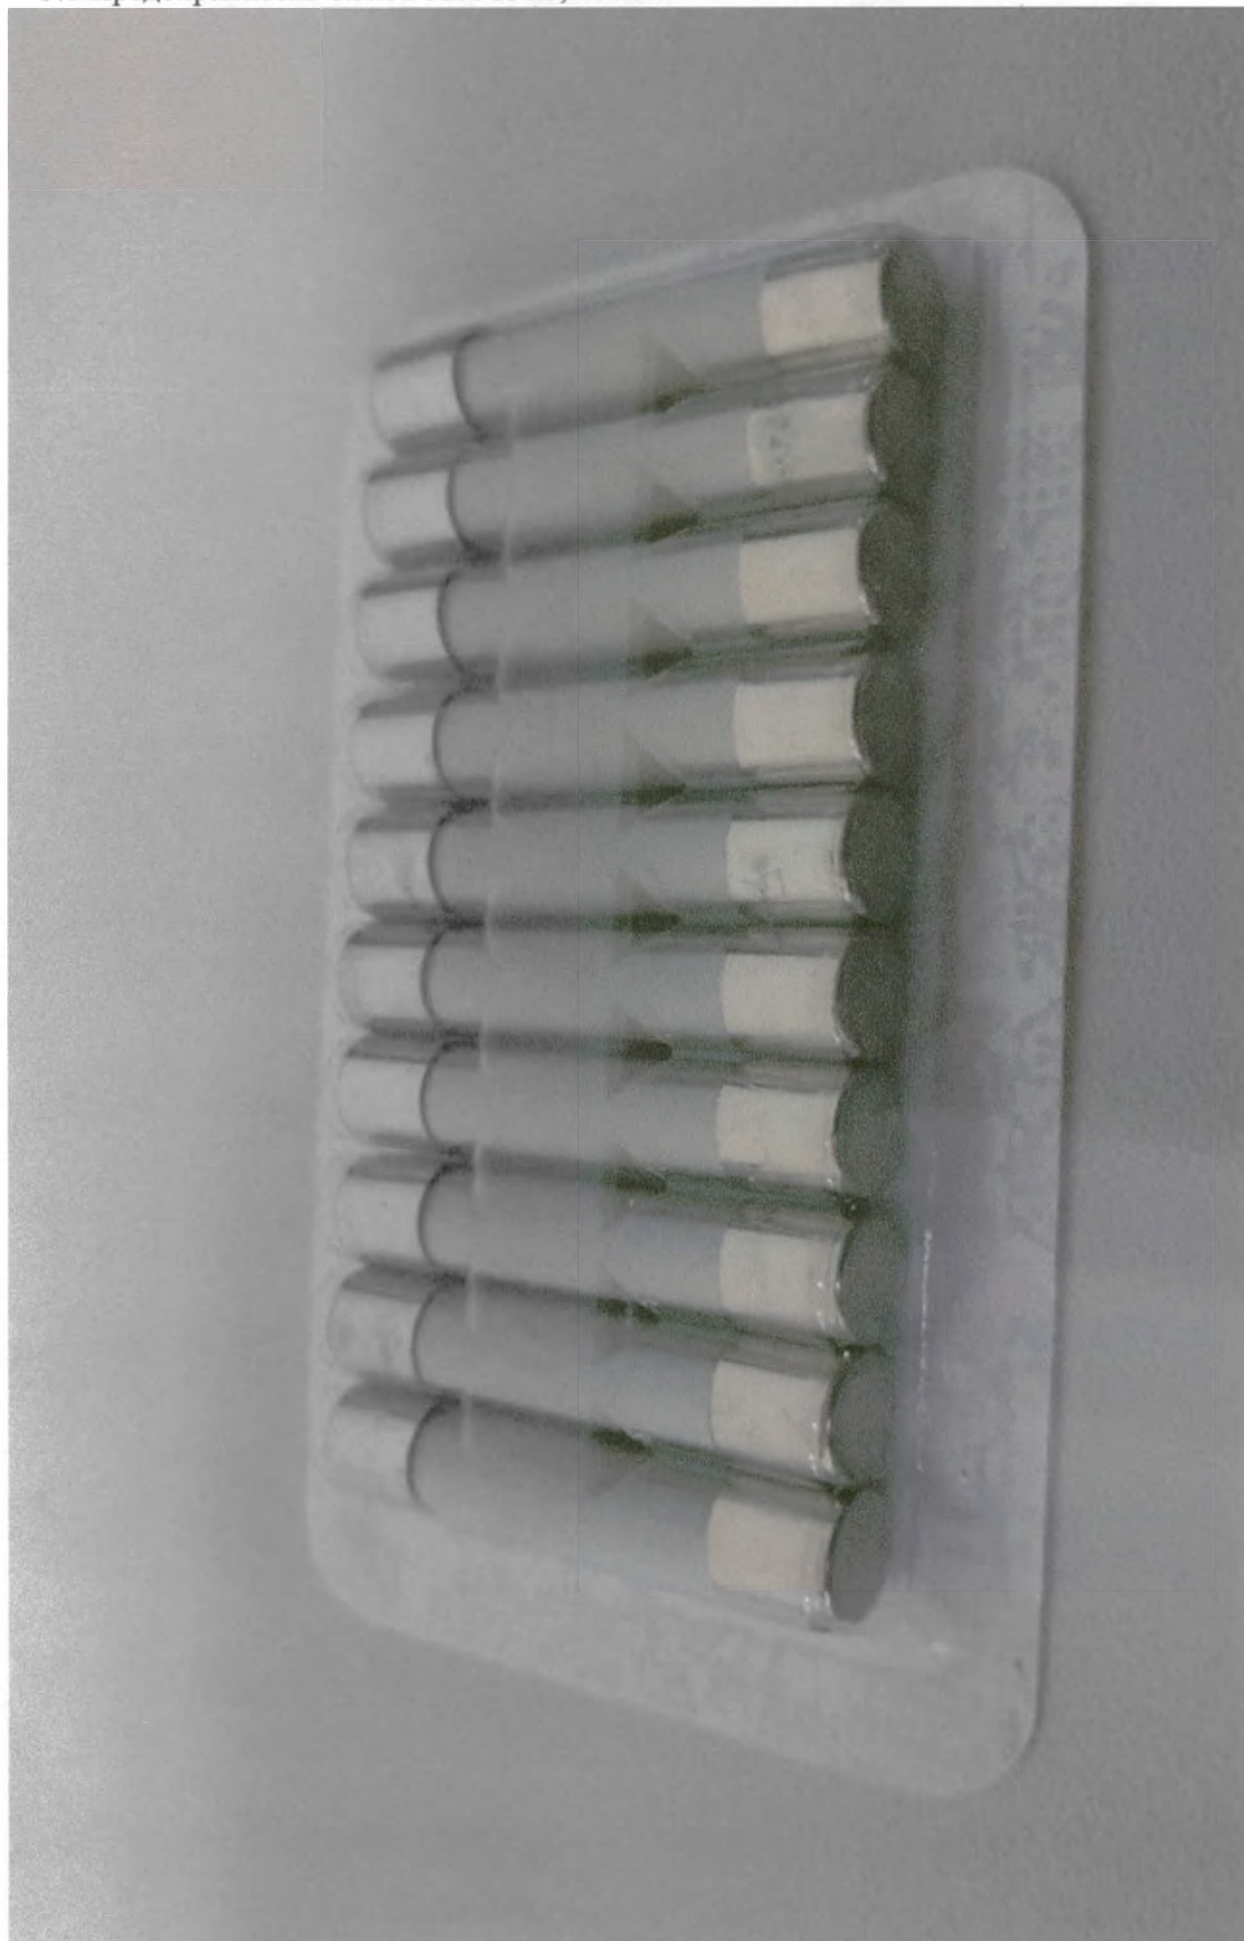



SCHURTER

IEC/EN60127-2/5
Fuse-links 5x20mm



A004739 C **UL** US



JET

SU05016-5002

+82220436909

SCHURTER K.K. 소형퓨즈 5x20mm

Piece

10

Type

SPT

T3.15A H 250VAC



IR UL 10000A/125VAC 1500A/300VDC

P/N 0001.2509

IR1500A/250VAC

Batch 1/10274 Date 1730 Made in China CL





3.5 Кабель питания, 1 шт.




3.6 Пакет для твердых отходов, 80 шт. в упаковке, 1 упаковка.



3.7 Кюветы, 1000 шт. в упаковке, 1 упаковка.



3.8 Наклейка - предупреждение, 1 шт.

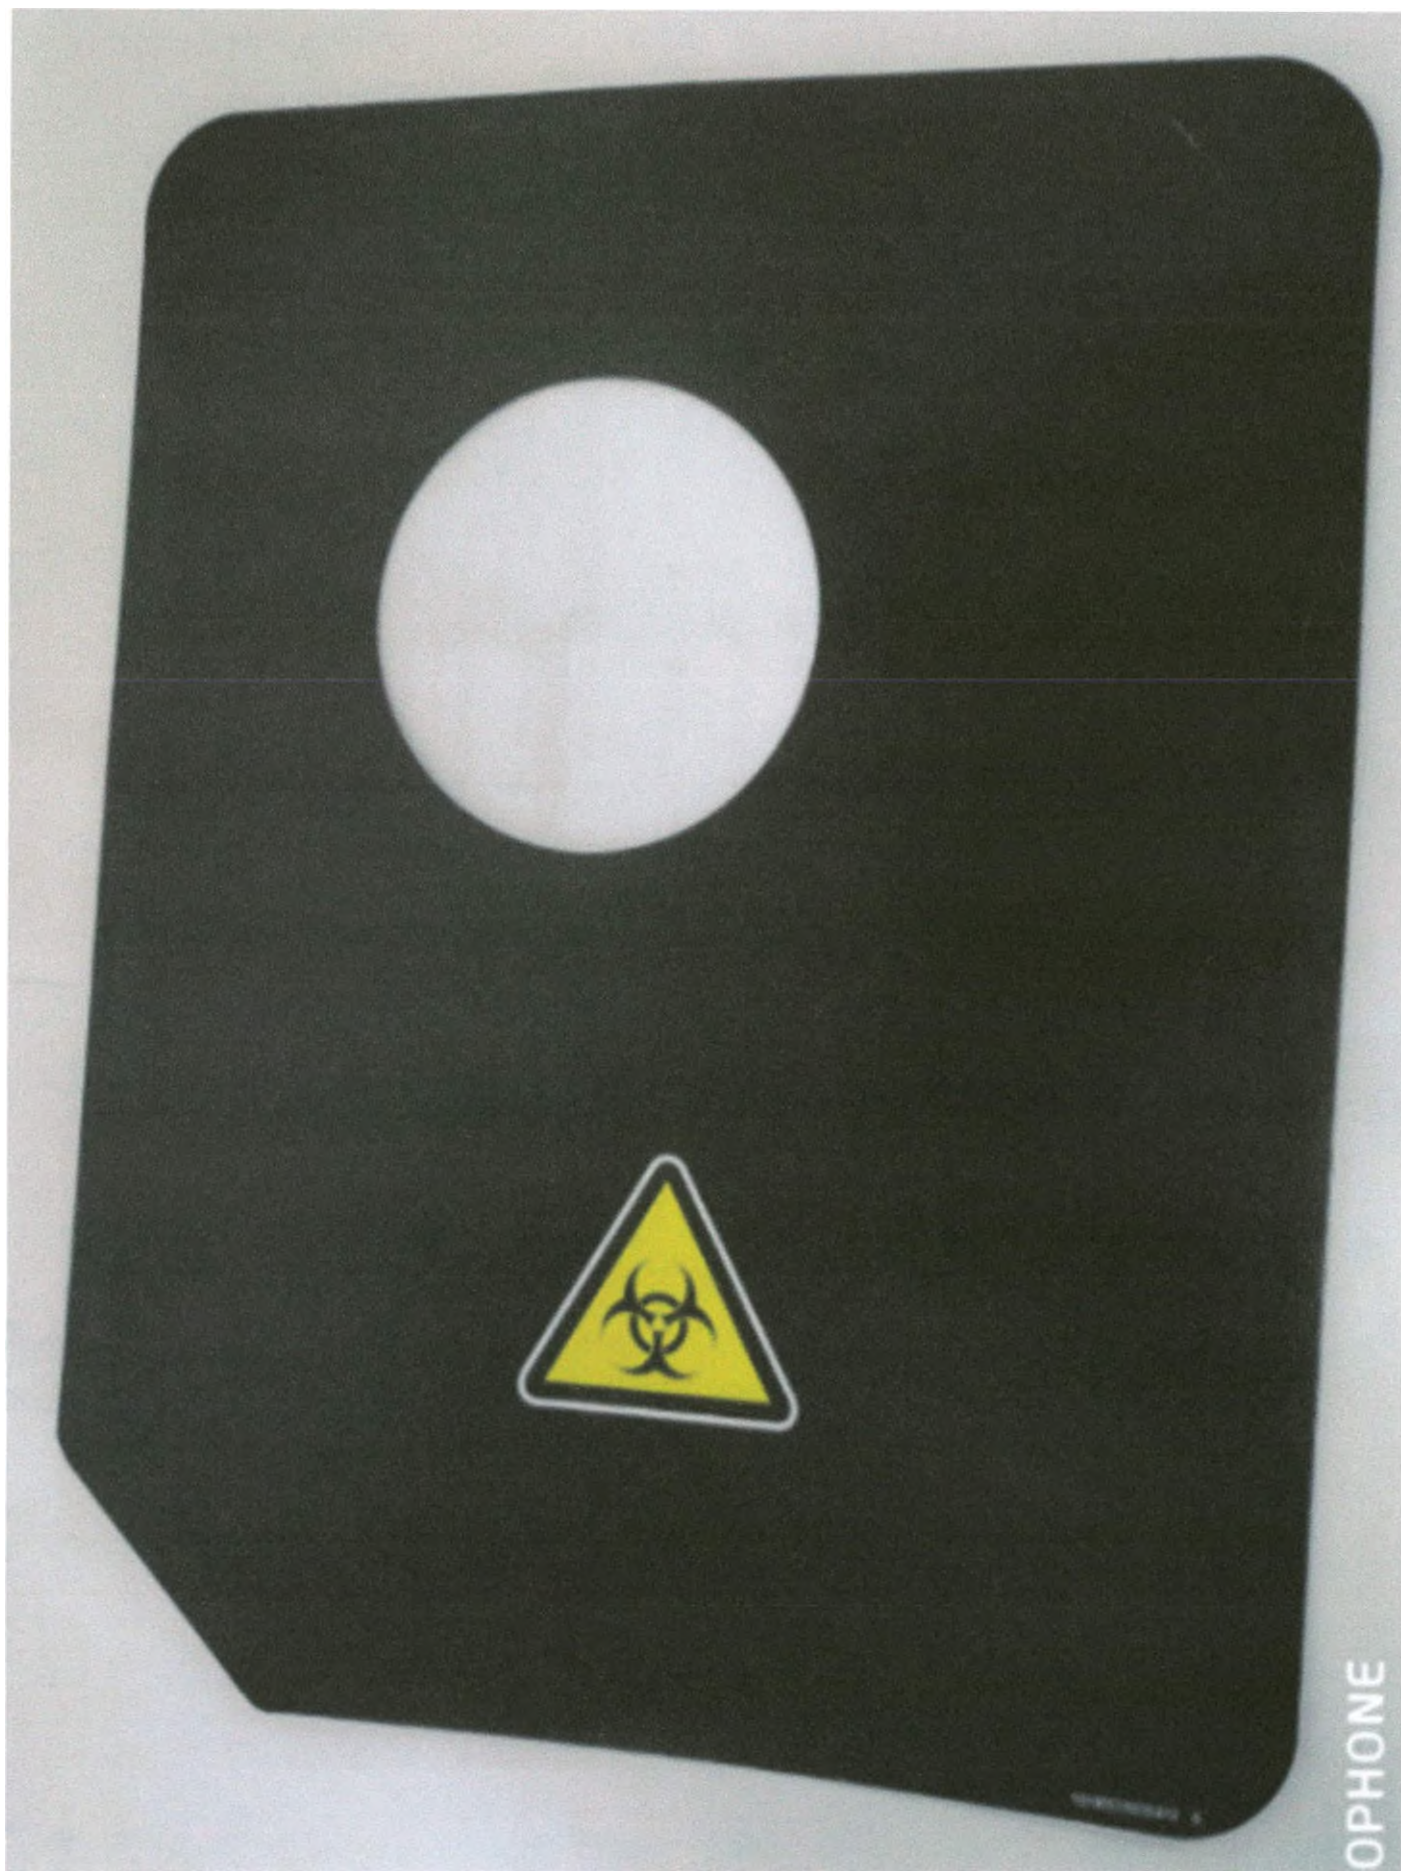

3.9 Кабель сетевой, серый, 1 шт.




3.10 Набор штативов стартовый, в составе:

3.10.1 Штатив для пробирок с переходниками для гемостаза Мxxx, где xxx номер из диапазона 001-200, 1 шт.



3.10.2 Штатив для пробирок для гемостаза, 0xxx, где xxx номер из диапазона 001-250, 1 шт.

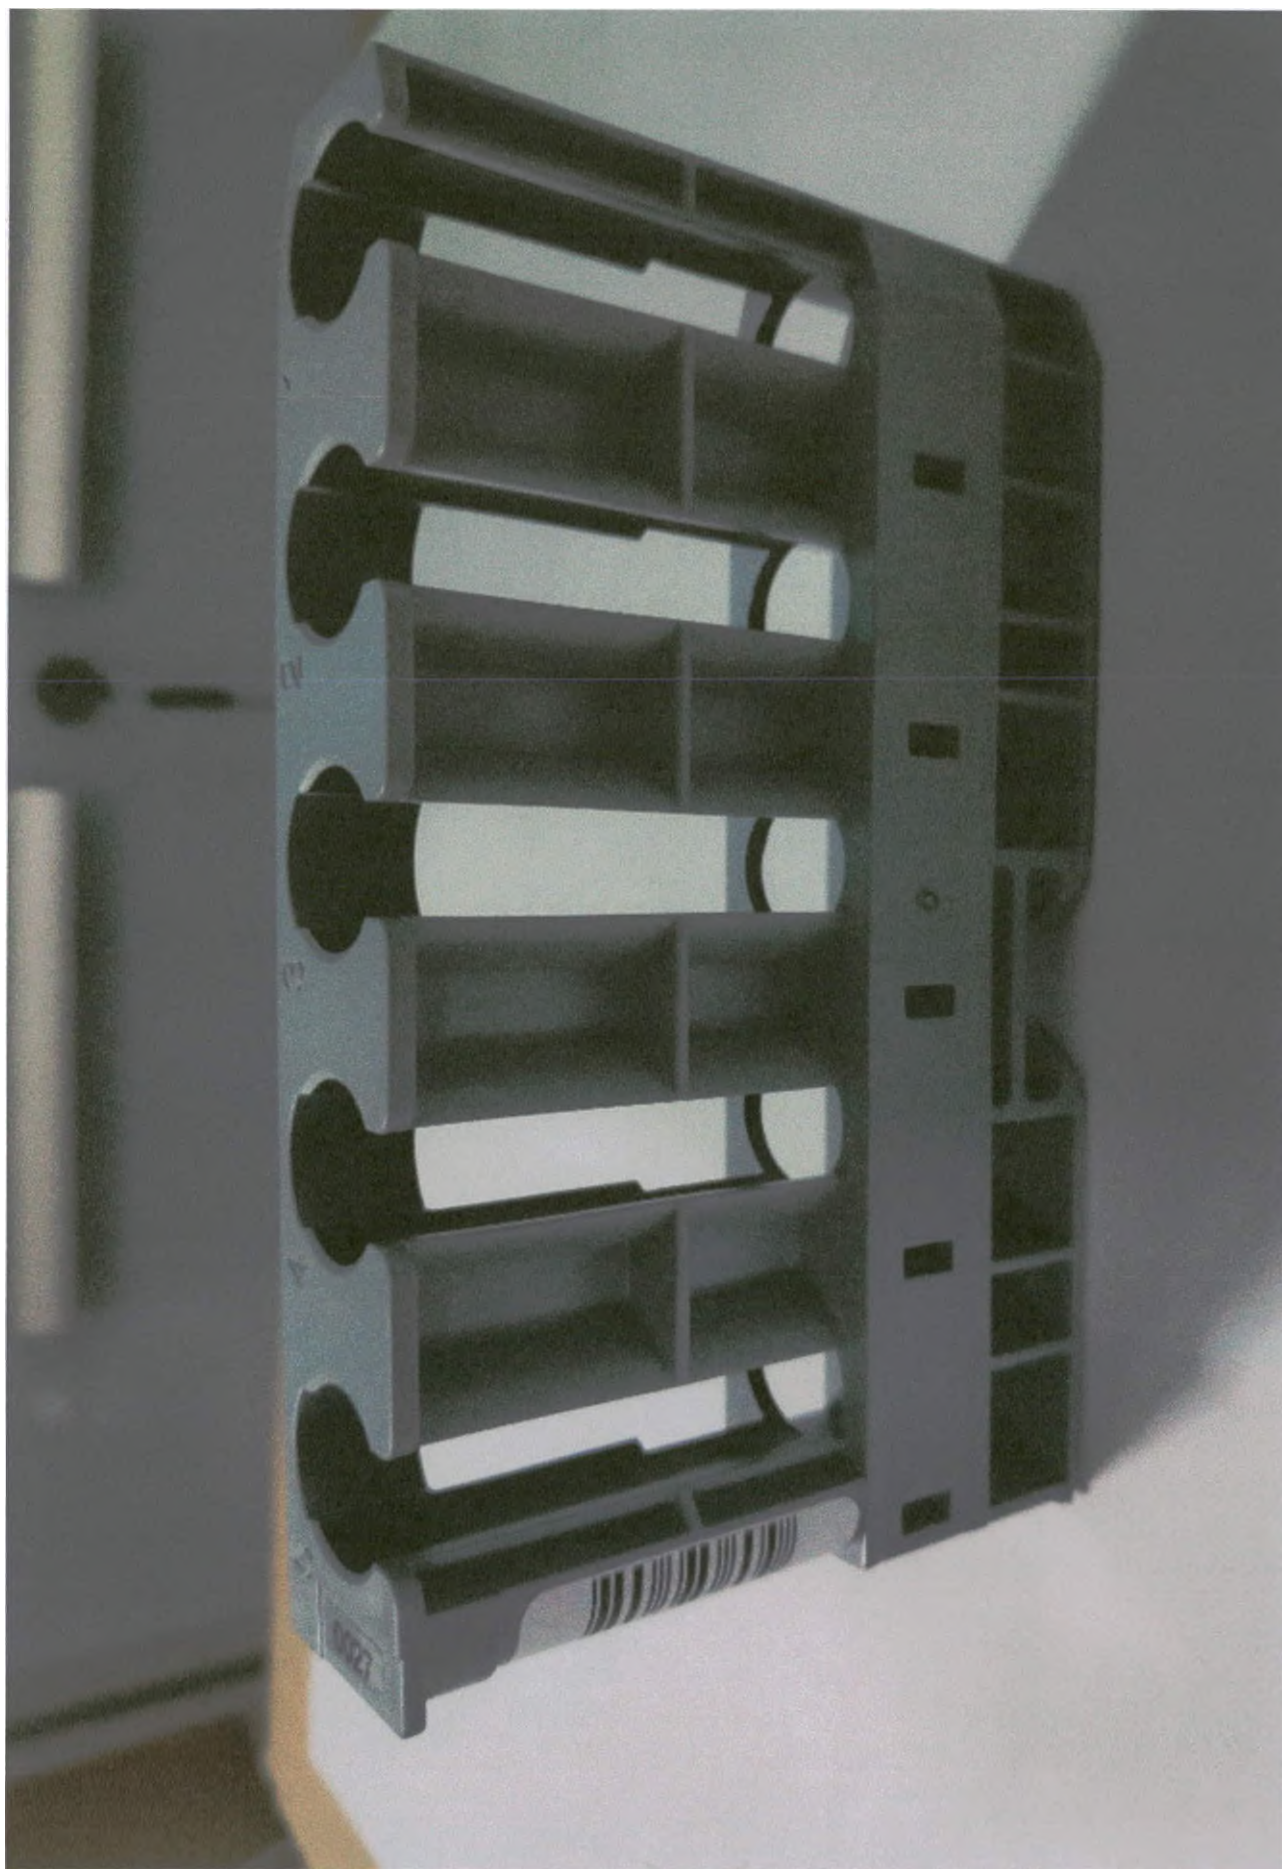

3.10.3 Штатив для контролей гемостаза Qxxx, где xxx номер из диапазона 001-030, 1 шт.




3.10.4 Штатив для калибратора для гемостаза, Сxxx, где xxx номер из диапазона 001-030, 2 шт.




3.11 Набор пробирок для активатора, 6 шт. в упаковке, 1 упаковка.



3.12 Фильтр, 10 шт. в упаковке, 3 уп.

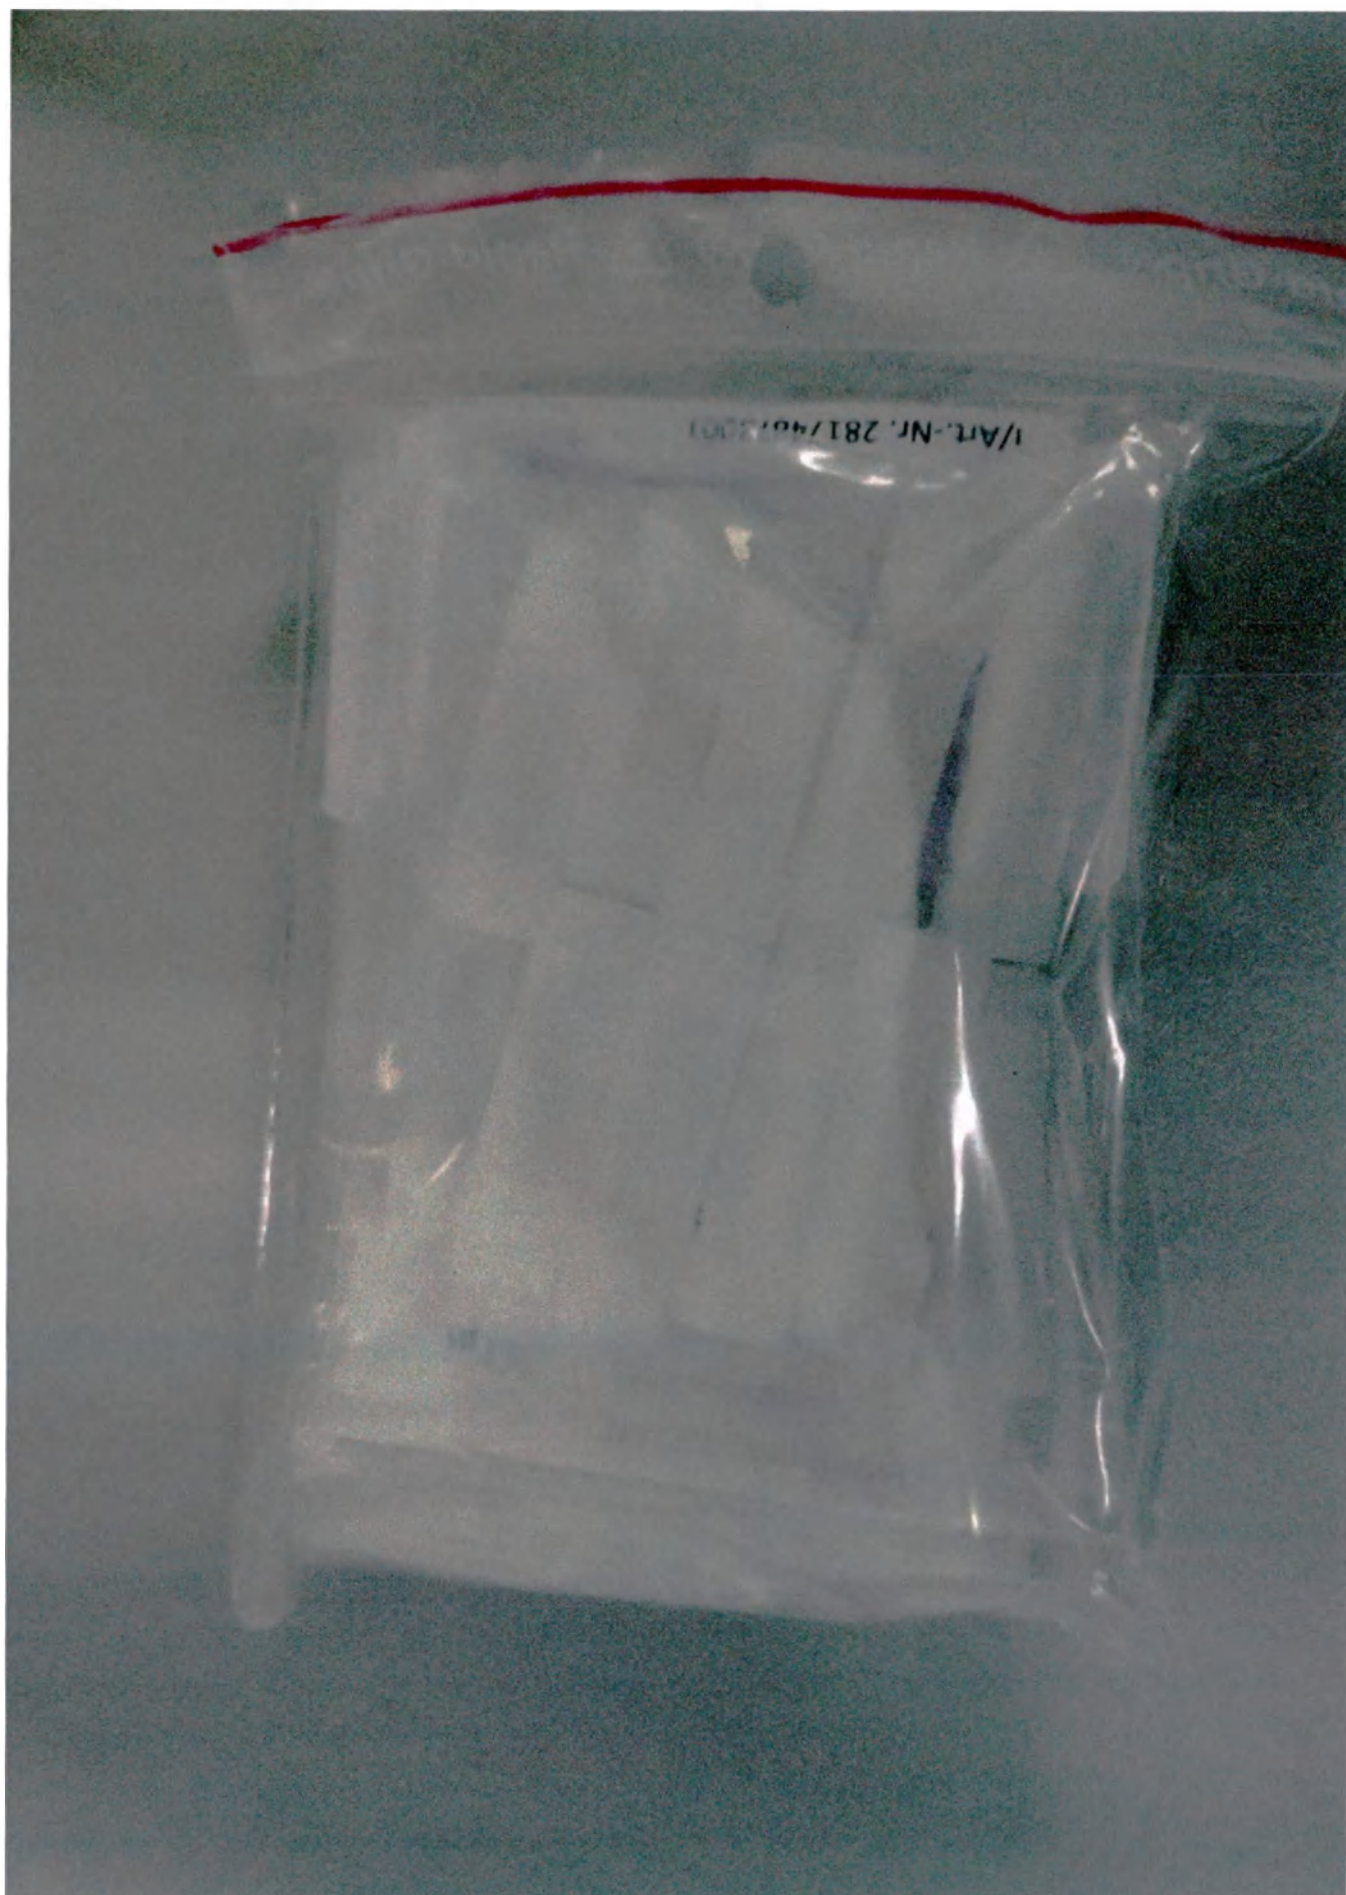


3.13 Кассета коагуляционная черная, 1 шт.

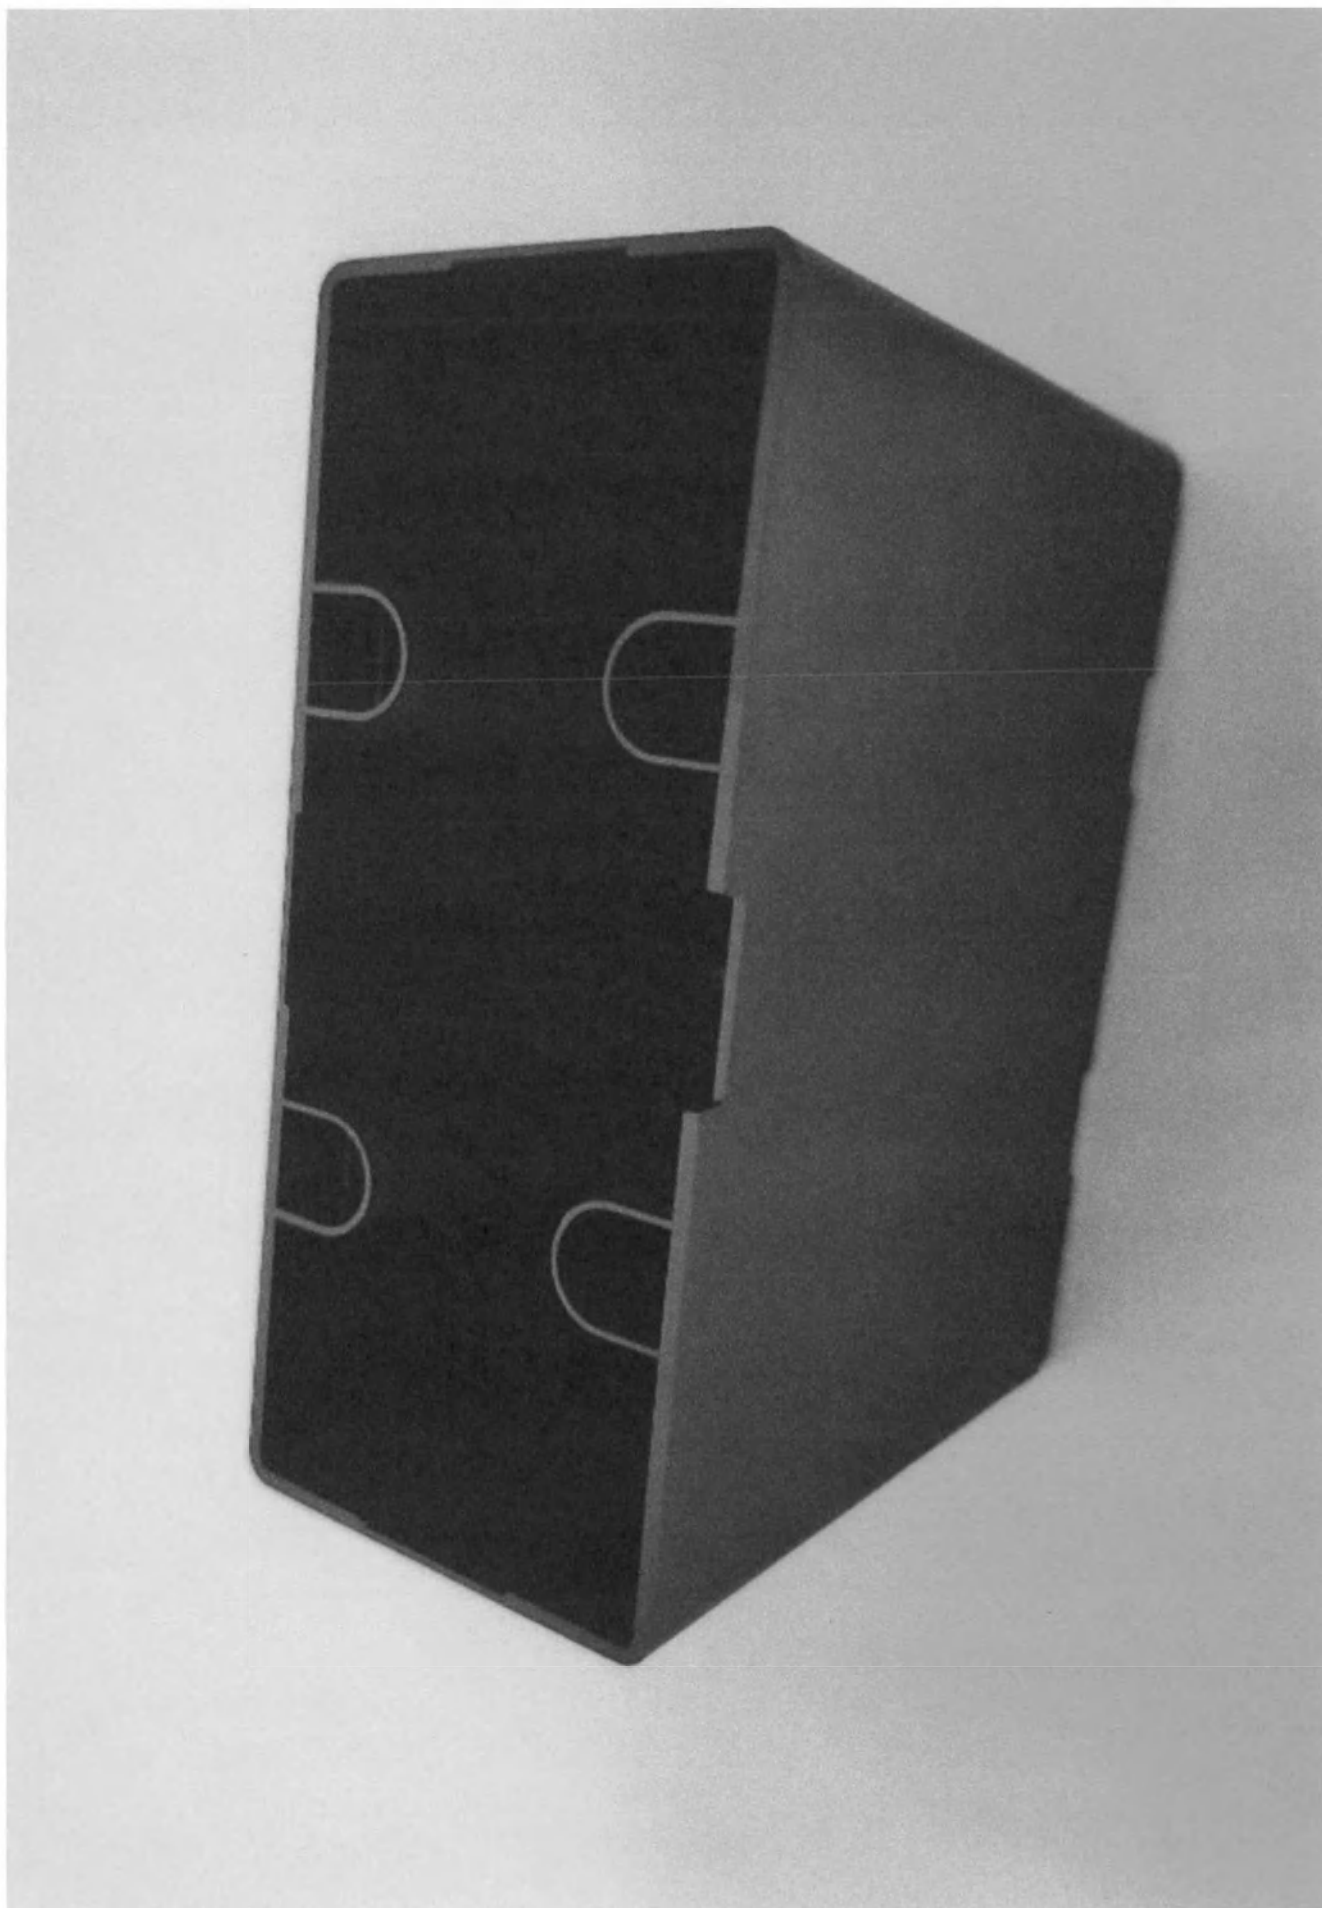

3.14 Ограничитель серый, 6 шт.



3.15 Крышка винтовая, белая GL 18, 6 шт.

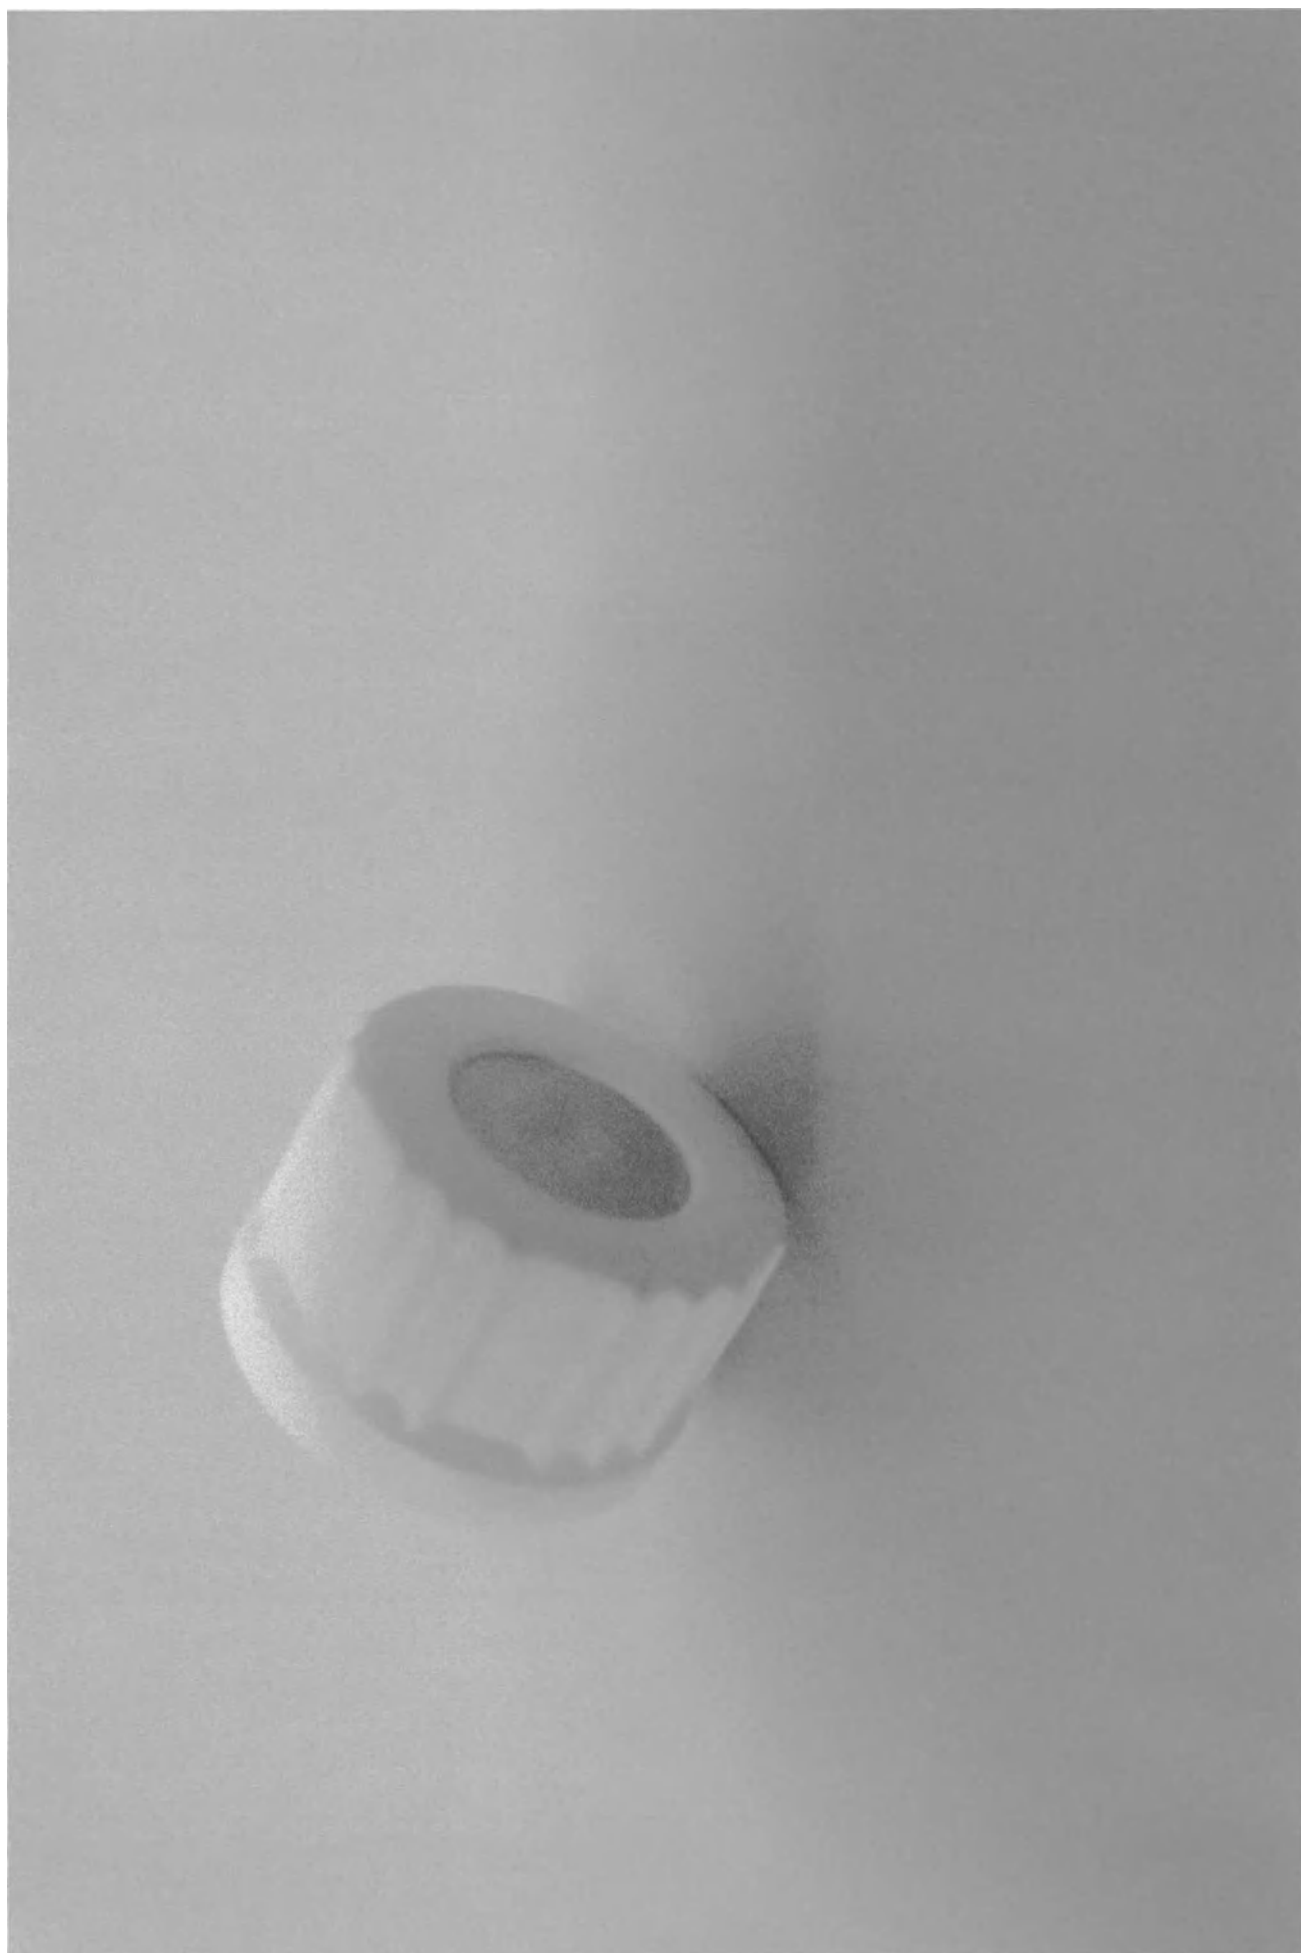

3.16 Емкость стеклянная, 3 шт.




5.17 Кассета системная, 2 шт



3.18 Набор штрих-кодов к системной кассете, 6 шт. в упаковке, 1 упаковка.




3.19 Пинцет, 1 шт.

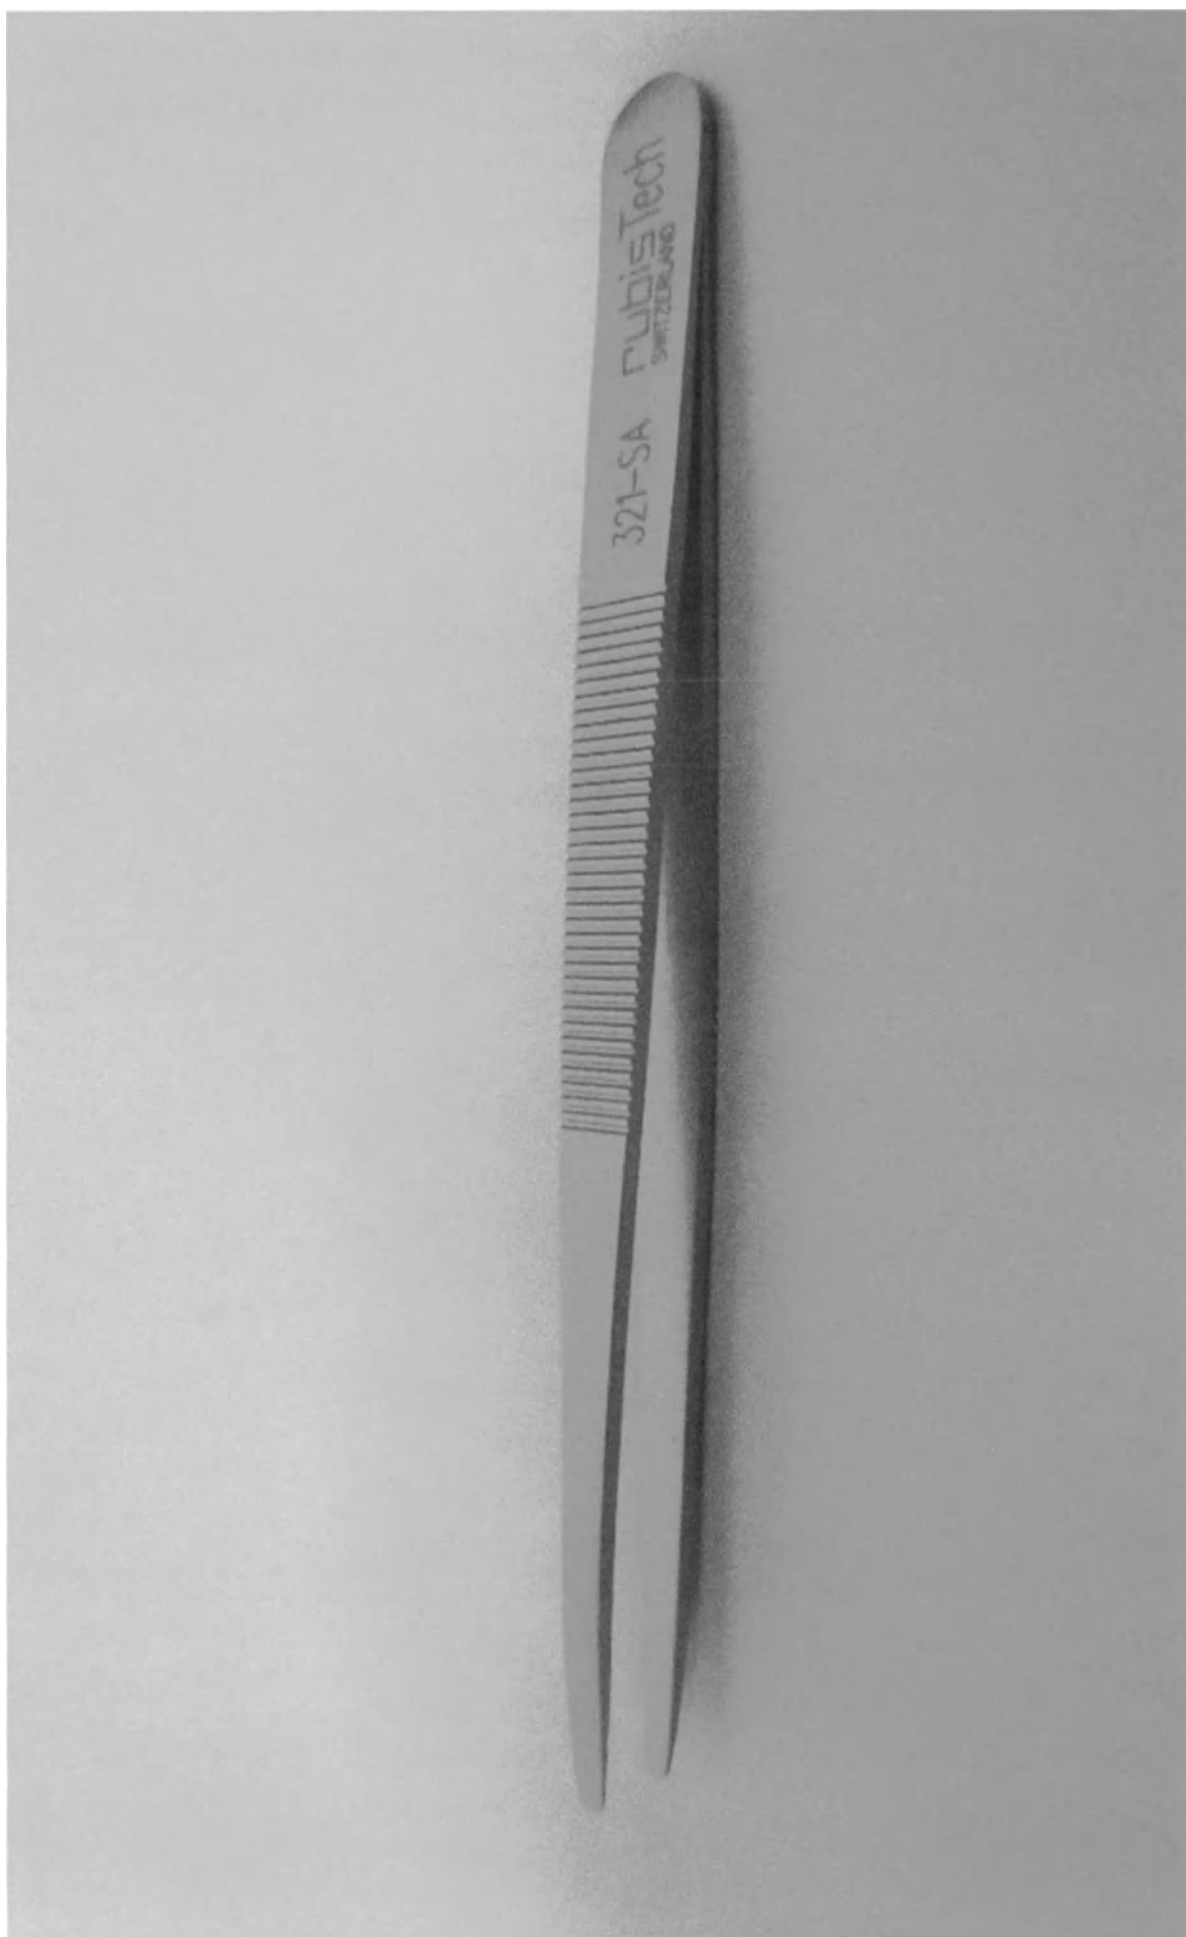

3.20 Пробирки вторичные 13x75 мм, 6 шт. в упаковке, 1 упаковка.




3.21 Инструмент для выравнивания термостата, 1 шт.

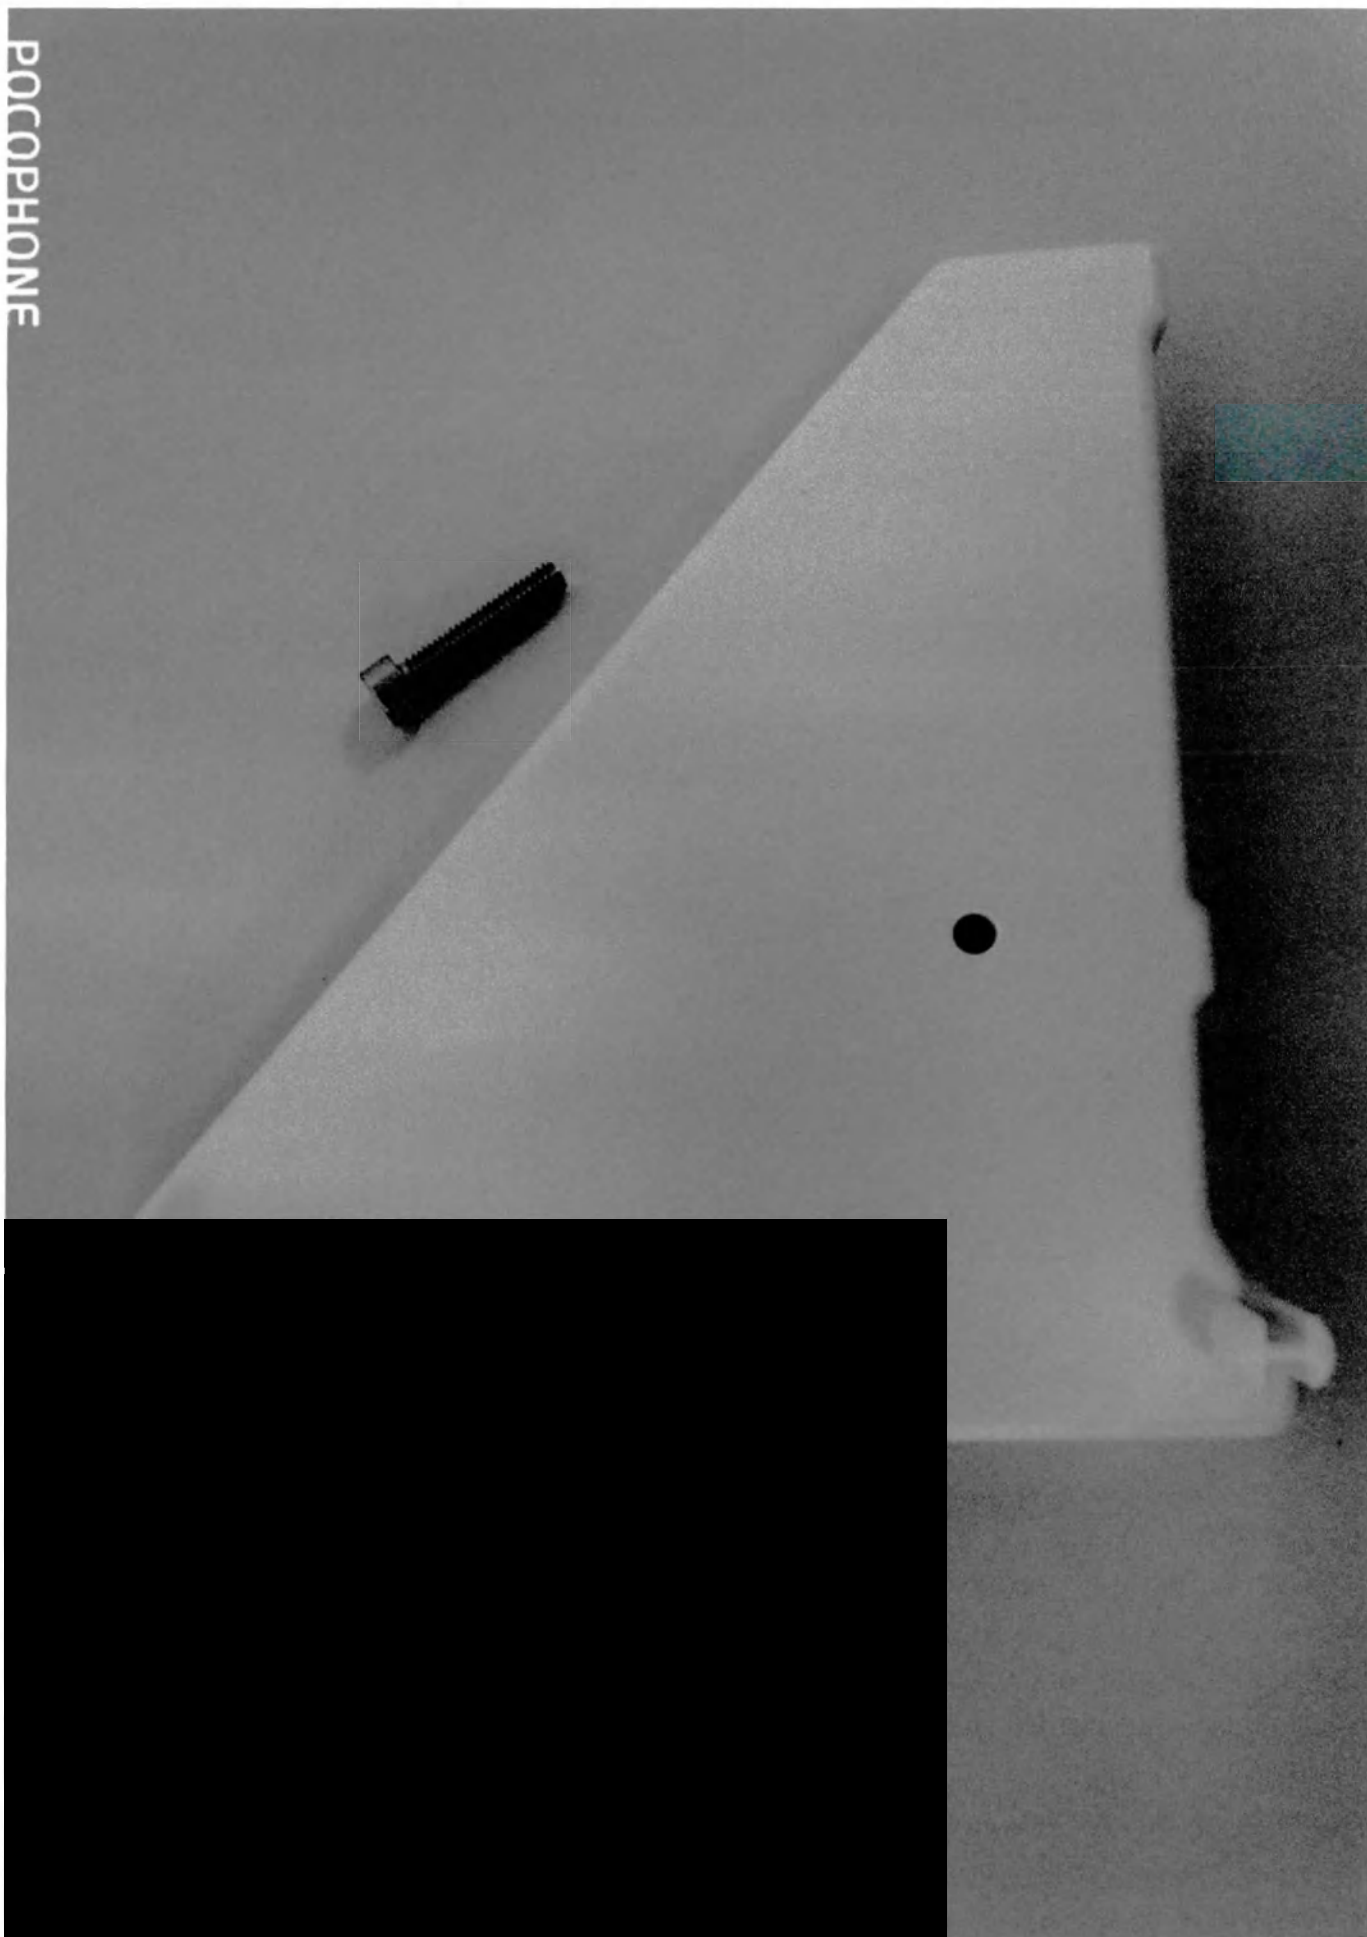


3.22 Палочка для очистки, 50 шт. в упаковке, 1 упаковка.



3.23 Держатель для крышек черный, 1 шт.

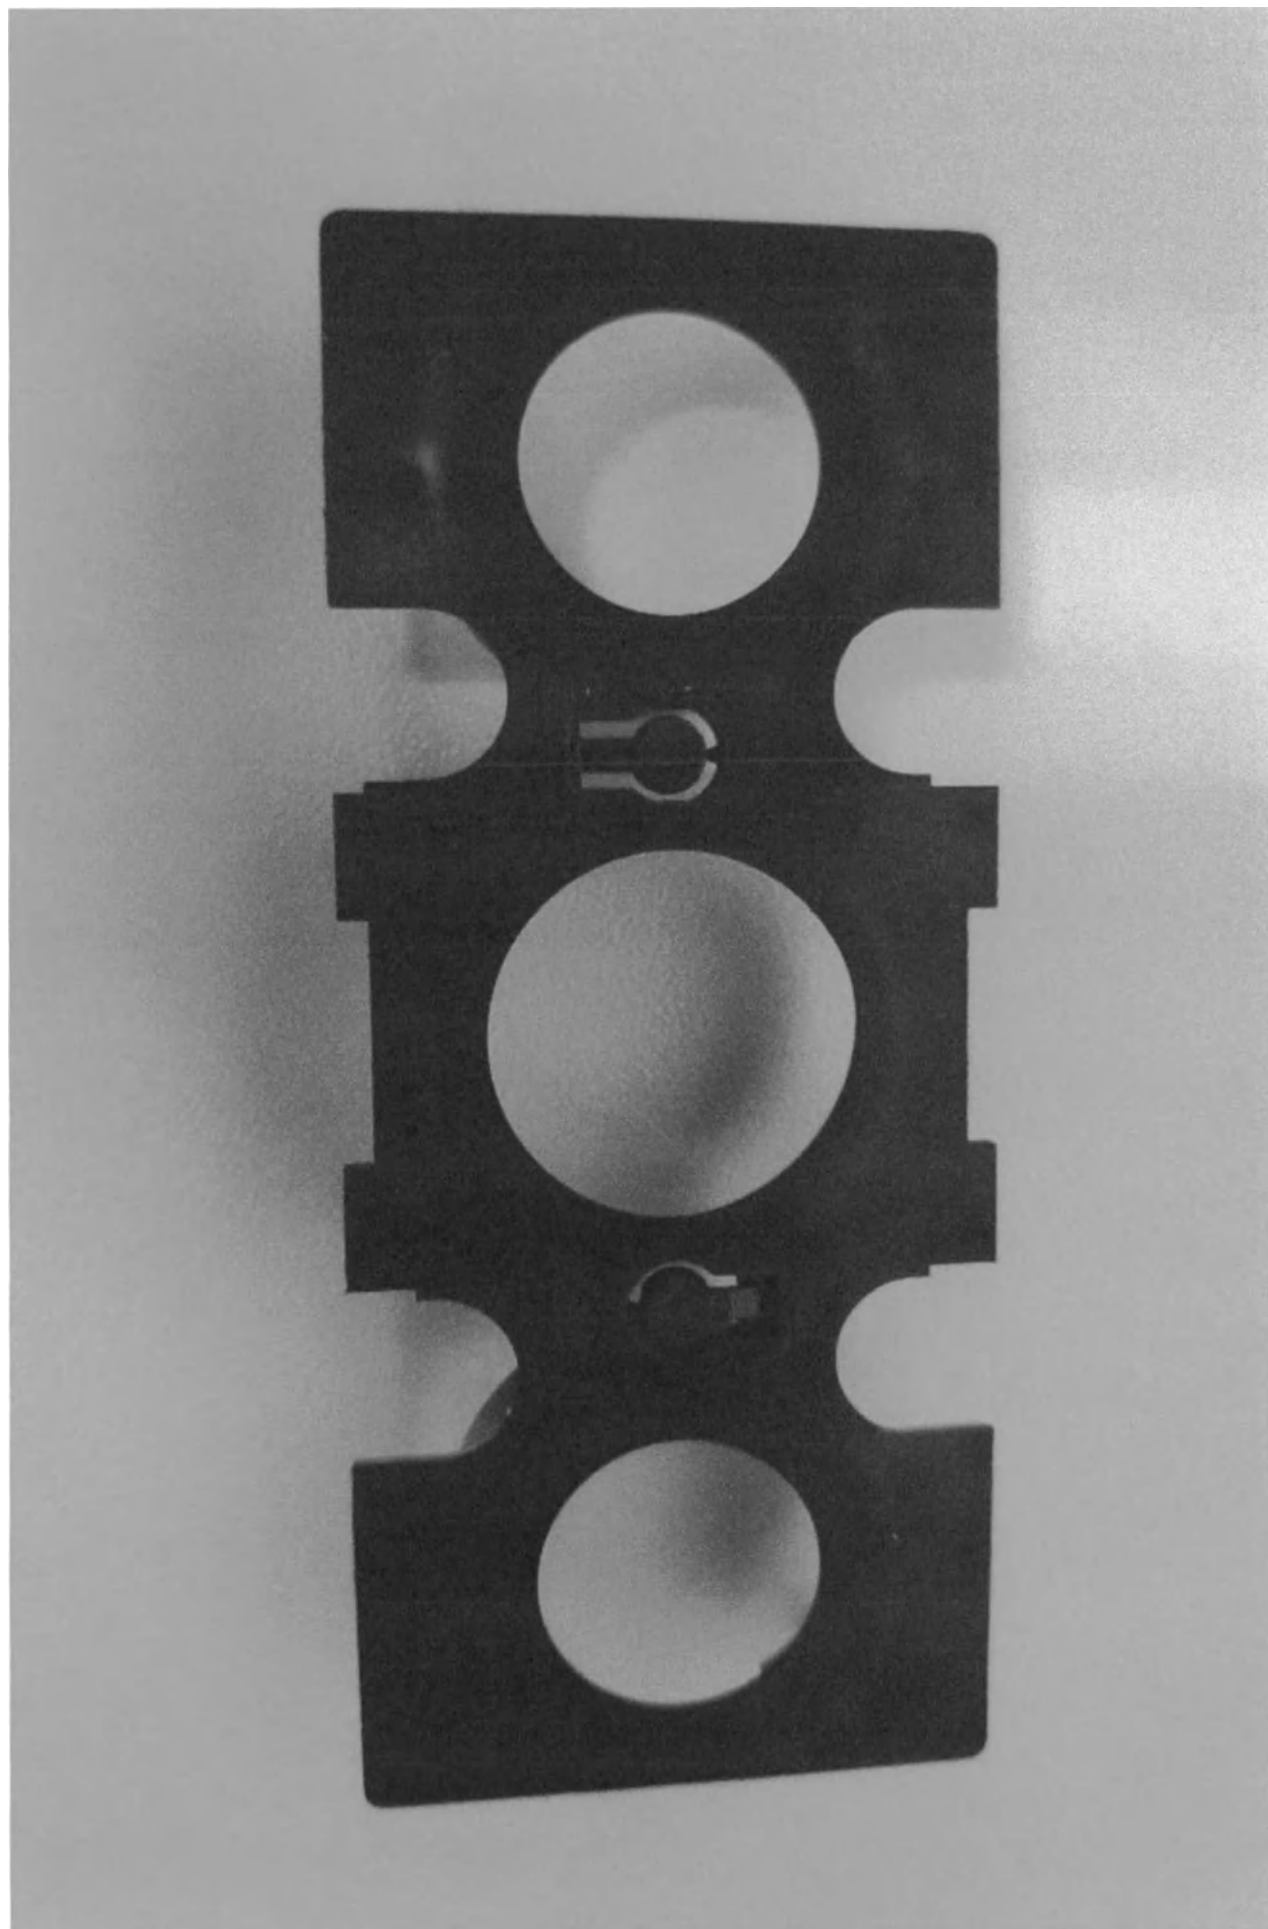


3.24 Микропробирка под винтовой колпачок, 500 шт. в упаковке, 1 упаковка

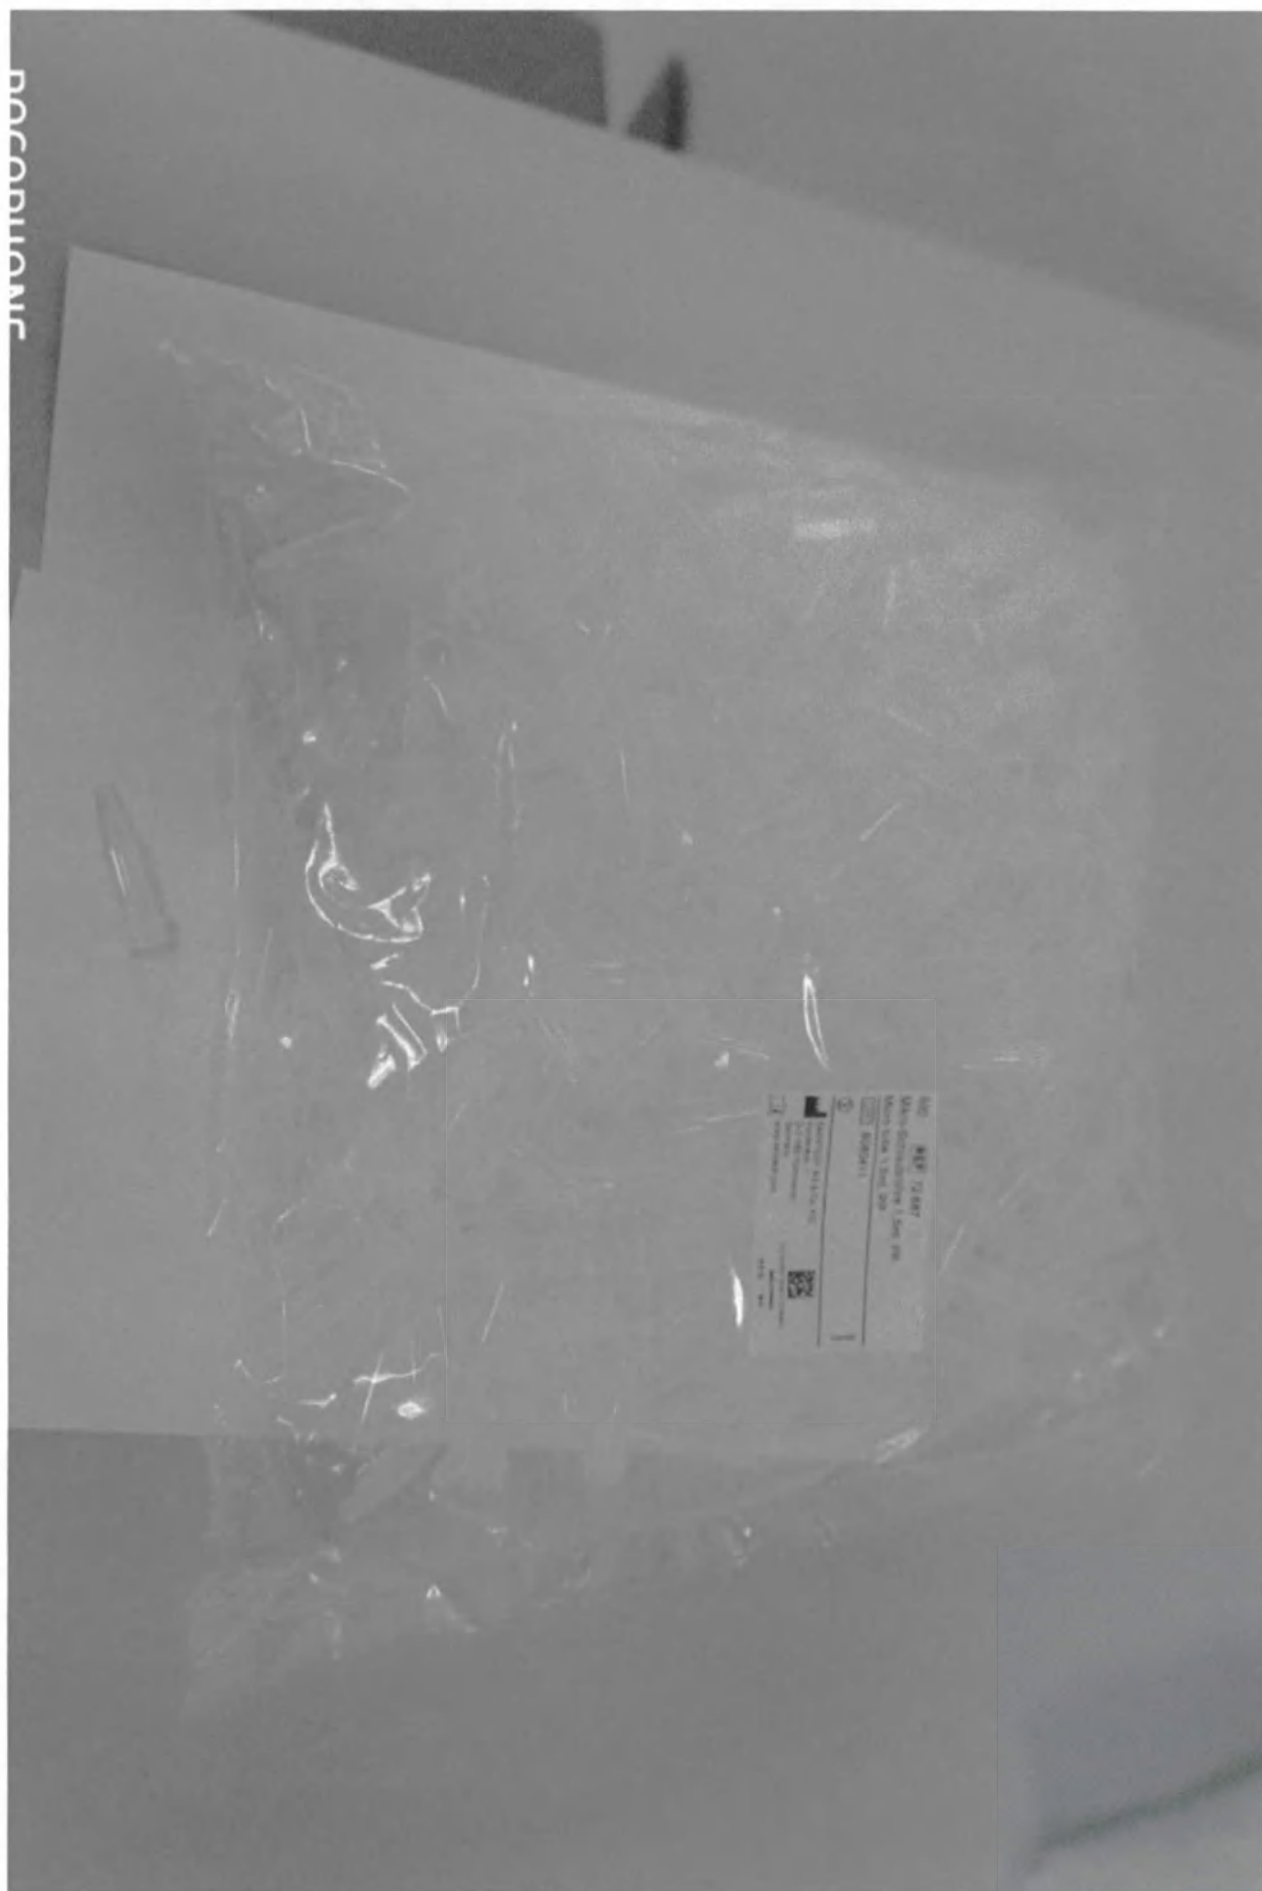

4. Монитор в составе:

4.1 Монитор, не более 1 шт.

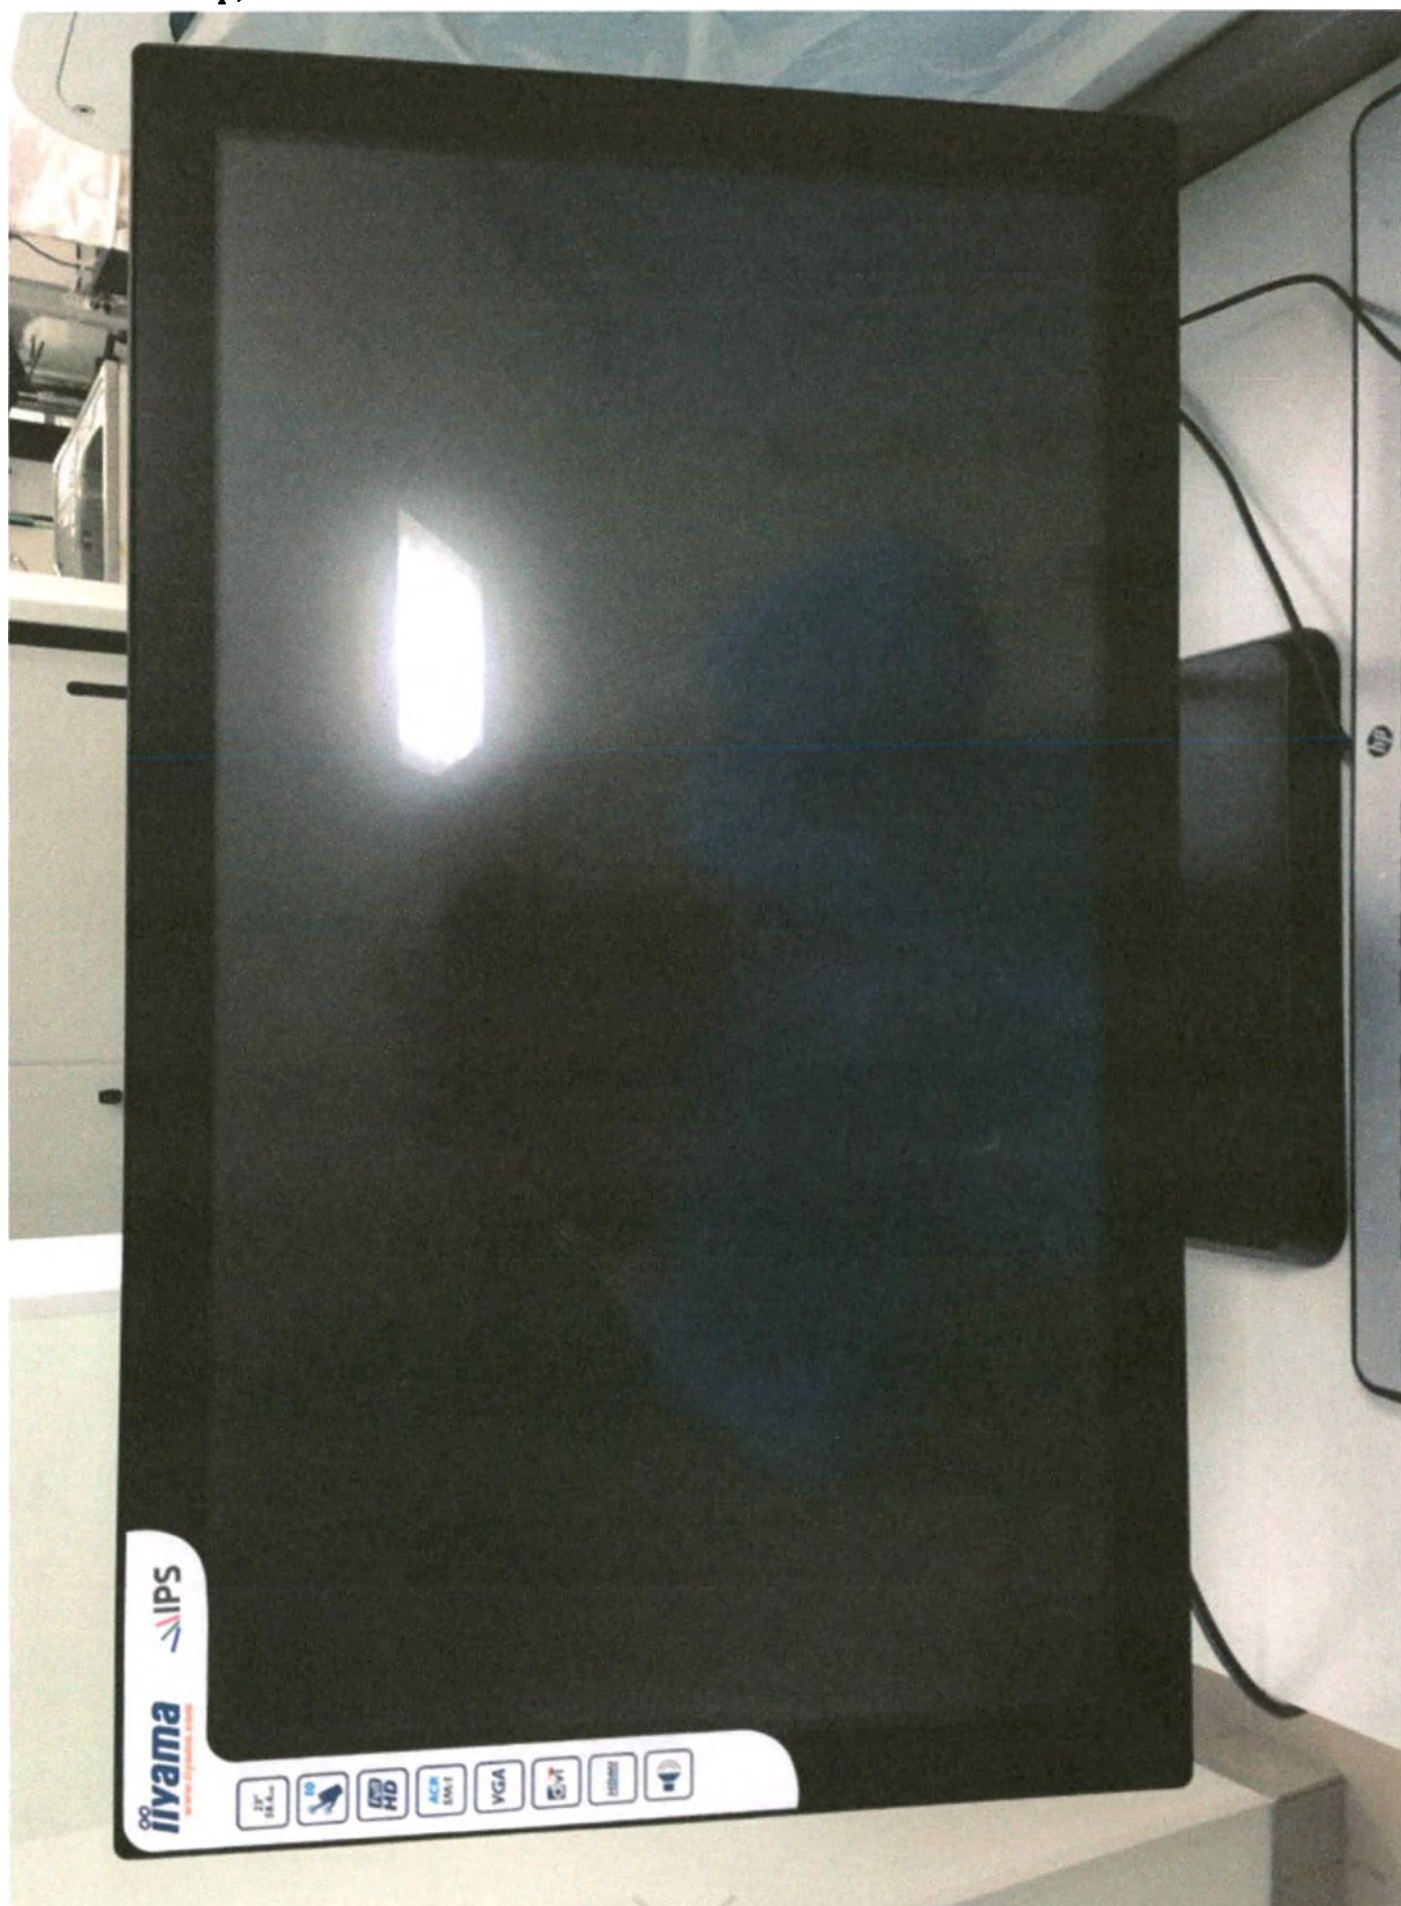

4.2 Кабель питания, не более 1 шт.



4.3 Кабель VGA, не более 1 шт.



4.4 Кабель DVI, не более 1 шт.



4.5 Кабель USB, не более 1 шт.




4.6 Кабель Audio, не более 1 шт.



5. Системный блок, не более 1 шт.



6. Мышь, не более 1 шт.

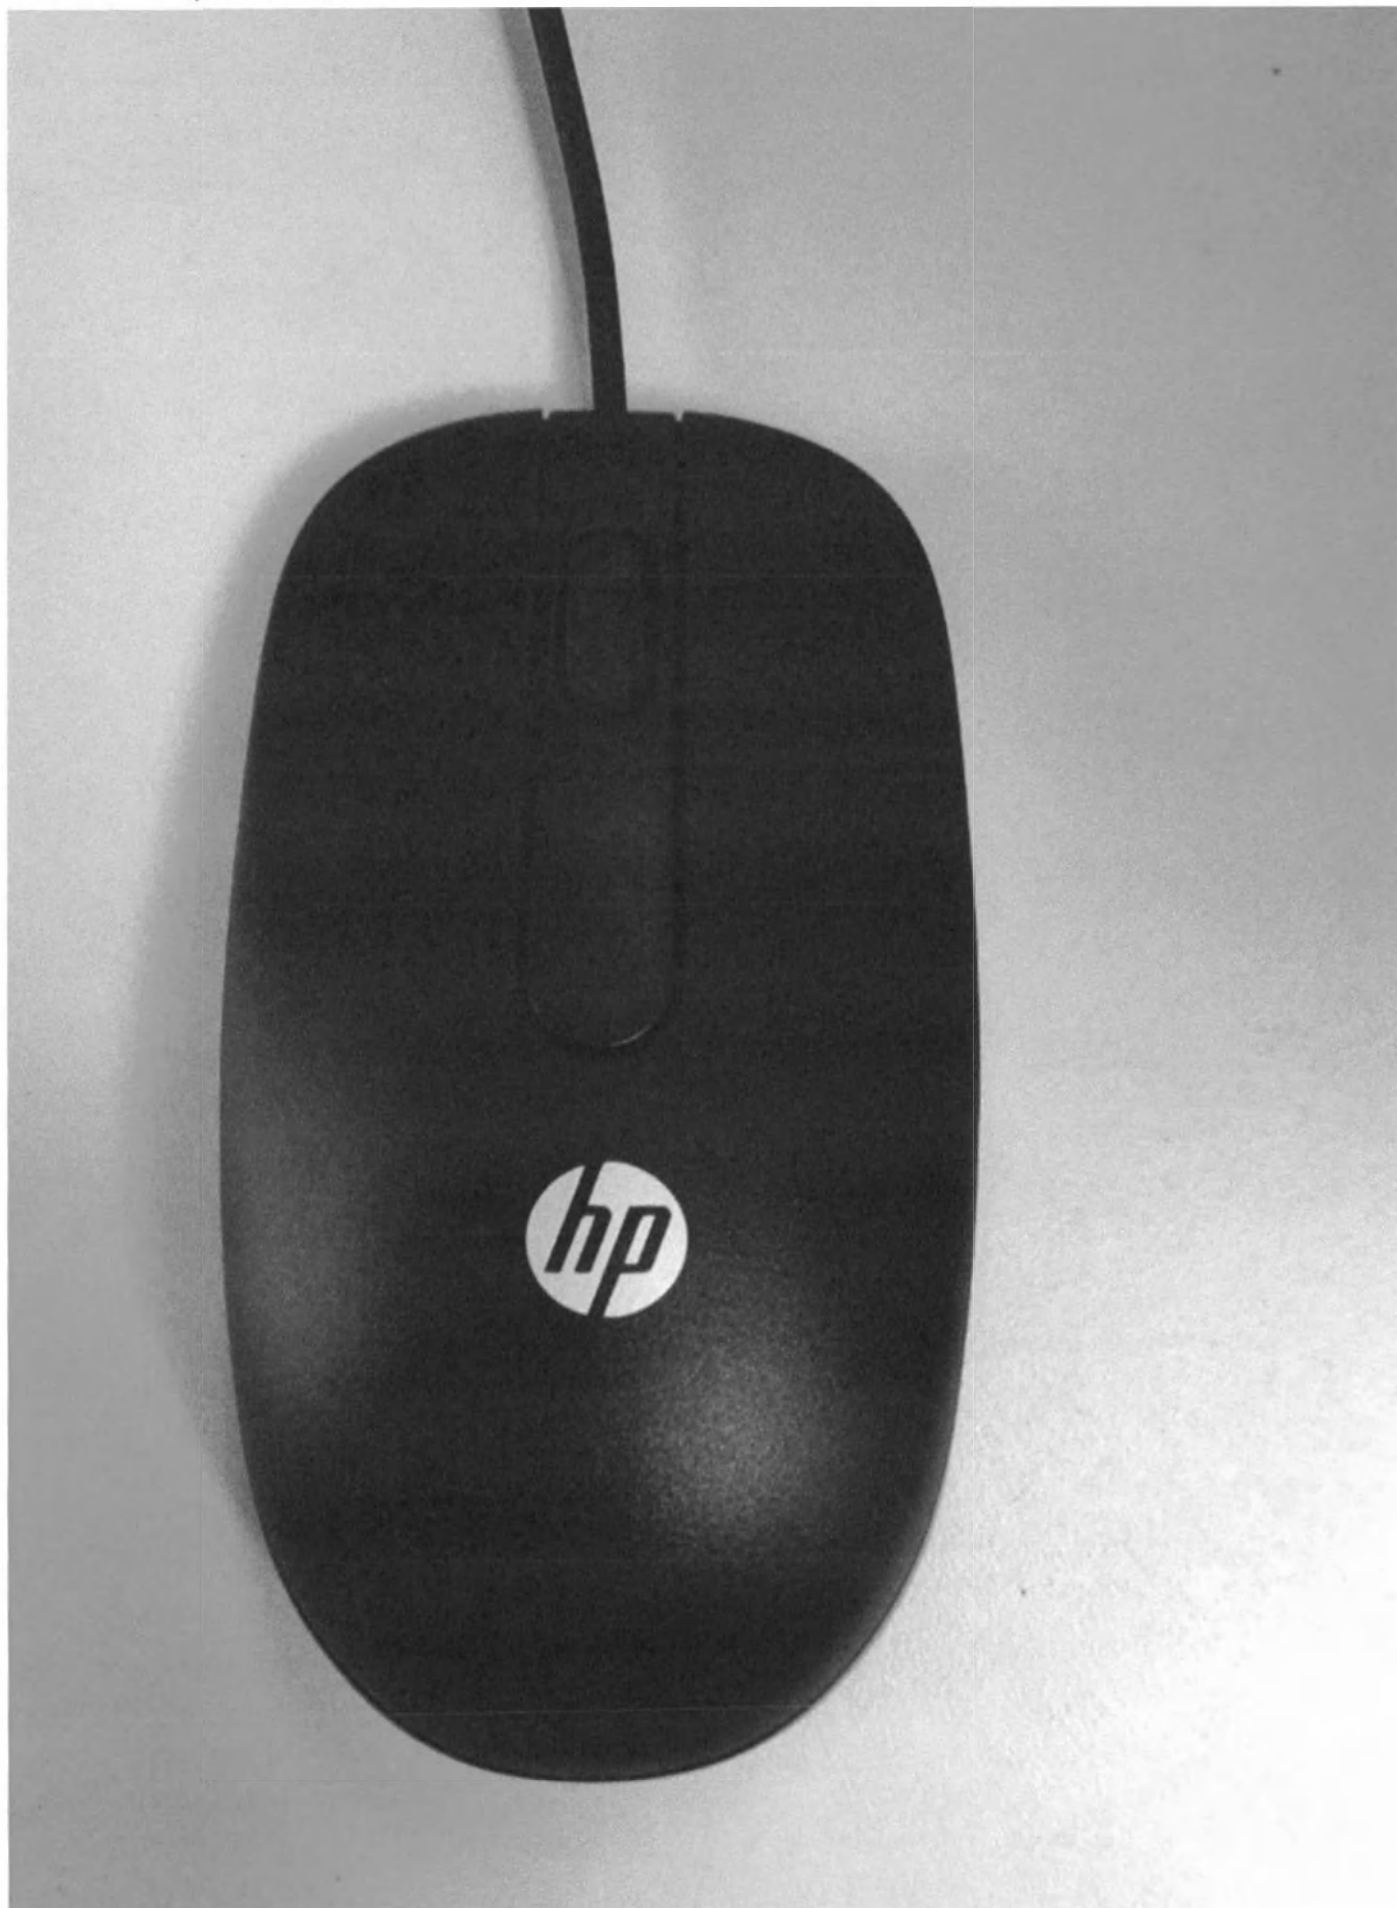

7. Клавиатура, не более 1 шт.



8. Микропробирка 13/16, 900 шт. в упаковке, не более 5000 упаковок (при необходимости).



9. Измерительная кювета, 20x1000 шт. в упаковке, не более 5000 упаковок (при необходимости).



10. Раствор промывочный в кассете для депротеинизации реагентных и пробозаборных игл к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (Deproteinizer cobas t systems), не более 100 шт. (при необходимости).



11. Раствор промывочный для кондиционирования пробозаборных игл после их очистки во флаконе к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (Probe Cond. / Probe Conditioner cobas t systems), не более 100 шт. (при необходимости).



12. Раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (System cleaner cobas t systems), не более 5000 шт. (при необходимости).




13. Раствор промывочный в кассете к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (CLEAN cobas t systems), не более 5000 шт. (при необходимости).



POCOPHONE

14. Набор системных пластиковых пробирок, 50 x 11 мл, 50 шт. по 11 мл в упаковке, не более 100 упаковок, (при необходимости).

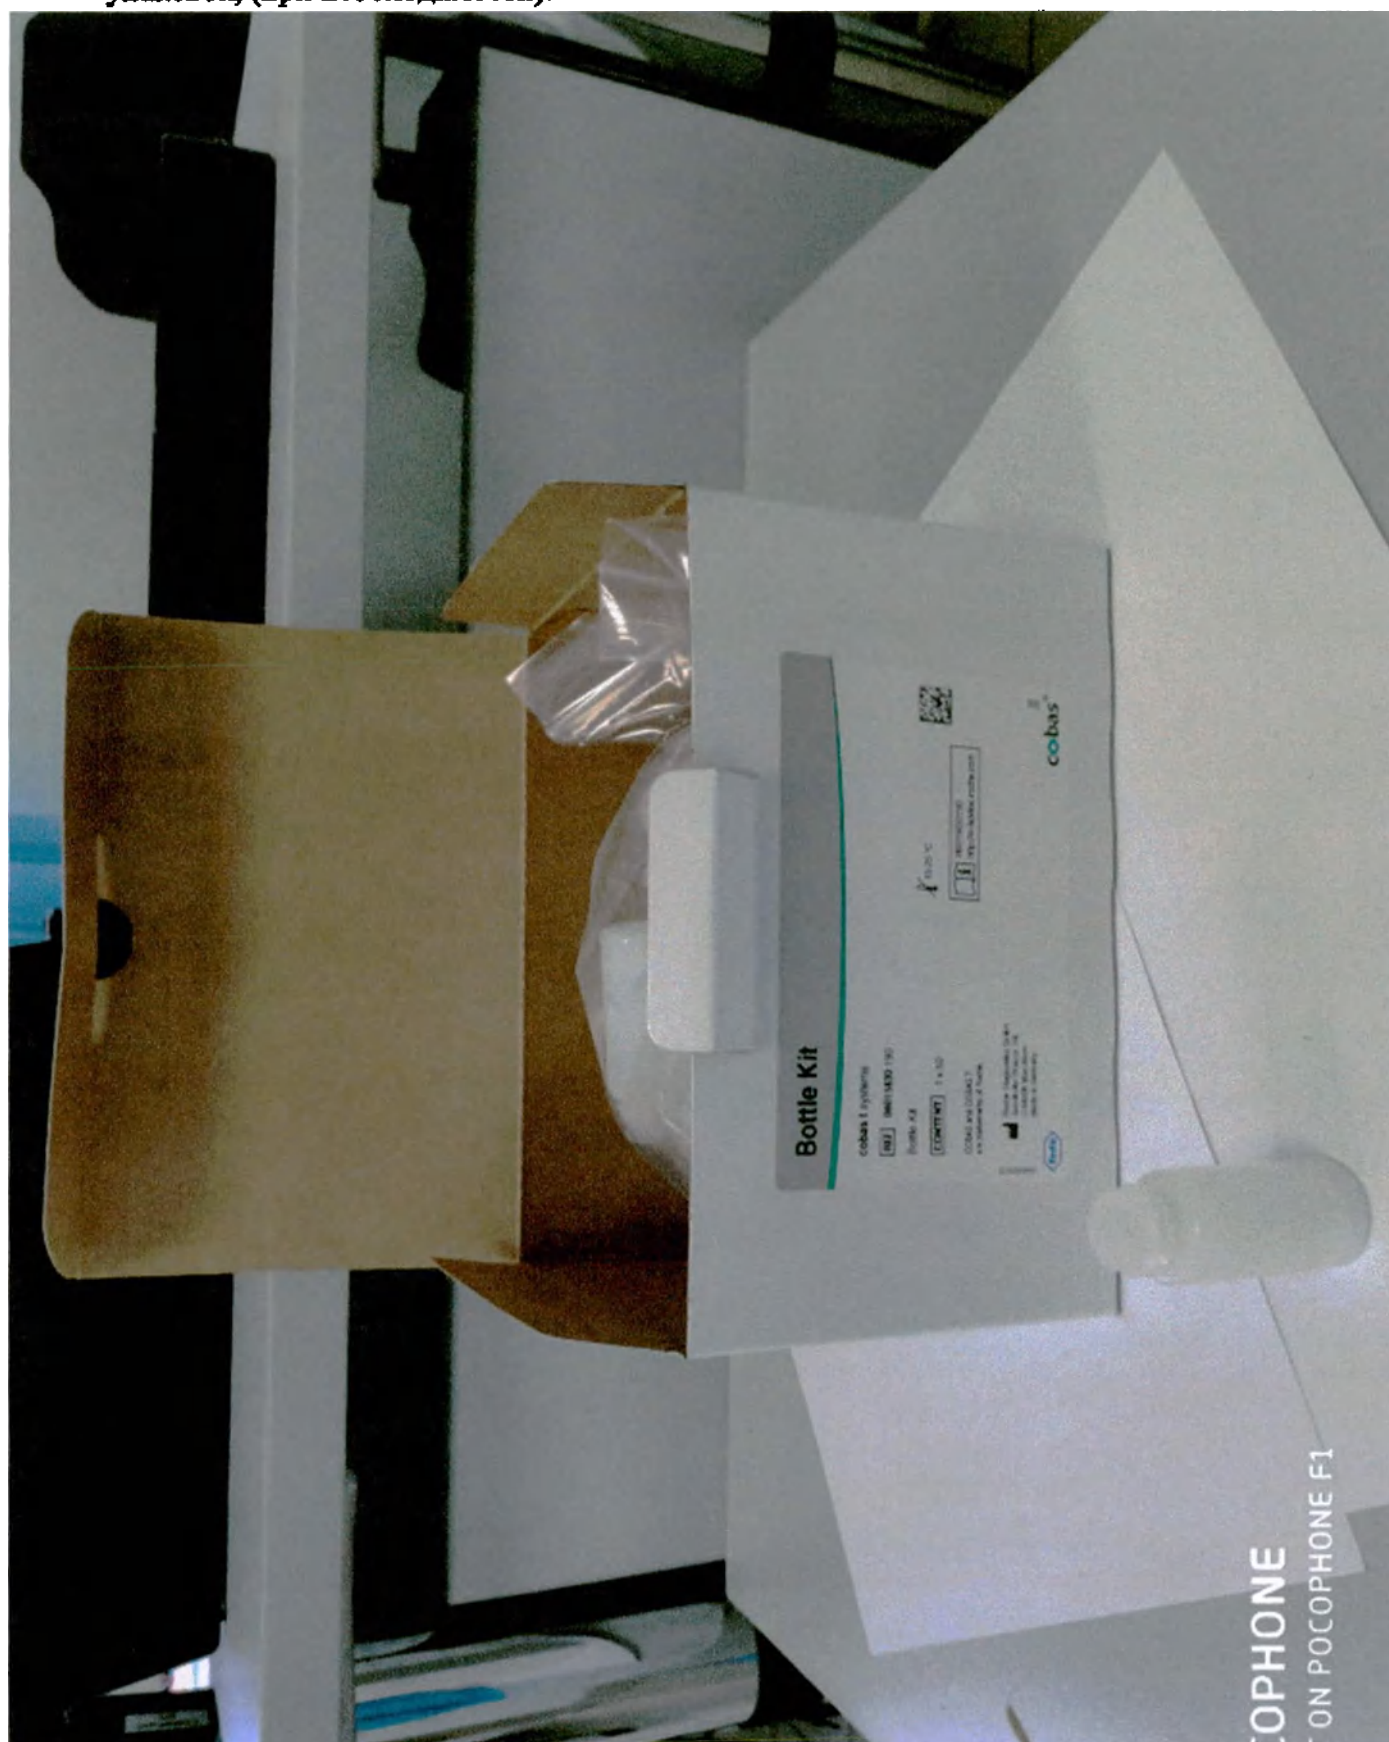


POCOPHONE F1

15. Микропробирка под винтовой колпачок, 500 шт. в упаковке, не более 100 упаковок (при необходимости).



16. DVD диск с образом операционной системы, не более 1 шт.

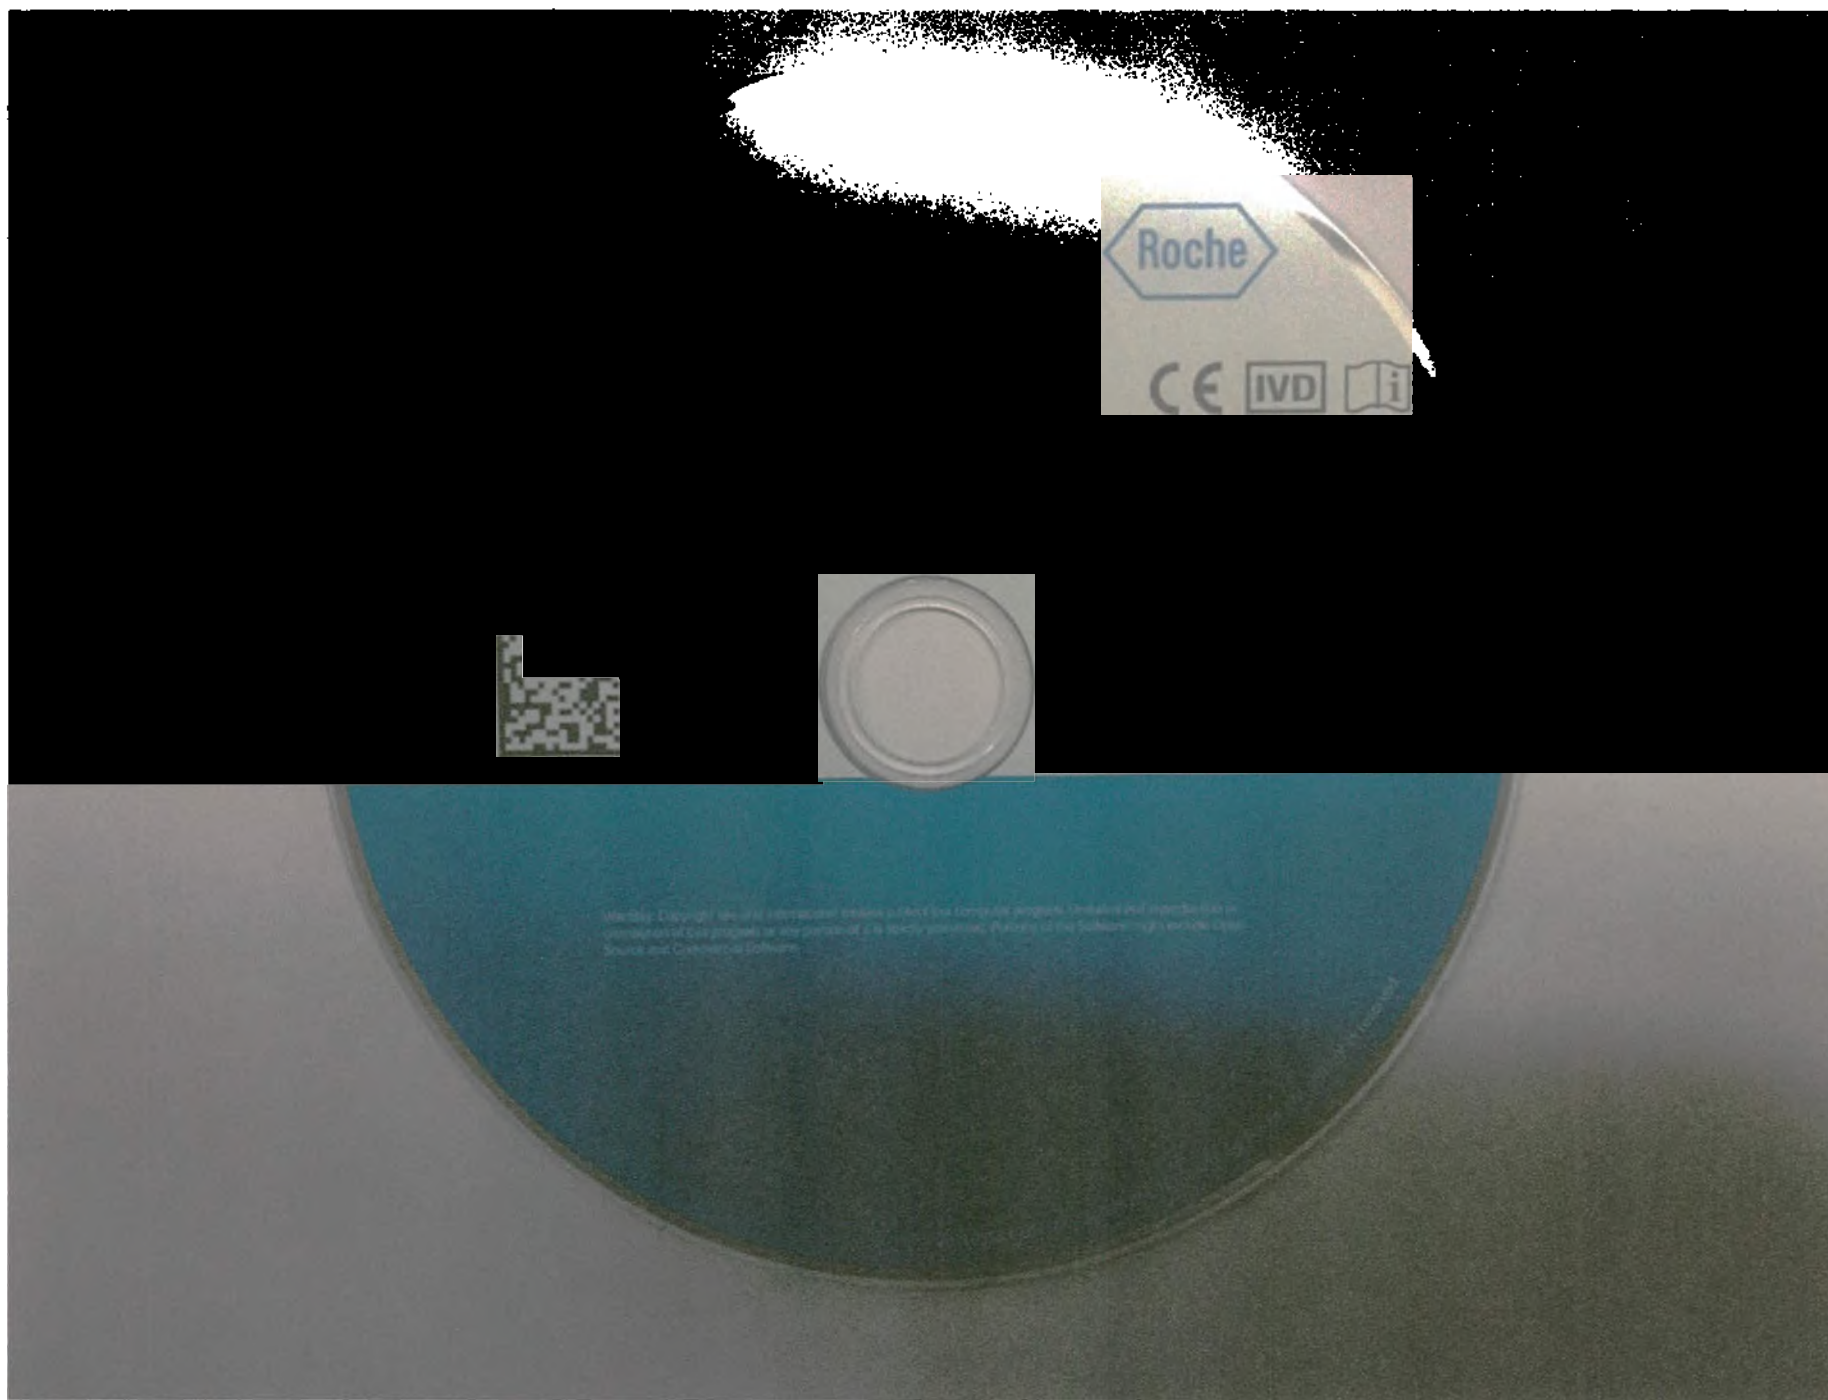

17. DVD диск с программным обеспечением, не более 1 шт.




18. CD диск с установщиком языковых пакетов, не более 1 шт.



19. CD диск с пакетом с диагностическим и сервисным программным обеспечением, не более 1 шт.



20. Фильтр воздушный, не более 1 шт.

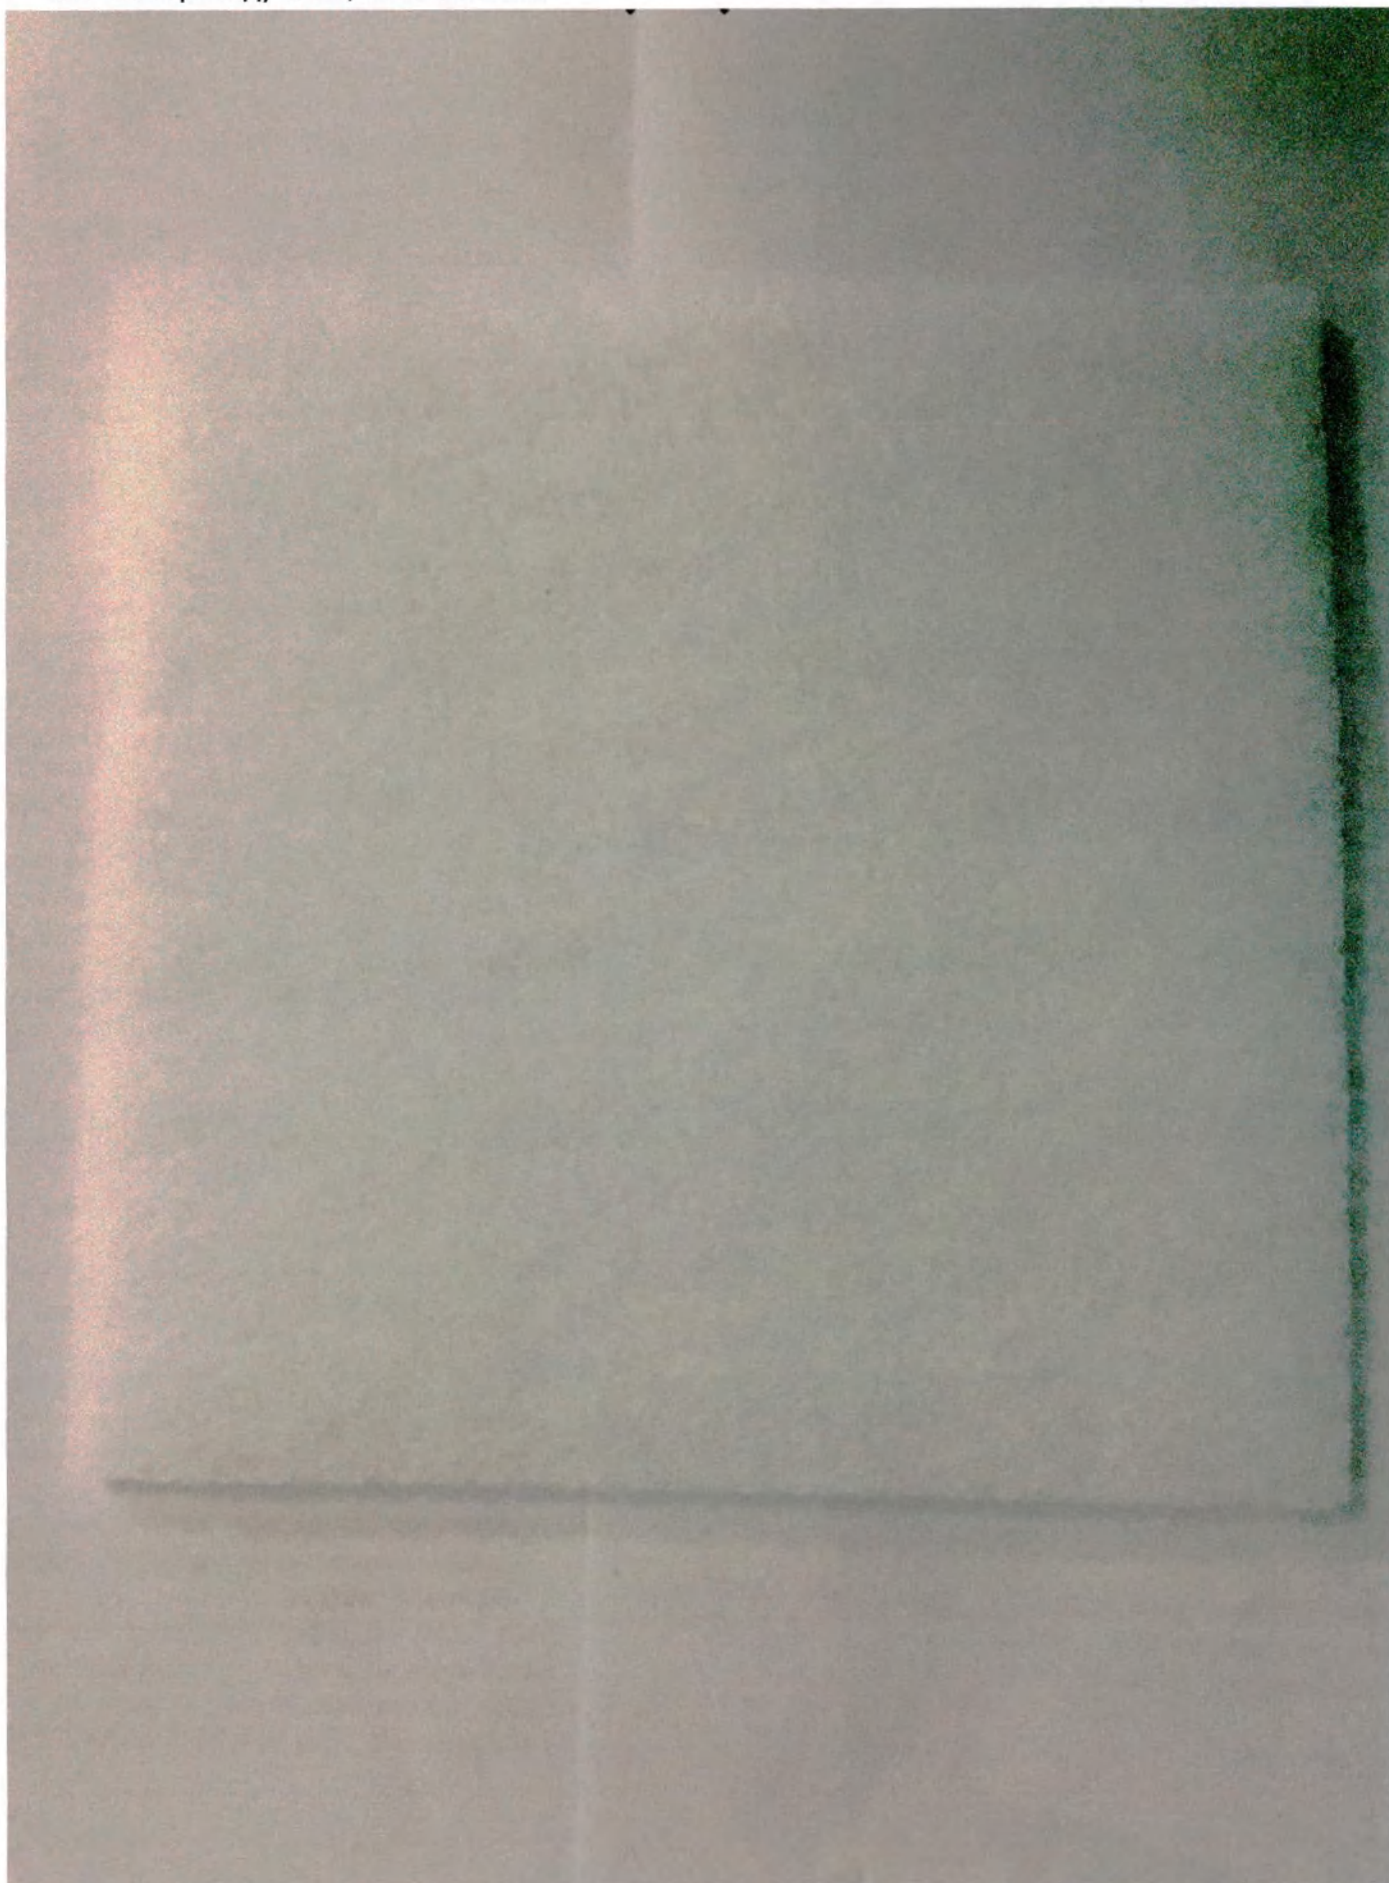

21. CD диск с локализацией ПО, не более 1 шт.



22. Стол для ПК, не более 1 шт. (при необходимости)





cobas t 511 coagulation analyzer

Руководство пользователя Версия 2.1
Версия программного обеспечения 2.0.2




cobas®
Life needs answers

24. Руководство по безопасности, не более 1 шт.



cobas t 511 coagulation analyzer

«Руководство по безопасности» Версия 2.0
Версия программного обеспечения 2.0.2

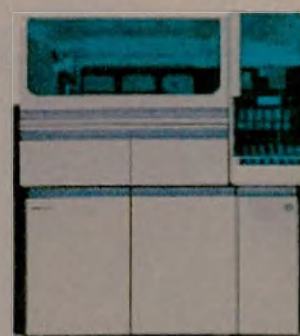

cobas[®]
Life needs answers



cobas t 511 coagulation analyzer


cobas t development channel

Поддержка пользователя Версия 2.1
Версия программного обеспечения 2.0.2




cobas[®]
Life needs answers


26. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M001-M010, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

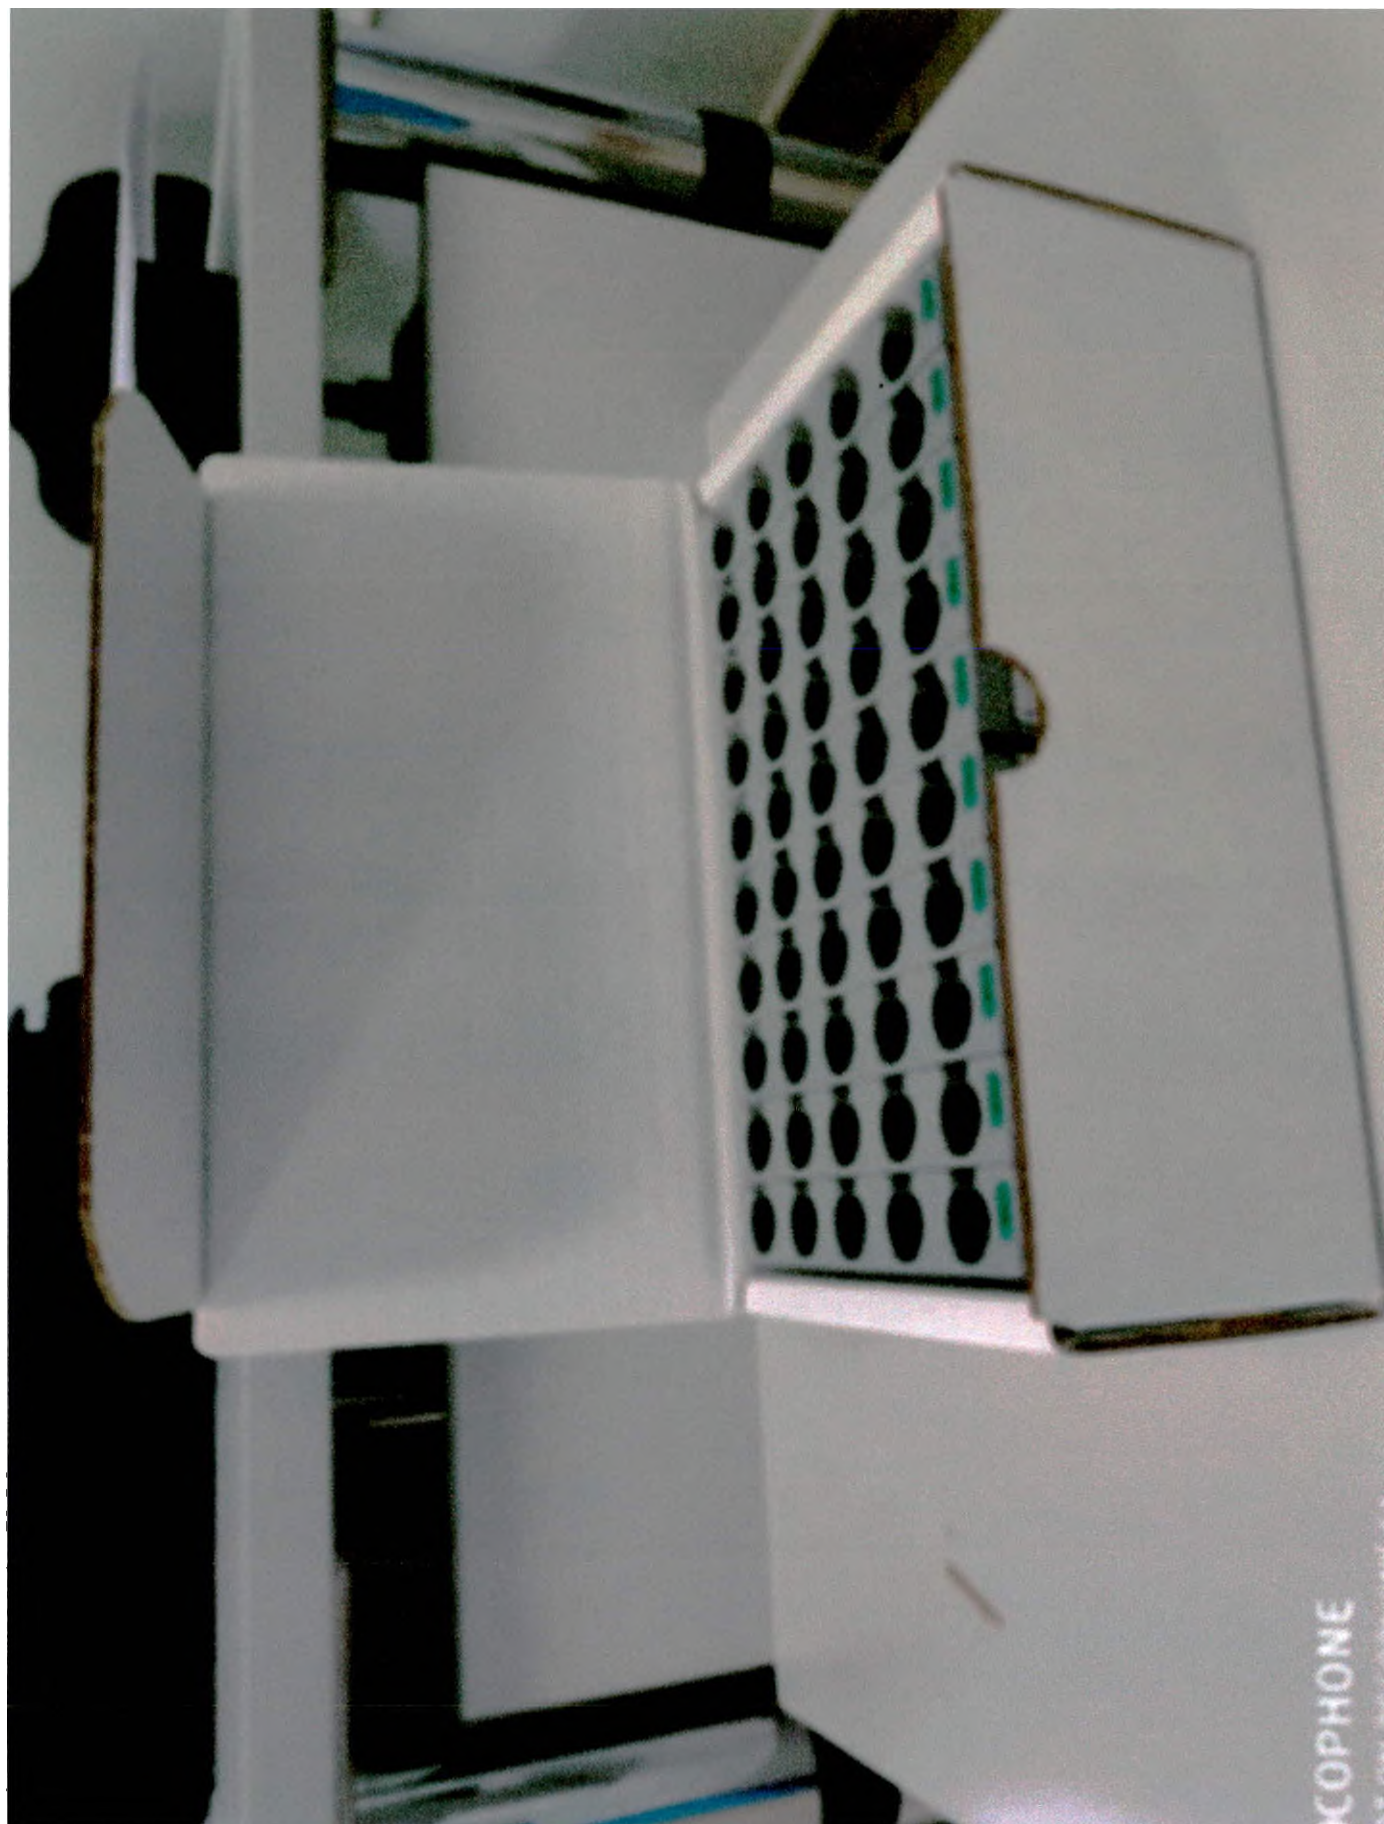


27. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M011-M020, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

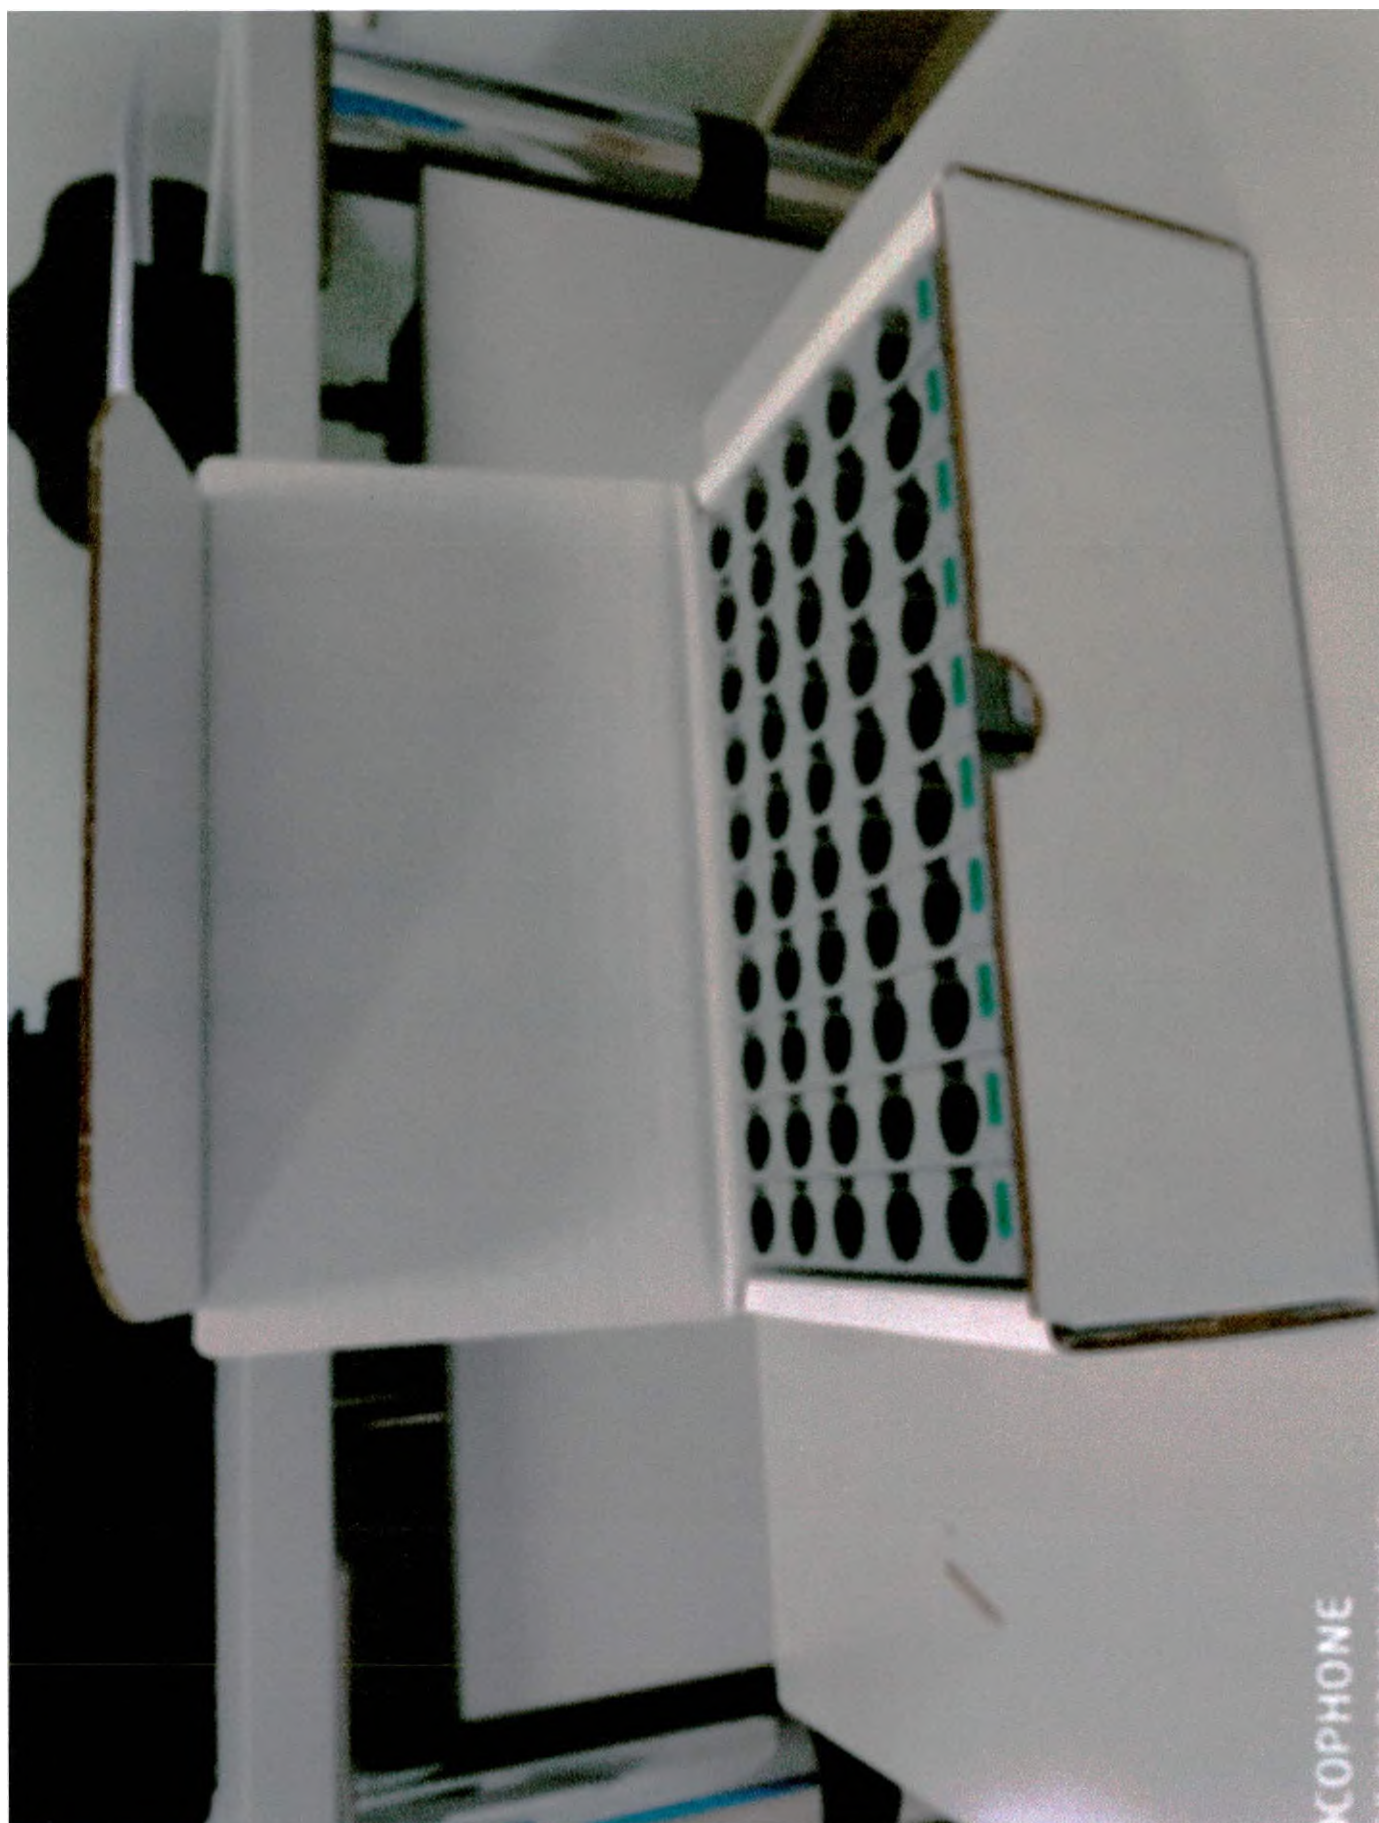


28. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M021-M030, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

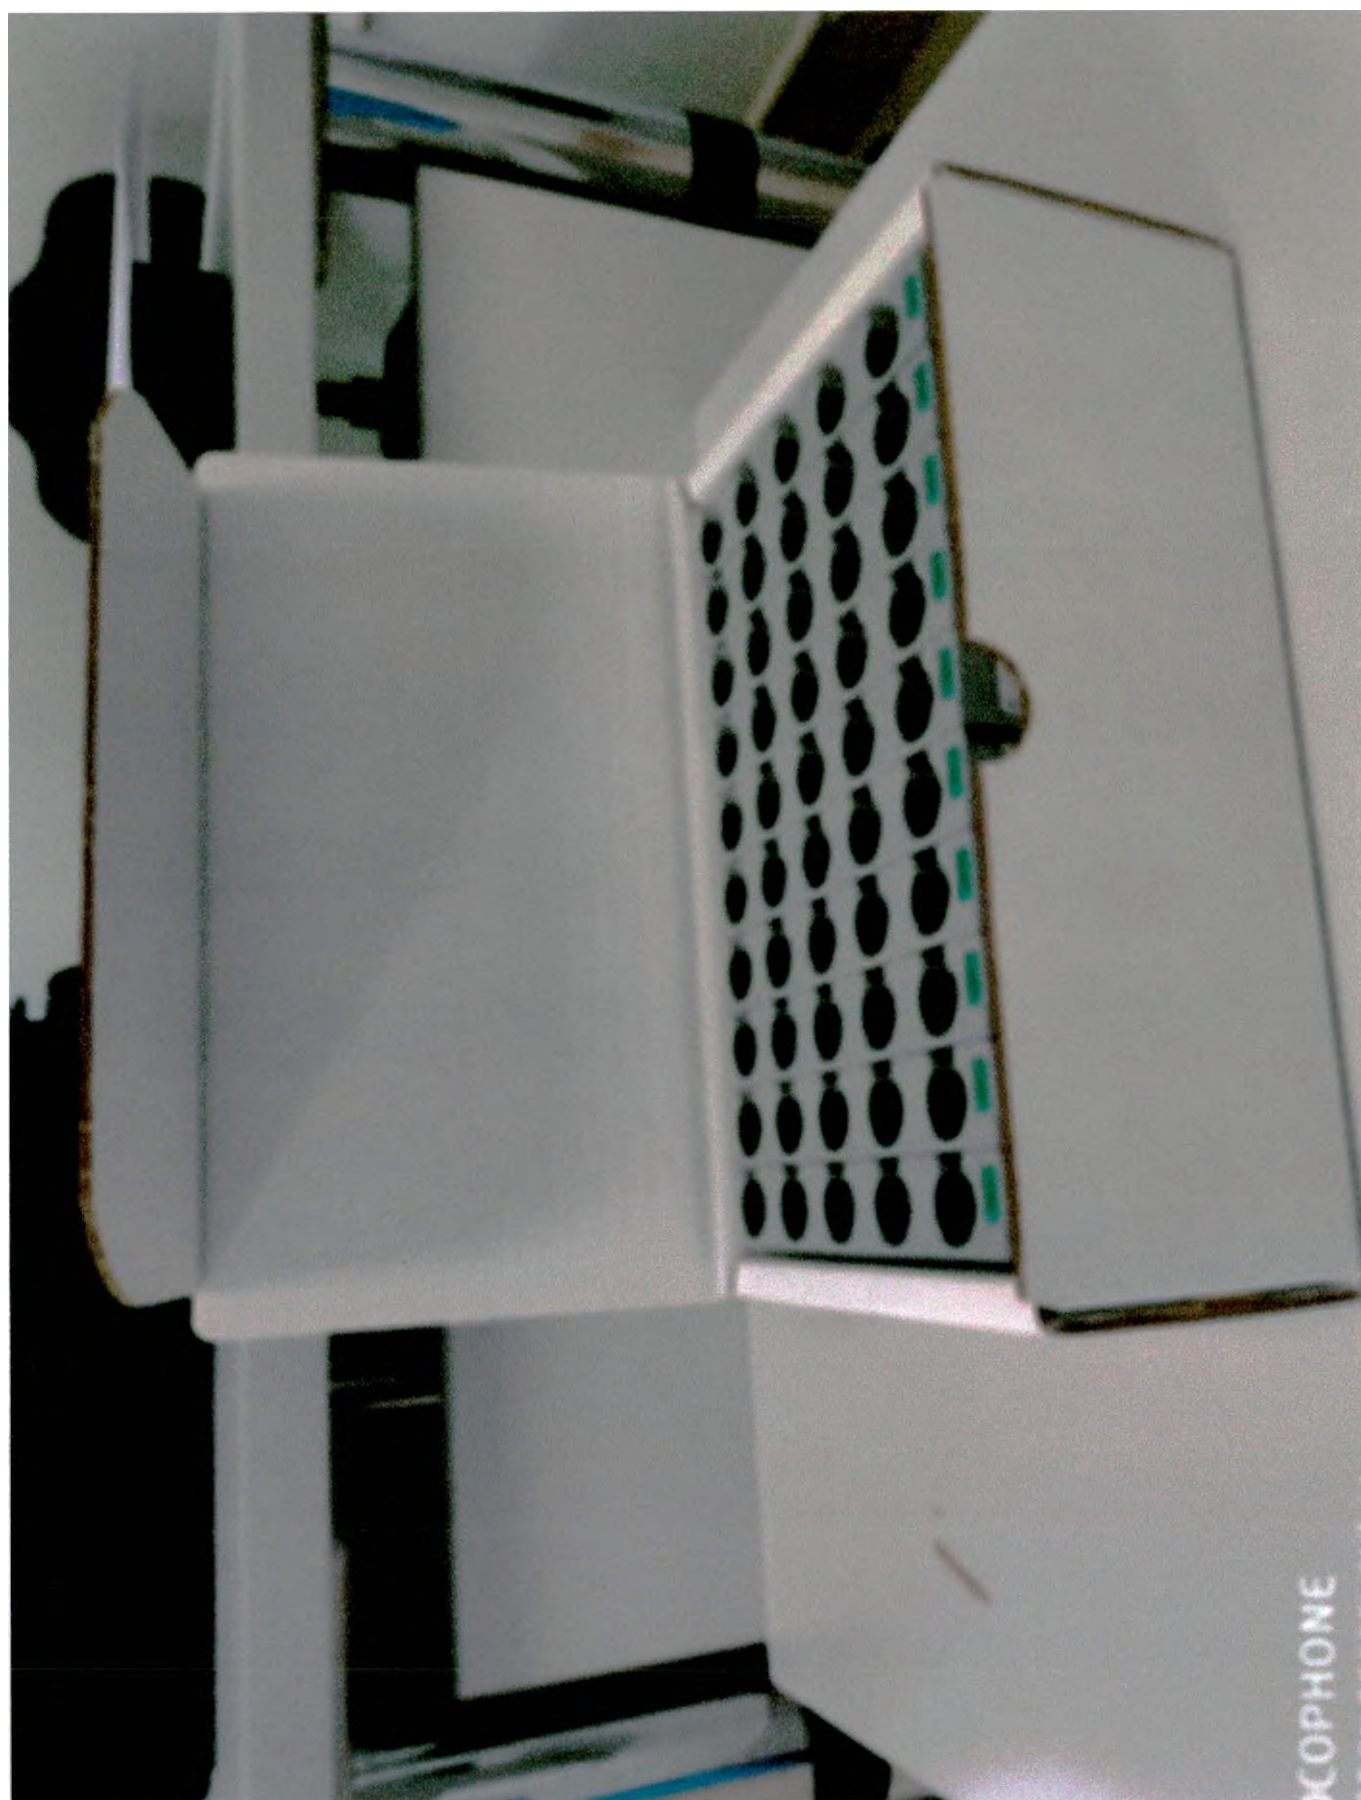


29. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M031-M040, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

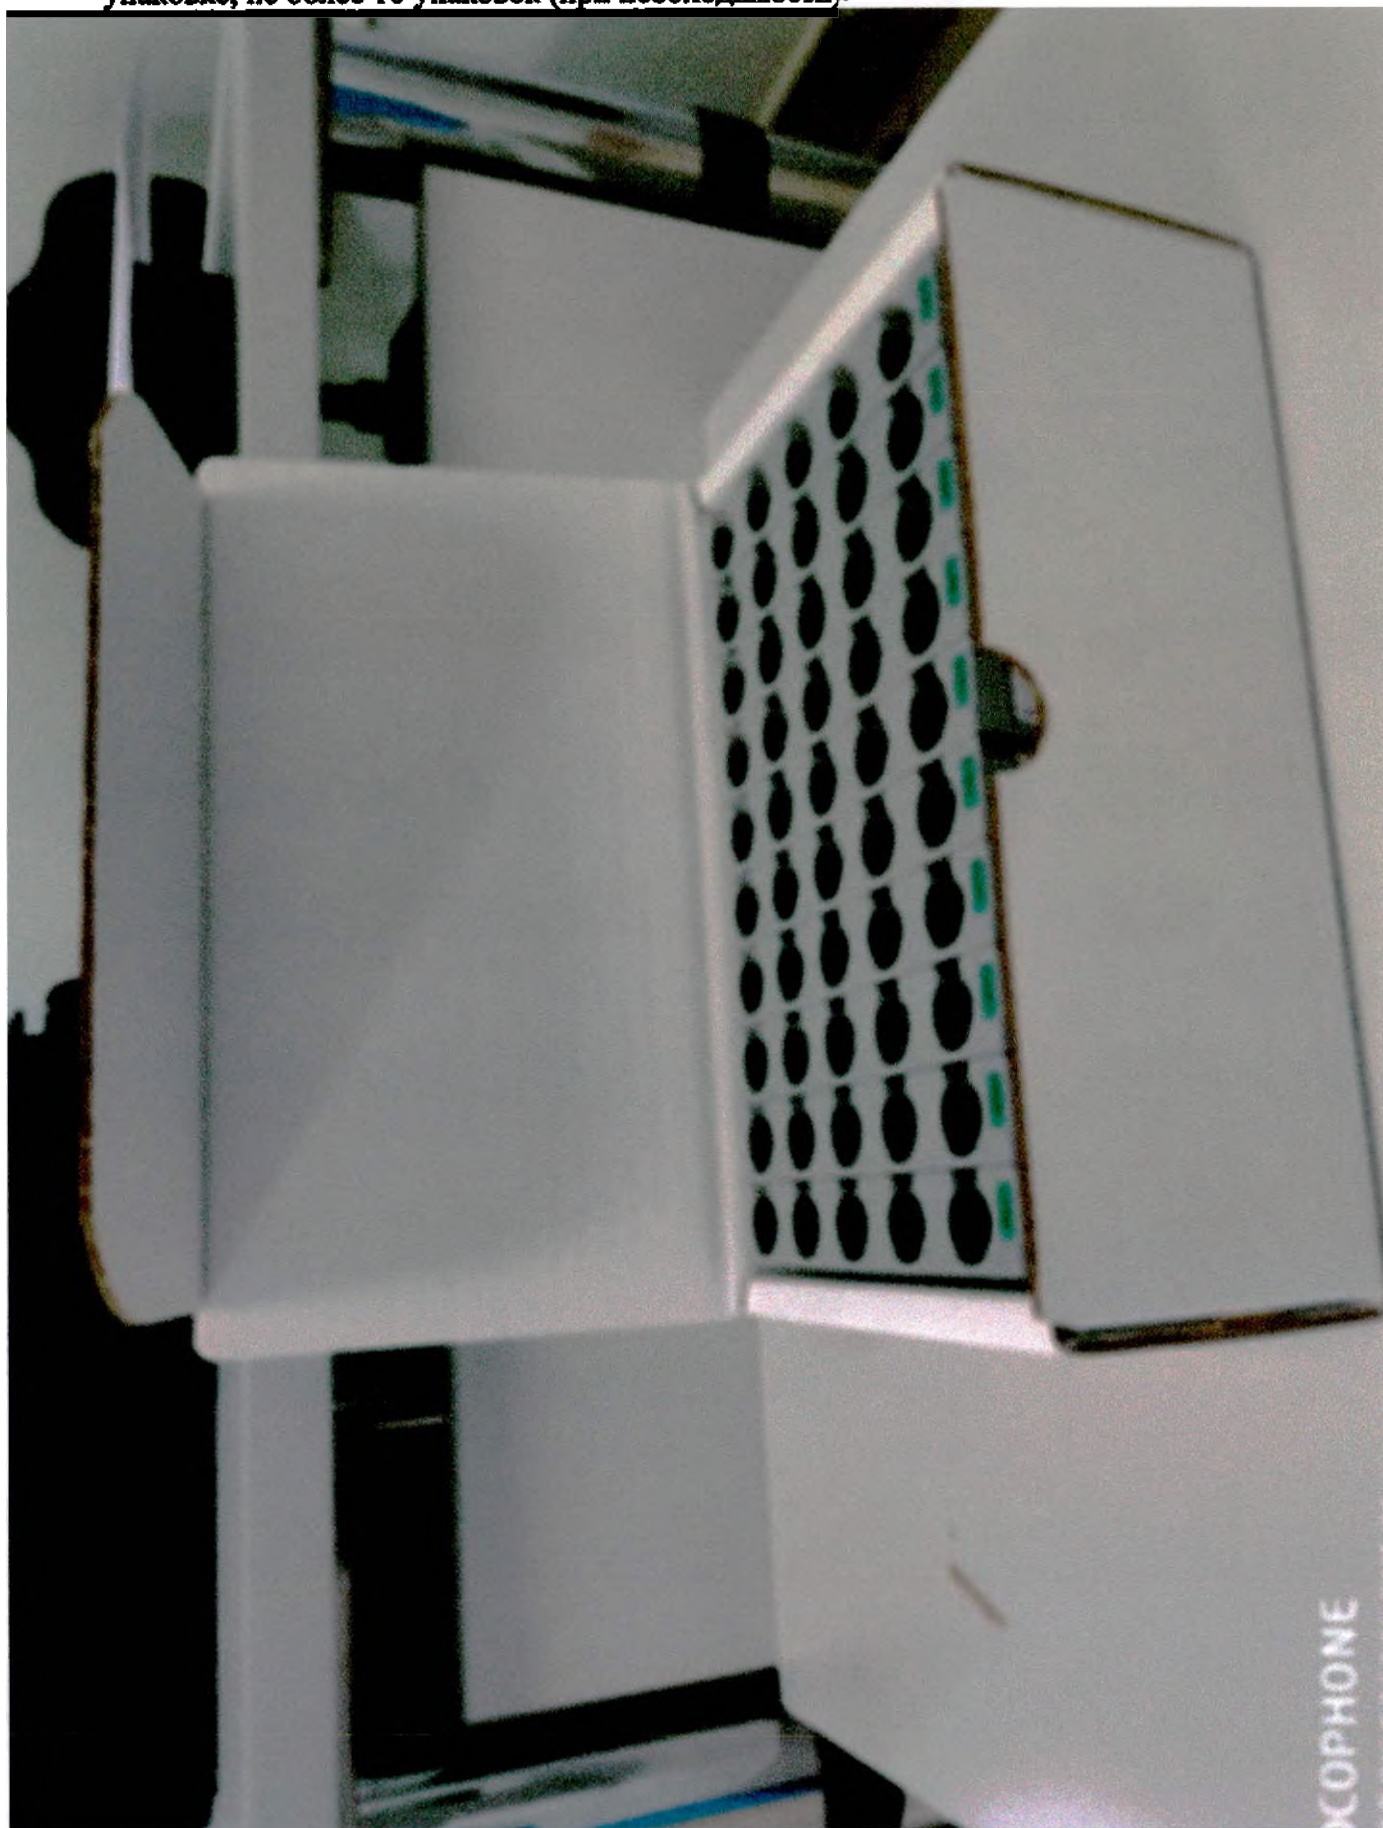


30. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M041-M050, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

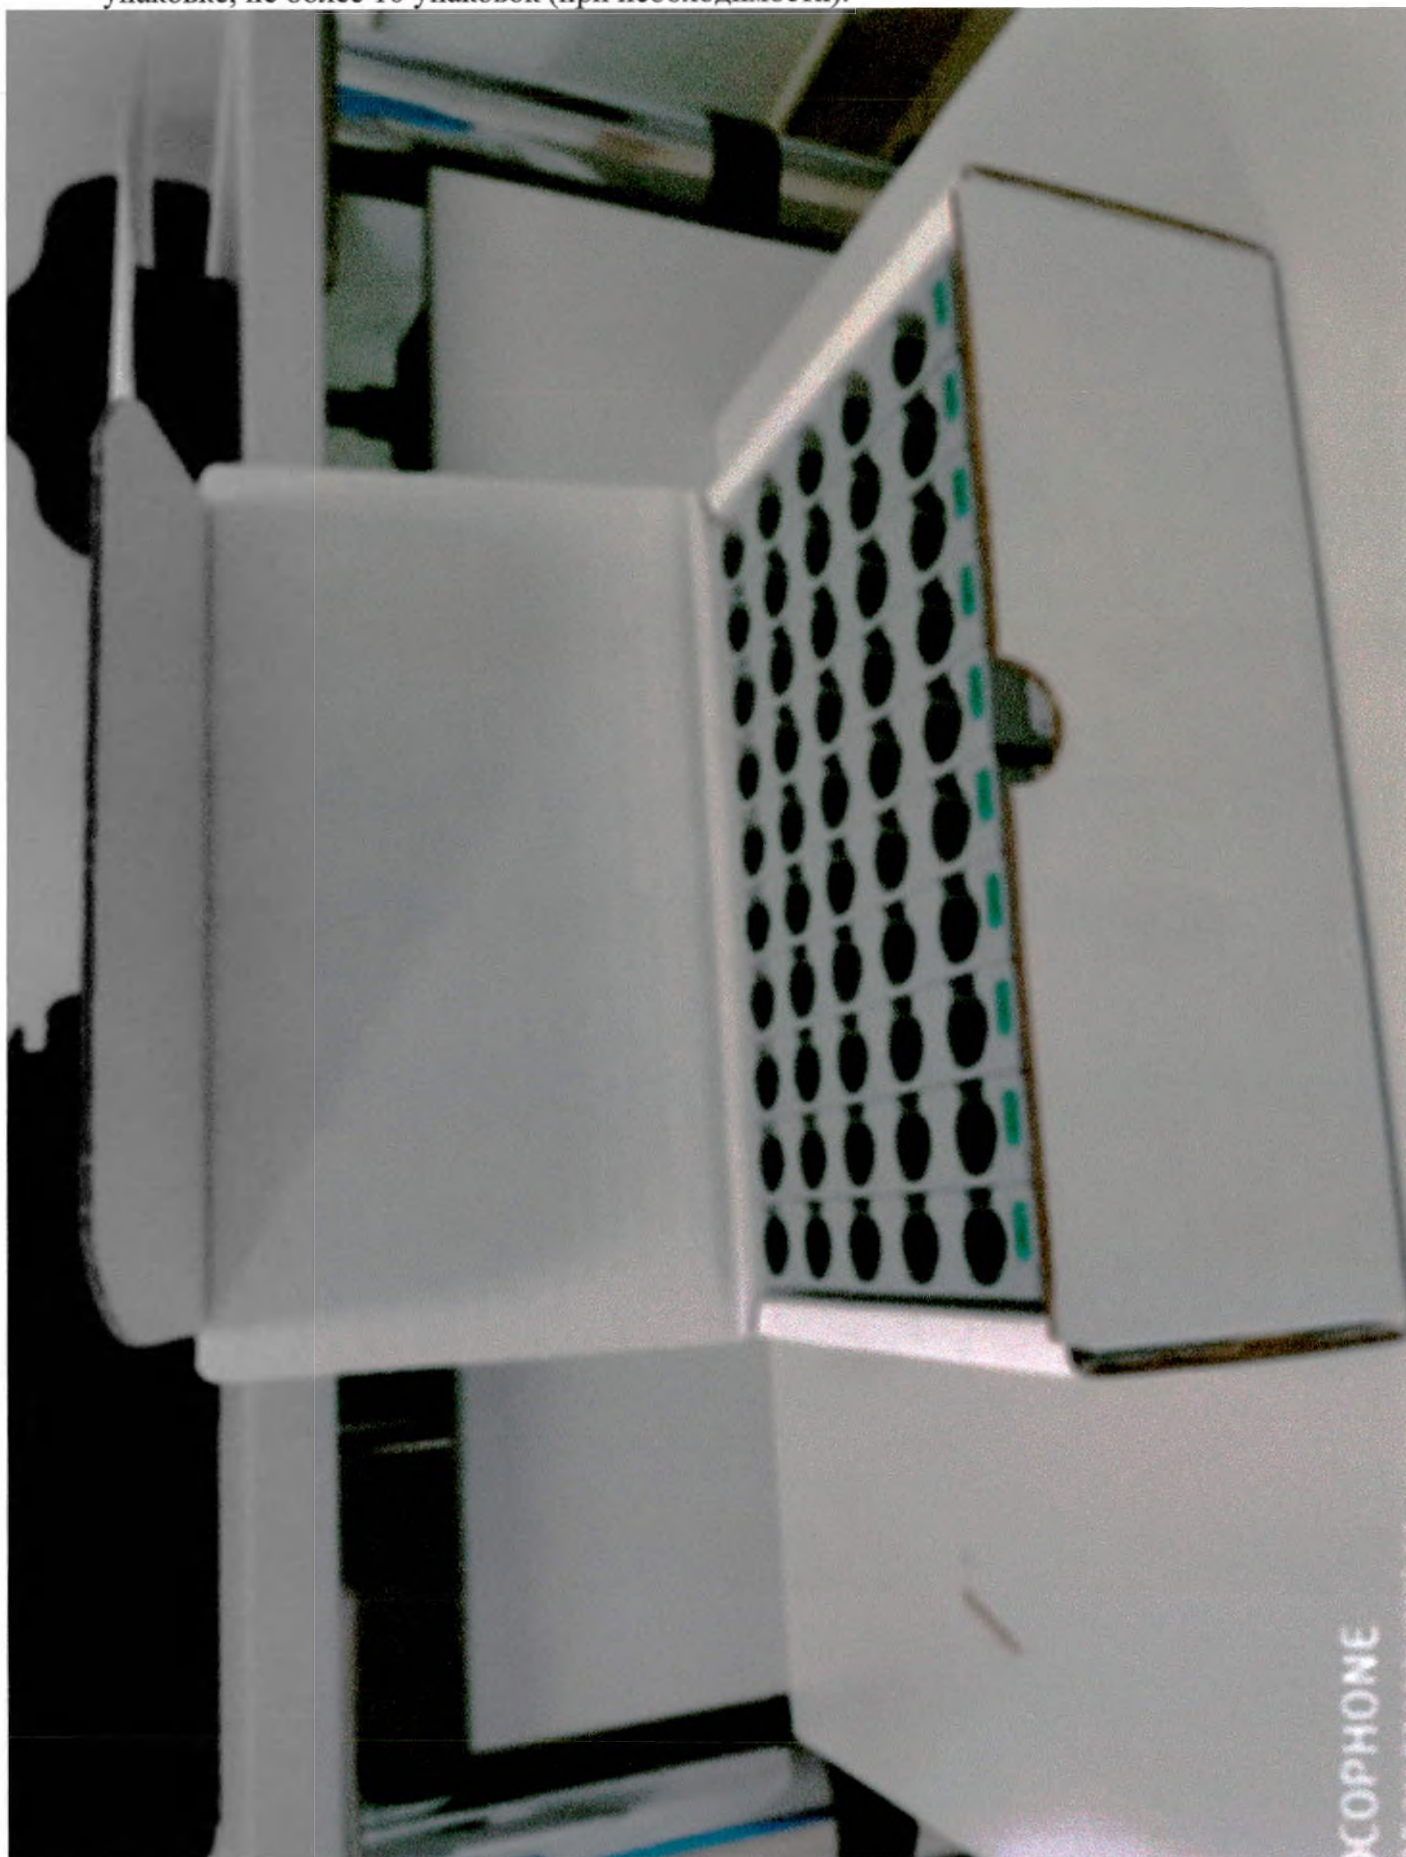


31. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M051-M060, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

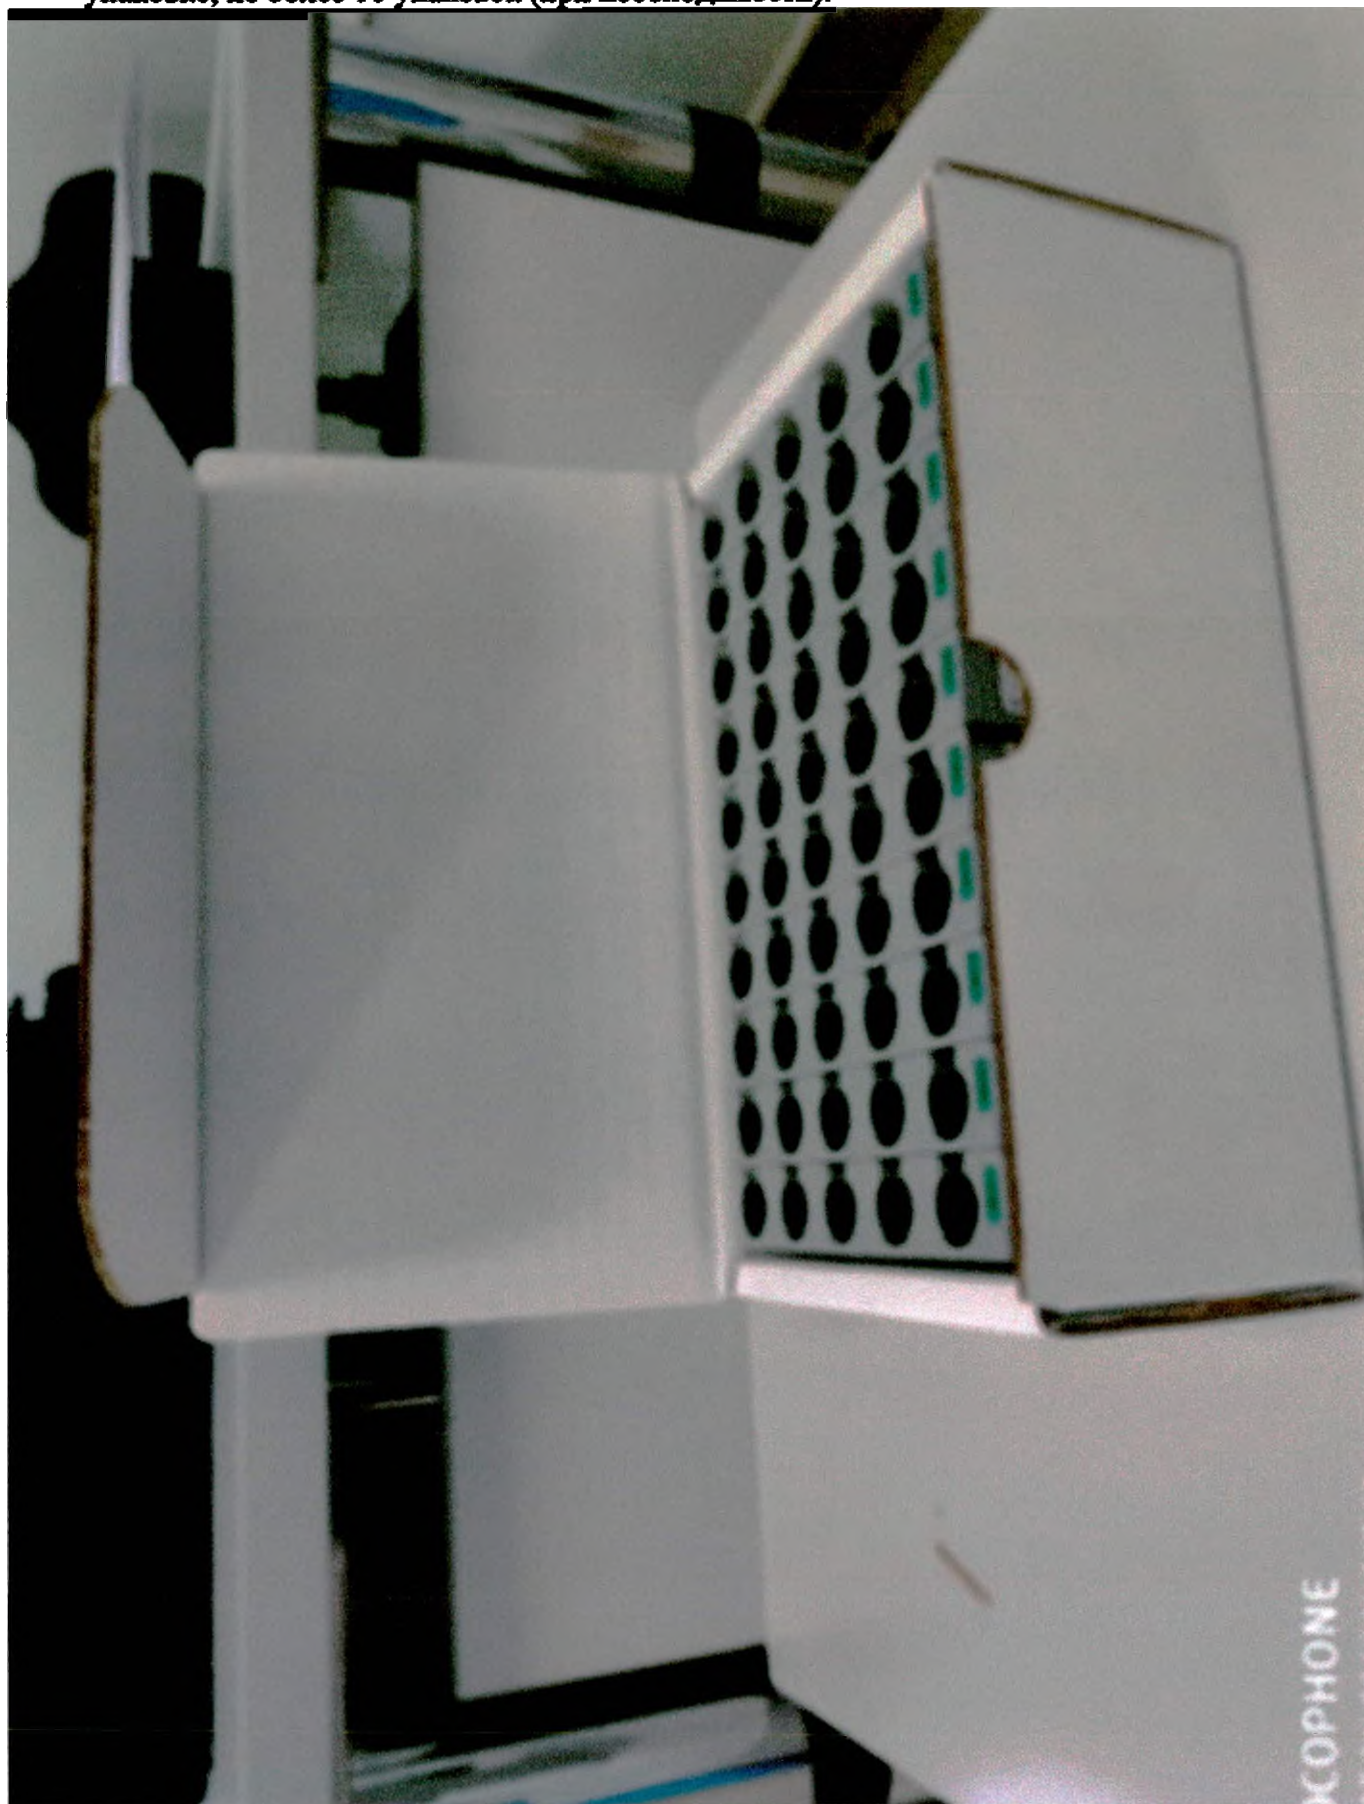


32. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M061-M070, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

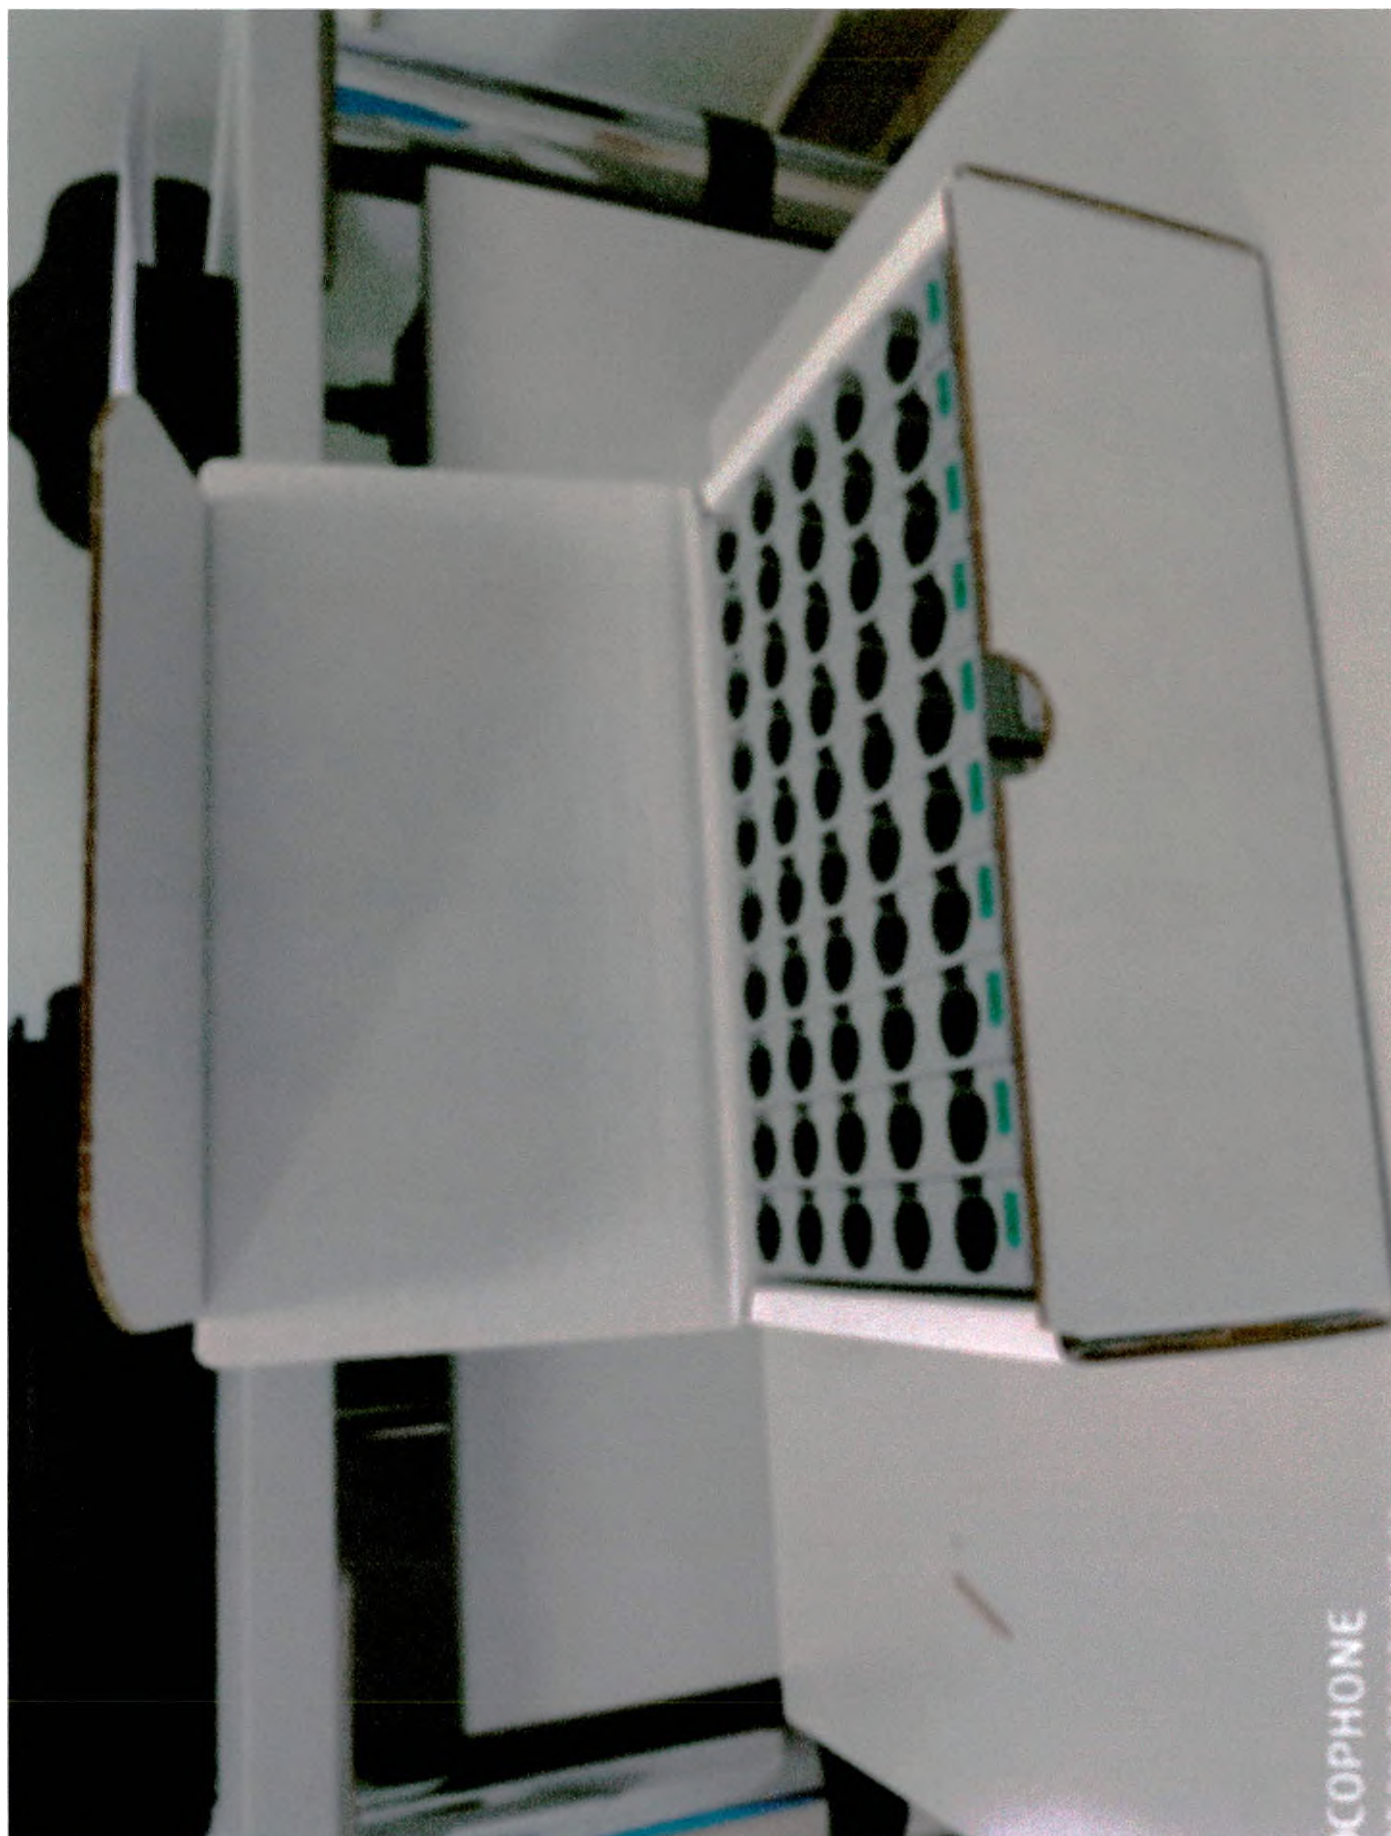


33. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M071-M080, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

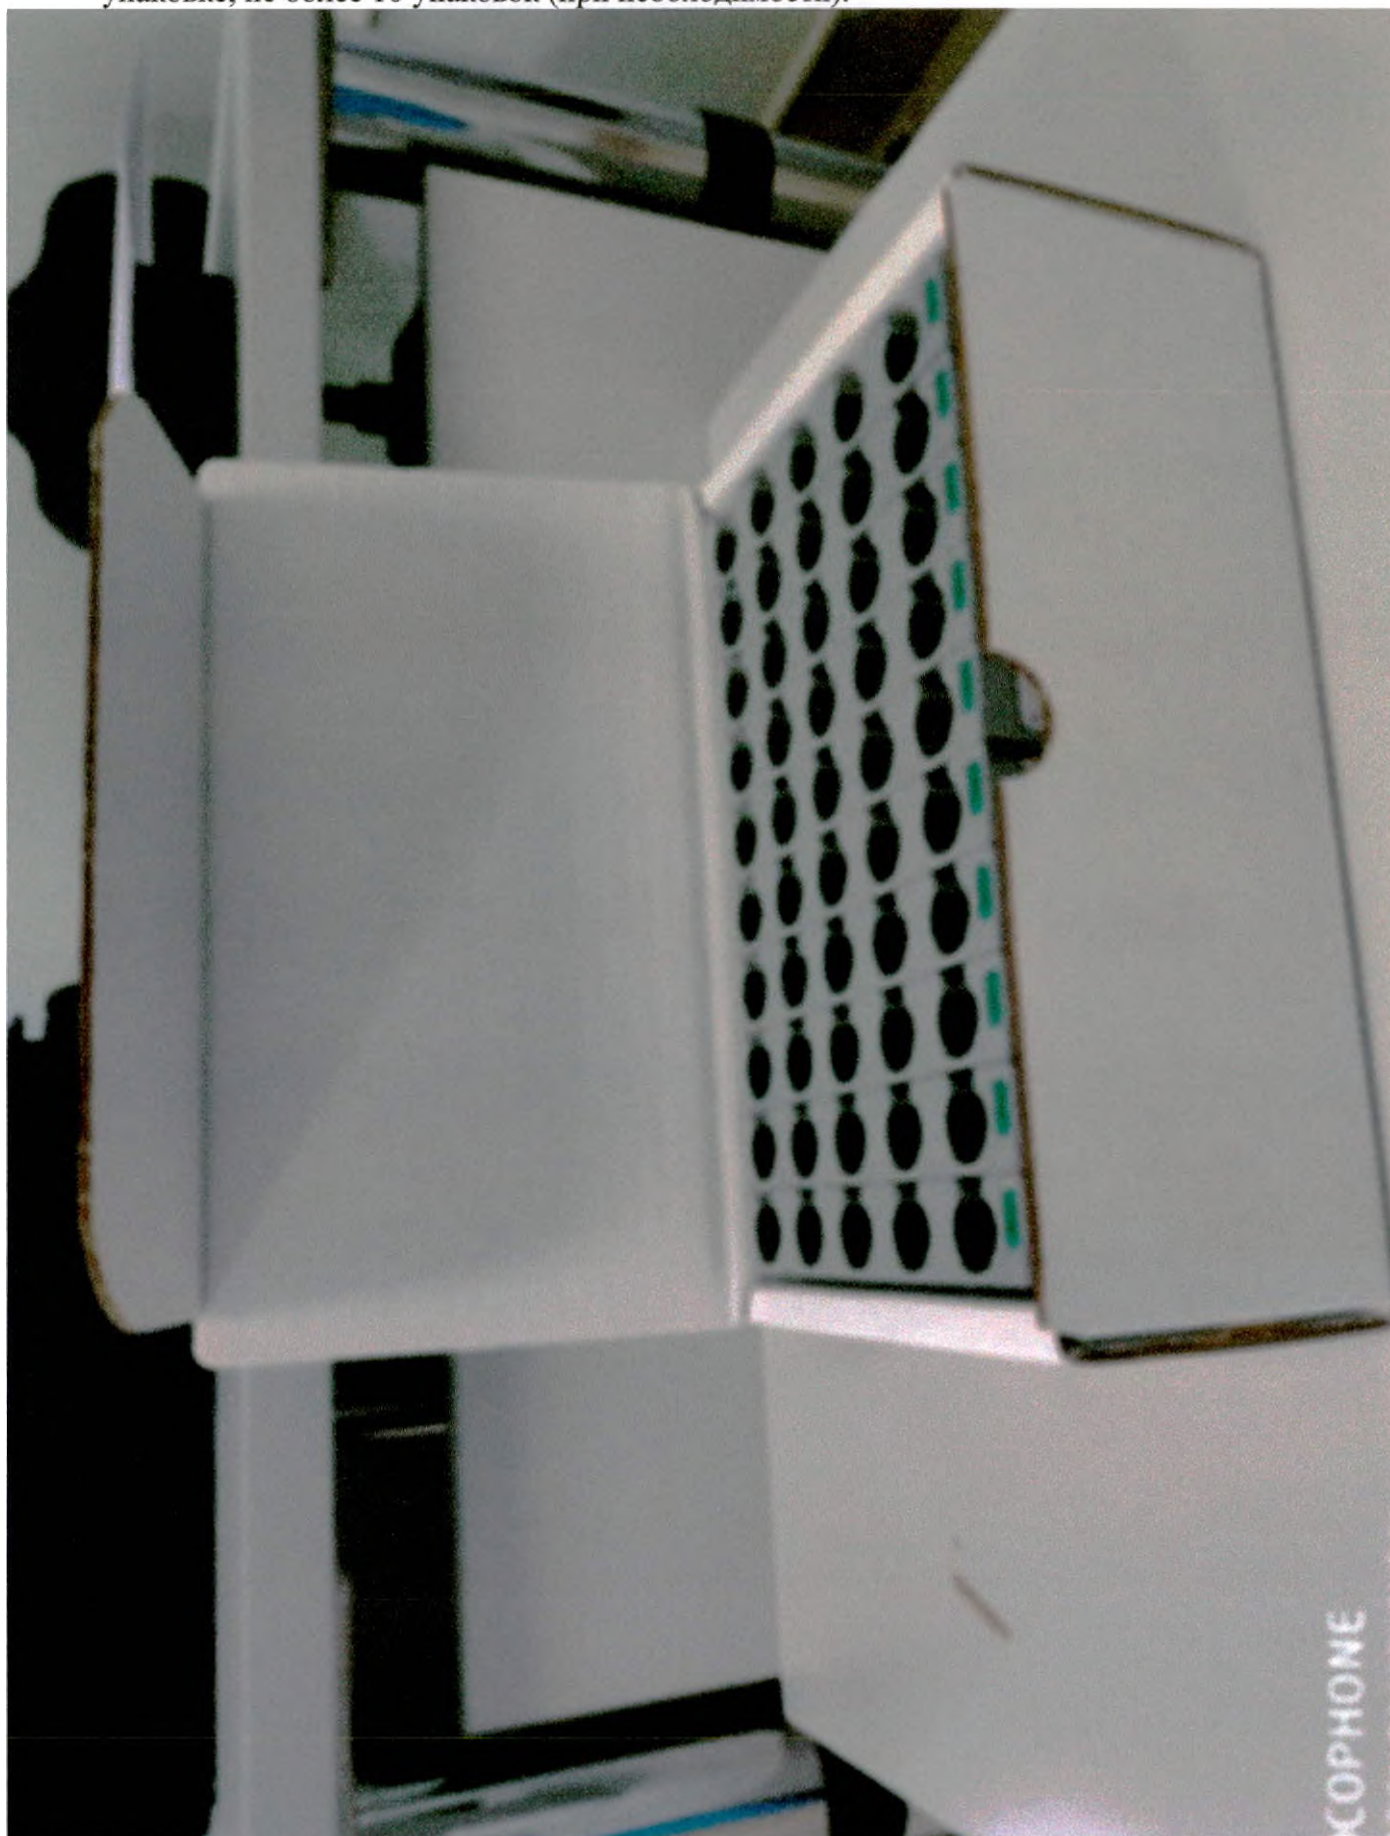


34. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M081-M090, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

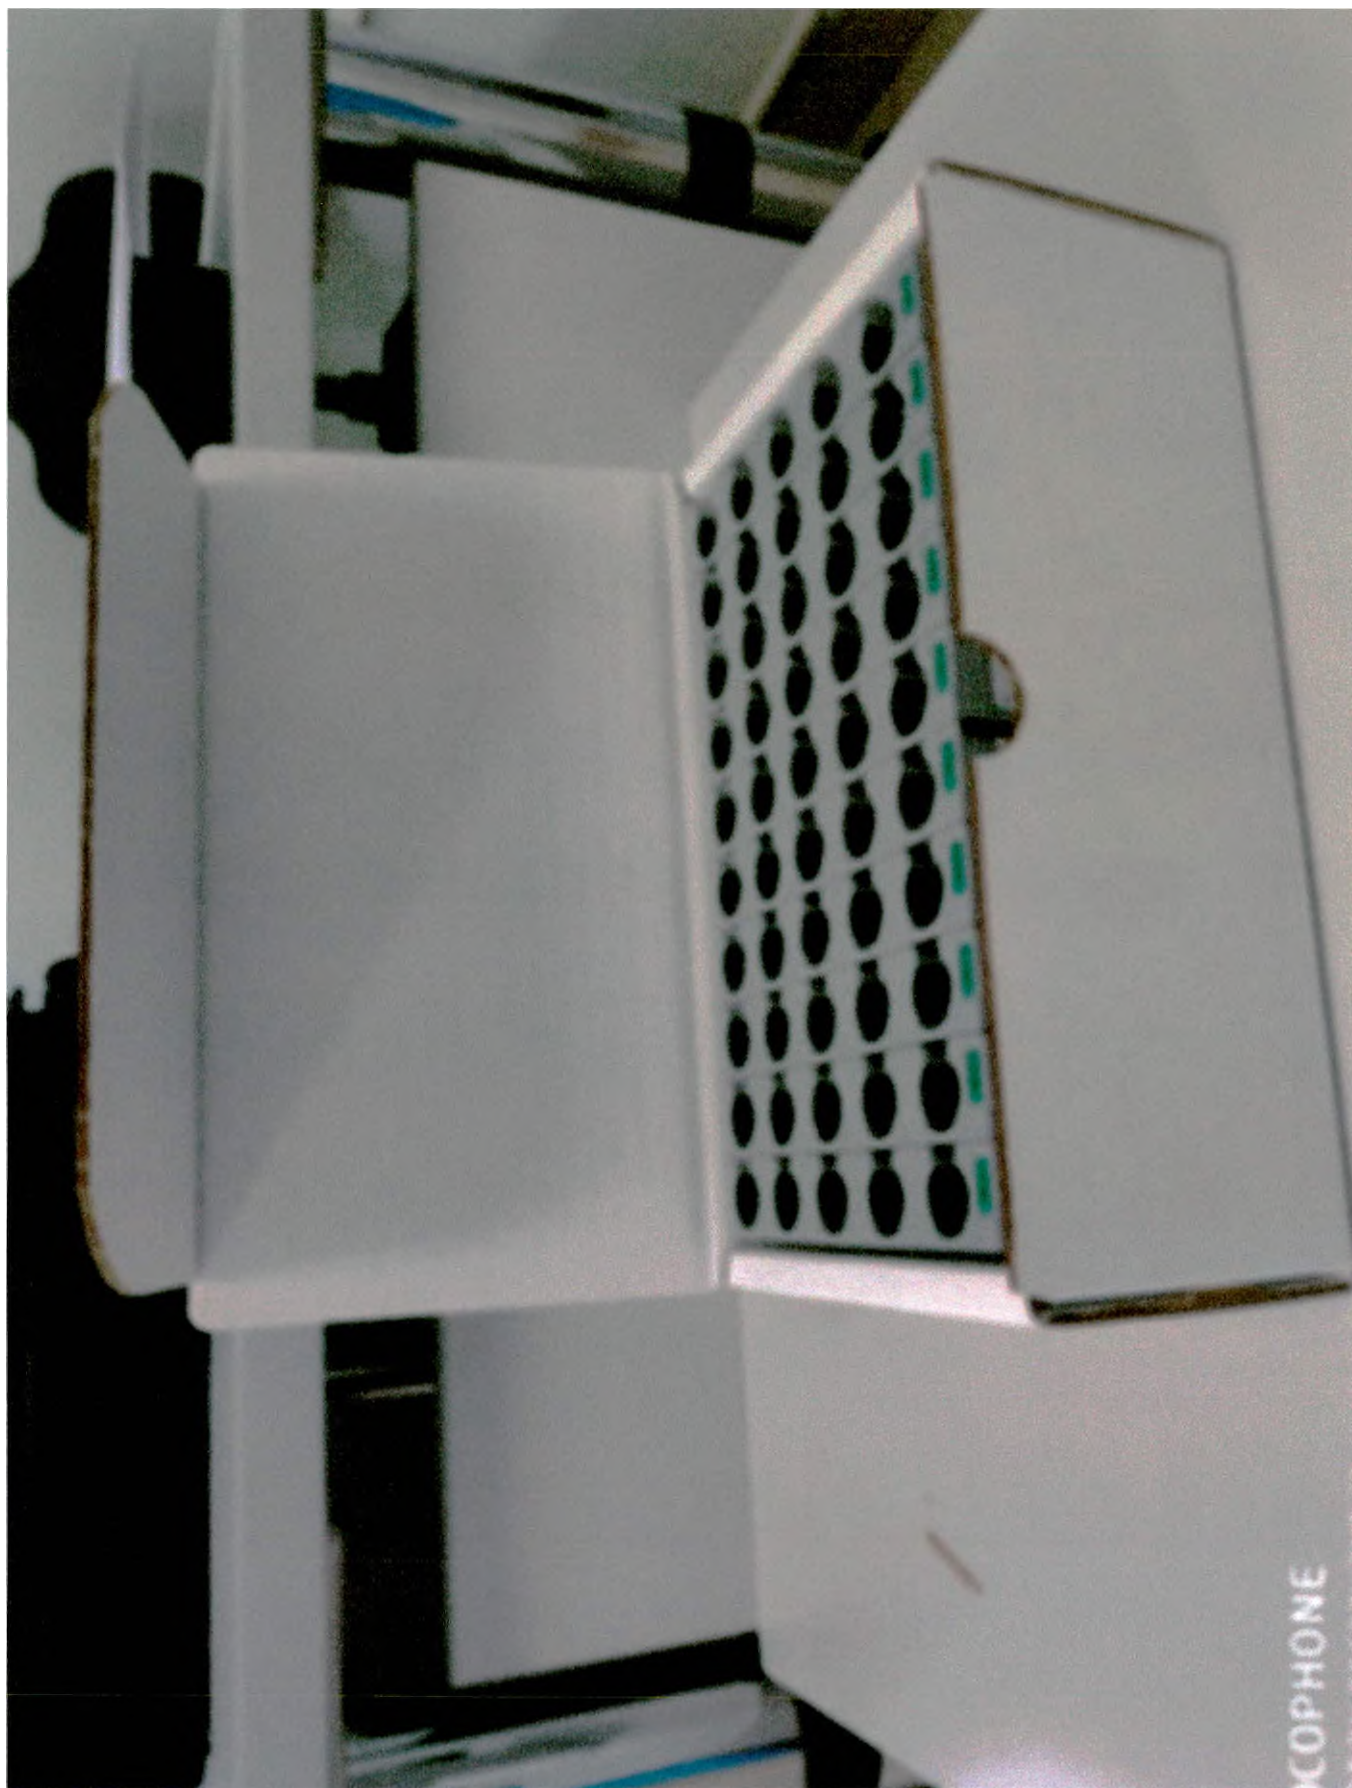


35. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M091-M100, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

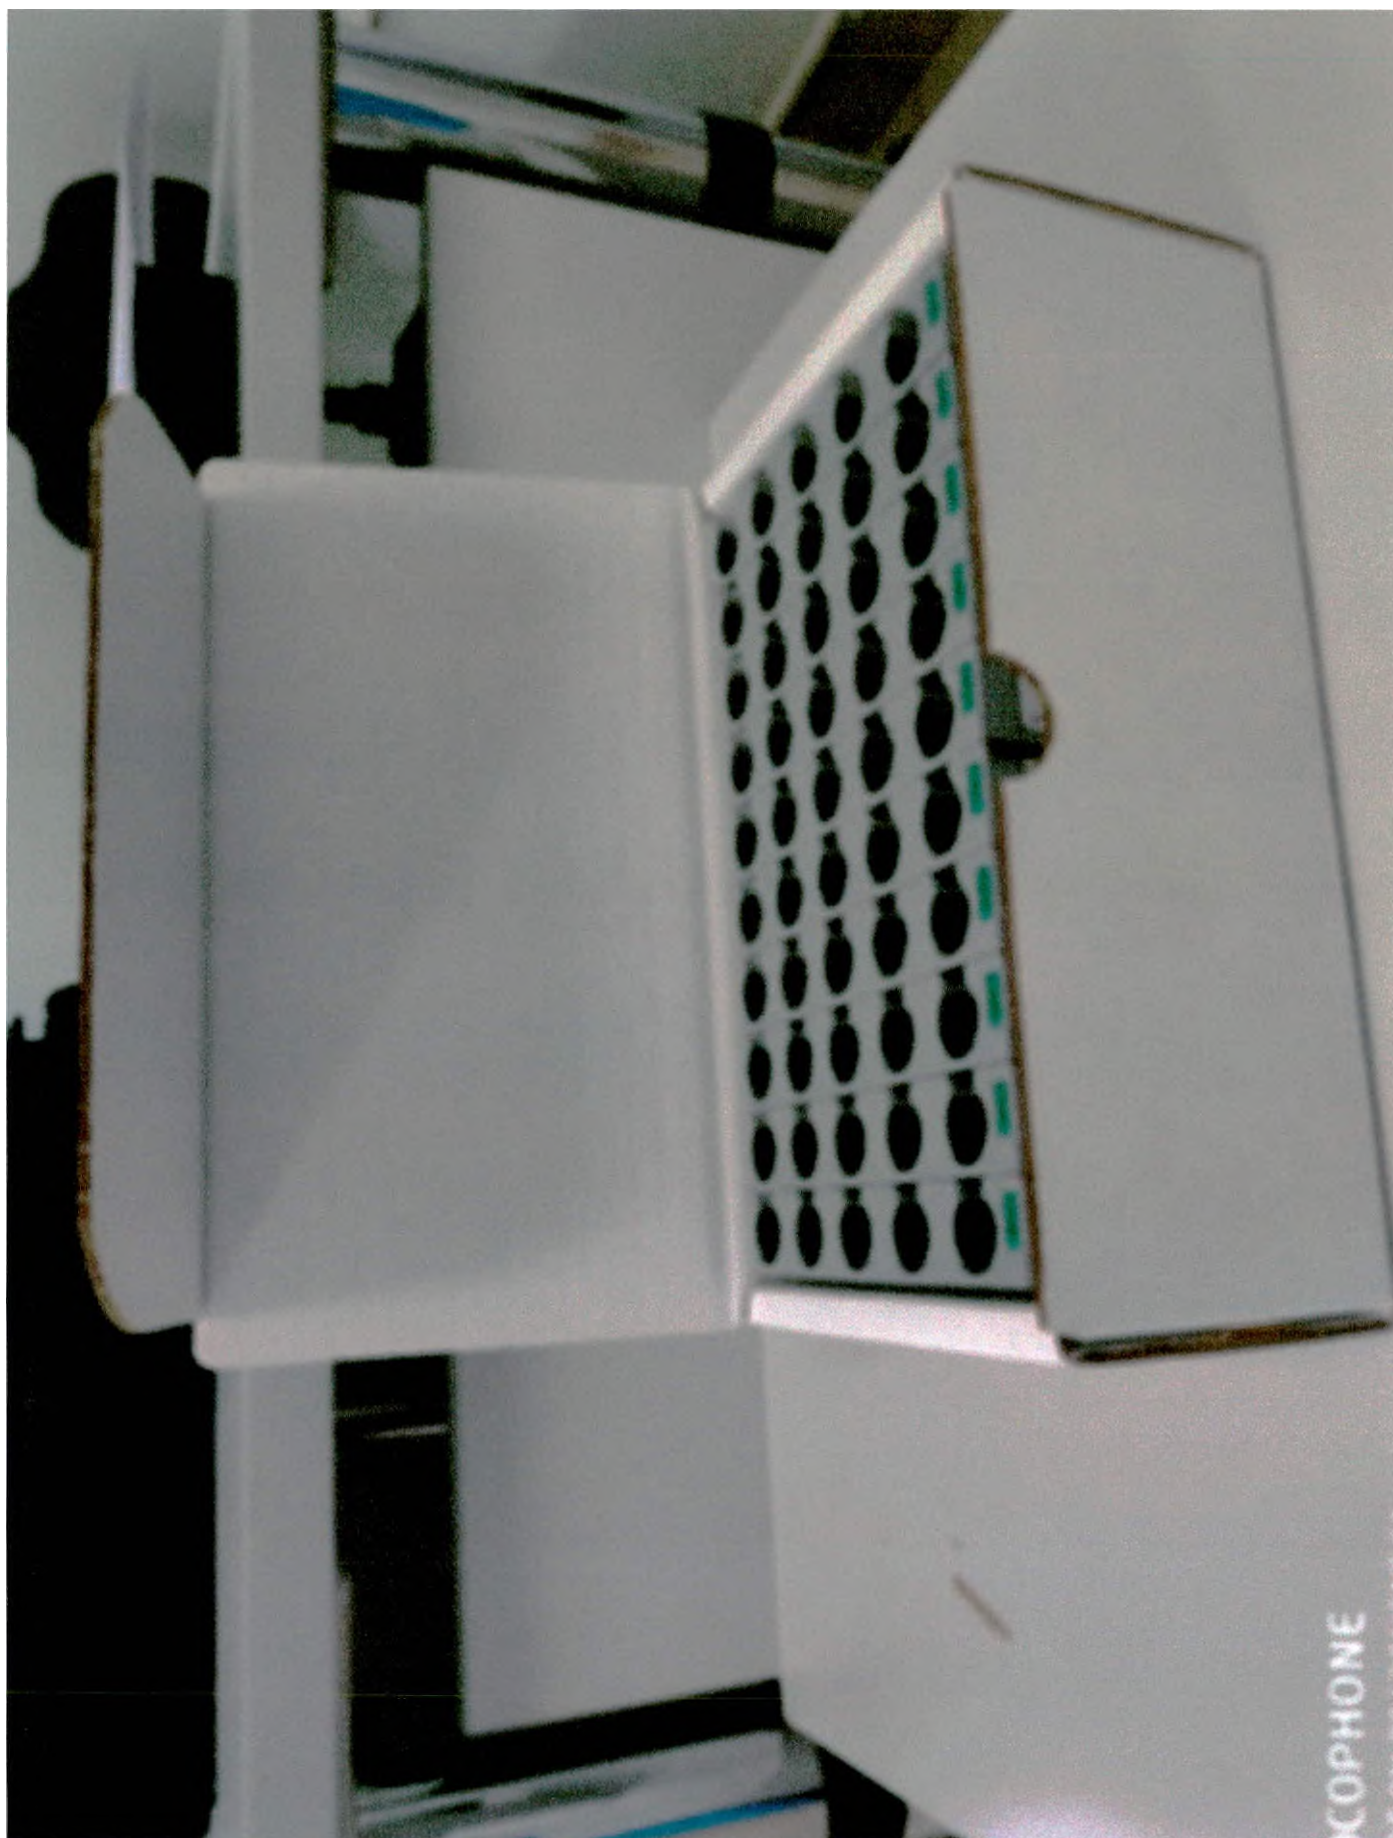


36. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0001-0050, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

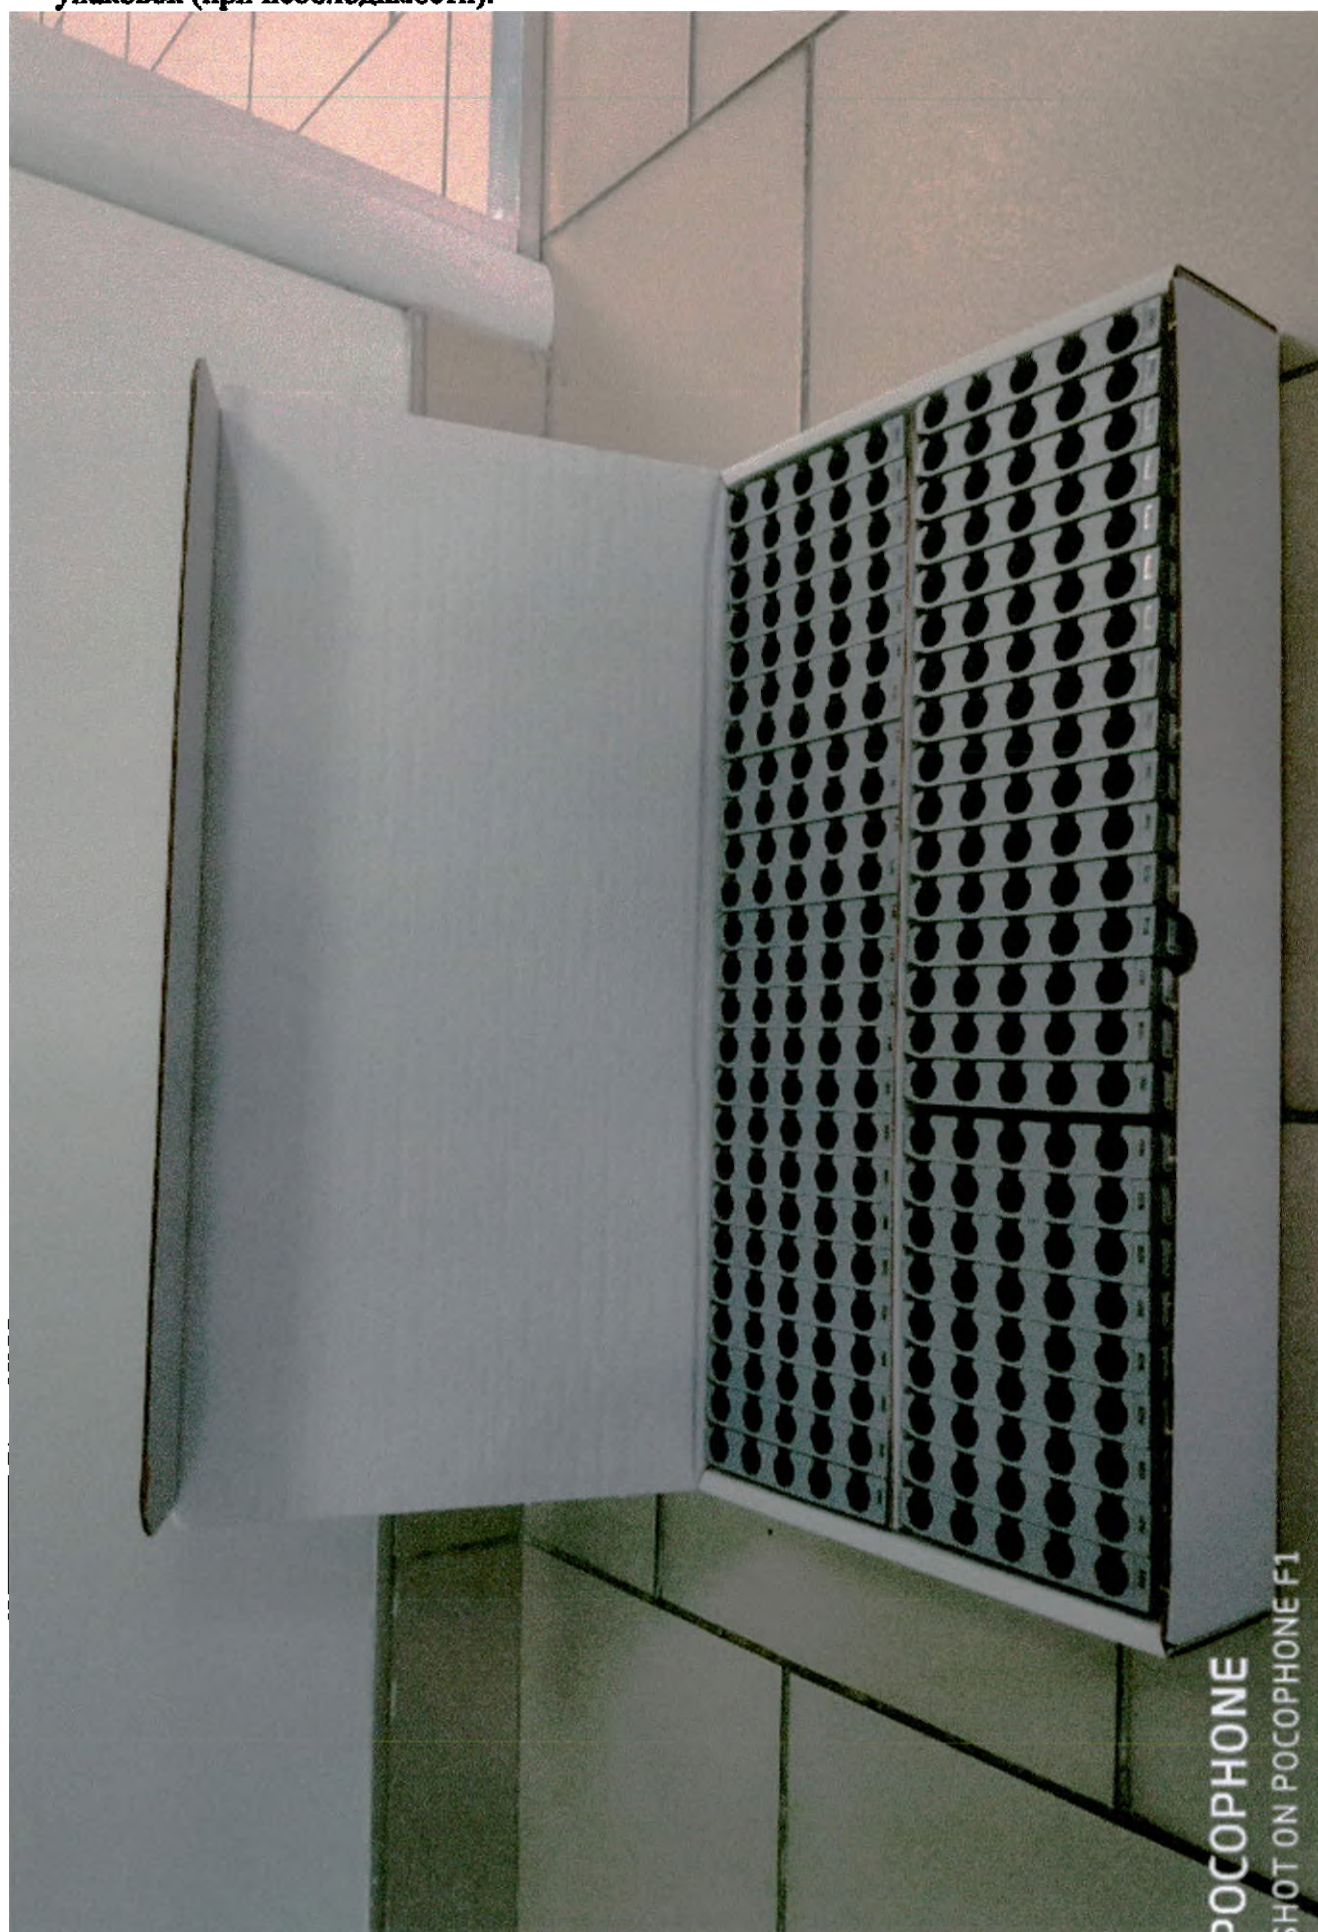


37. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0051-0100, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

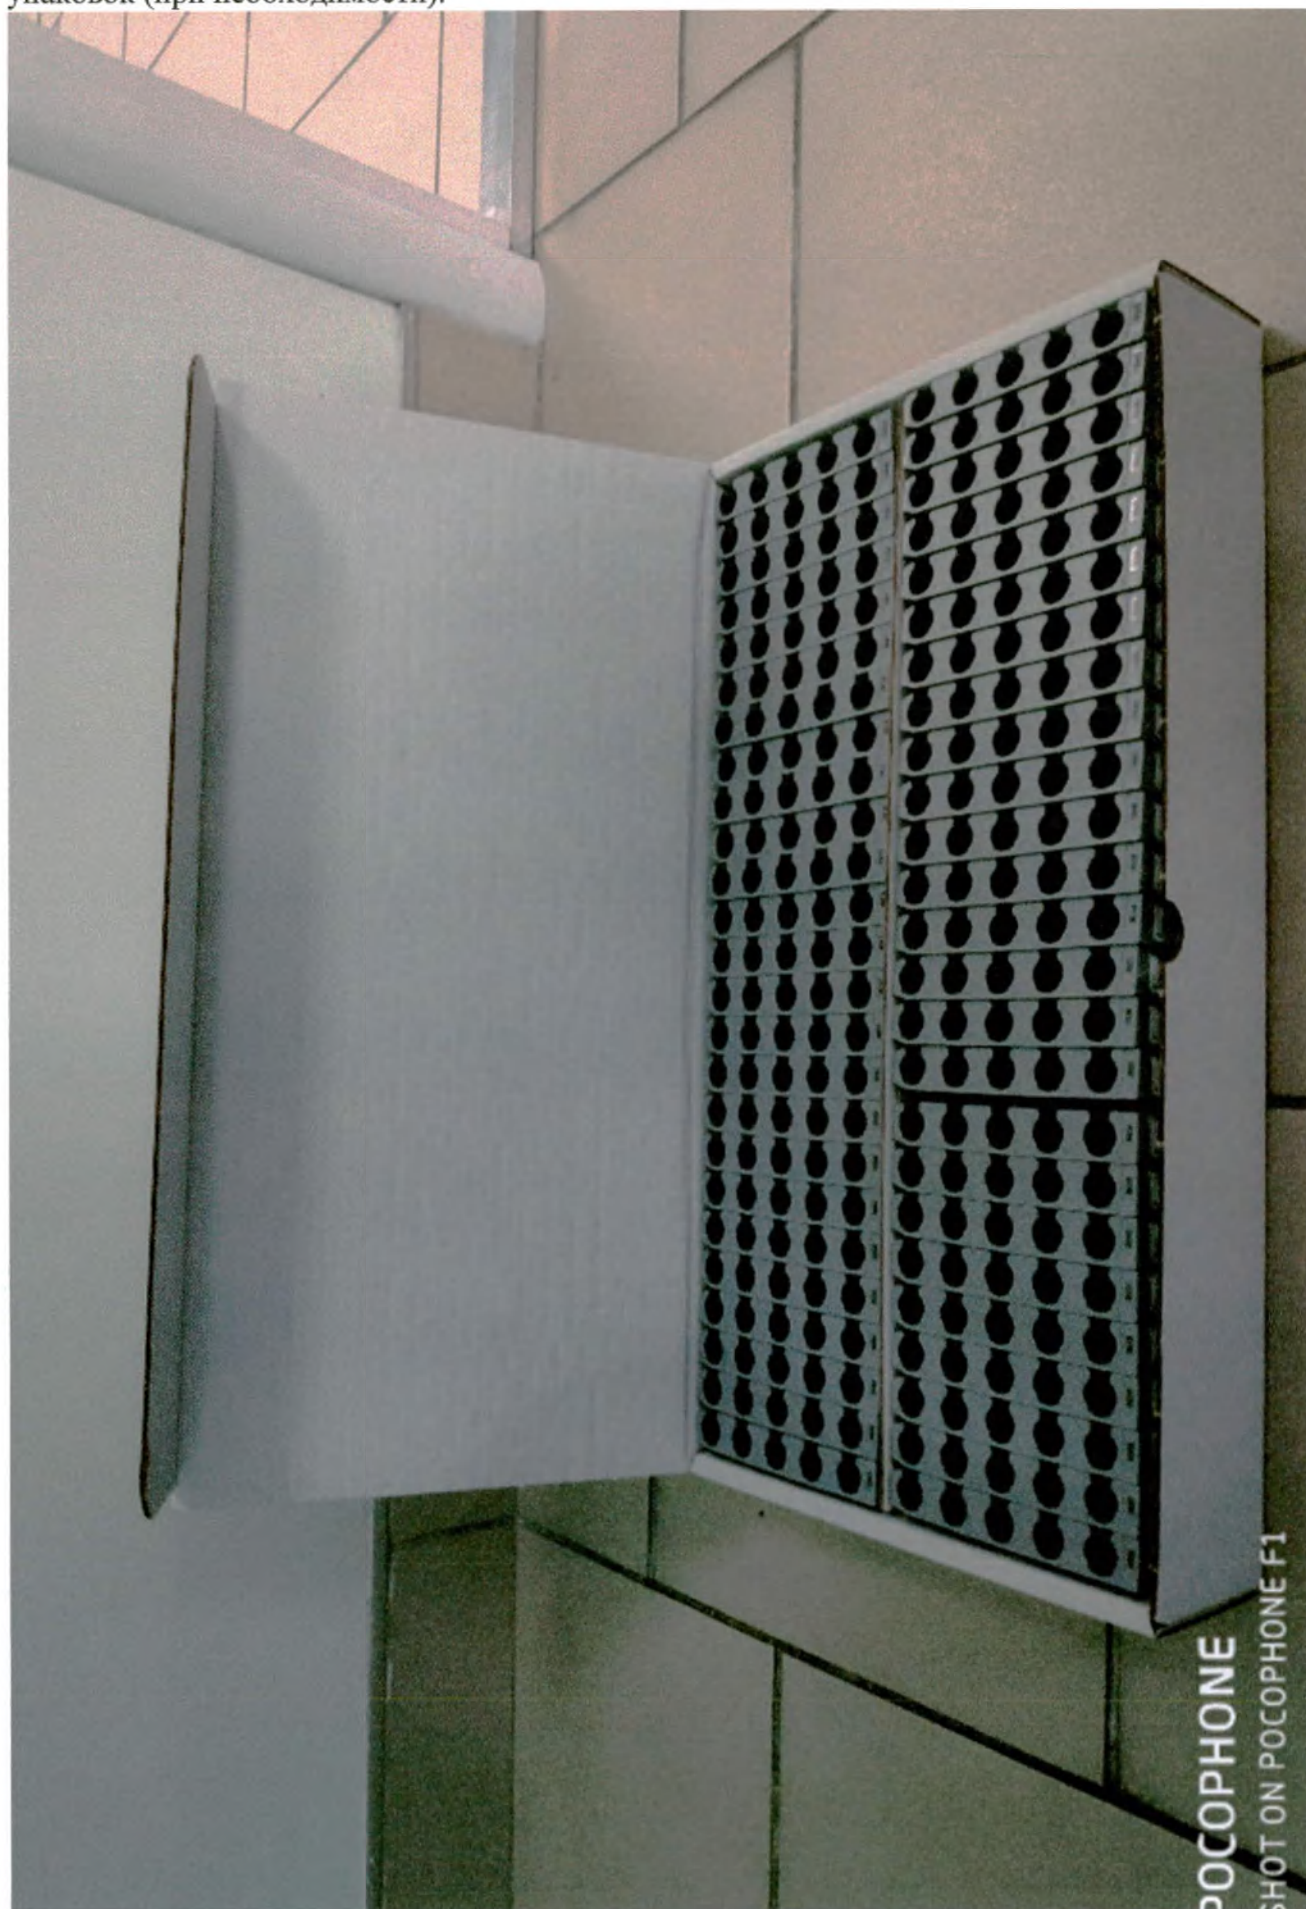


38. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0101-0150, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости)

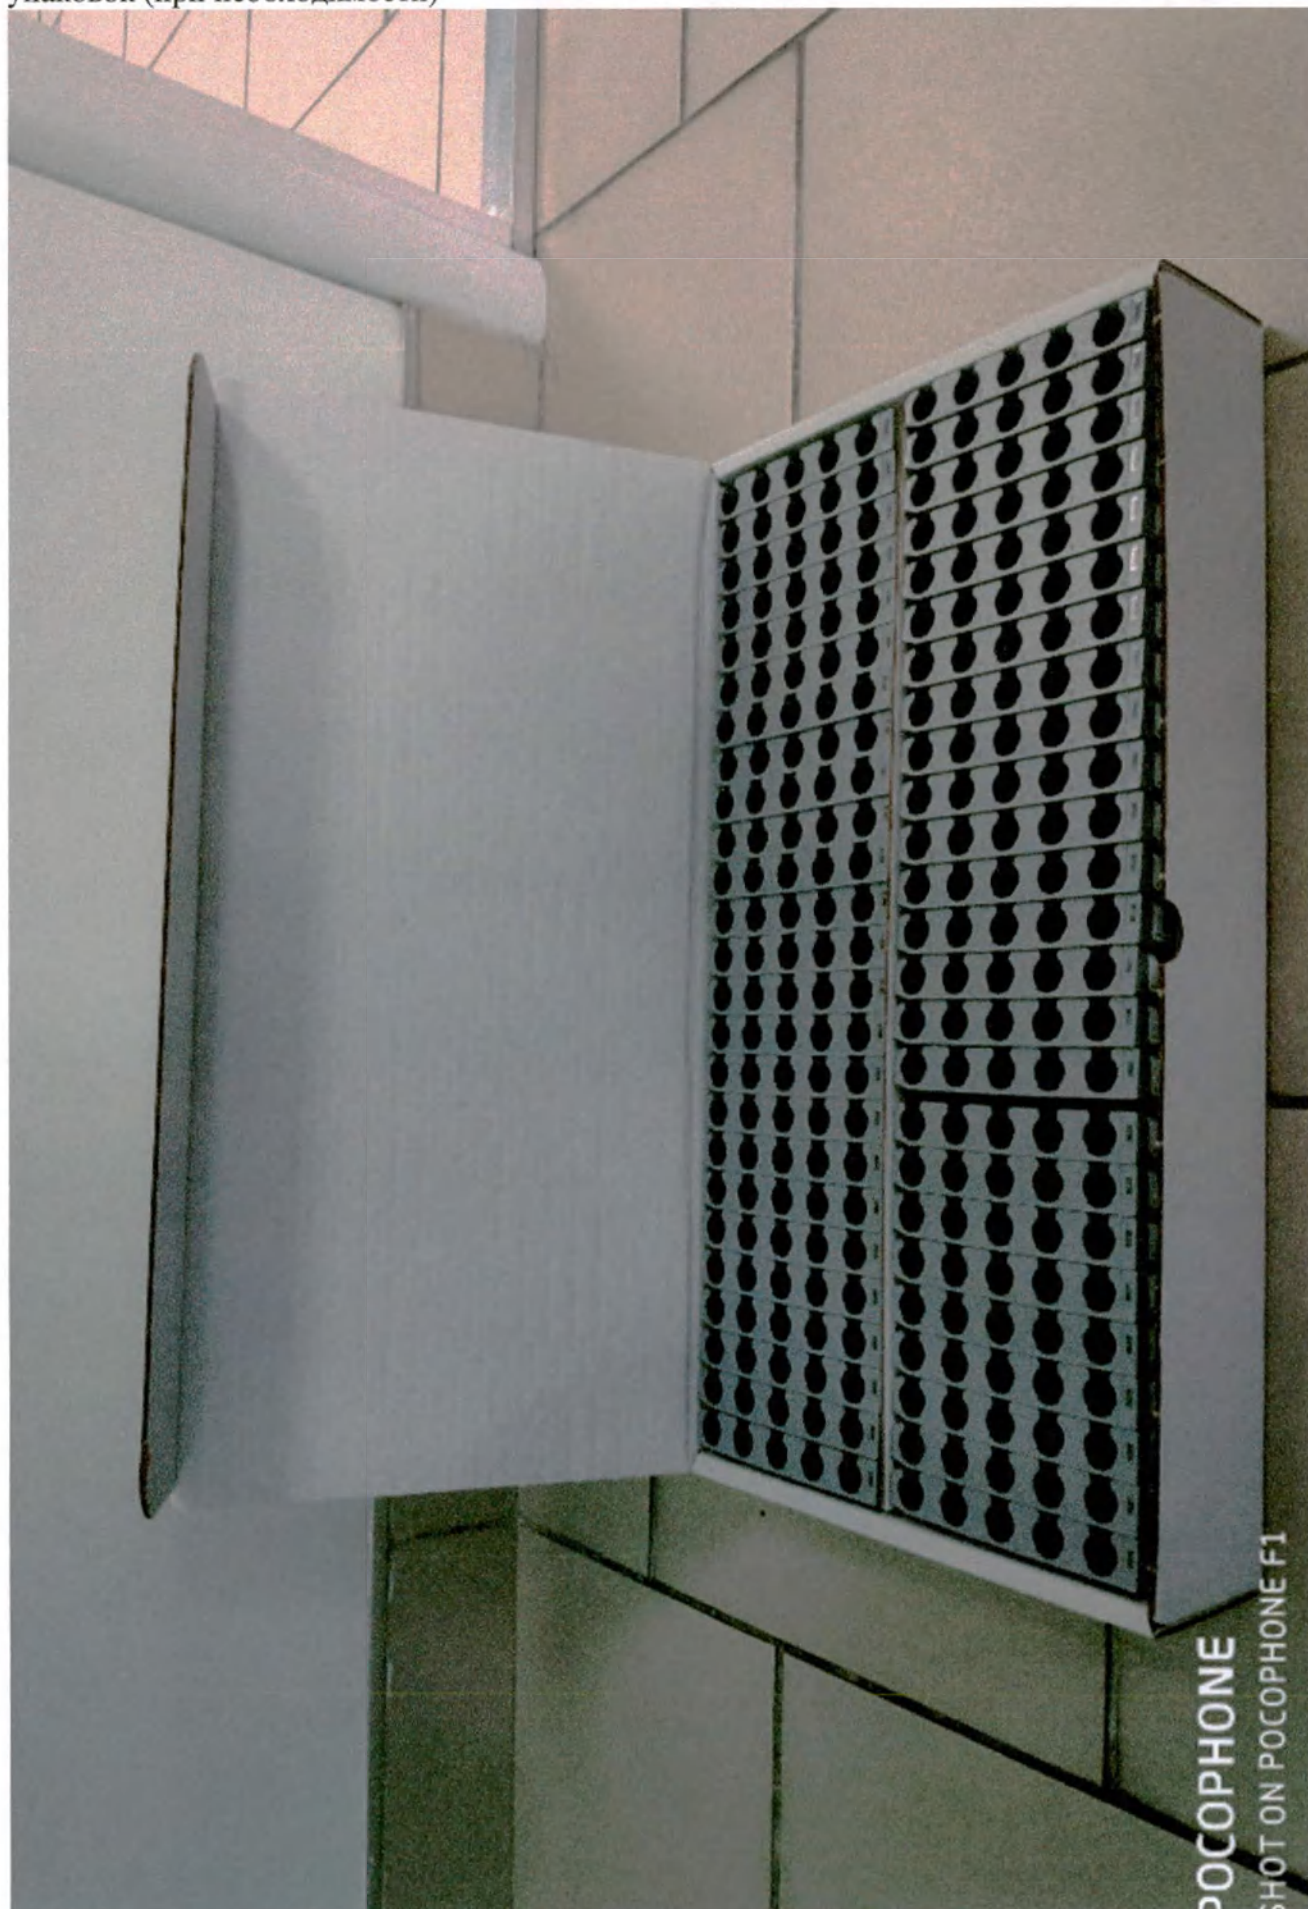

39. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0151-0200, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

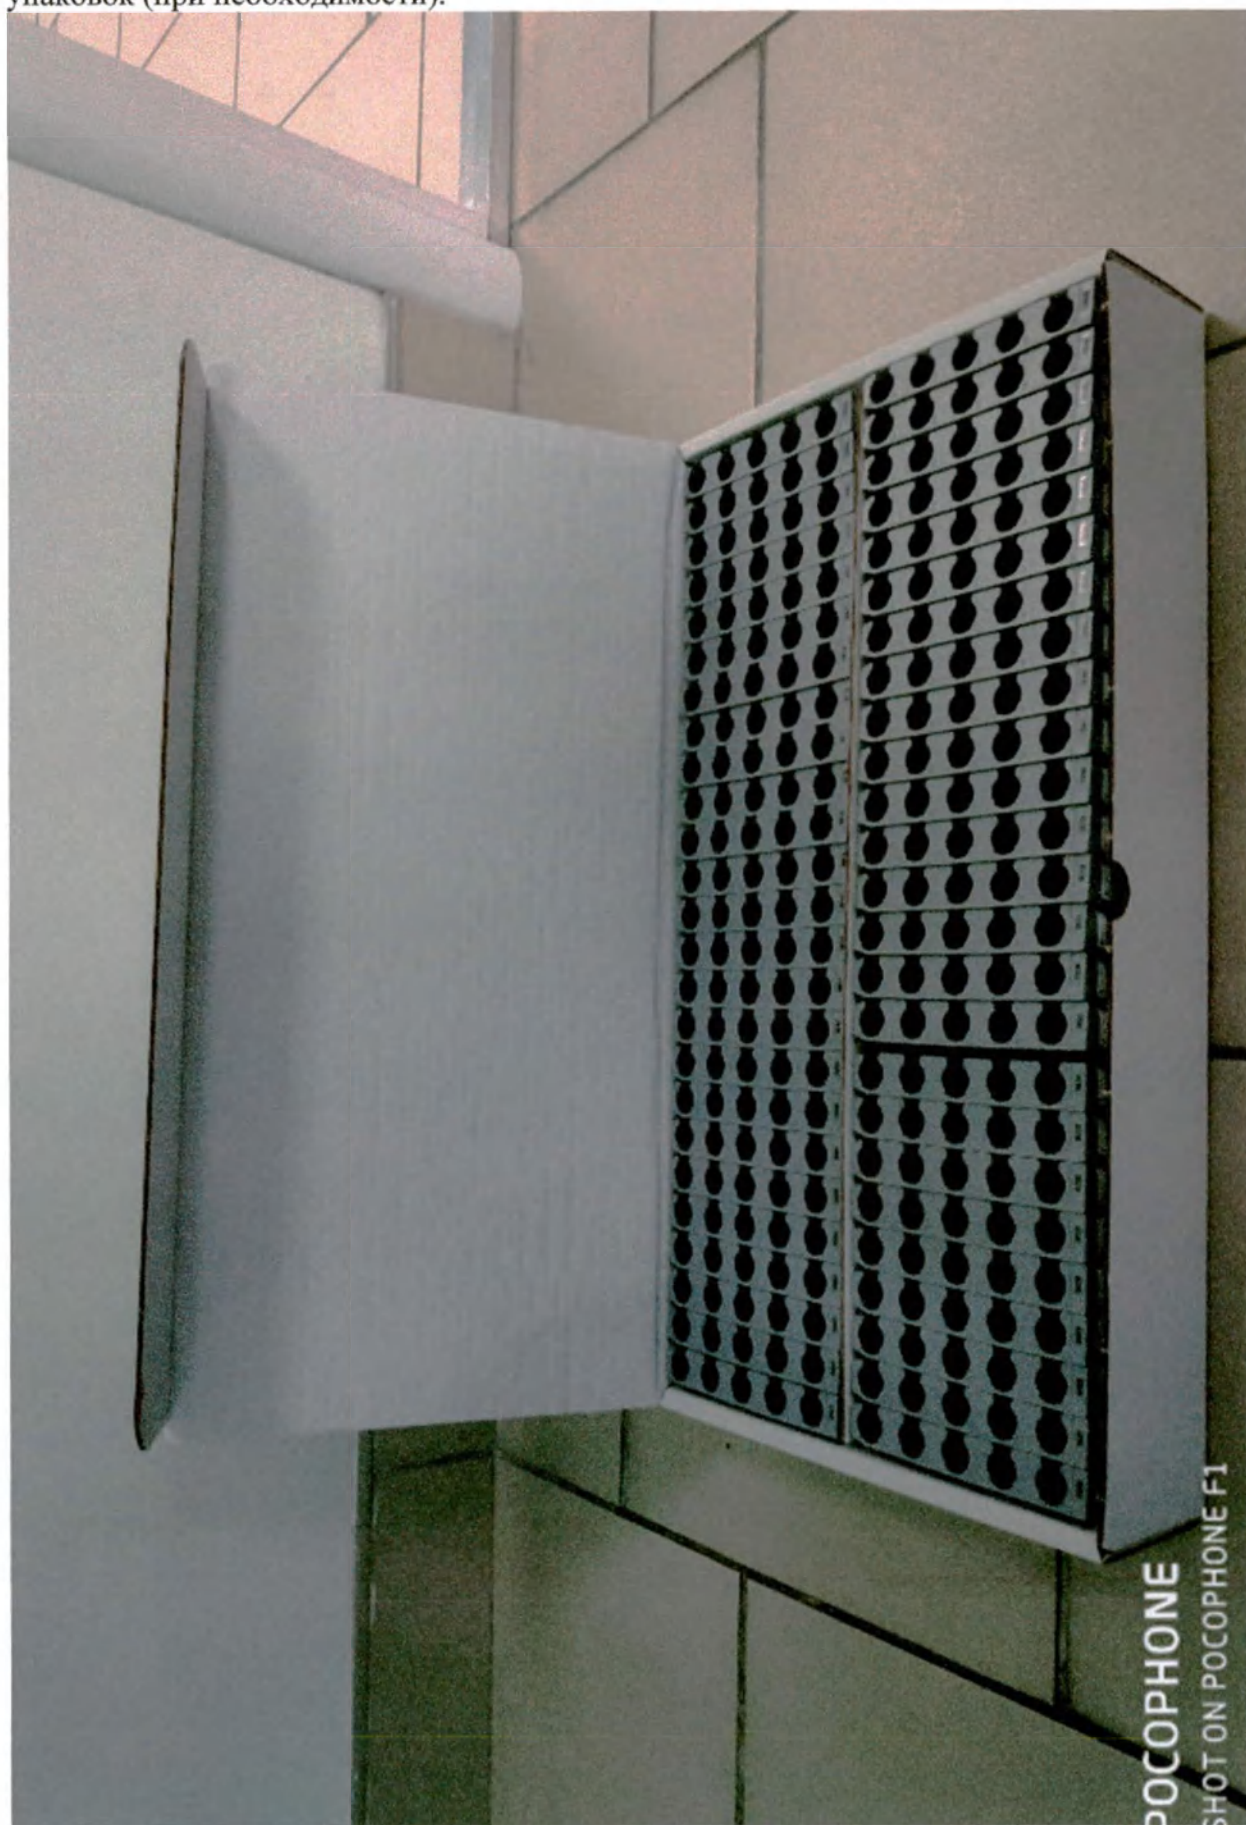

40. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0201-0250, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

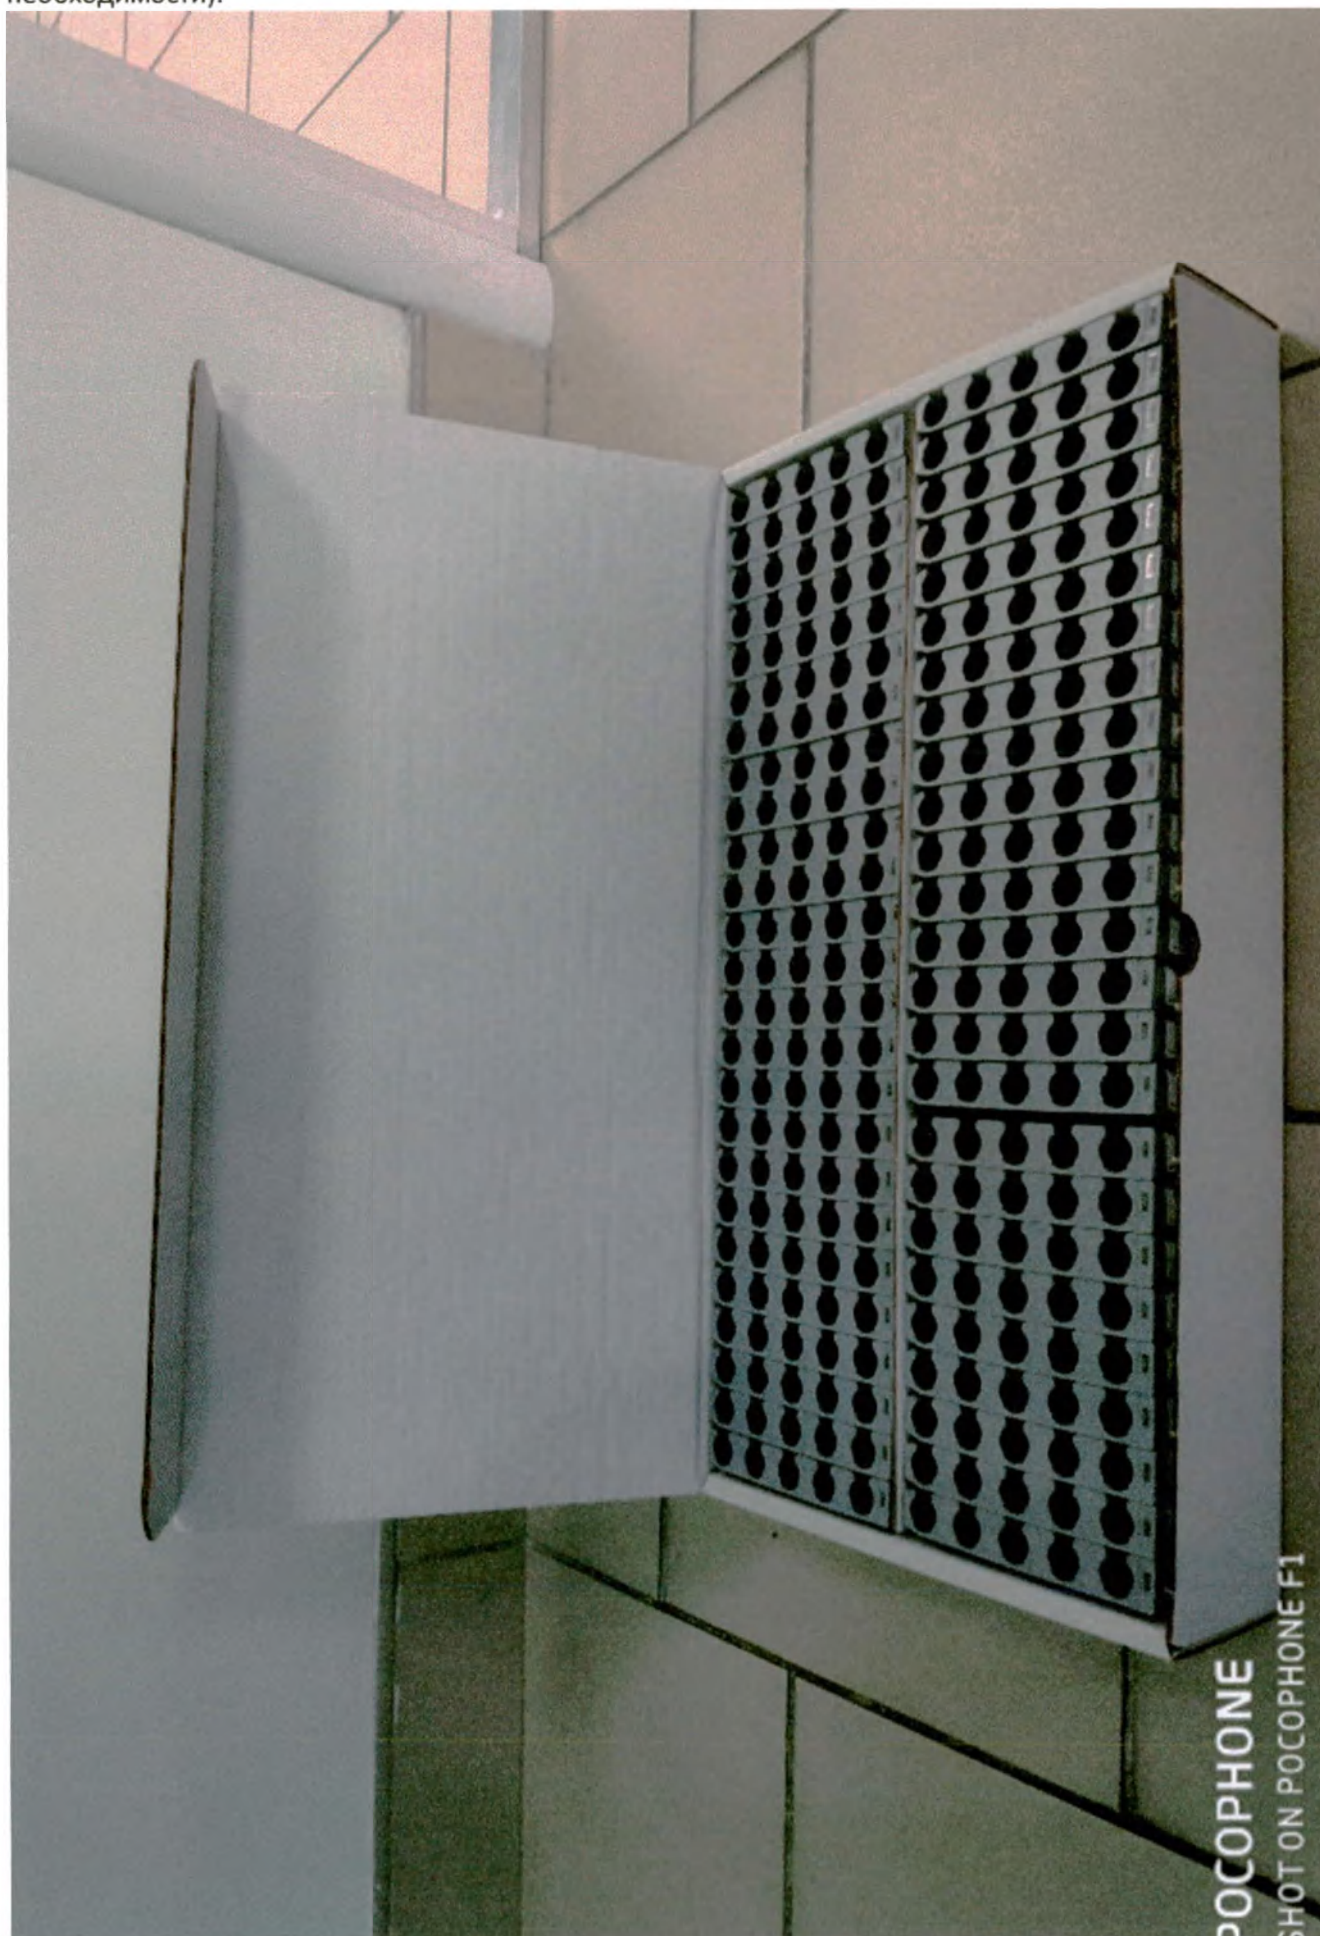

41. Набор штативов для контролей гемостаза №№Q001-Q010, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).




42. Набор штативов для контролей гемостаза №№Q011-Q020, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).




43. Набор штативов для контролей гемостаза №№Q021-Q030, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).




44. Набор штативов для калибратора для гемостаза №№С001-С010, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

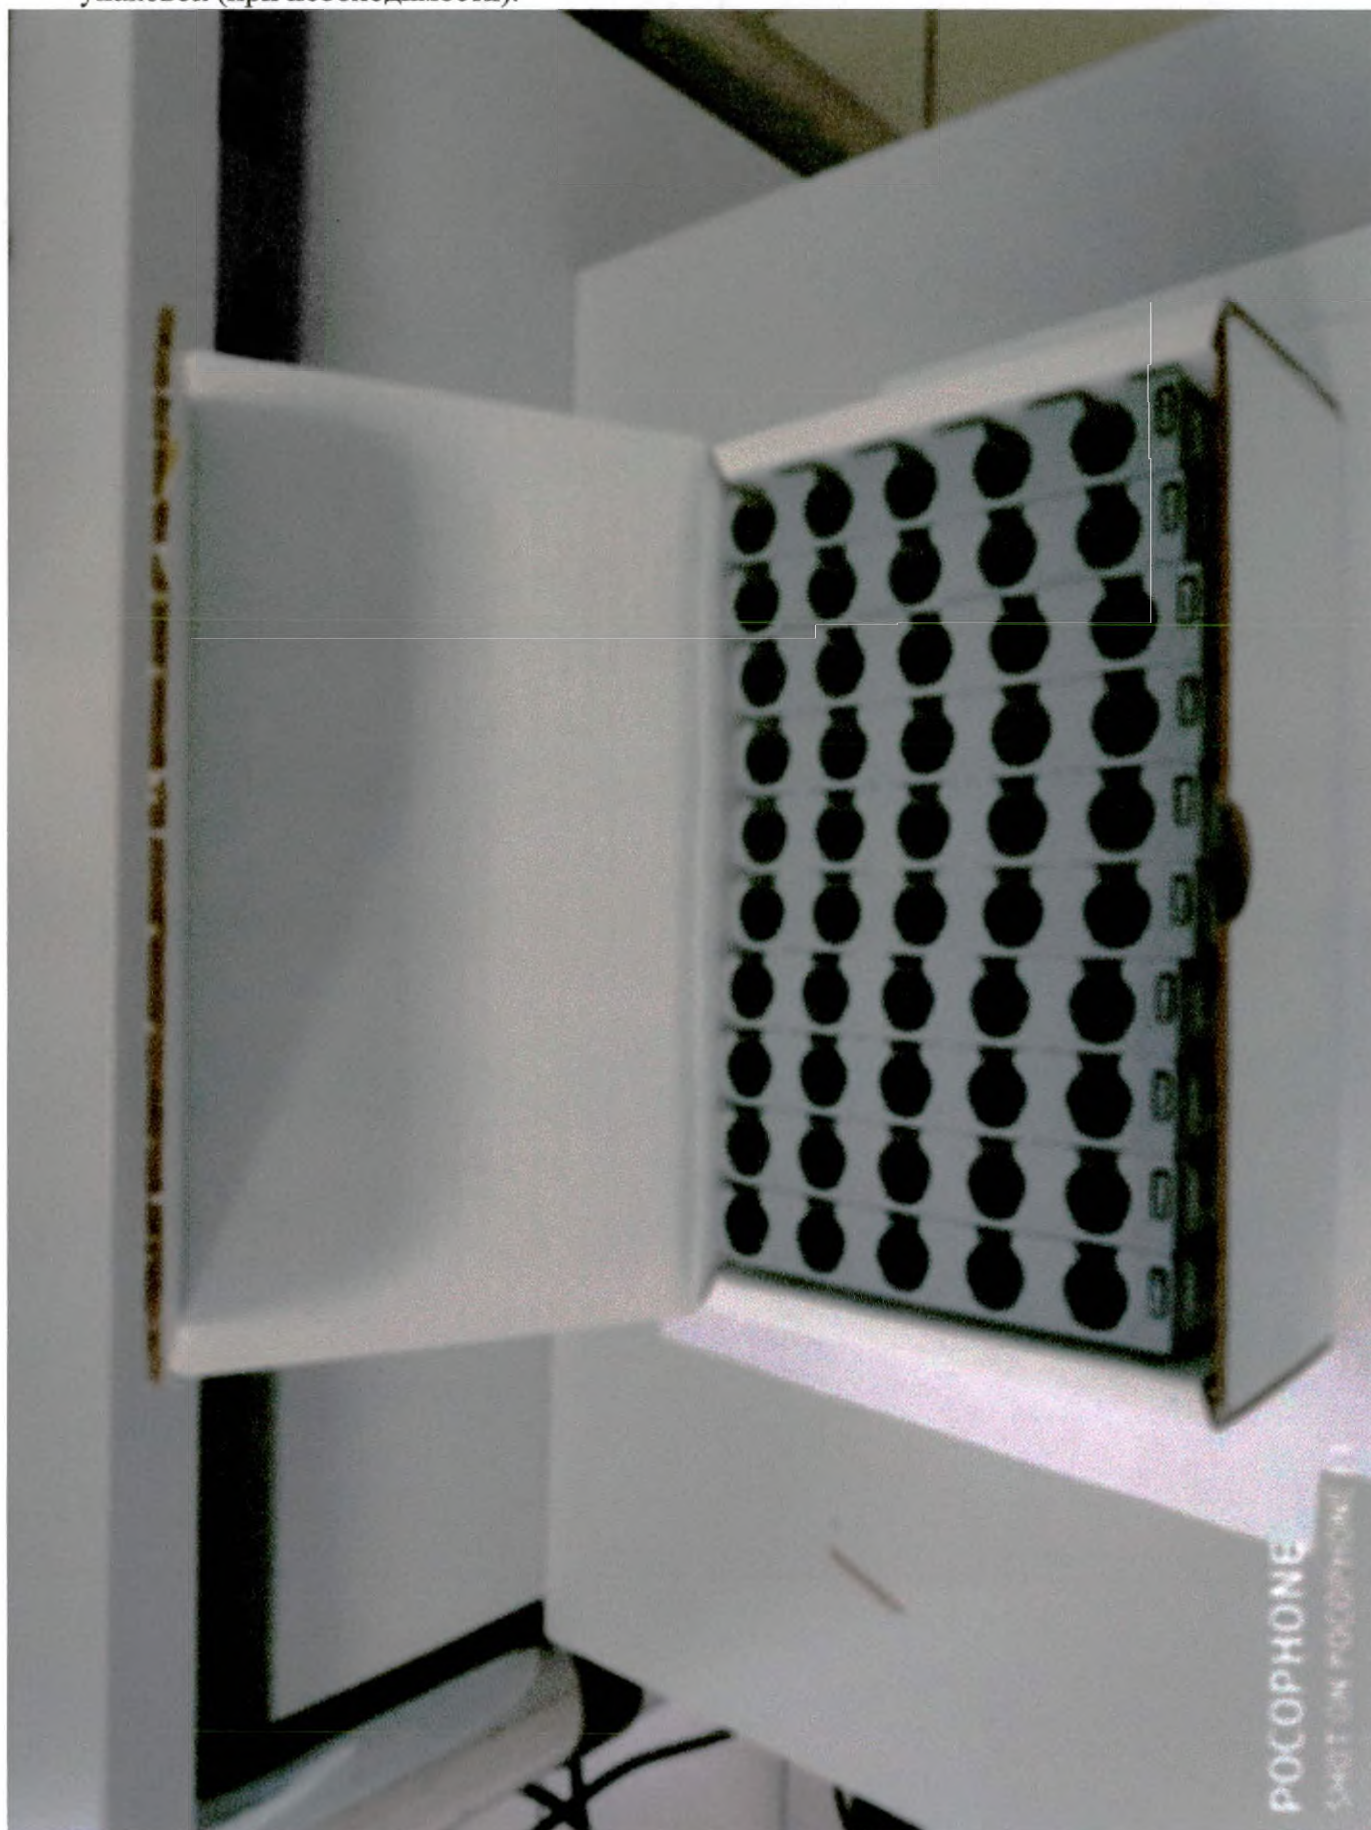

45. Набор штативов для калибратора для гемостаза №№C011-C020, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

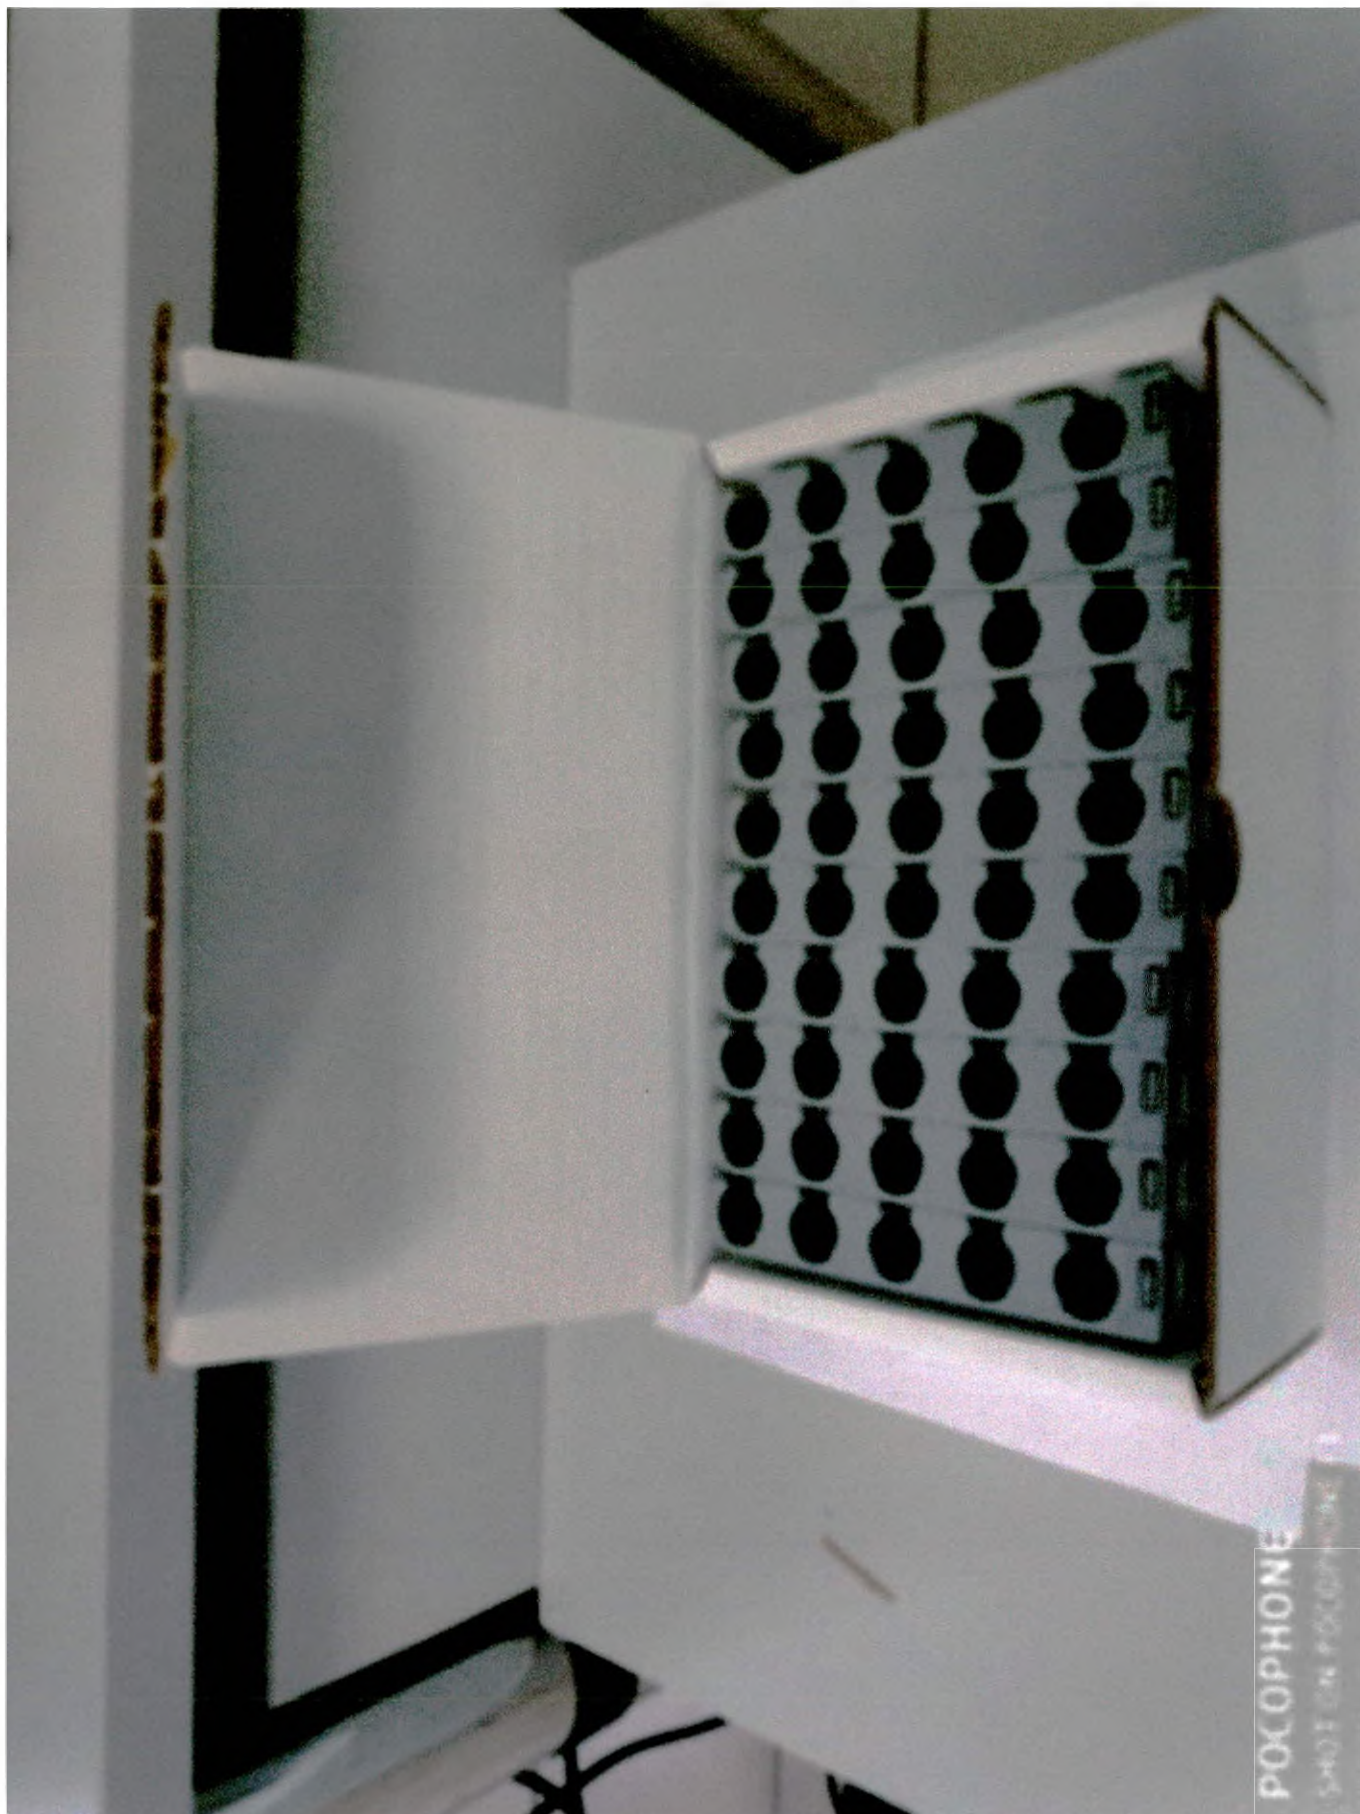

46. Набор штативов для калибратора для гемостаза №№C021-C030, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

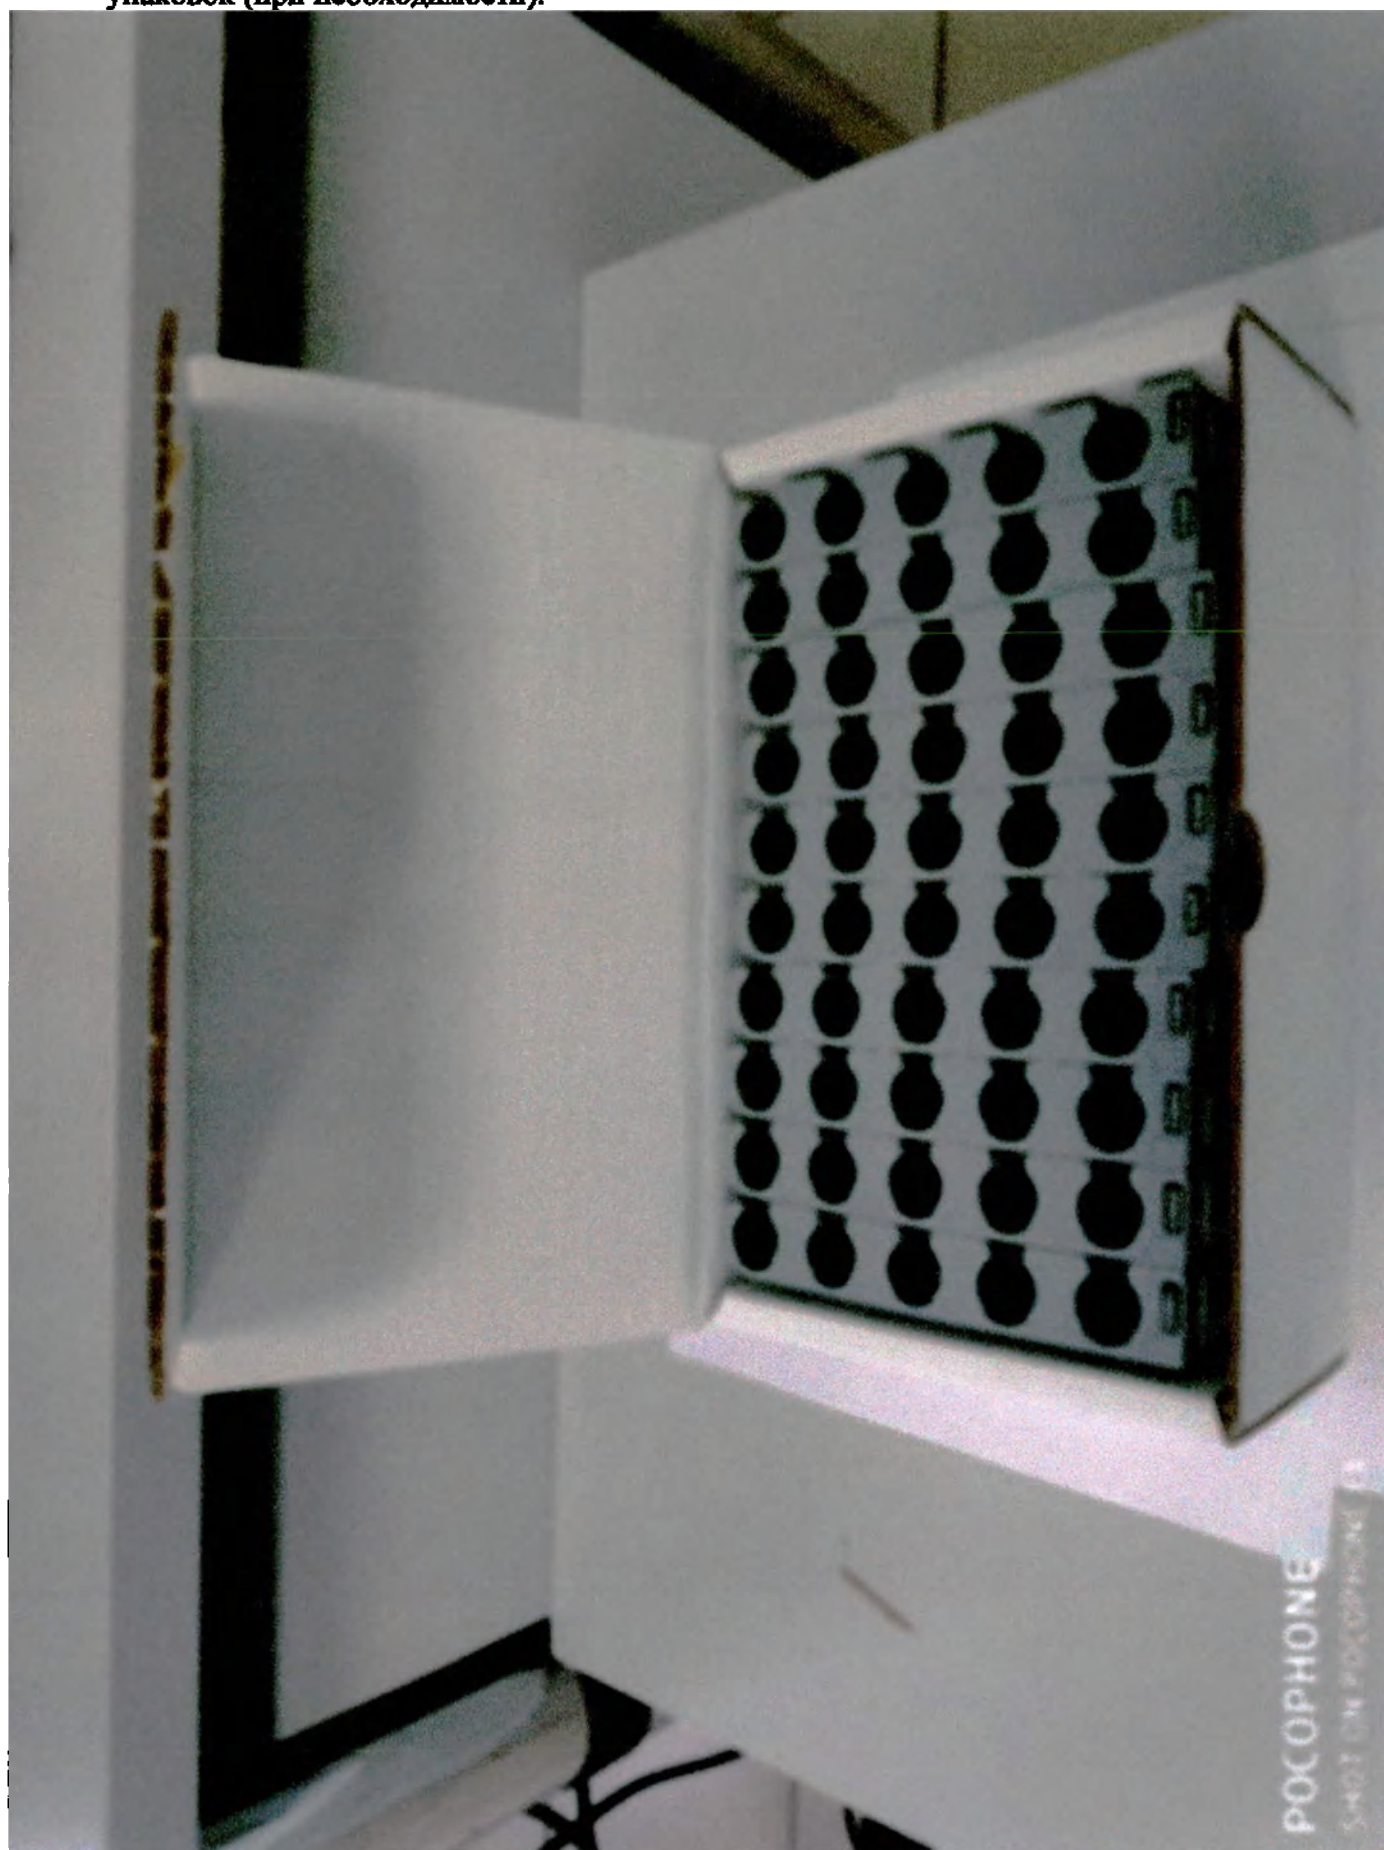

47. Кассета для открытого канала, 14 шт. в упаковке, не более 1 упаковки (при необходимости).



48. Набор флаконов sobas t для открытого канала, 50 шт. в упаковке, не более 1 упаковки (при необходимости).



Принадлежности:

1. Поддон для штативов на 75 позиций с ручкой, не более 2 шт.



OCOPHONE

2. Контейнер пластиковый для воды 5 л, белый, не более 1 шт.



3. Контейнер пластиковый для воды 5 л, желтый, не более 1 шт.




4. Переходник для микропробирок 8 мм, 45 шт. в упаковке, не более 1 упаковки.



5. Поршень шприца 100 мкл, не более 1 шт.



6. Поршень шприца 250 мкл, не более 1 шт.

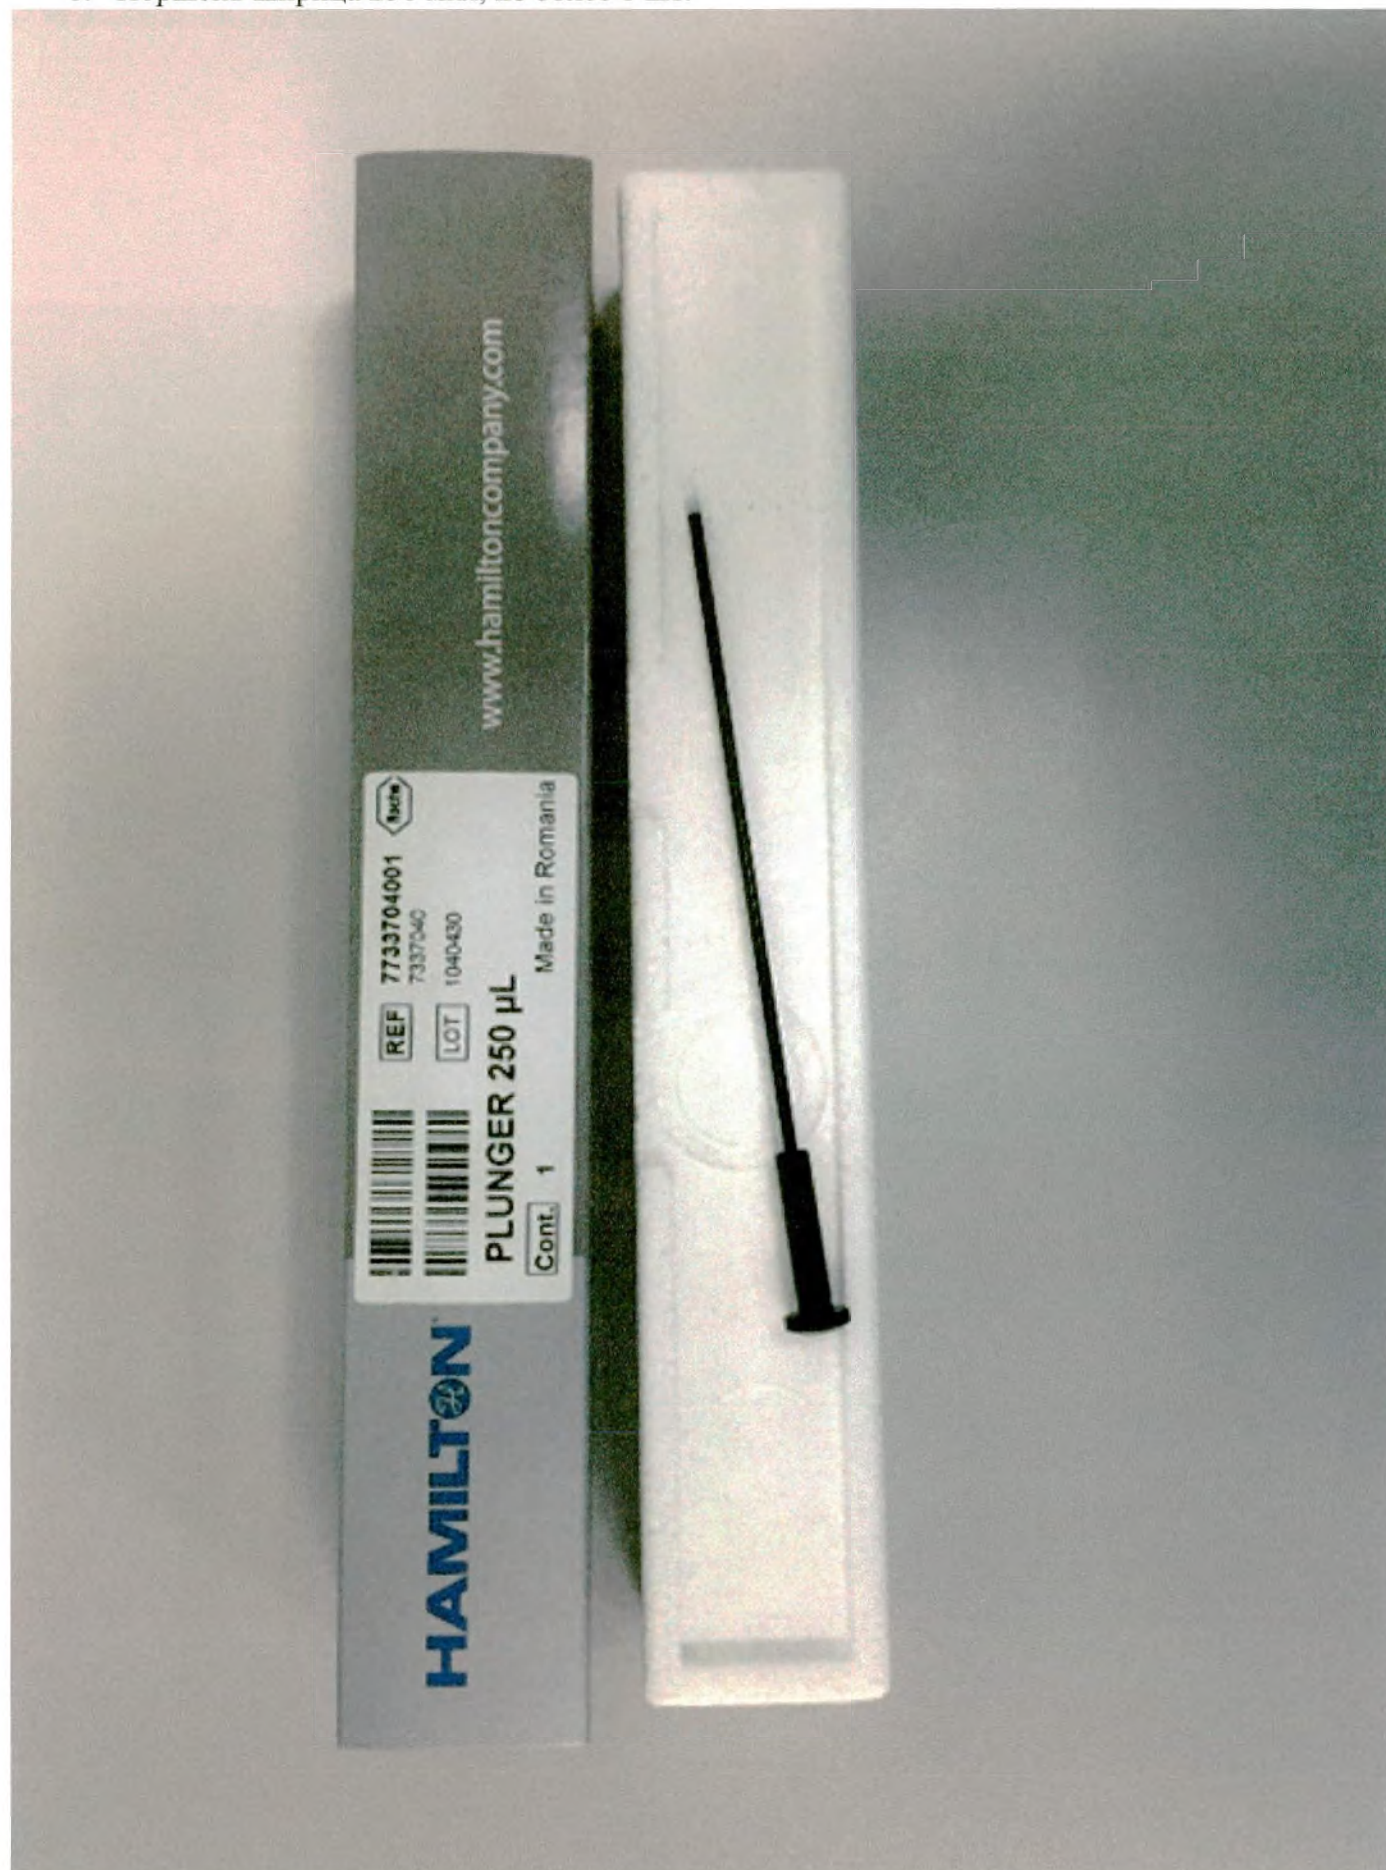

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
87 листа (ов)



Фотографические изображения МИ

«Анализатор гемостаза автоматический cobas t для диагностики in vitro с принадлежностями, варианты исполнения: cobas t 511 coagulation analyzer, cobas t 711 coagulation analyzer»

Анализатор гемостаза автоматический cobas t для диагностики in vitro с принадлежностями, вариант исполнения: cobas t 711 coagulation analyzer, общий вид



II. Анализатор гемостаза автоматический cobas t для диагностики in vitro с принадлежностями, вариант исполнения: cobas t 711 coagulation analyzer


1. Блок основной (cobas t 711 coagulation analyzer), не более 1 шт.




2. Автозагрузчик (cobas t 711 Sampling Unit), не более 1 шт.




3. Набор для запуска sobas t 711, в составе:
3.1 Предохранитель 6.3x32 32A 150B, 10 шт.

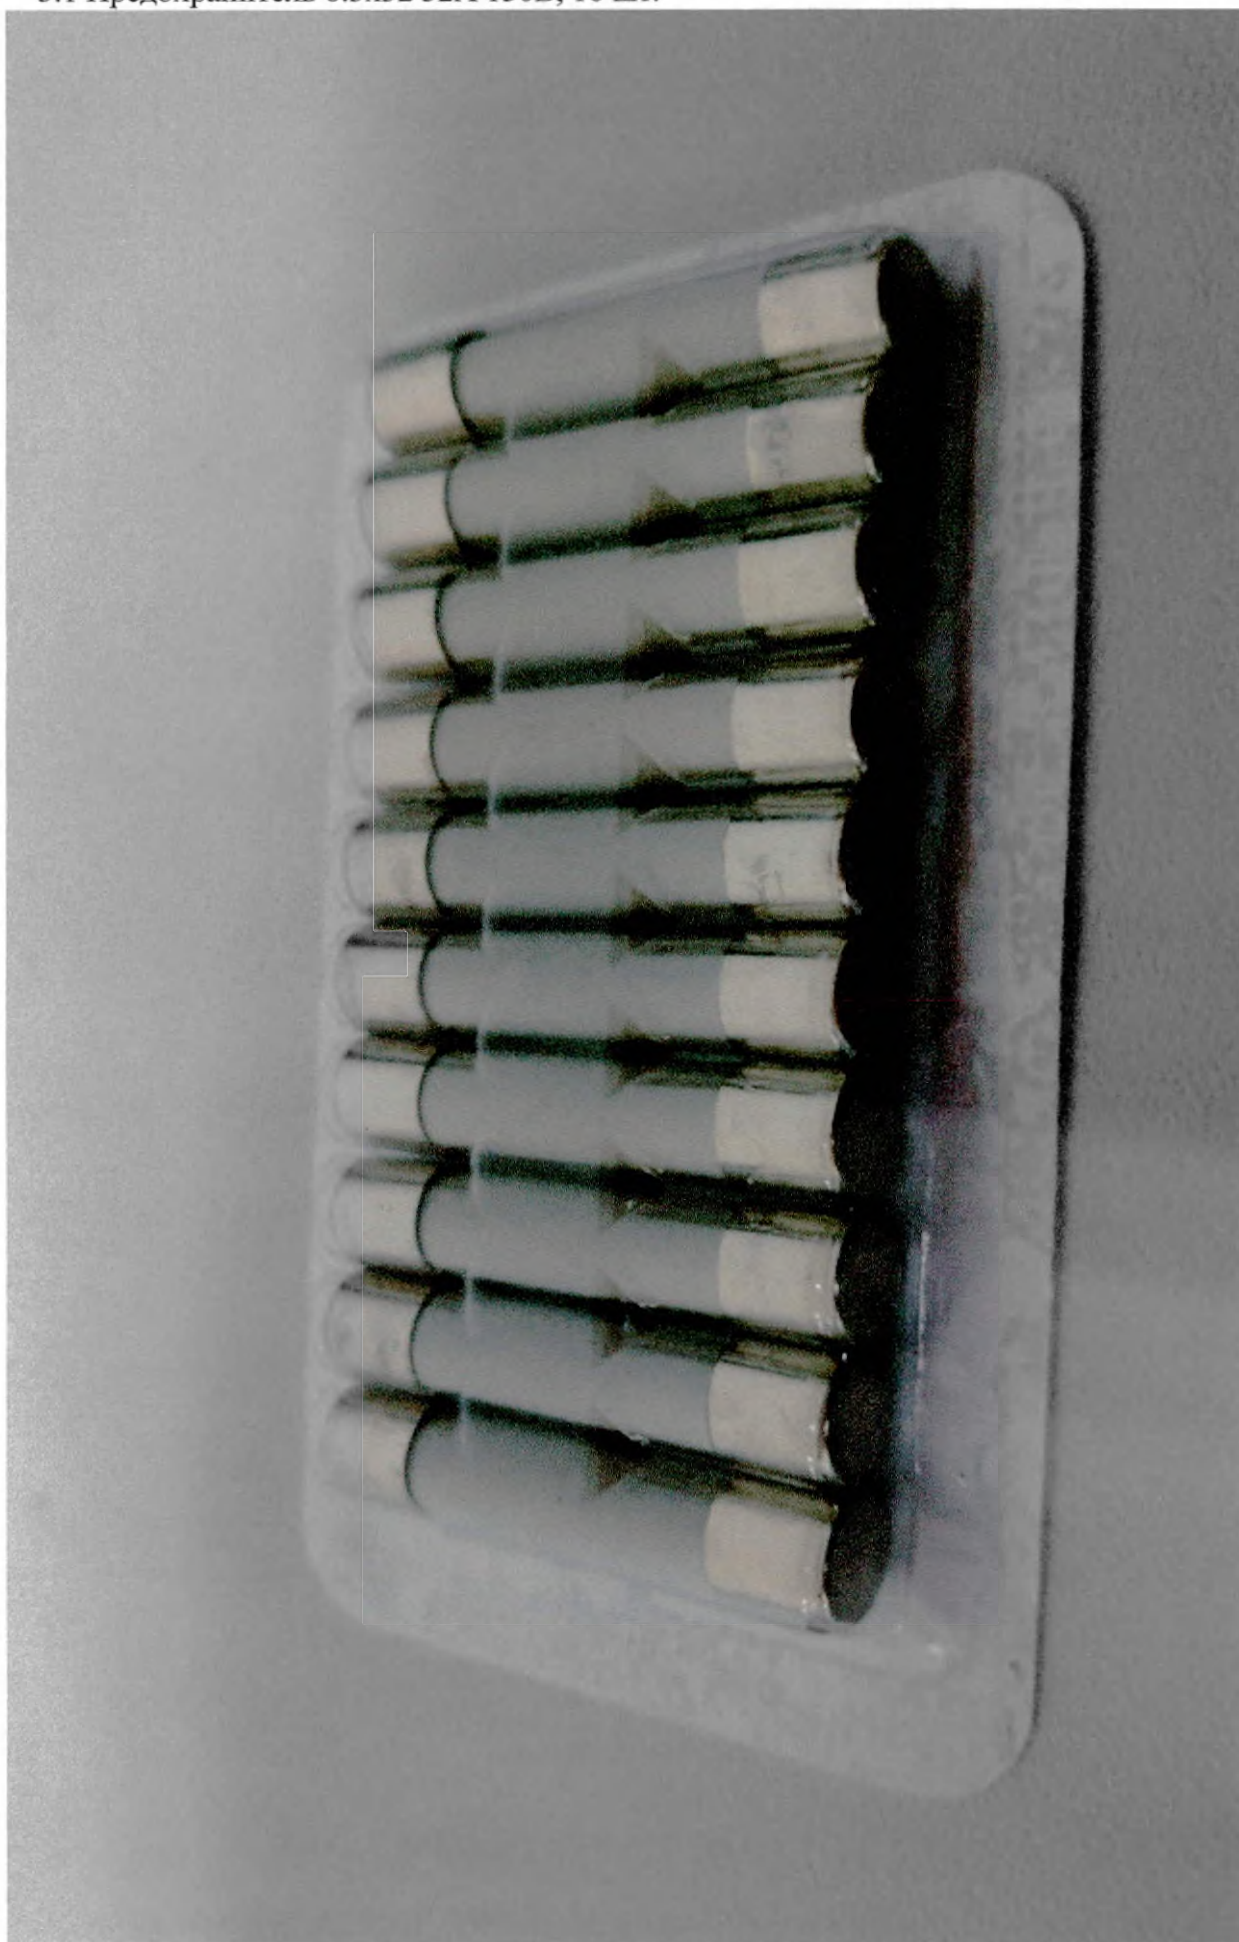

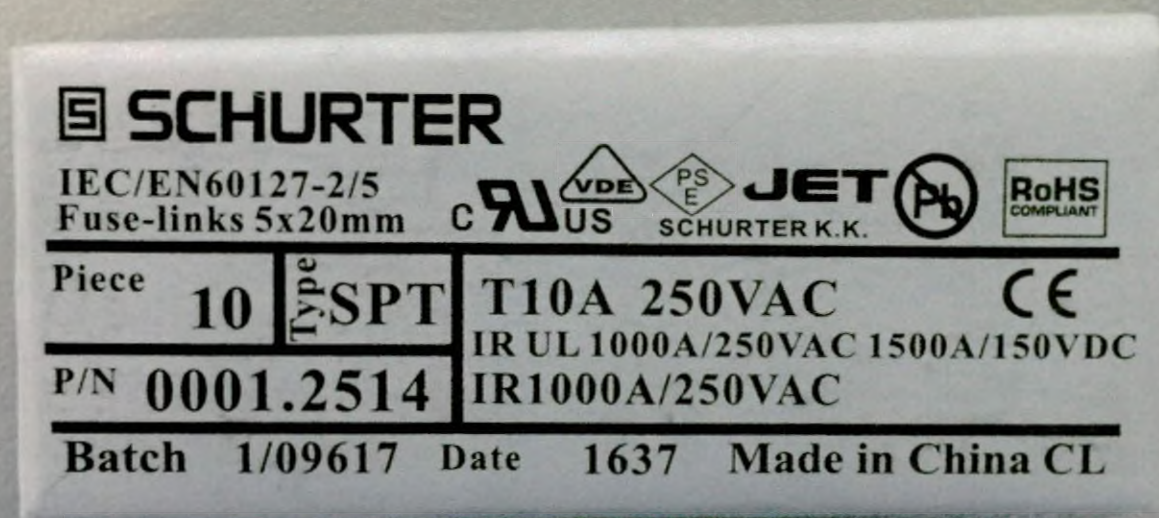

SCHURTER


IEC/EN60127-2/5
Fuse-links 5x20mm



RoHS
COMPLIANT



JET



SU05016-5002
+82220436909
SCHURTER K.K. 소형퓨즈 5x20mm

Piece

10

Type

SPT

T3.15A H 250VAC



IR UL 10000A/125VAC 1500A/300VDC

P/N 0001.2509

IR1500A/250VAC

Batch 1/10274 Date 1730 Made in China CL






3.5 Кабель питания, 1 шт.



3.6 Пакет для твердых отходов, 80 шт. в упаковке, 1 упаковка.



3.7 Кюветы, 1000 шт. в упаковке, 1 упаковка.

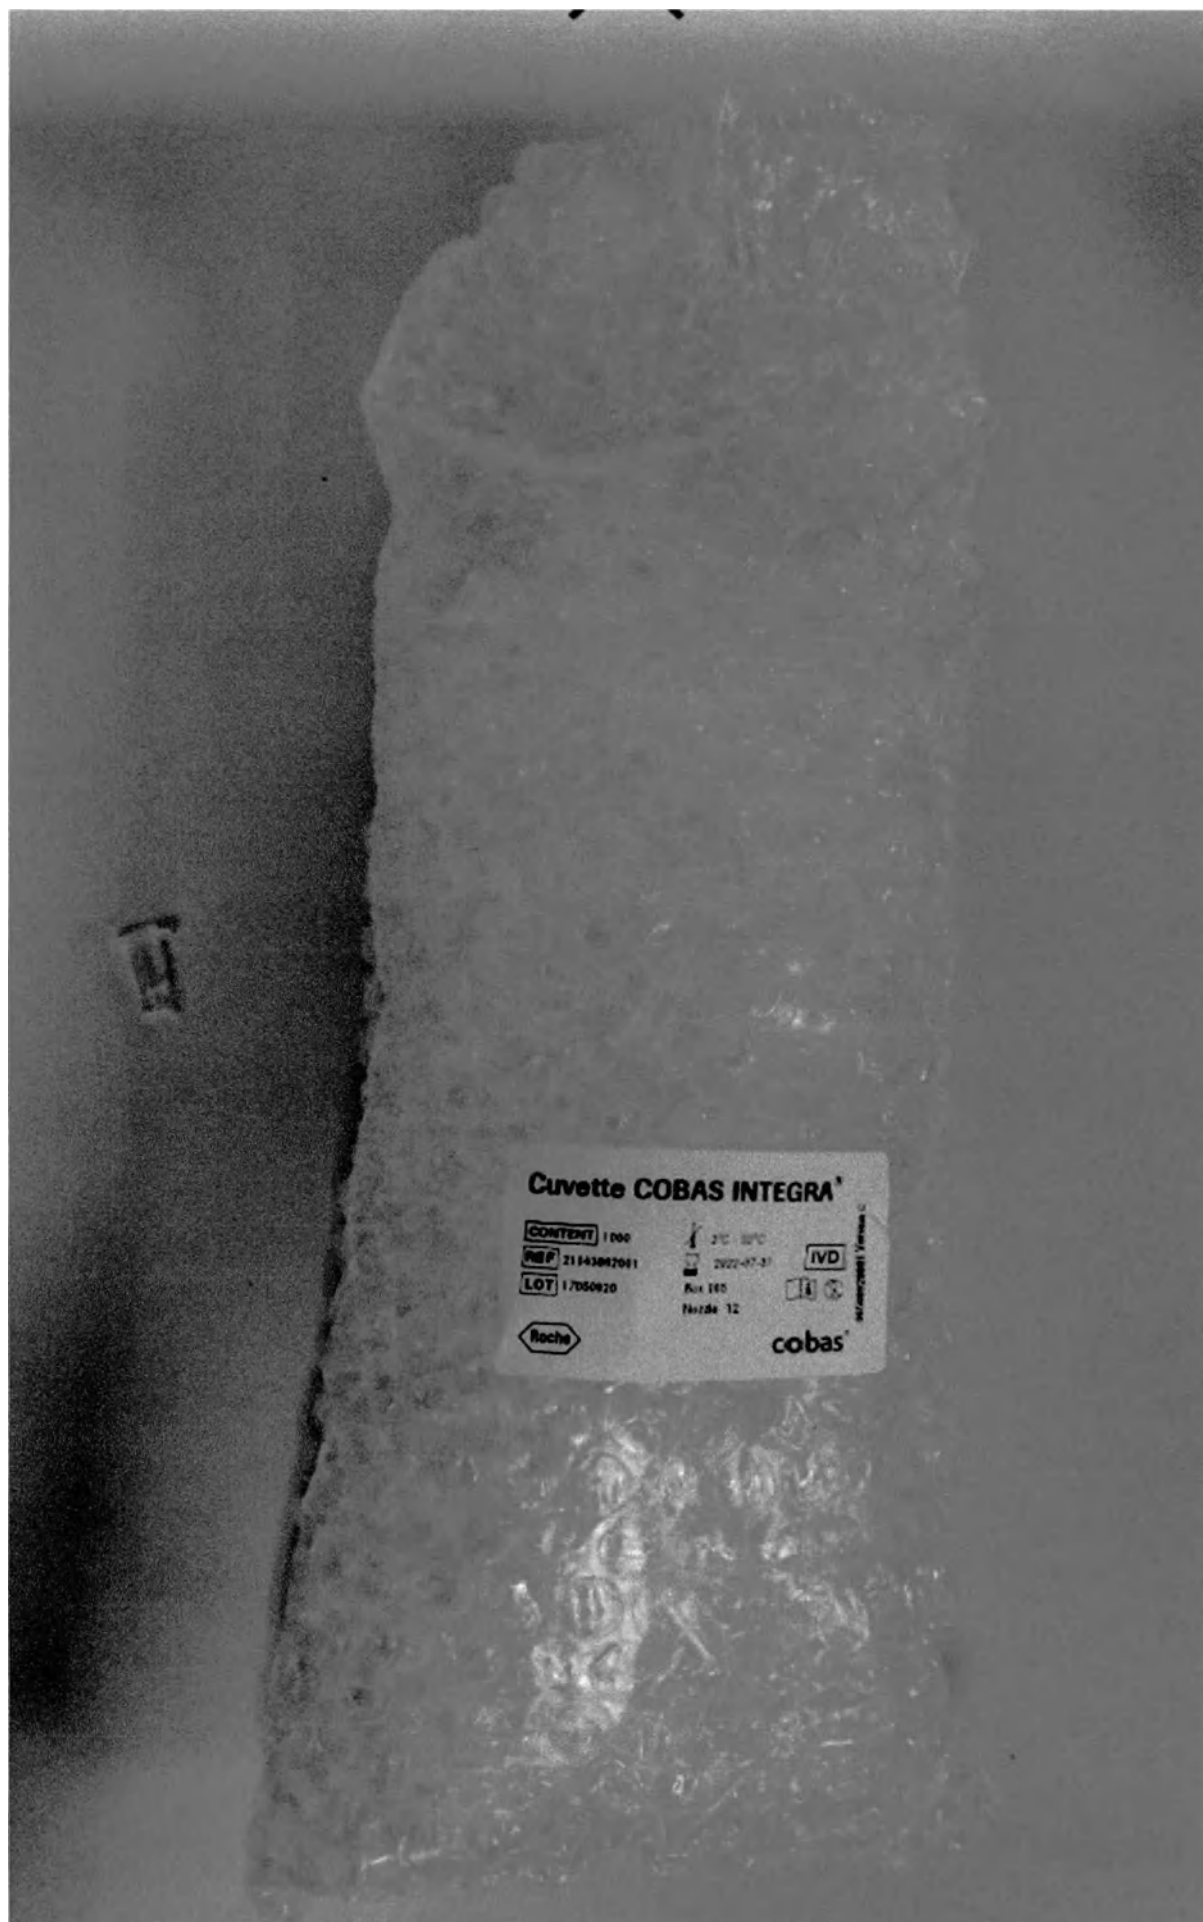


3.8 Наклейка – предупреждение, 1 шт.



OPHONE

3.9 Кабель сетевой, серый, 1 шт.

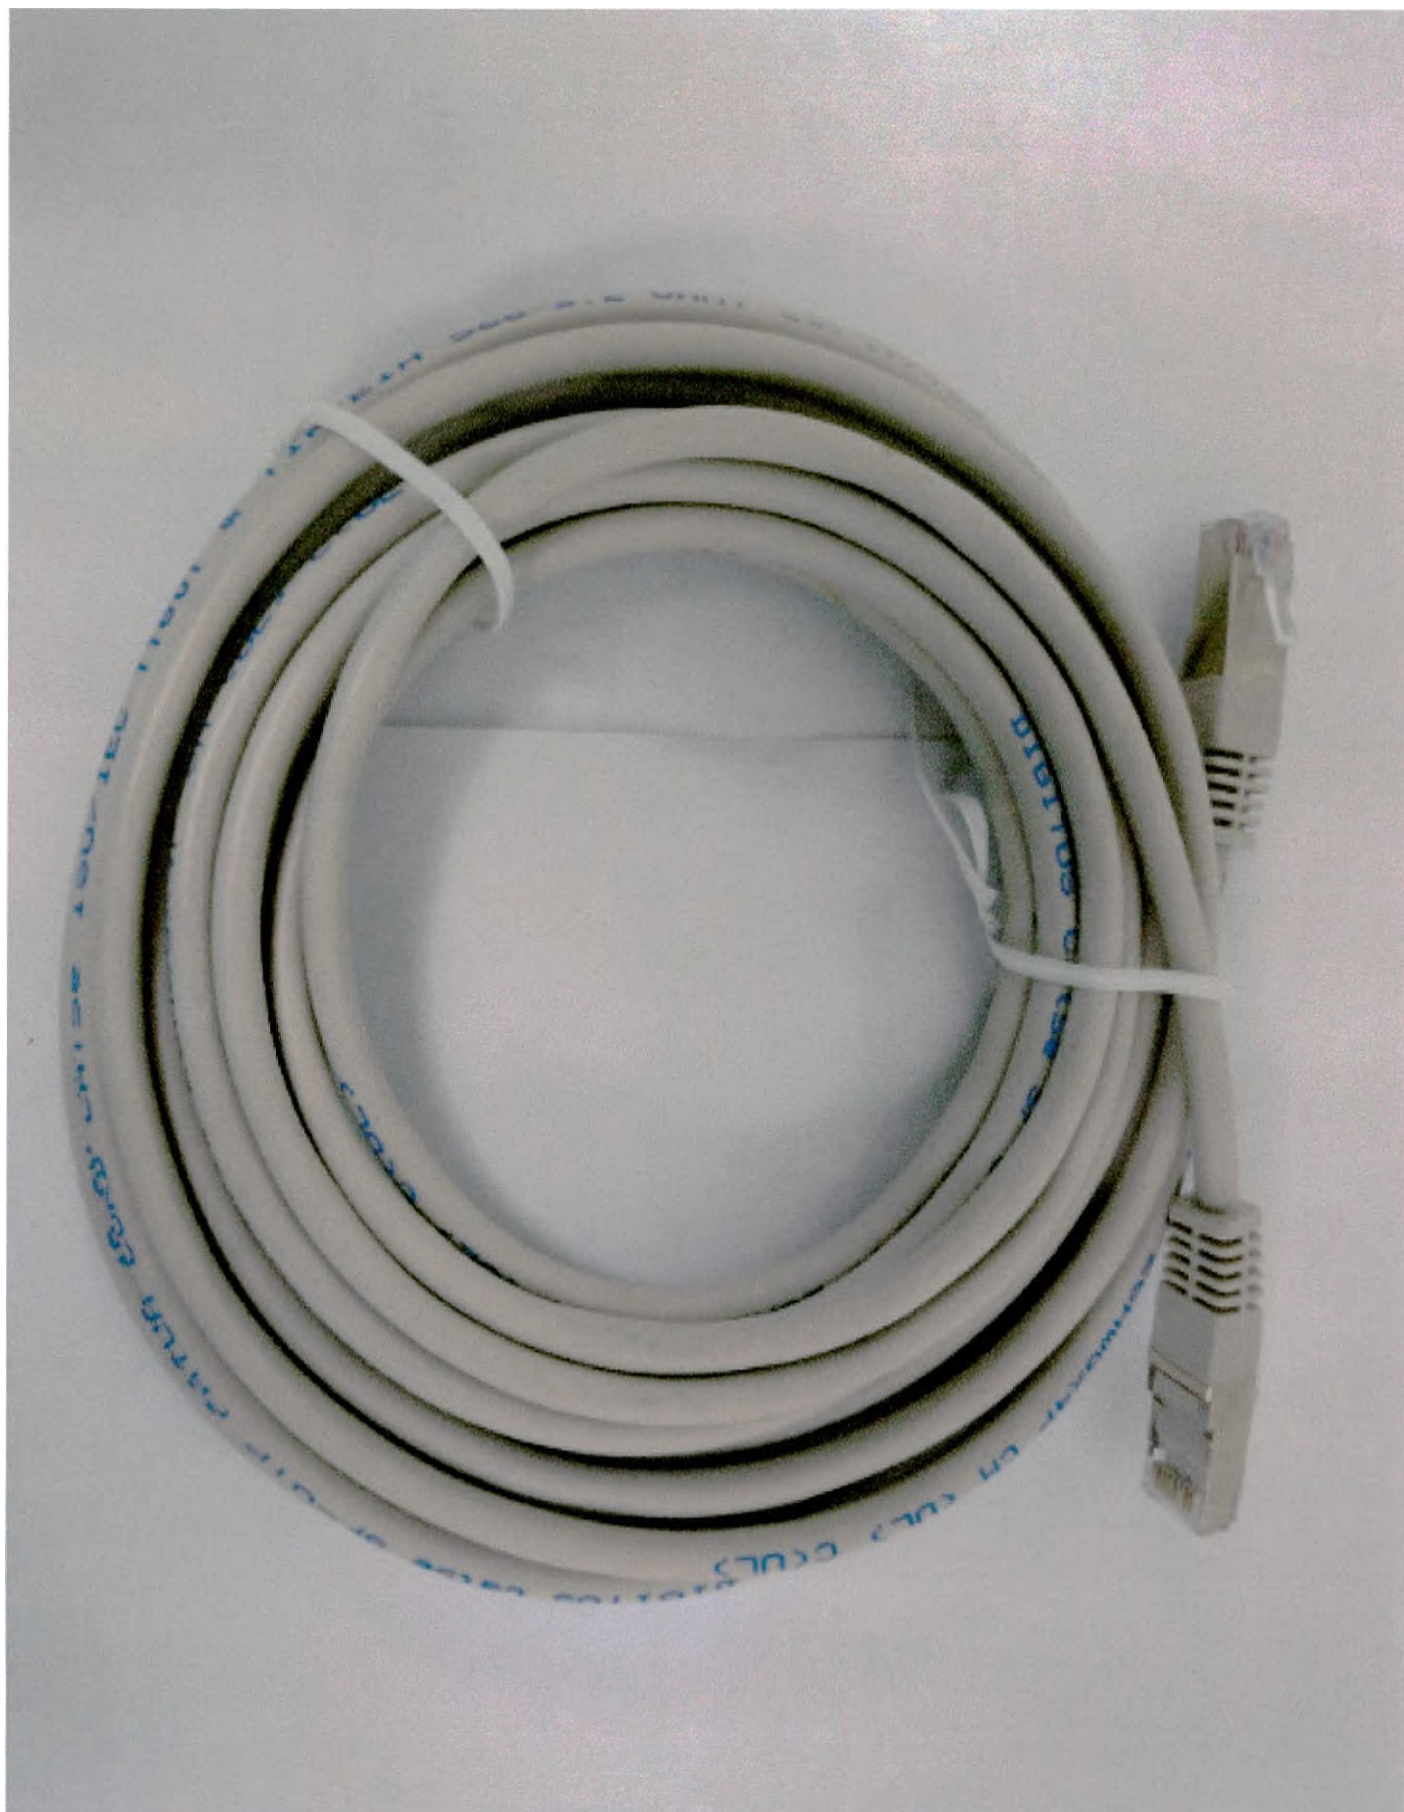


3.10 Набор штативов стартовый, в составе:

3.10.1 Штатив для пробирок с переходниками для гемостаза Мxxx, где xxx номер из диапазона 001-200, 1 шт.




3.10.2 Штатив для пробирок для гемостаза, 0xxx, где xxx номер из диапазона 001-250, 1 шт.

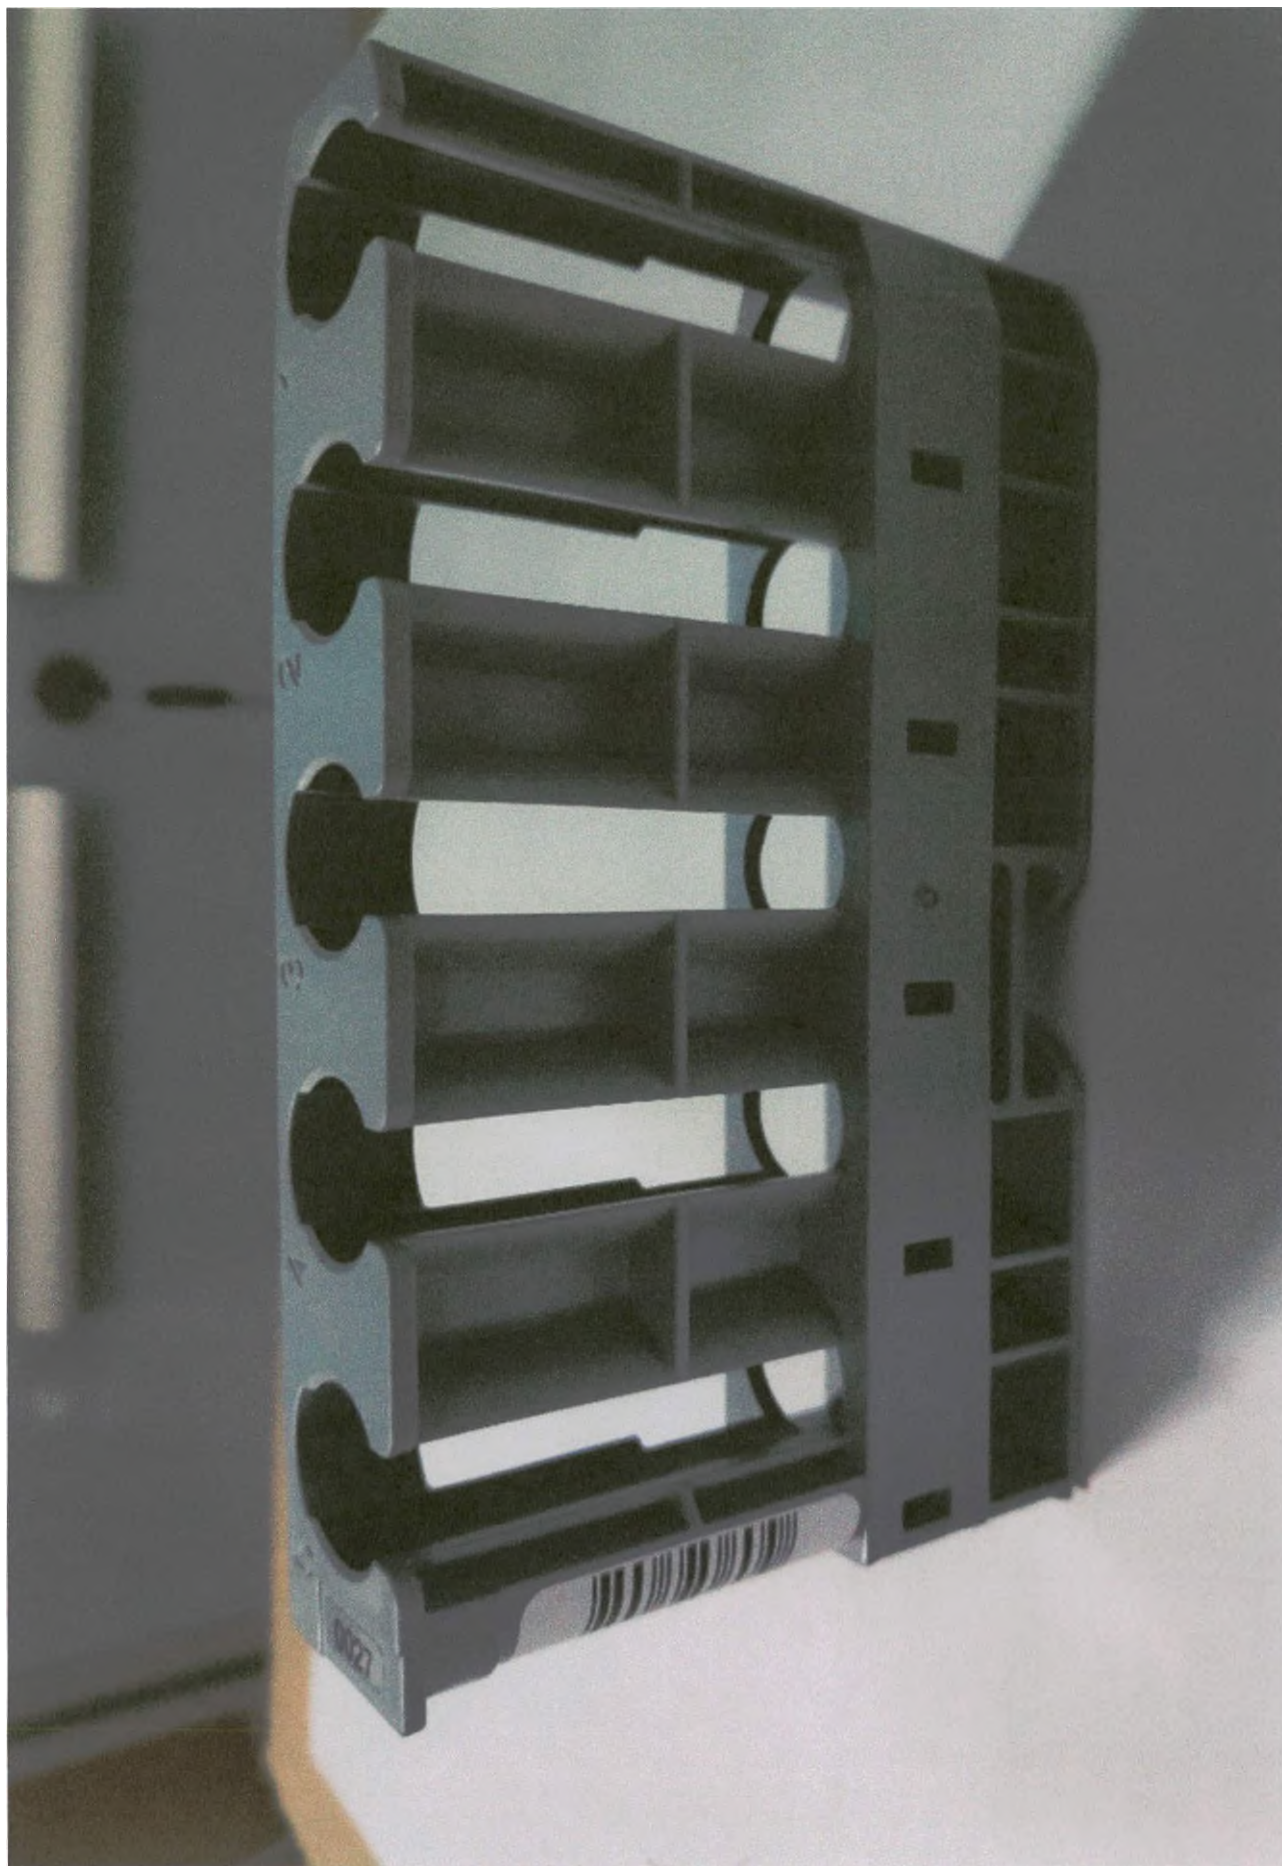

3.10.3 Штатив для контролей гемостаза Qxxx, где xxx номер из диапазона 001-030, 1 шт.




3.10.4 Штатив для калибратора для гемостаза, Сxxx, где xxx номер из диапазона 001-030, 2 шт.

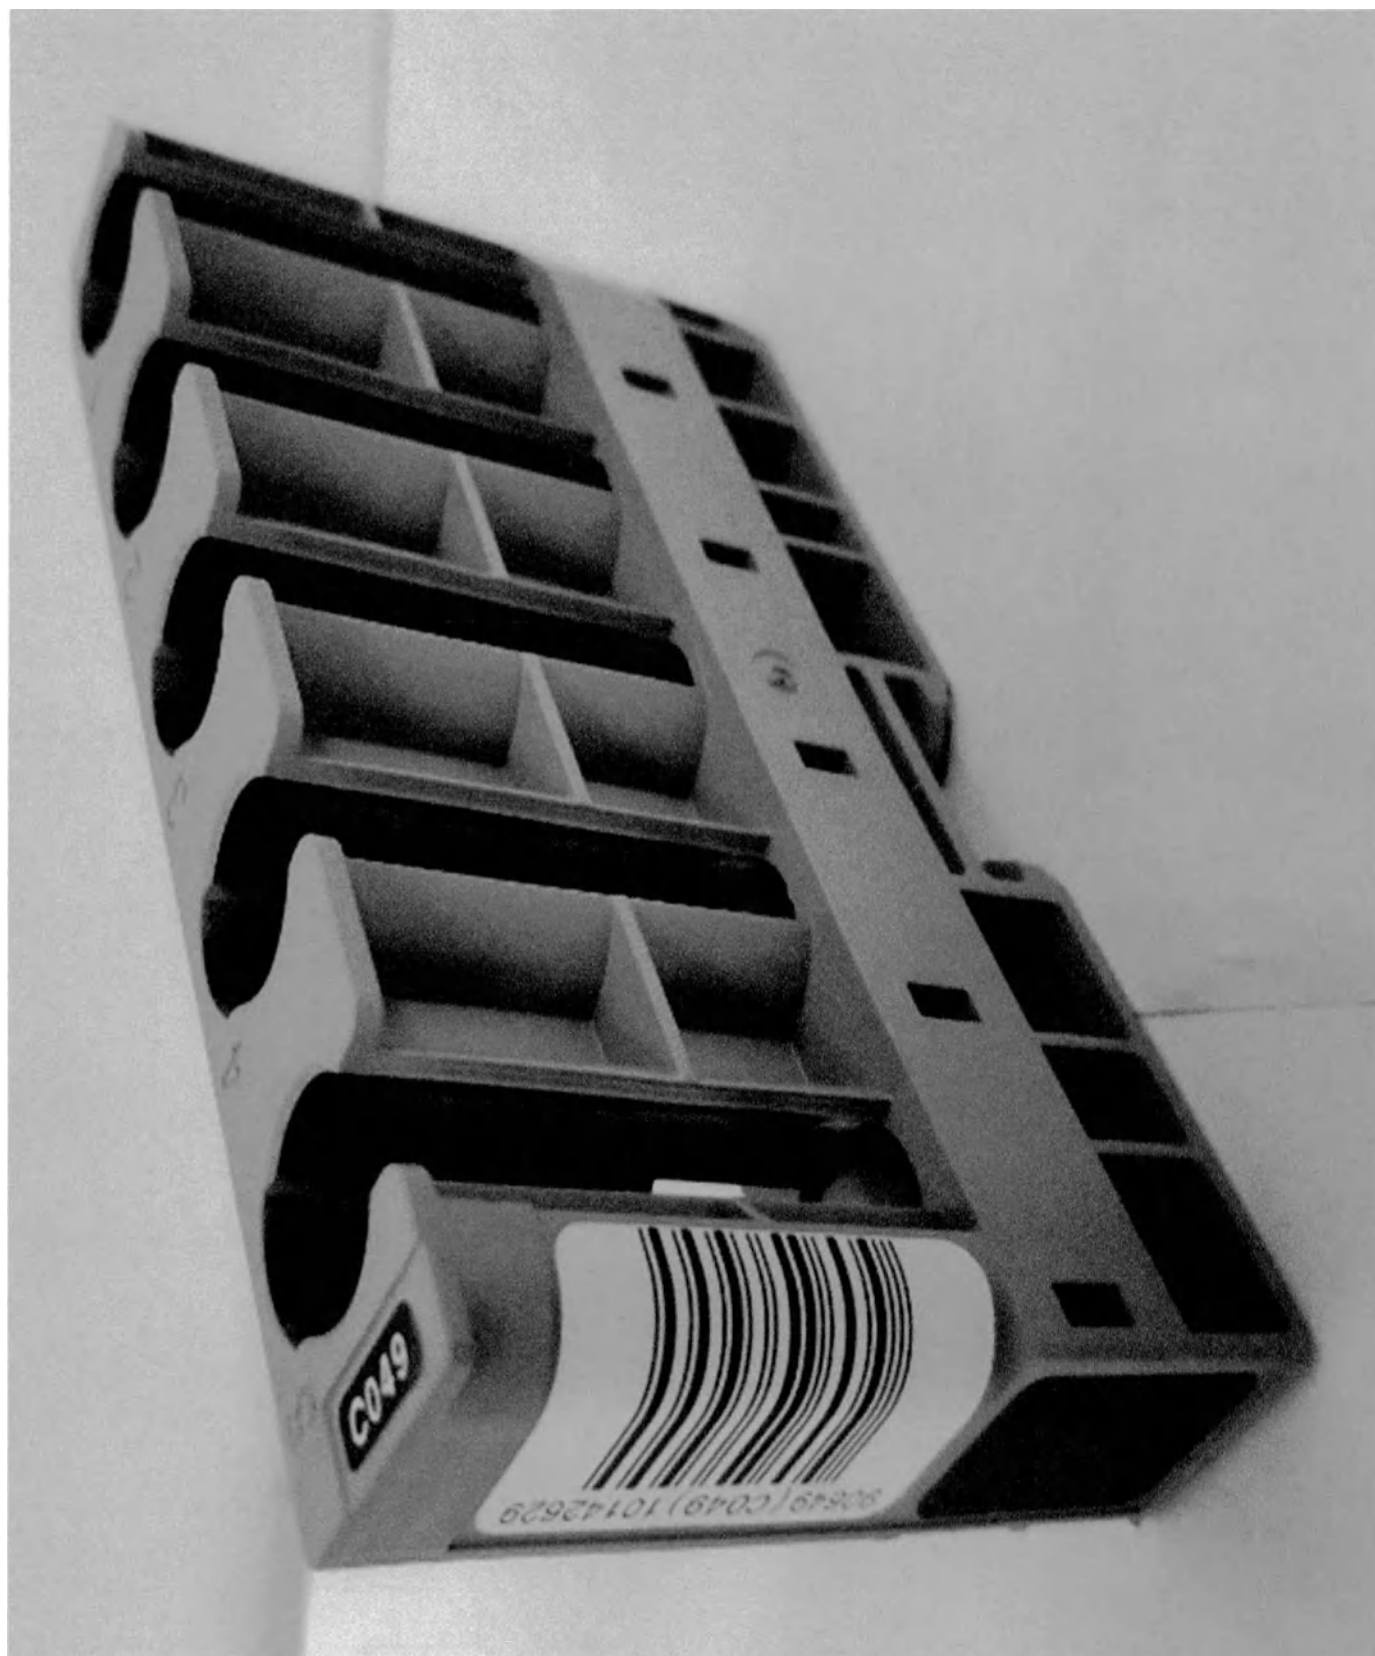


3.11 Набор пробирок для активатора, 6 шт. в упаковке, 1 упаковка.



3.12 Фильтр, 10 шт. в упаковке, 3 уп.

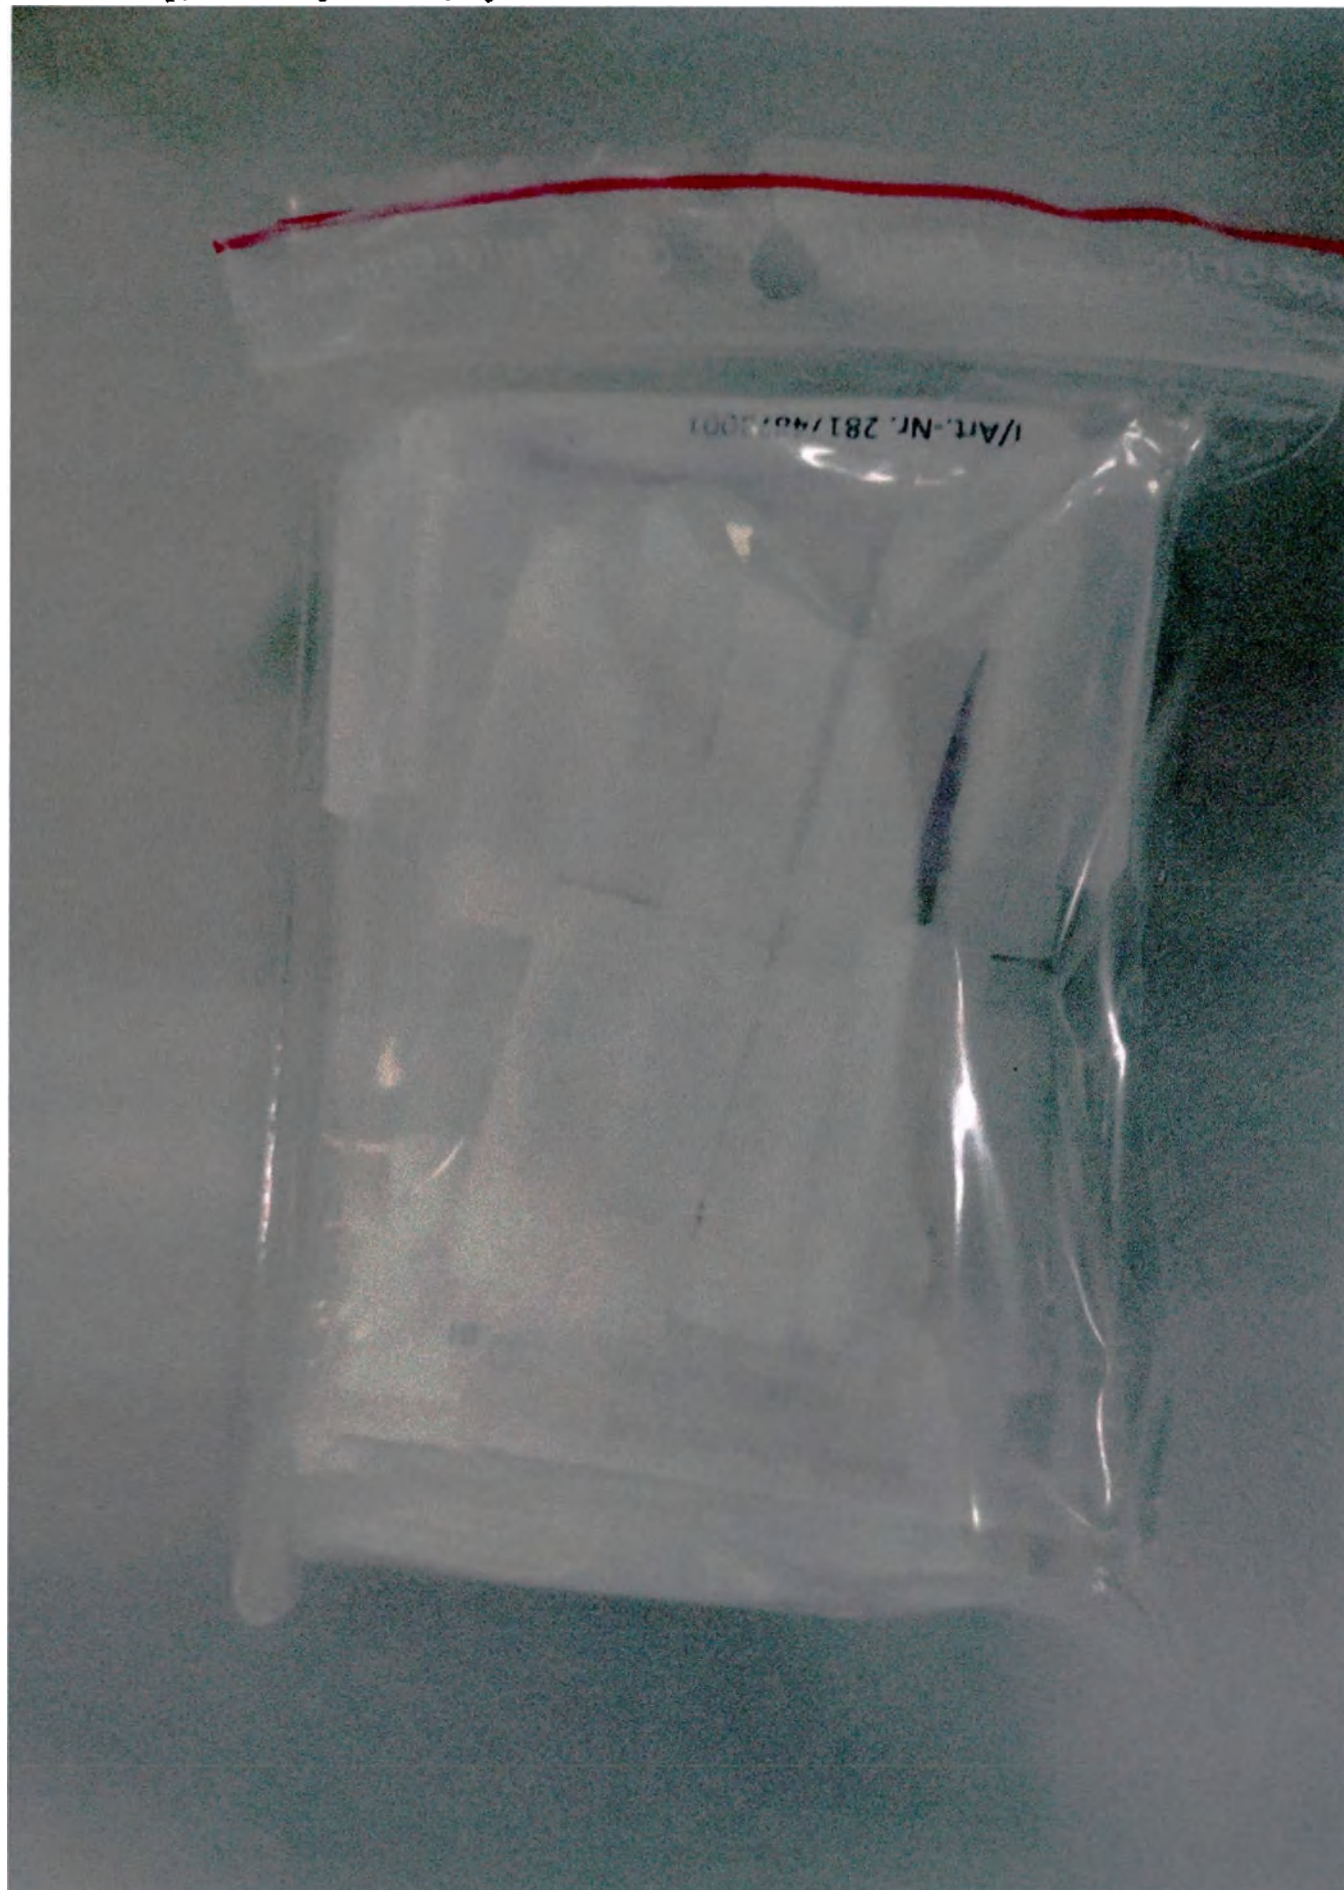

3.13 Кассета коагуляционная черная, 1 шт.

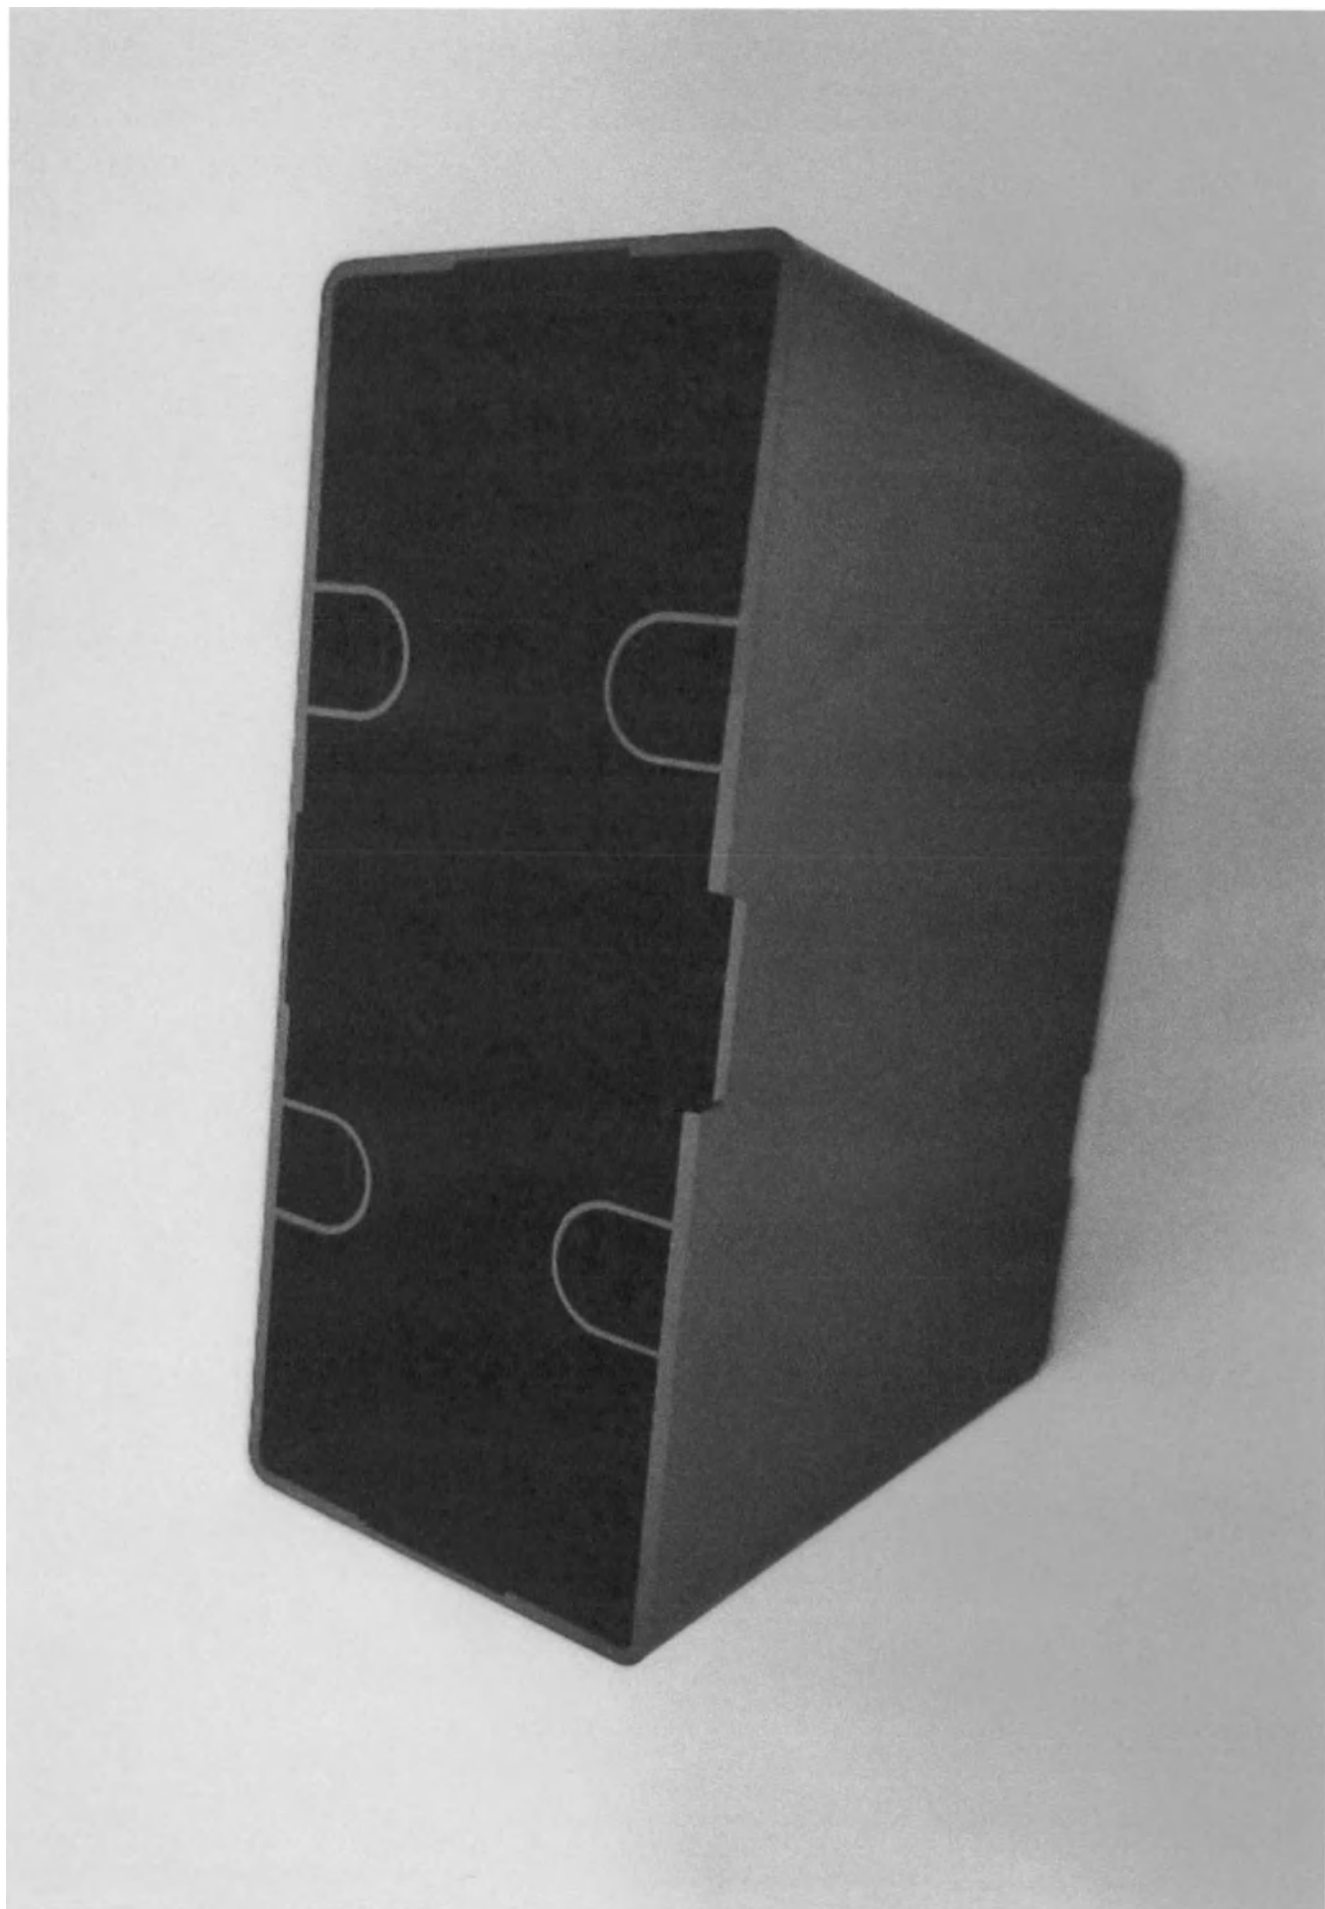

3.14 Ограничитель серый, 6 шт.




3.15 Крышка винтовая, белая GL 18, 6 шт.



3.16 Емкость стеклянная, 3 шт.




3.17 Кассета системная, 2 шт.

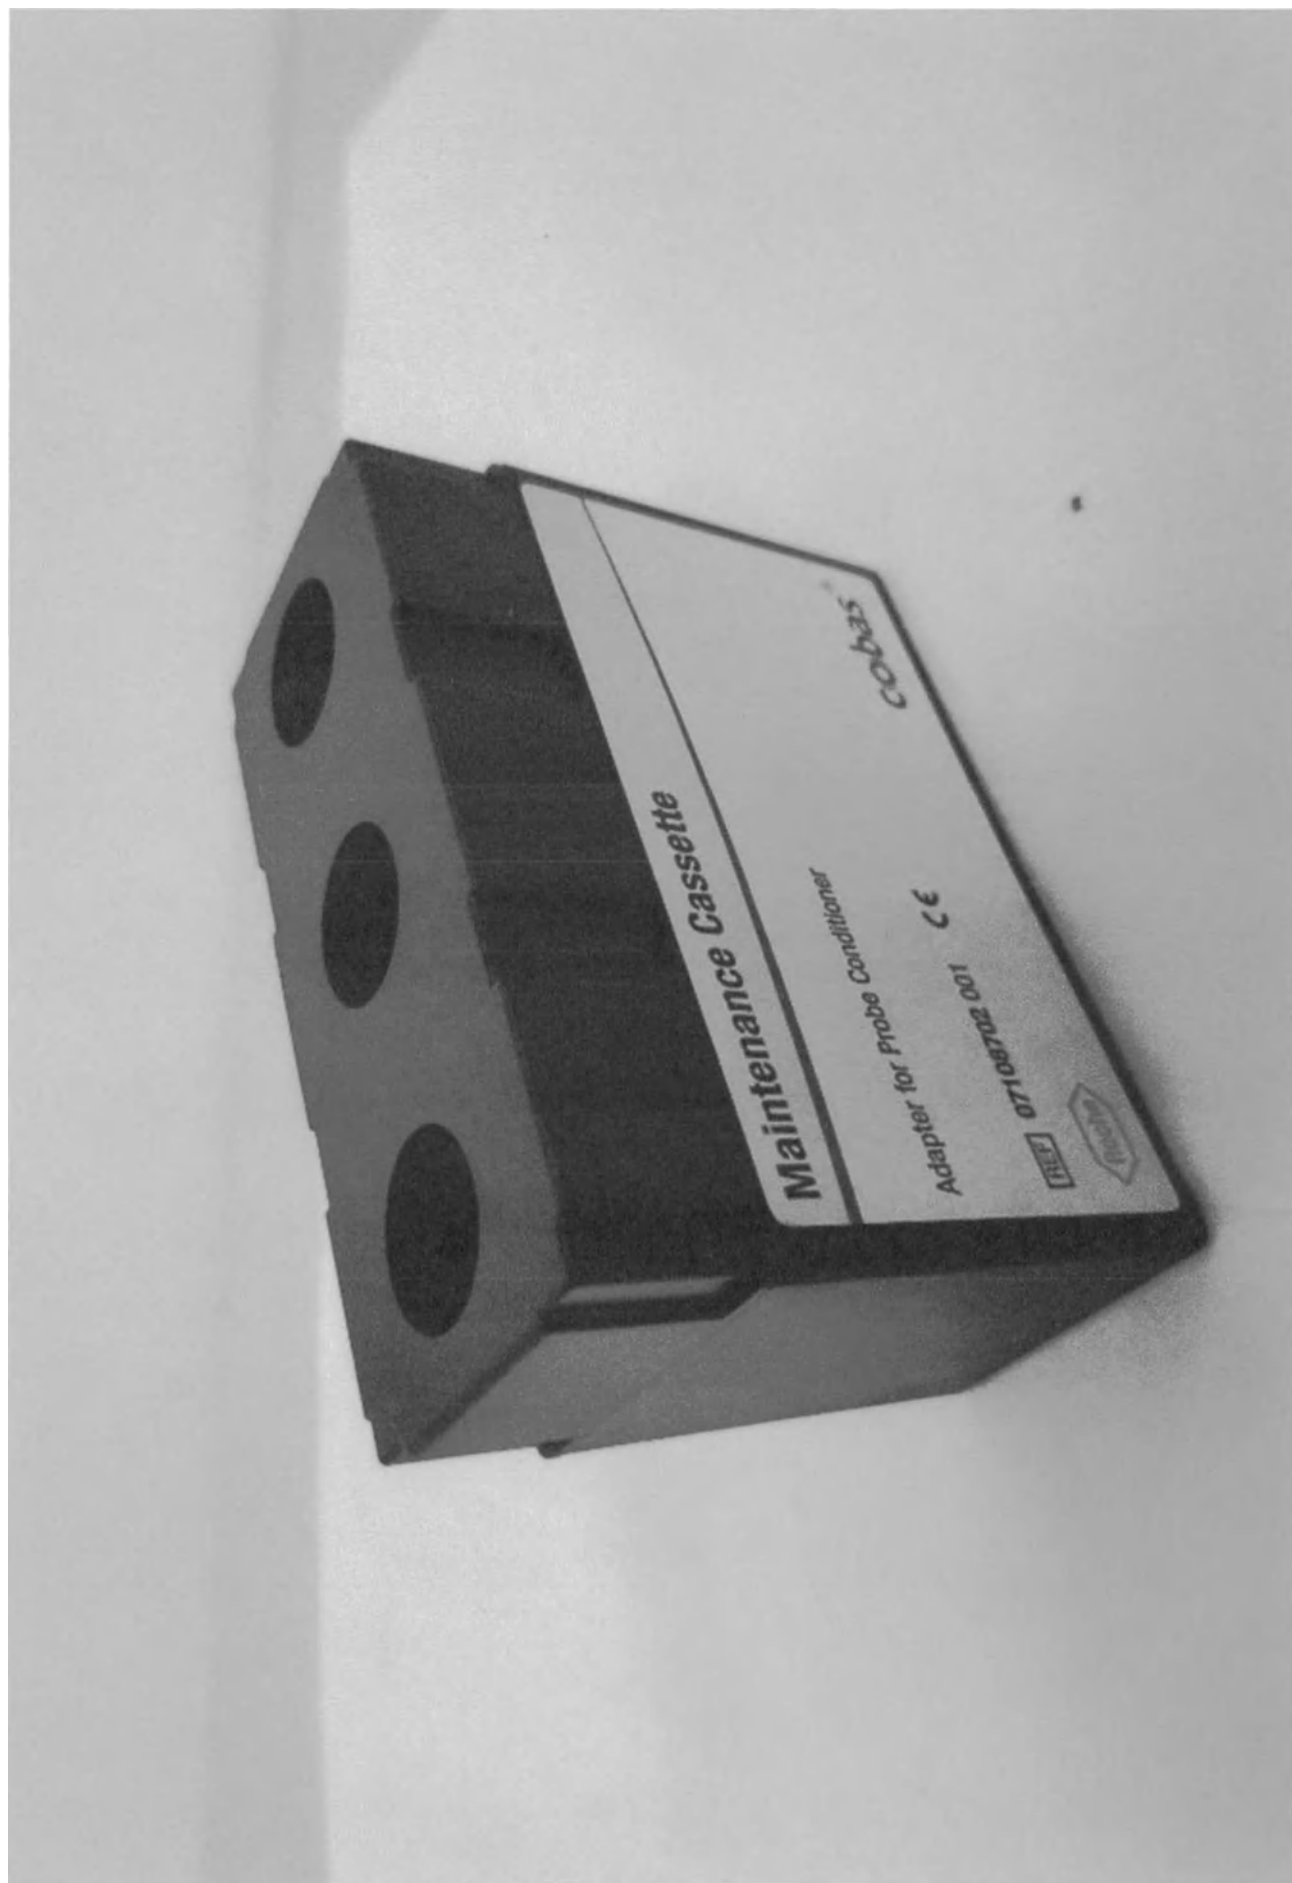

3.18 Набор штрих-кодов к системной кассете, 6 шт. в упаковке, 1 упаковка.




3.19 Пинцет, 1 шт.

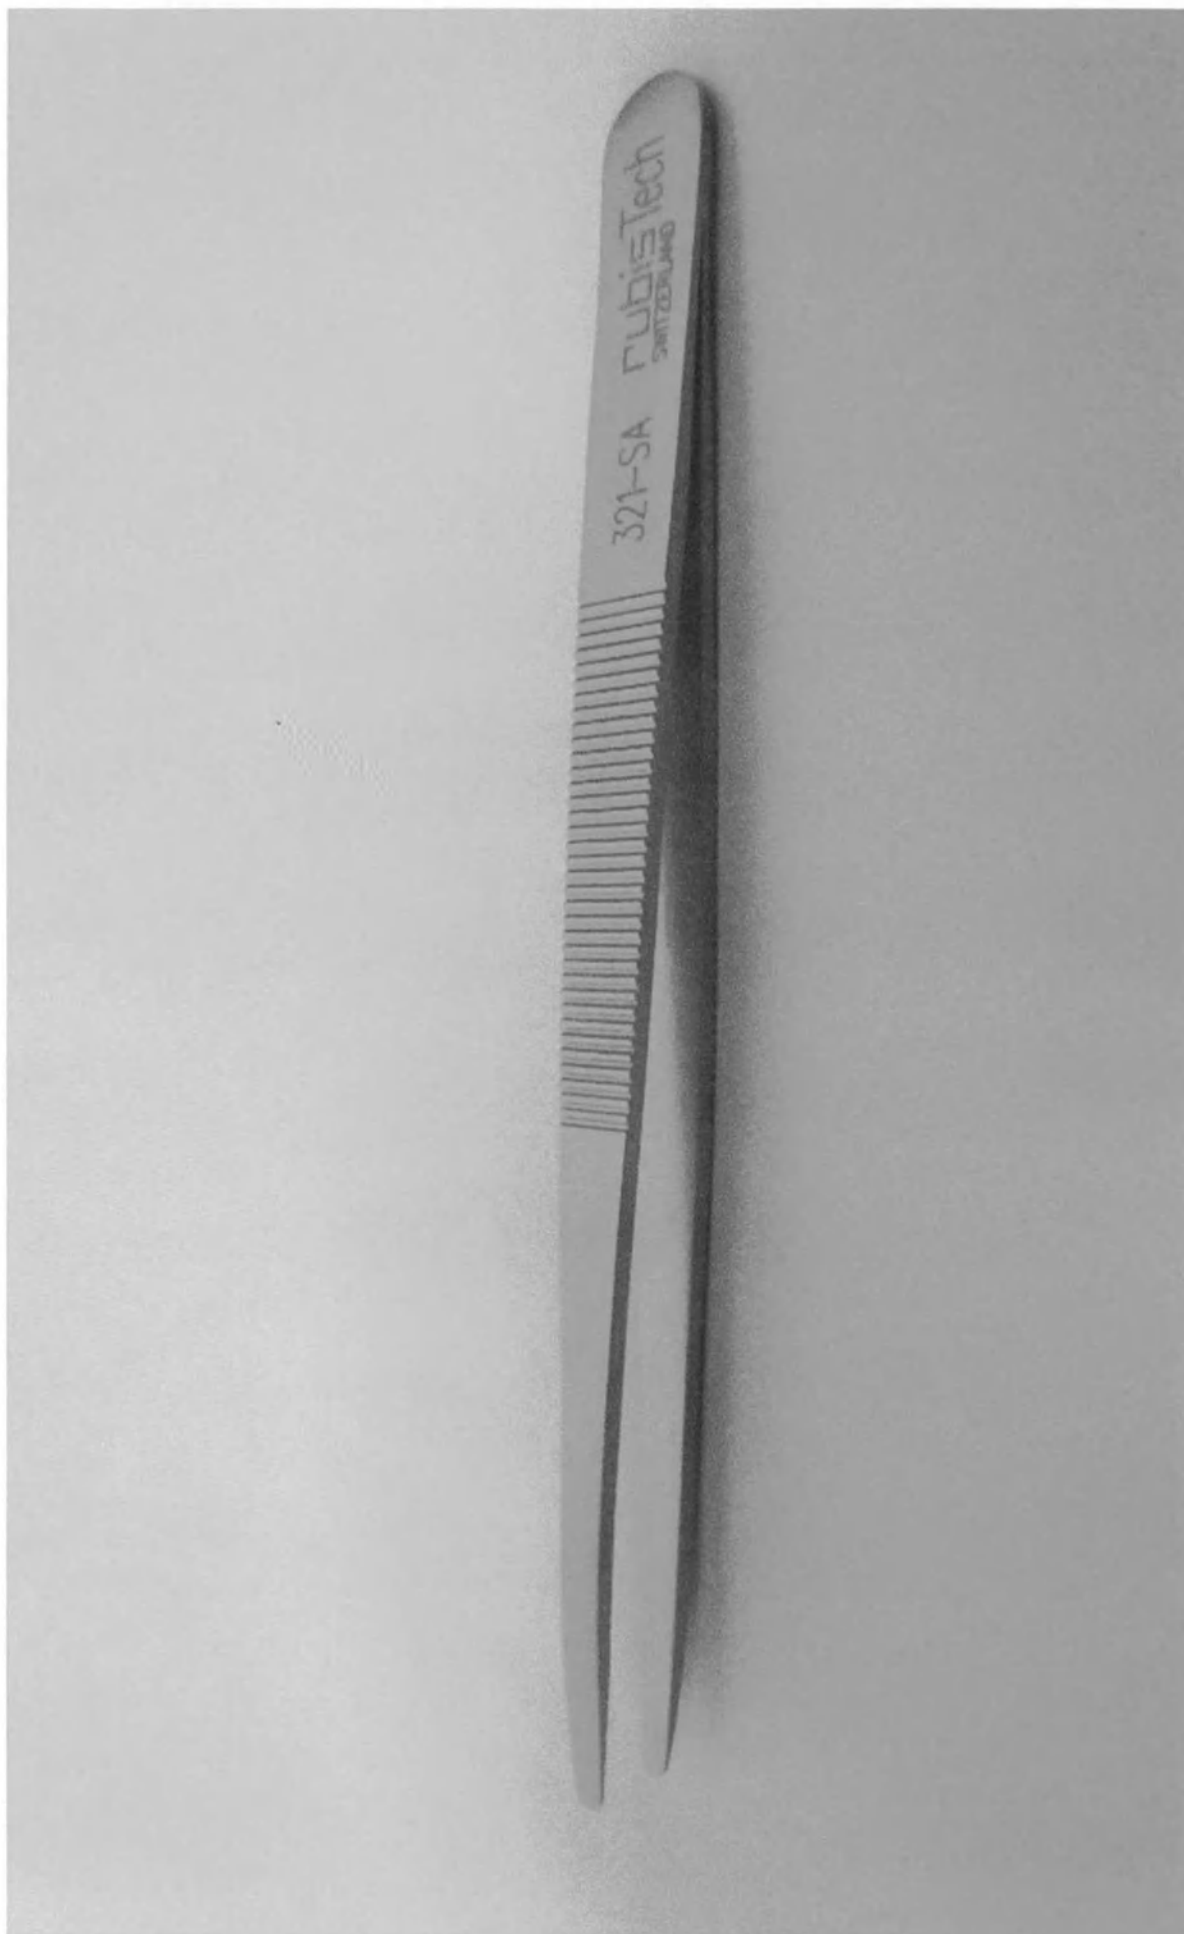

3.20 Пробирки вторичные 13x75 мм, 6 шт. в упаковке, 1 упаковка.




3.21 Инструмент для выравнивания термостата, 1 шт.

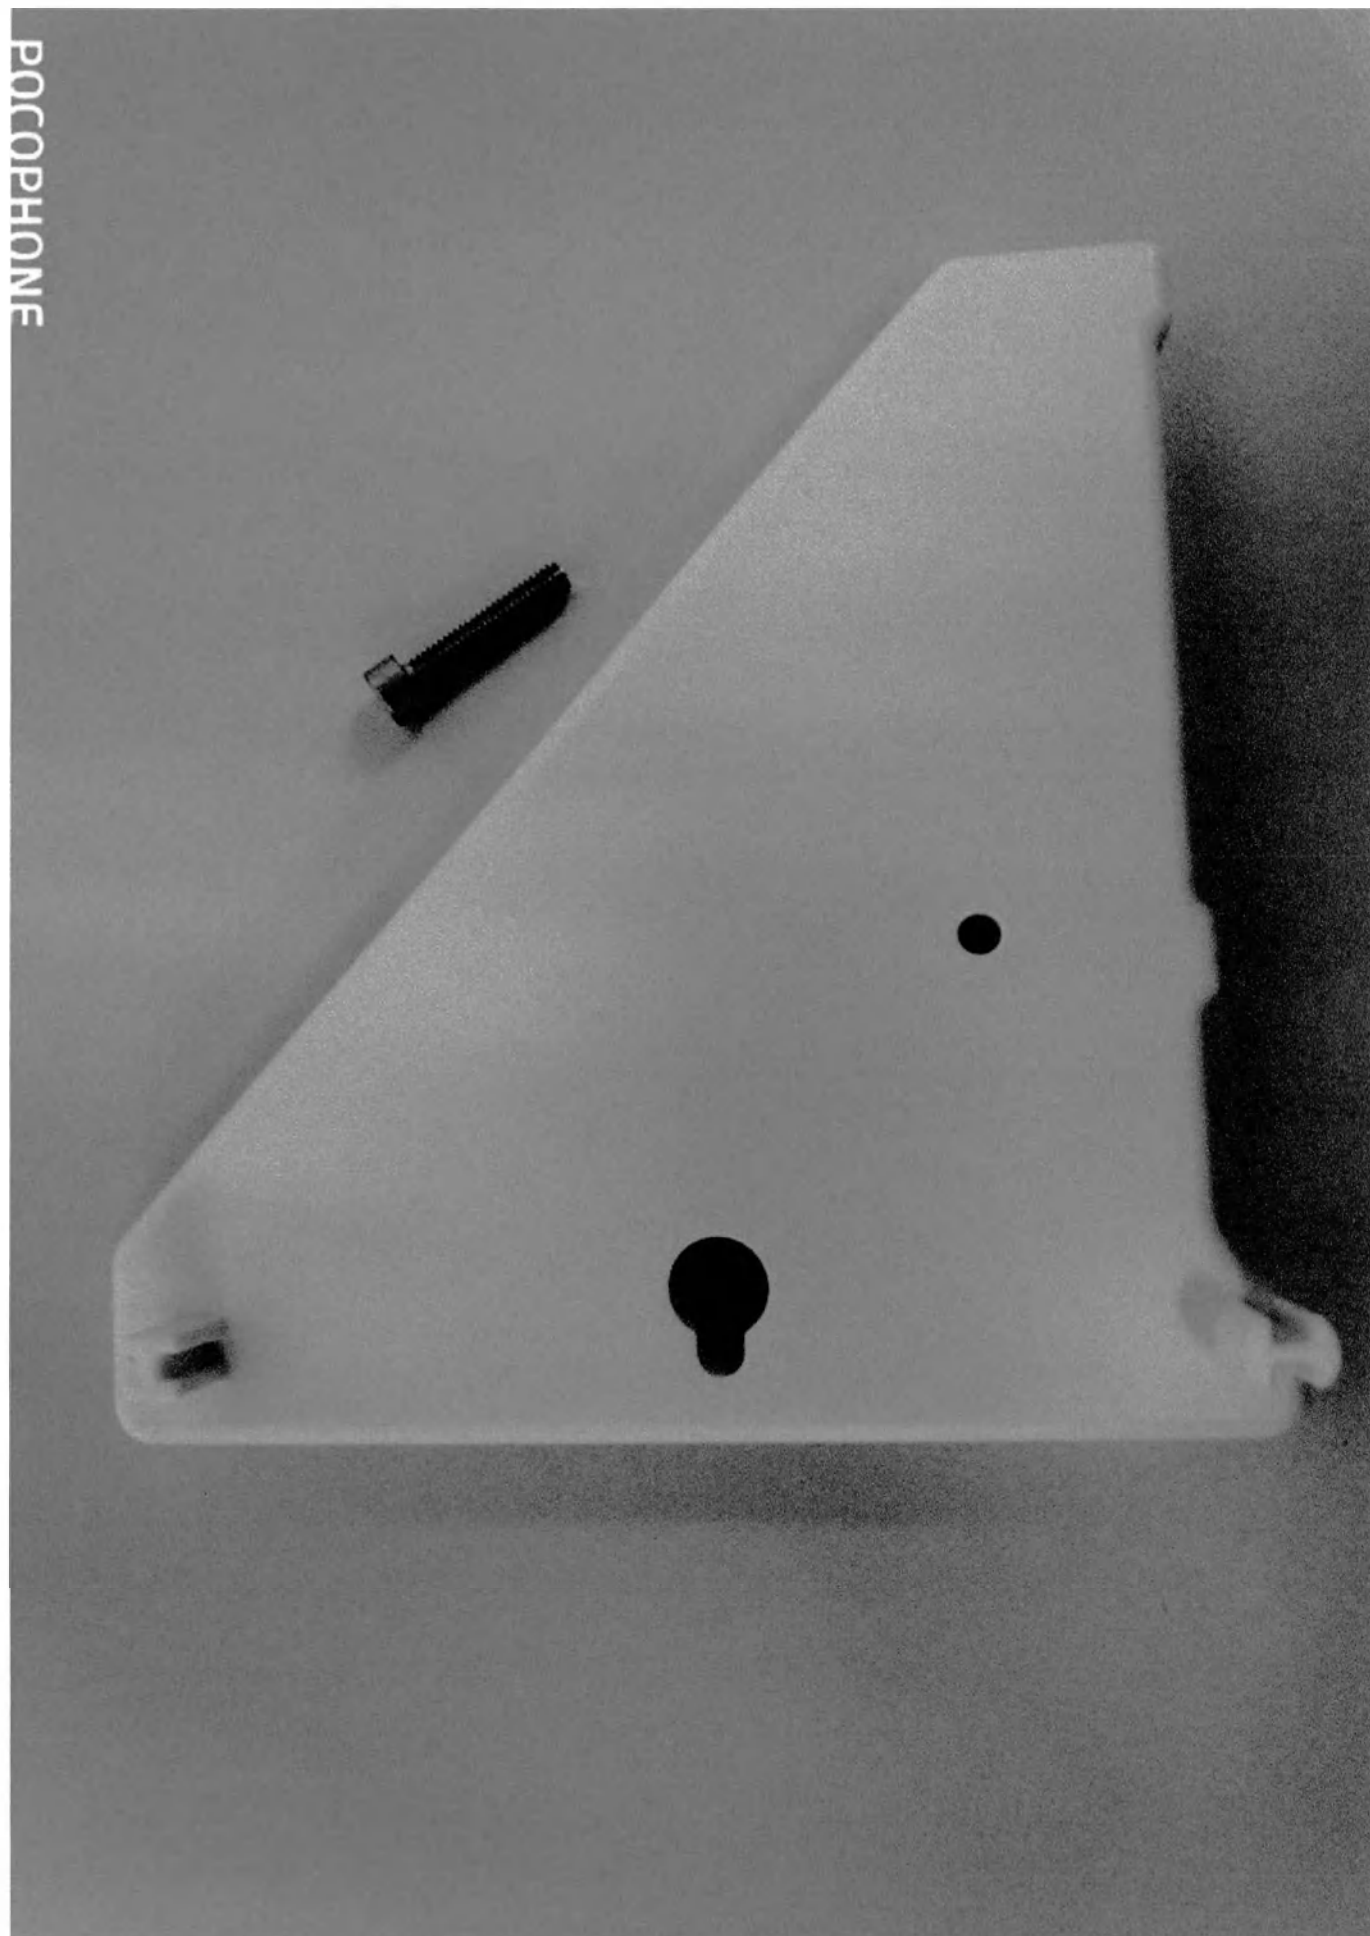

3.22 Палочка для очистки, 50 шт. в упаковке, 1 упаковка.



3.23 Держатель для крышек черный, 1 шт.

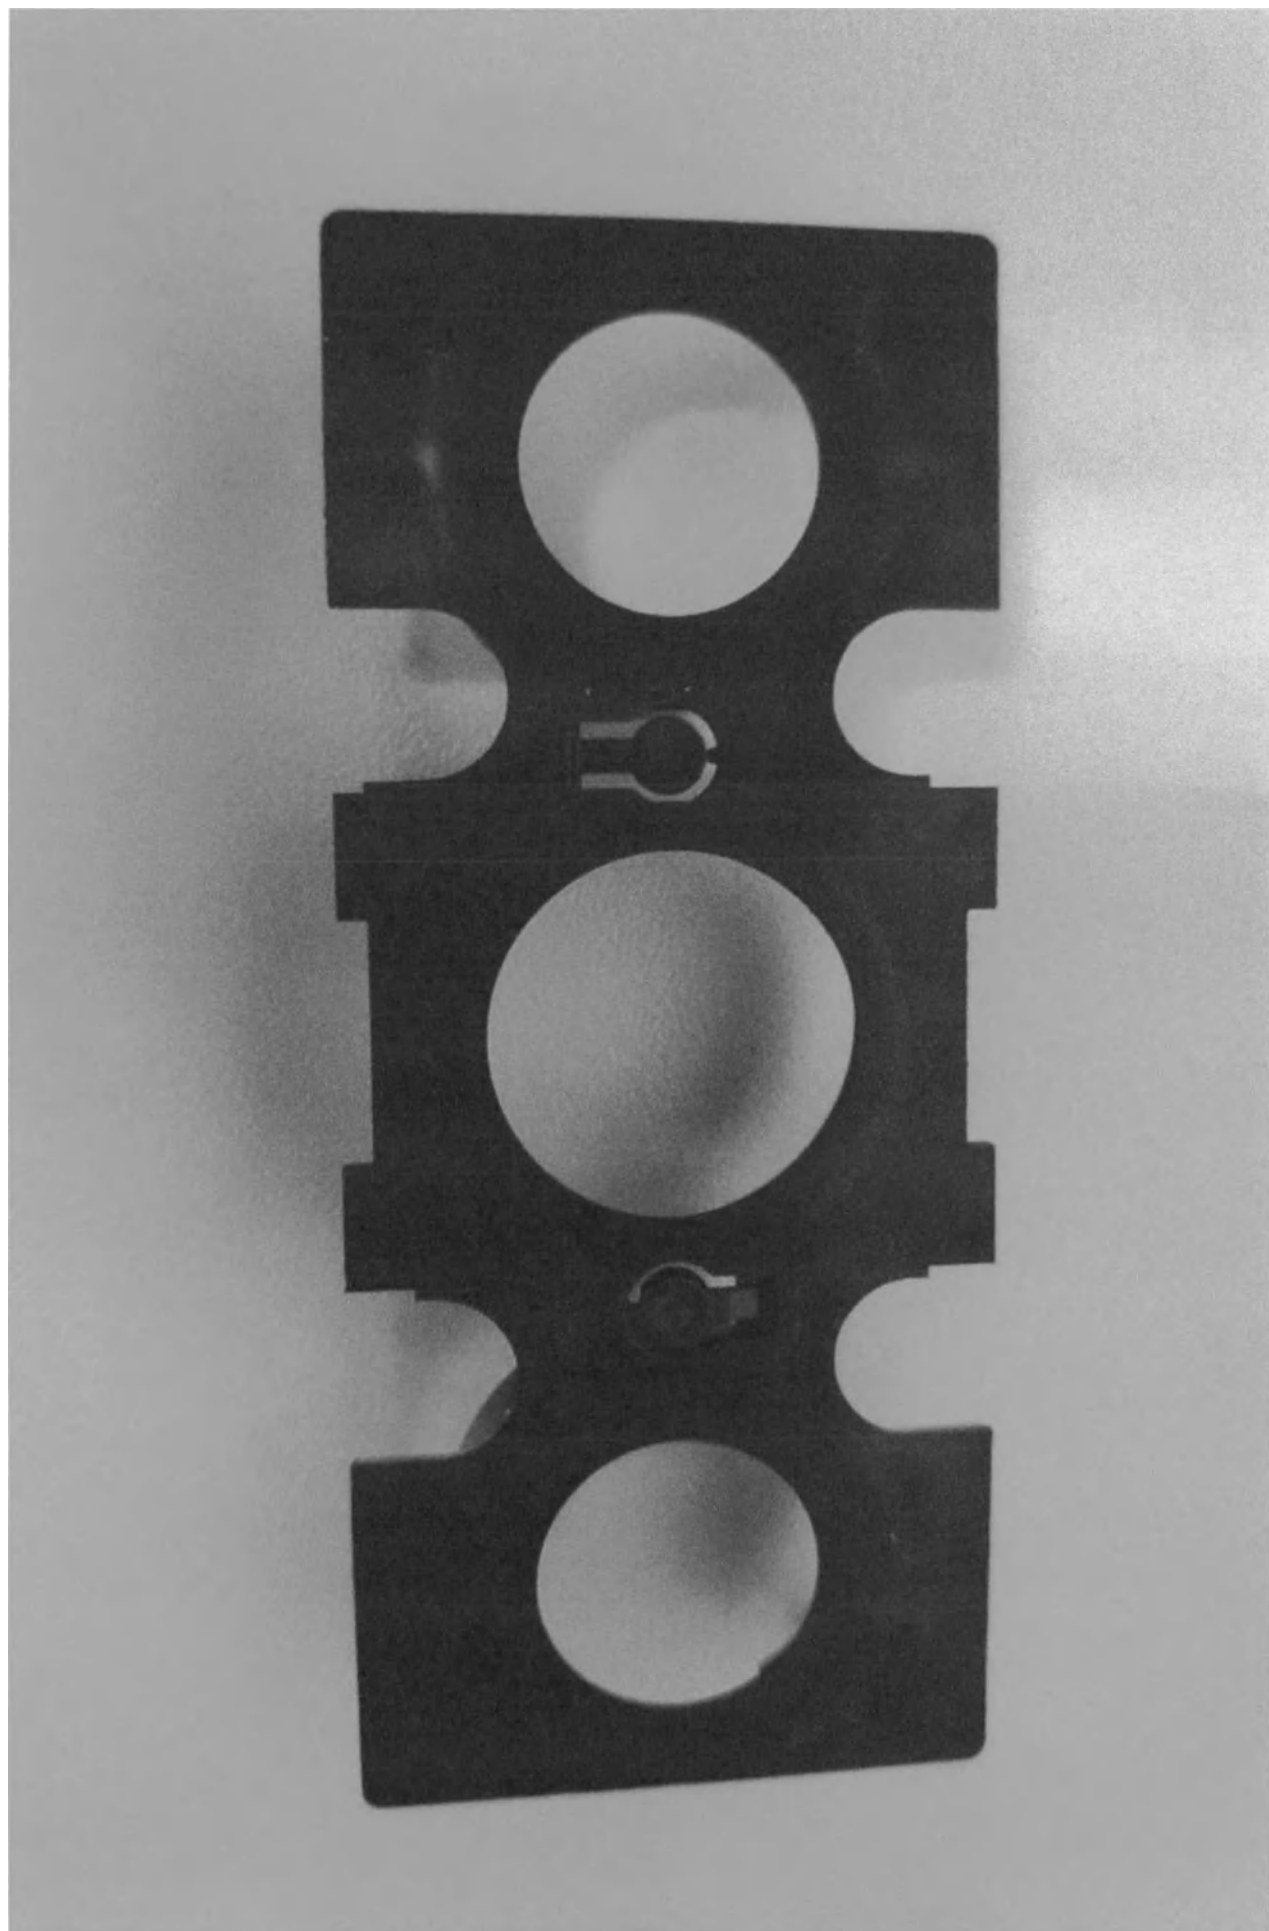

3.24 Микропробирка под винтовой колпачок, 500 шт. в упаковке, 1 упаковка.



4. Монитор в составе:

4.1 Монитор, не более 1 шт.



4.2 Кабель питания, не более 1 шт.



4.3 Кабель VGA, не более 1 шт.




4.4 Кабель DVI, не более 1 шт.



4.5 Кабель USB, не более 1 шт.




4.6 Кабель Audio, не более 1 шт.

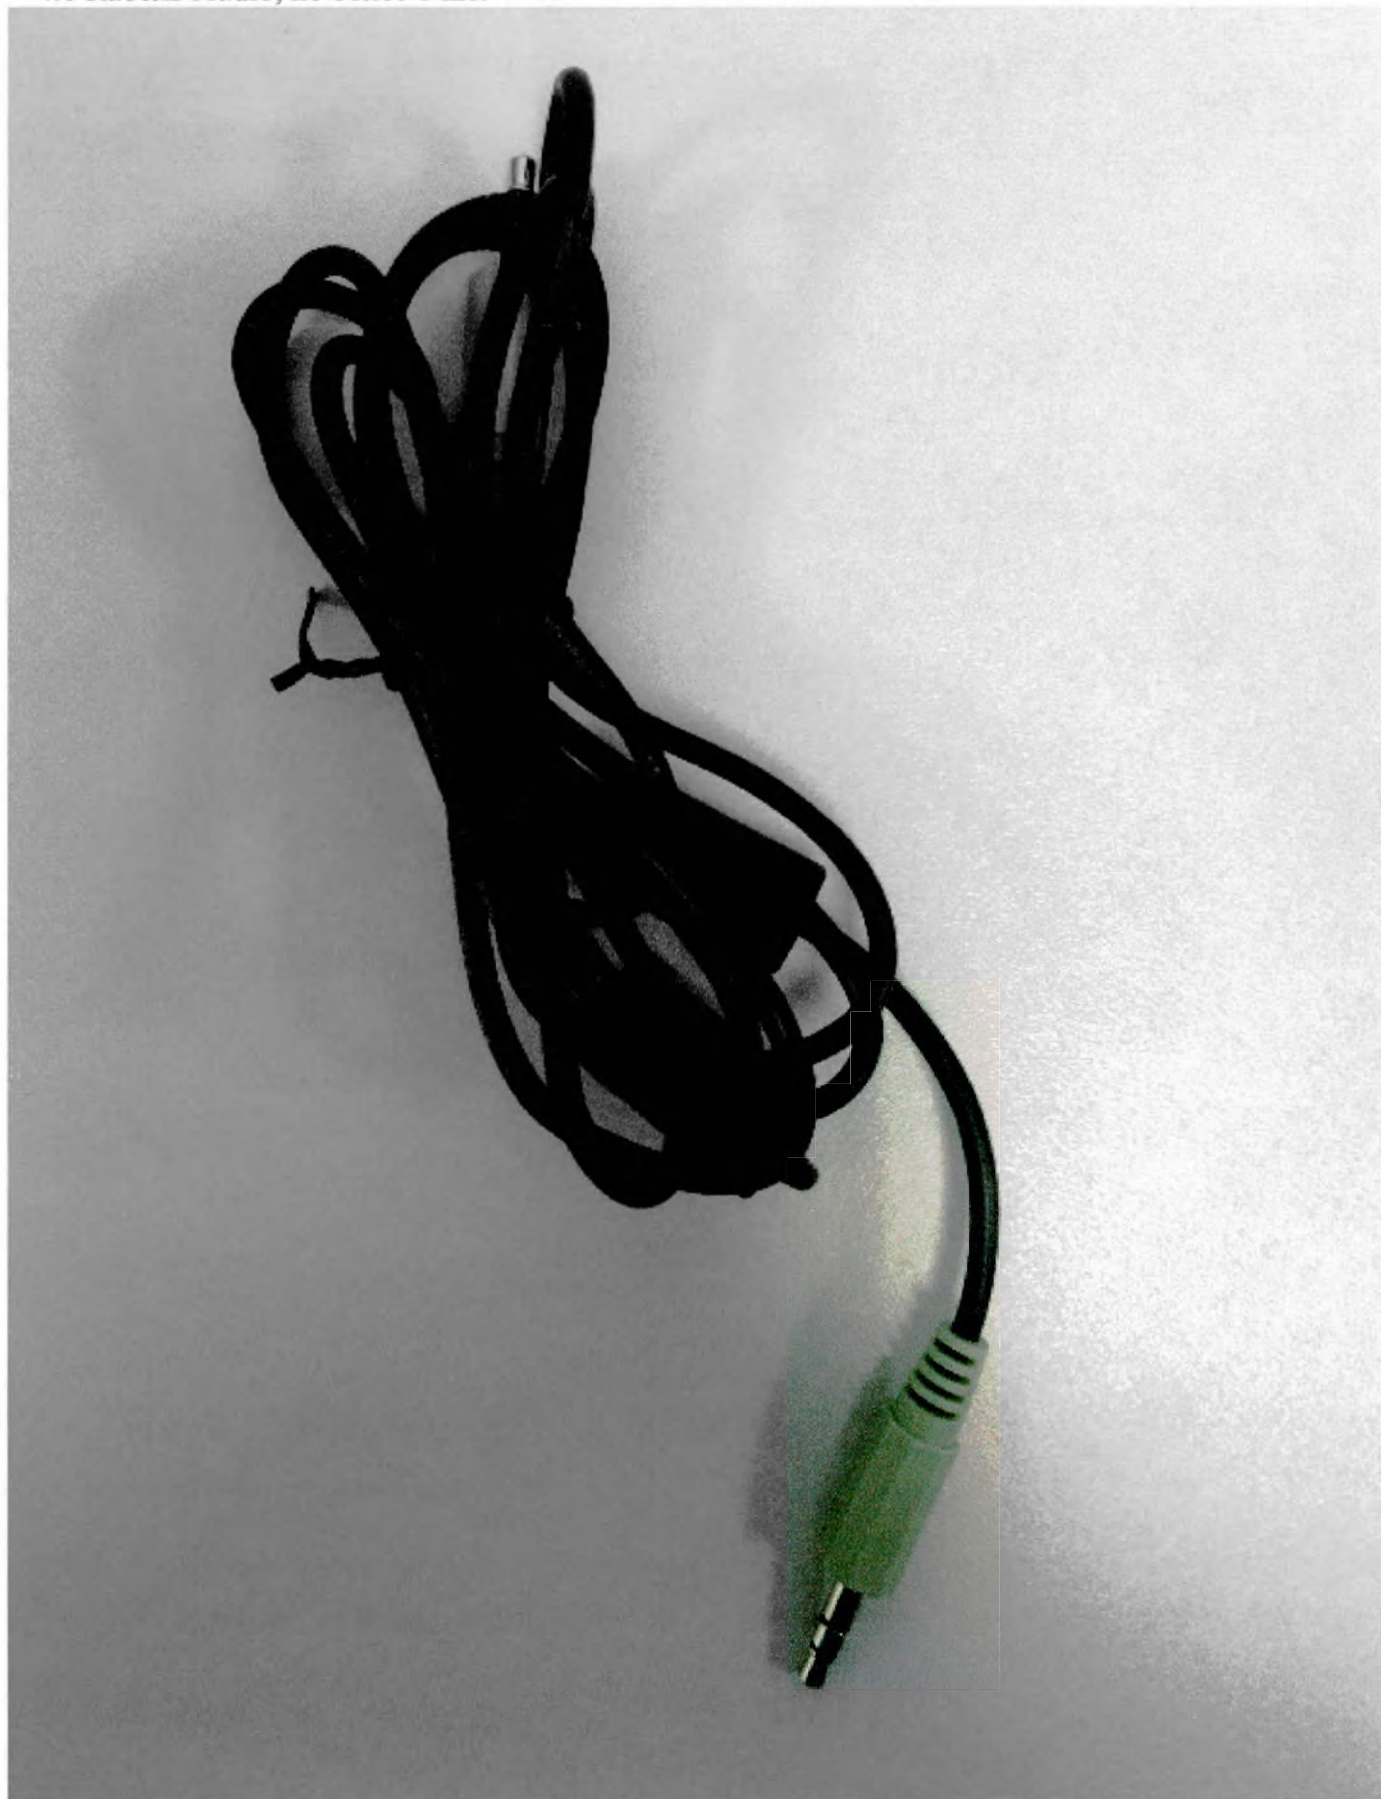

5. Системный блок, не более 1 шт.



6. Мышь, не более 1 шт.

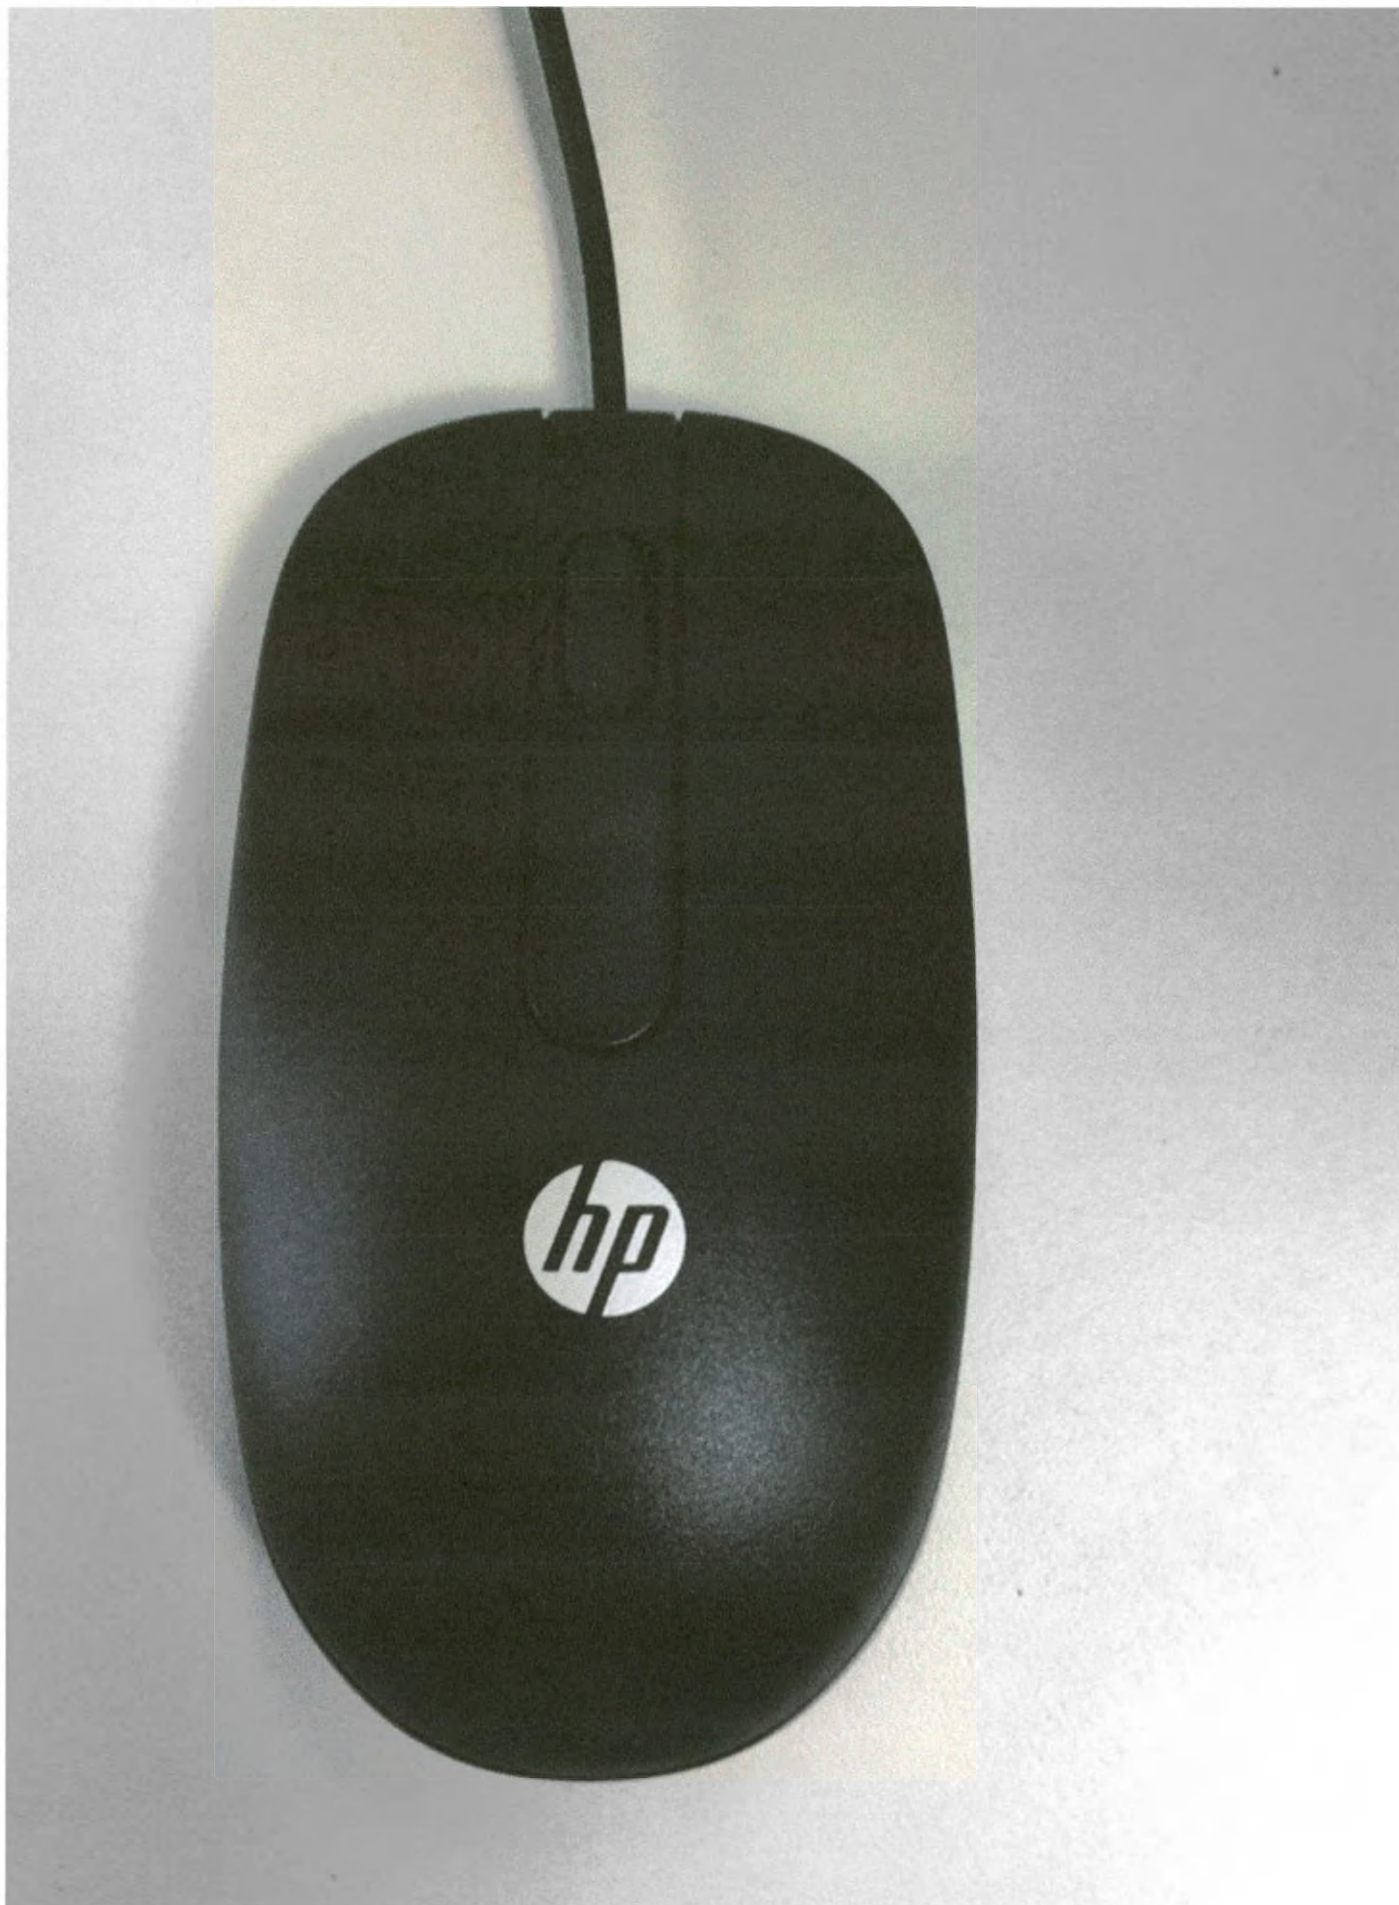

7. Клавиатура 13/16, 900 шт. в упаковке, не более 5000 упаковок (при необходимости).



8. Микропробирка 13/16, 900 шт. в упаковке, не более 5000 упаковок (при необходимости)



9. Измерительная кювета, 20х1000 шт. в упаковке, не более 5000 упаковок (при необходимости)



10. Раствор промывочный в кассете для депротенизации реагентных и пробозаборных игл к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (Deproteinizer cobas t systems), не более 100 шт. (при необходимости).



11. Раствор промывочный для кондиционирования пробозаборных игл после их очистки во флаконе к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (Probe Cond. / Probe Conditioner cobas t systems), не более 100 шт. (при необходимости).



12. Раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (System cleaner cobas t systems), не более 5000 шт. (при необходимости).




13. Раствор промывочный в кассете к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (CLEAN cobas t systems), не более 5000 шт. (при необходимости).




14. Набор системных пластиковых пробирок, 50 x 11 мл, 50 шт. по 11 мл в упаковке, не более 100 упаковок, (при необходимости).



15. Микропробирка под винтовой колпачок, 500 шт. в упаковке, не более 100 упаковок (при необходимости).

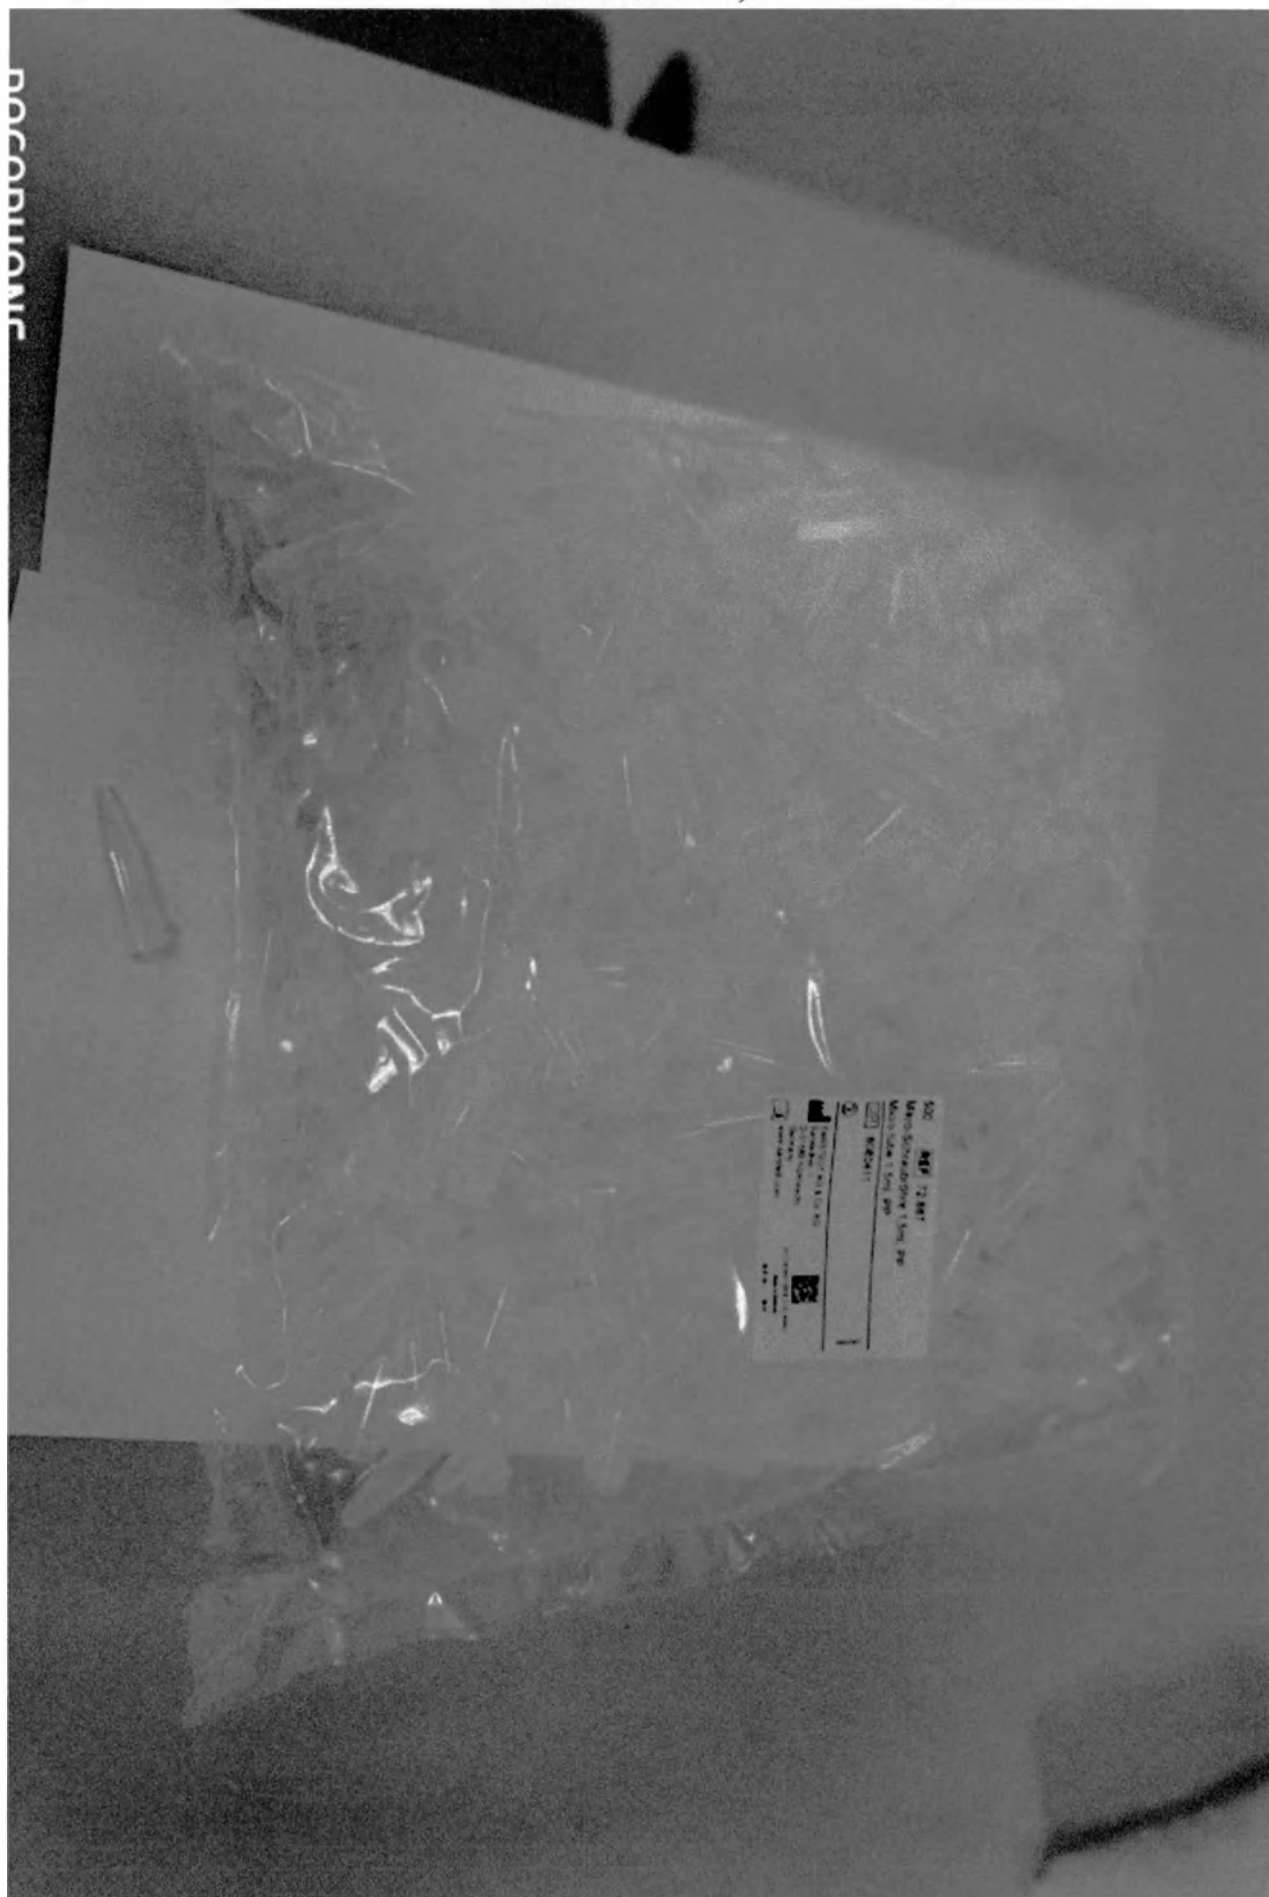

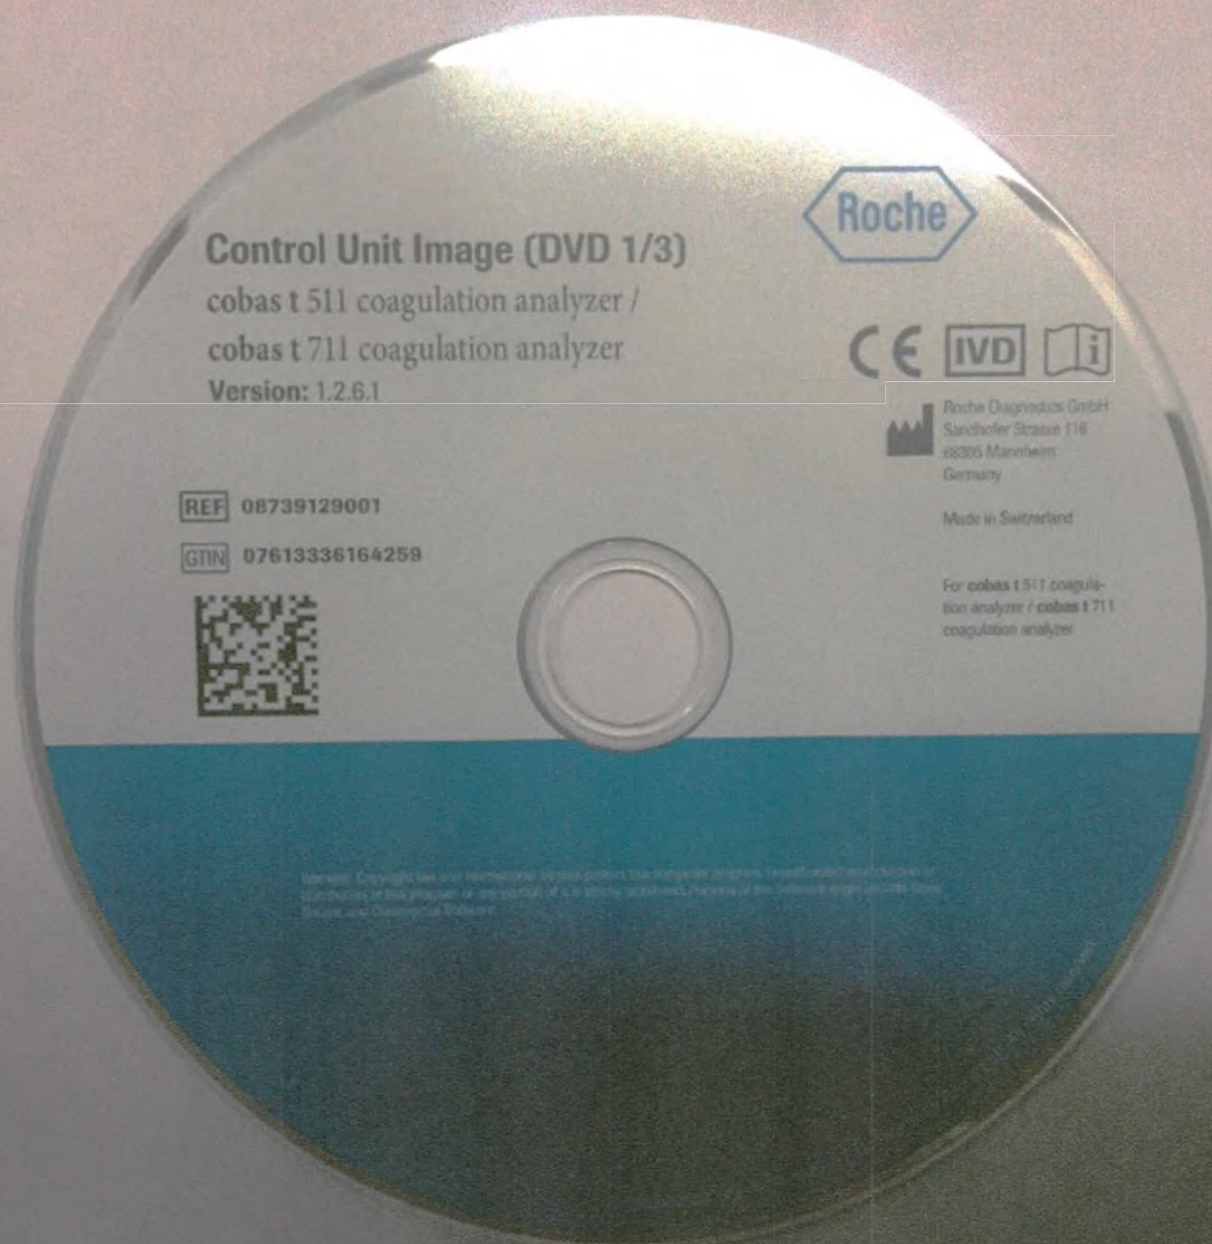

17. DVD диск с программным обеспечением, не более 1 шт.




18. CD диск с установщиком языковых пакетов, не более 1 шт.



19. CD диск с пакетом с диагностическим и сервисным программным обеспечением, не более 1 шт.



20. Фильтр воздушный, не более 1 шт.

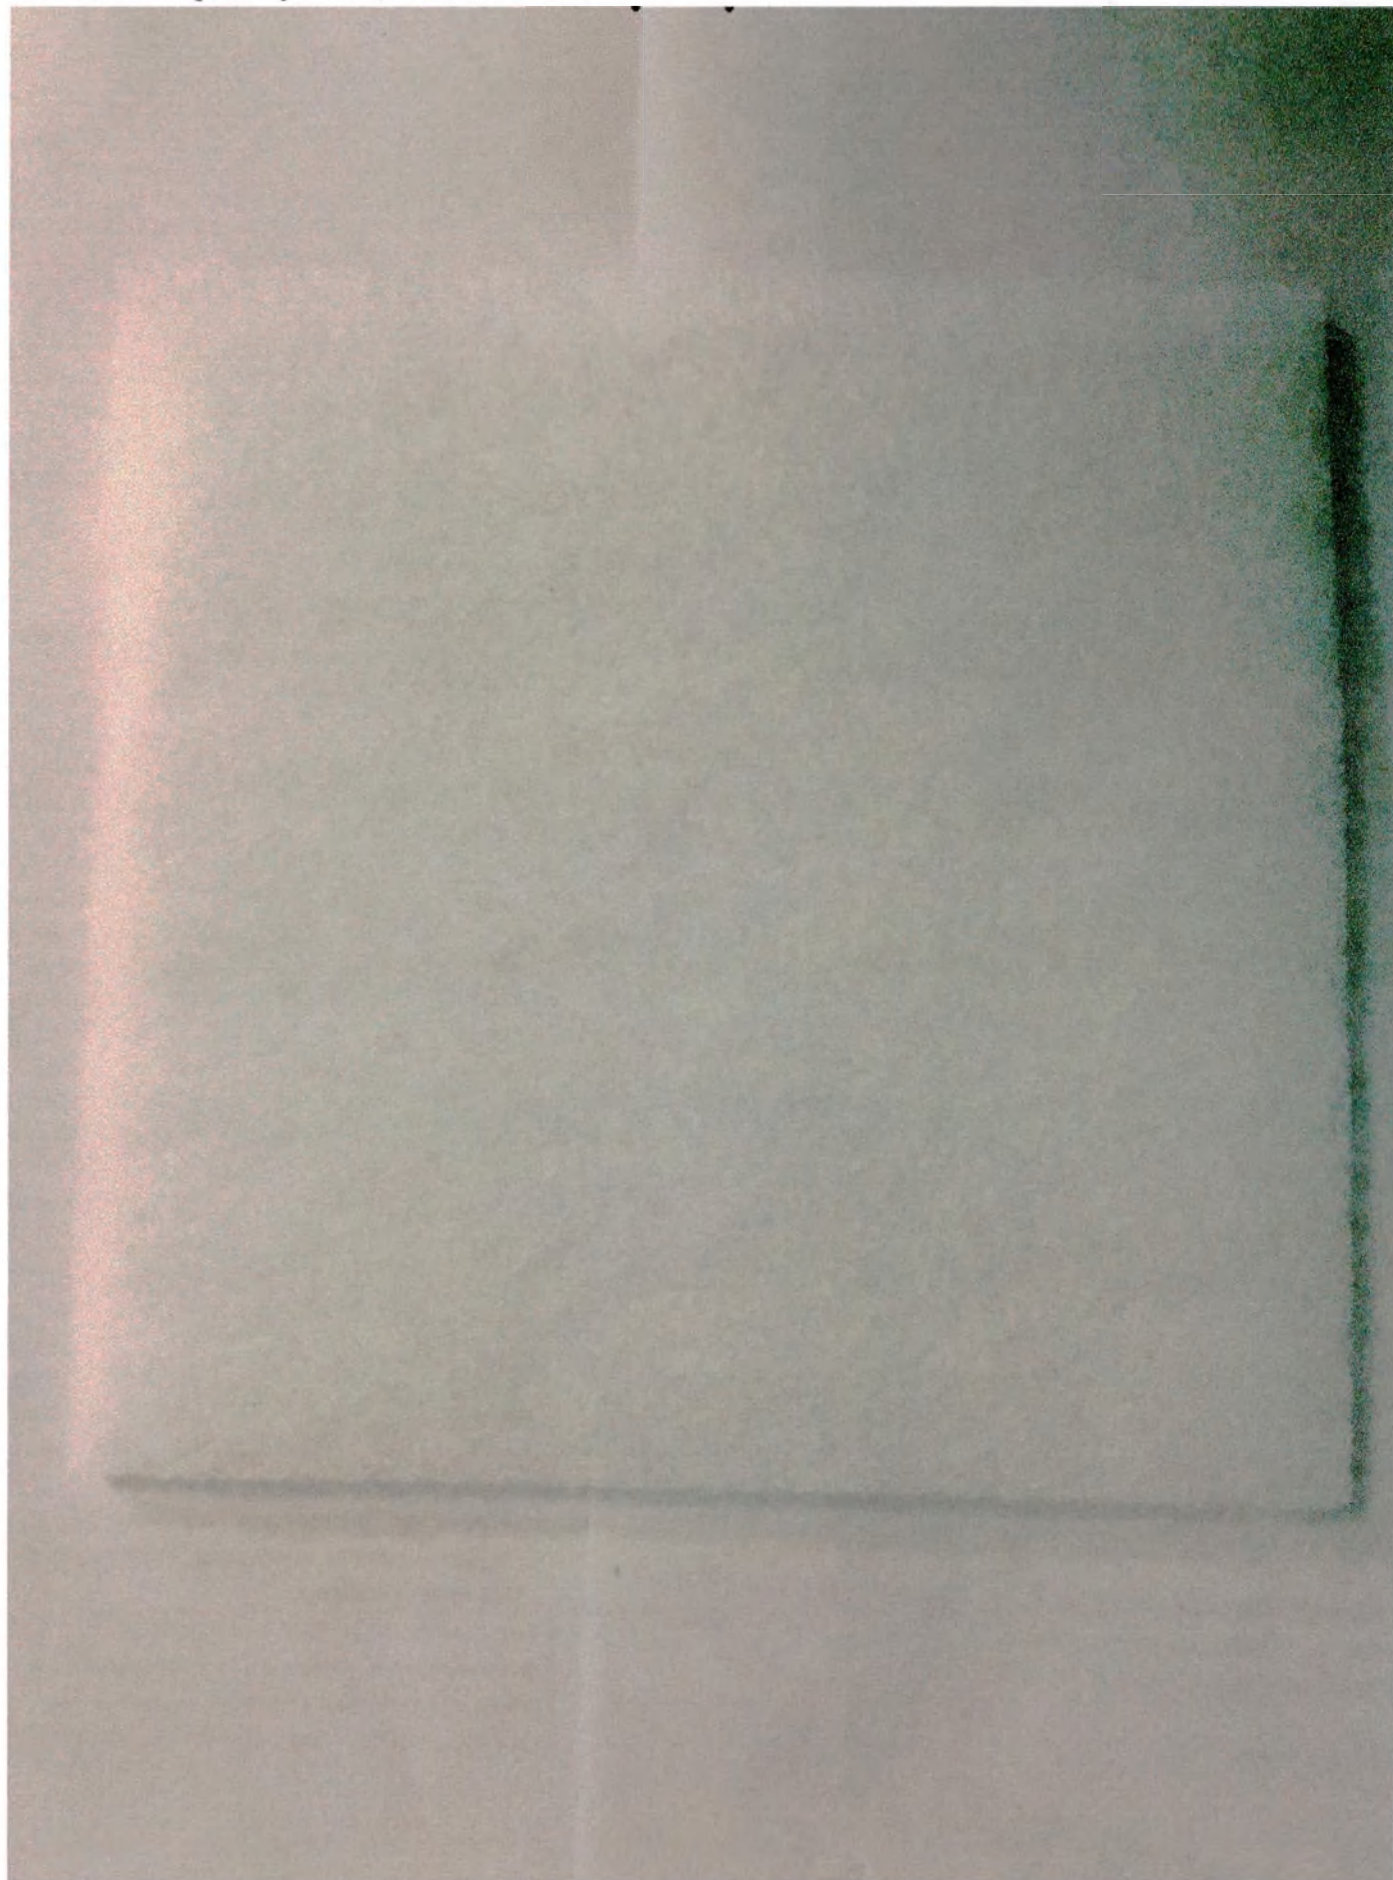

21. CD диск с локализацией ПО, не более 1 шт.



22. Стол для ПК (при необходимости), не более 1 шт.



23. Руководство пользователя, не более 1 шт.



cobas t 711 coagulation analyzer

Руководство пользователя Версия 2.1
Версия программного обеспечения 2.0.2




cobas®
Life needs answers



cobas t 711 coagulation analyzer

«Руководство по безопасности» Версия 2.0
Версия программного обеспечения 2.0.2

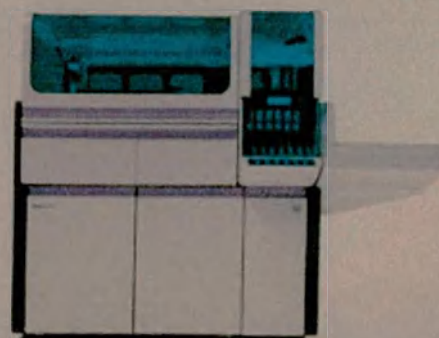

cobas®
Life needs answers

25. Руководство по предоставлению помощи пользователю, не более 1 шт.



cobas t 711 coagulation analyzer

cobas t 711 connection module

cobas t development channel


Поддержка пользователя Версия 2.1

Версия программного обеспечения 2.0.2




cobas®
Life needs answers


26. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M001-M010, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

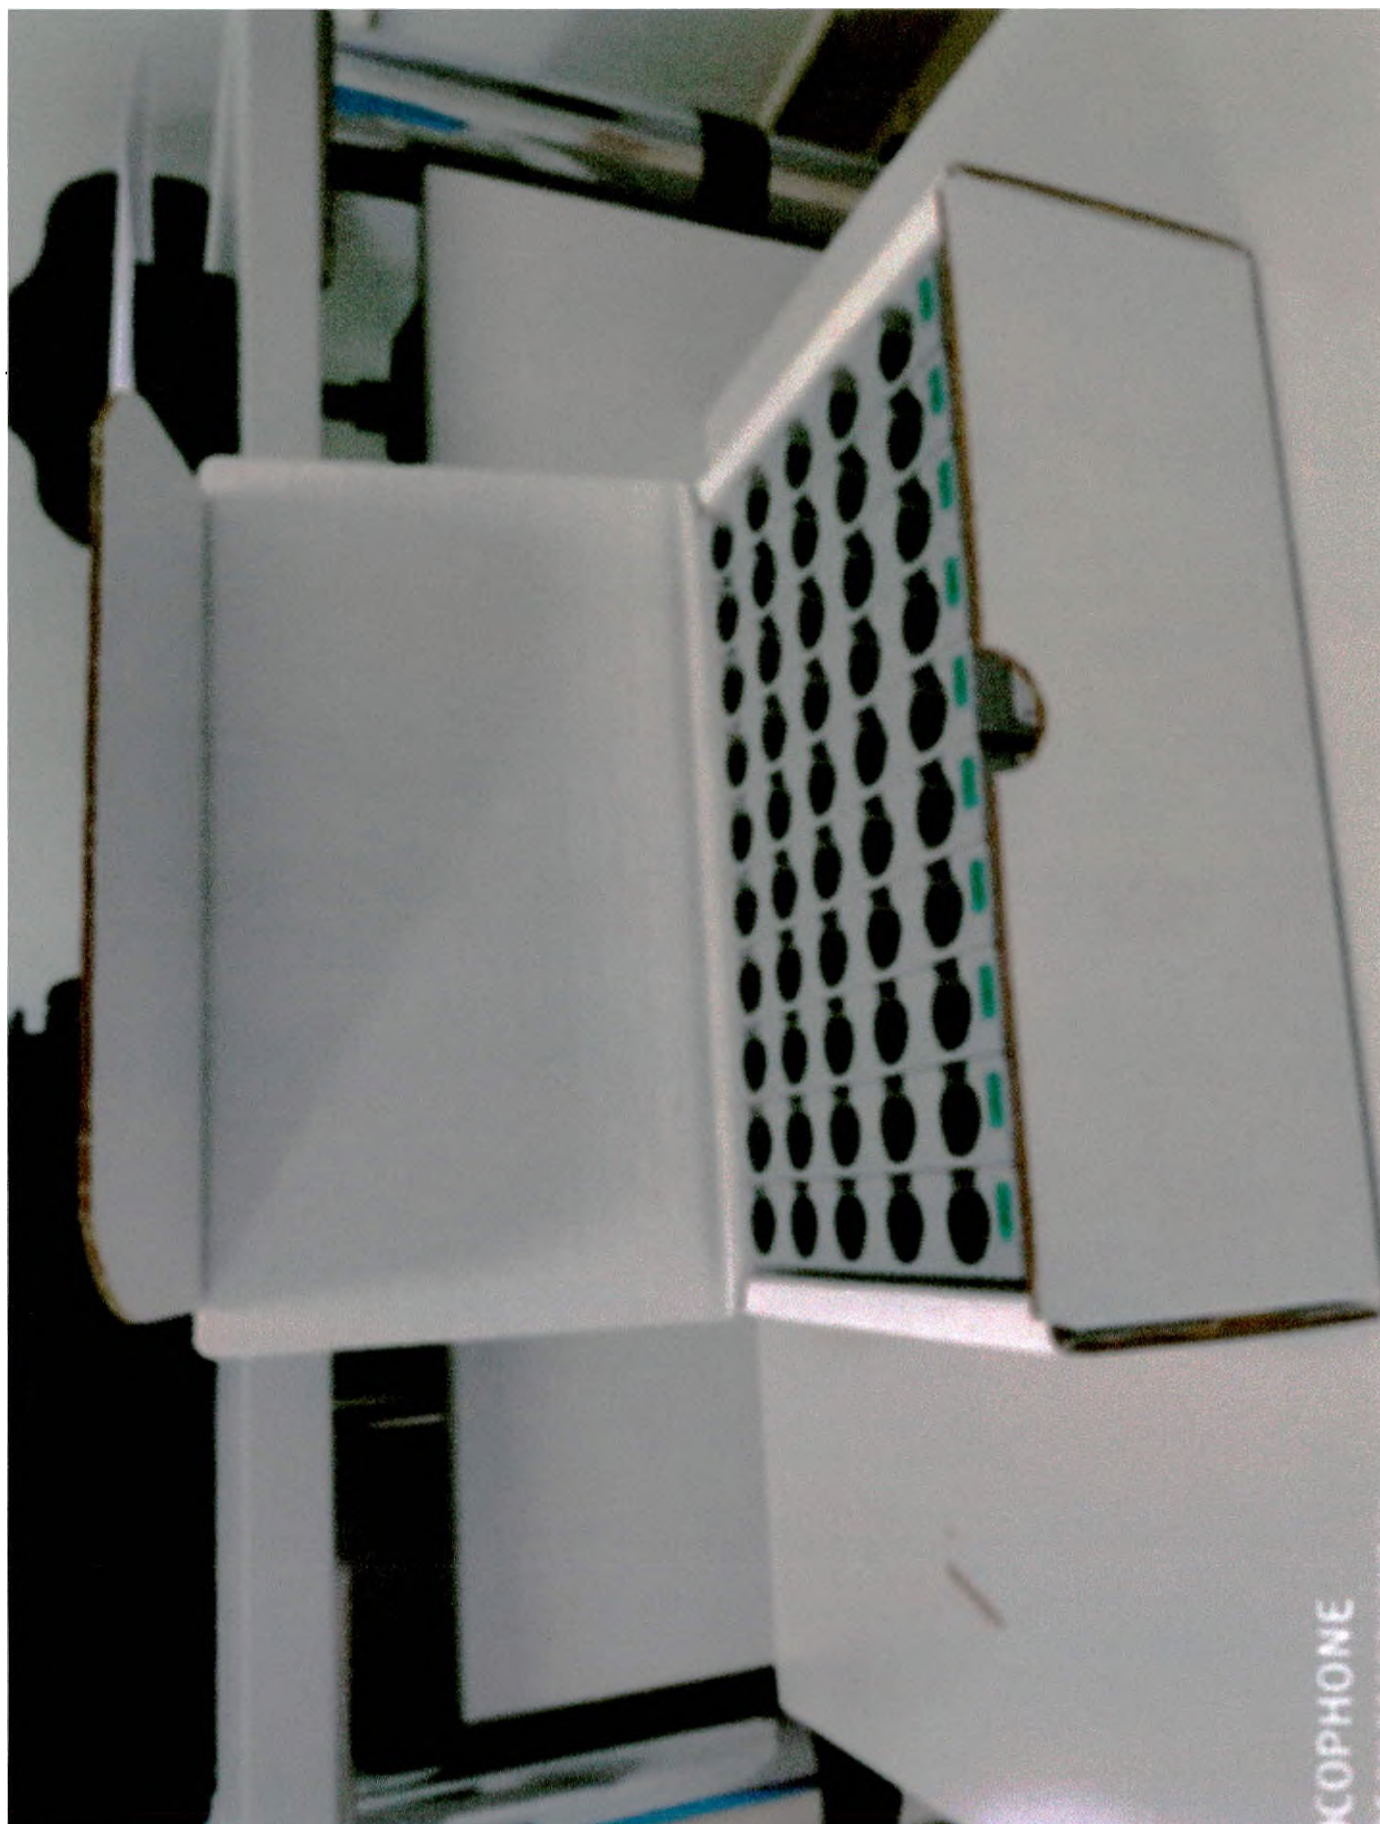


27. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M011-M020, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

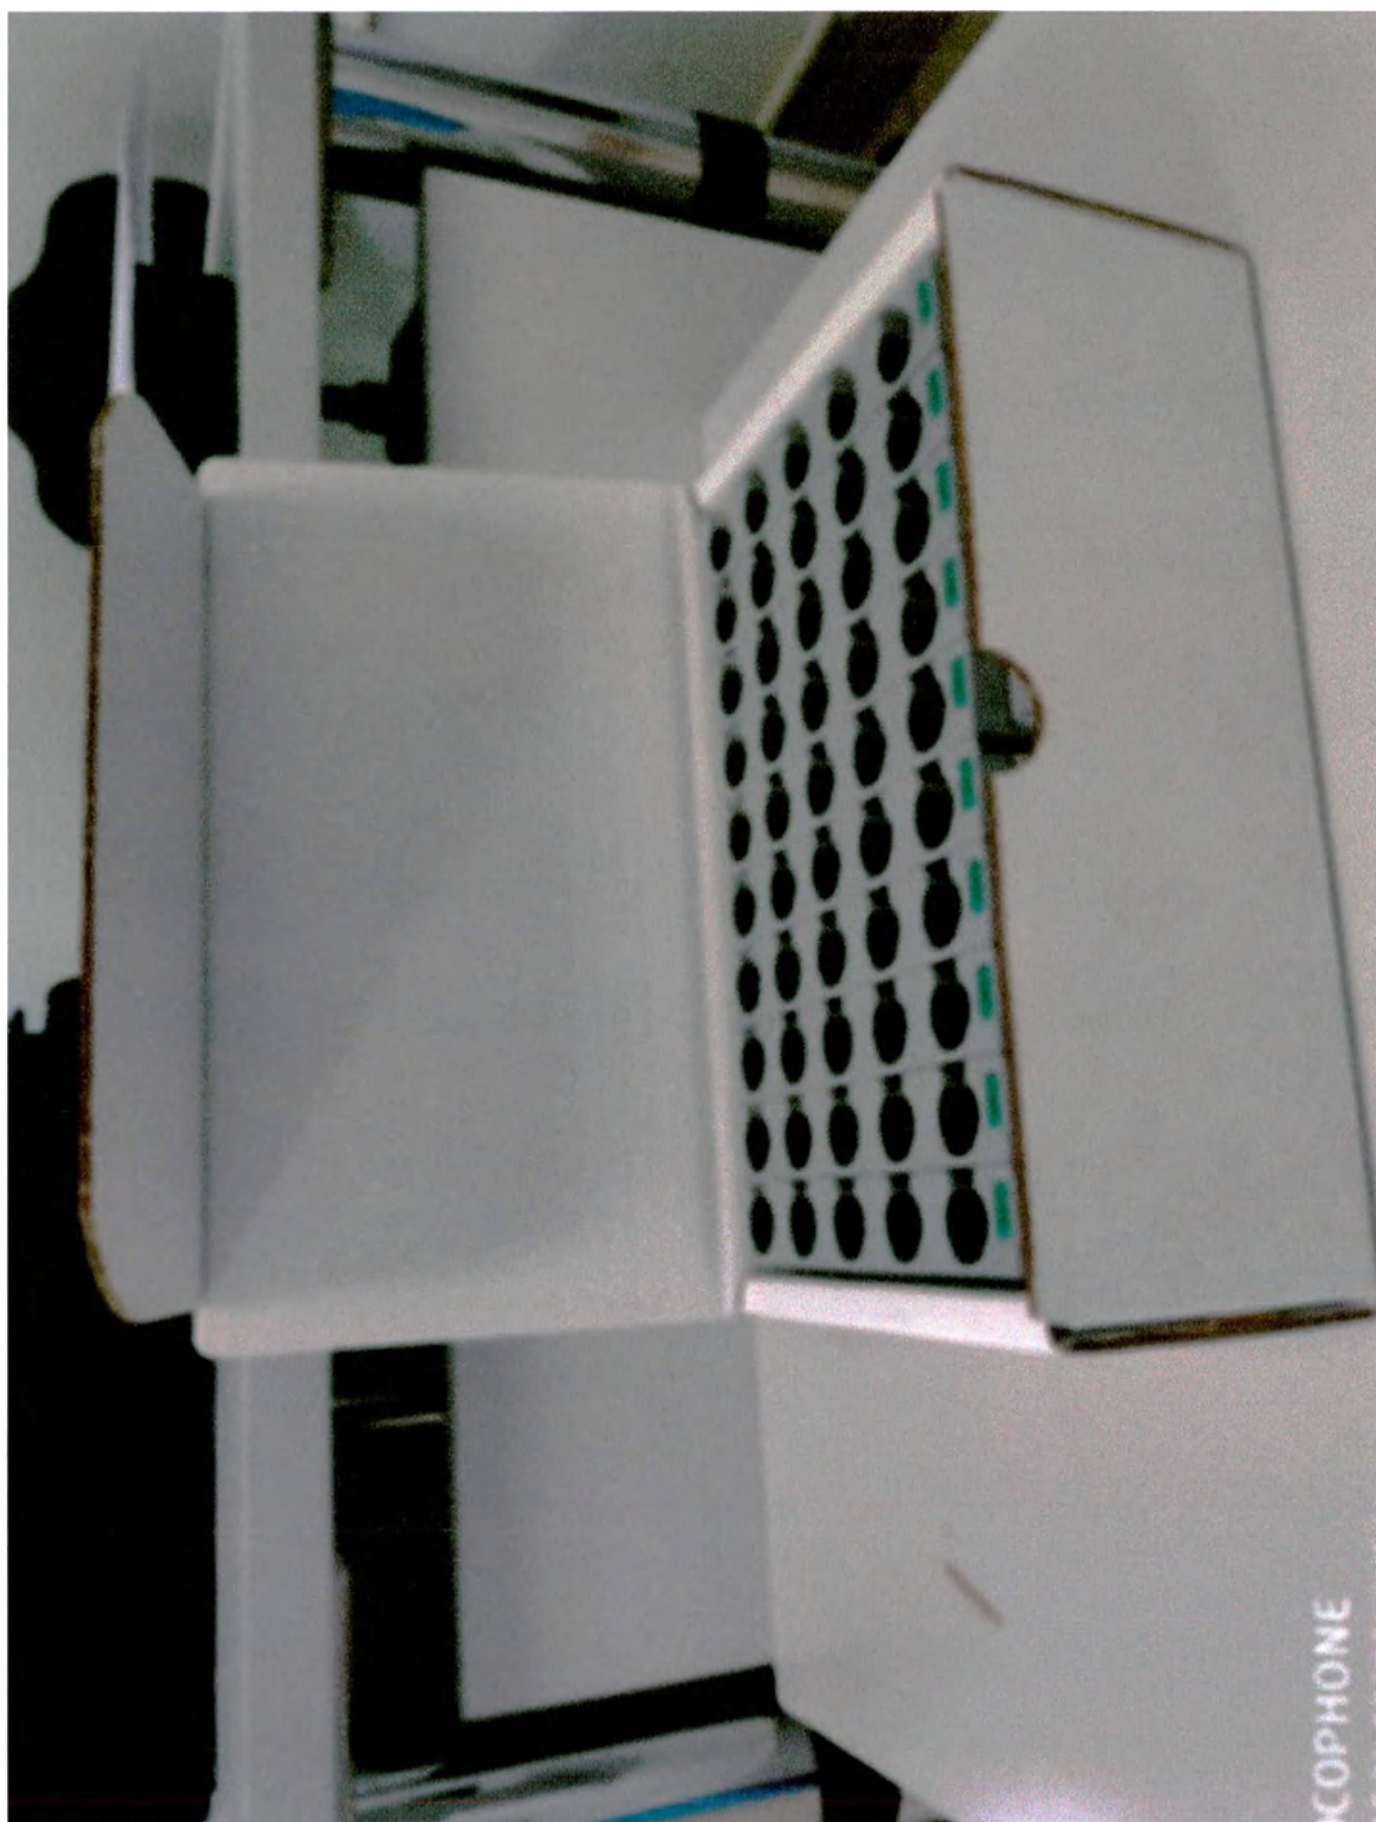


28. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M021-M030, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

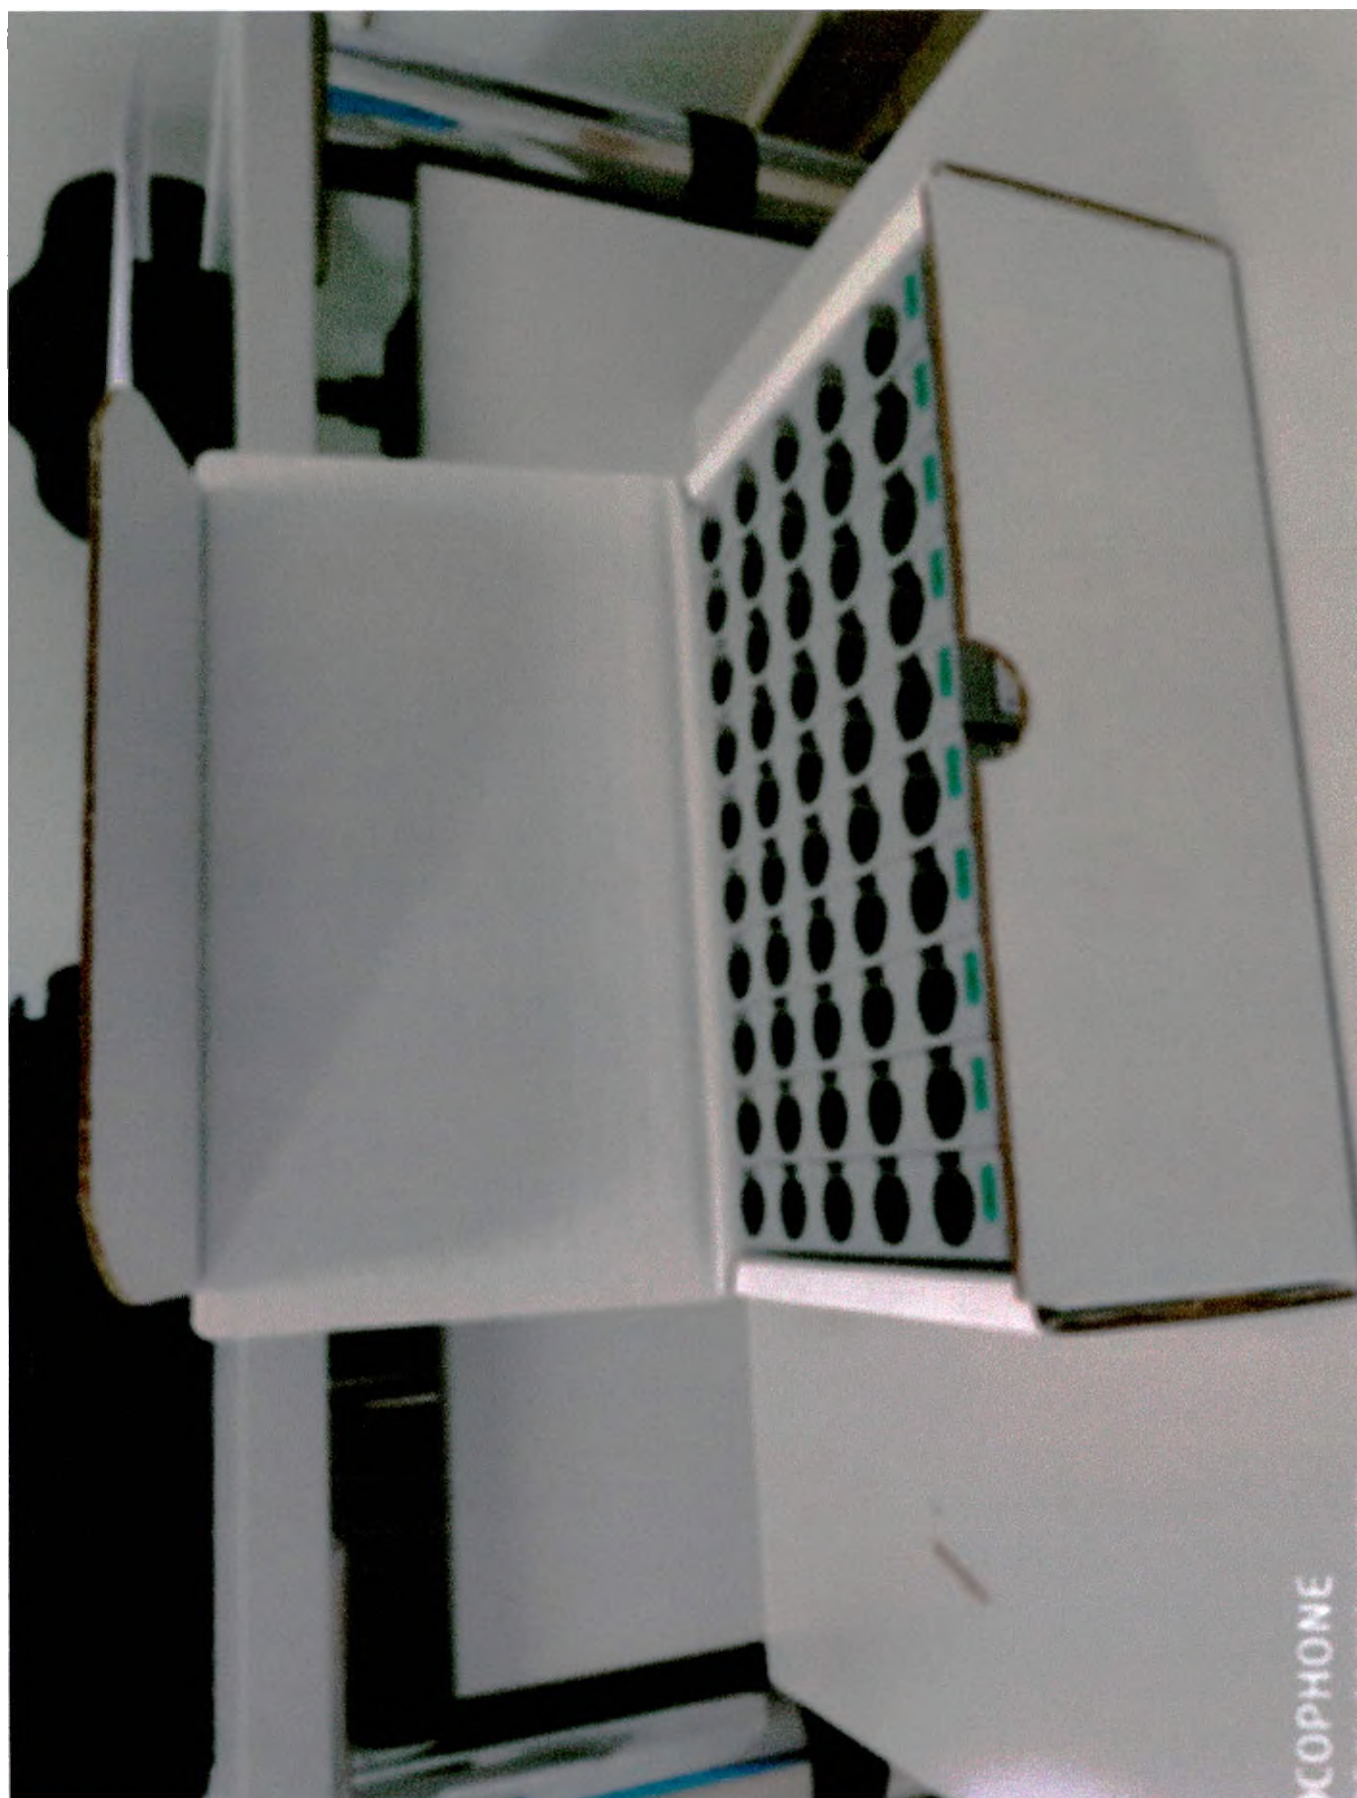


29. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M031-M040, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

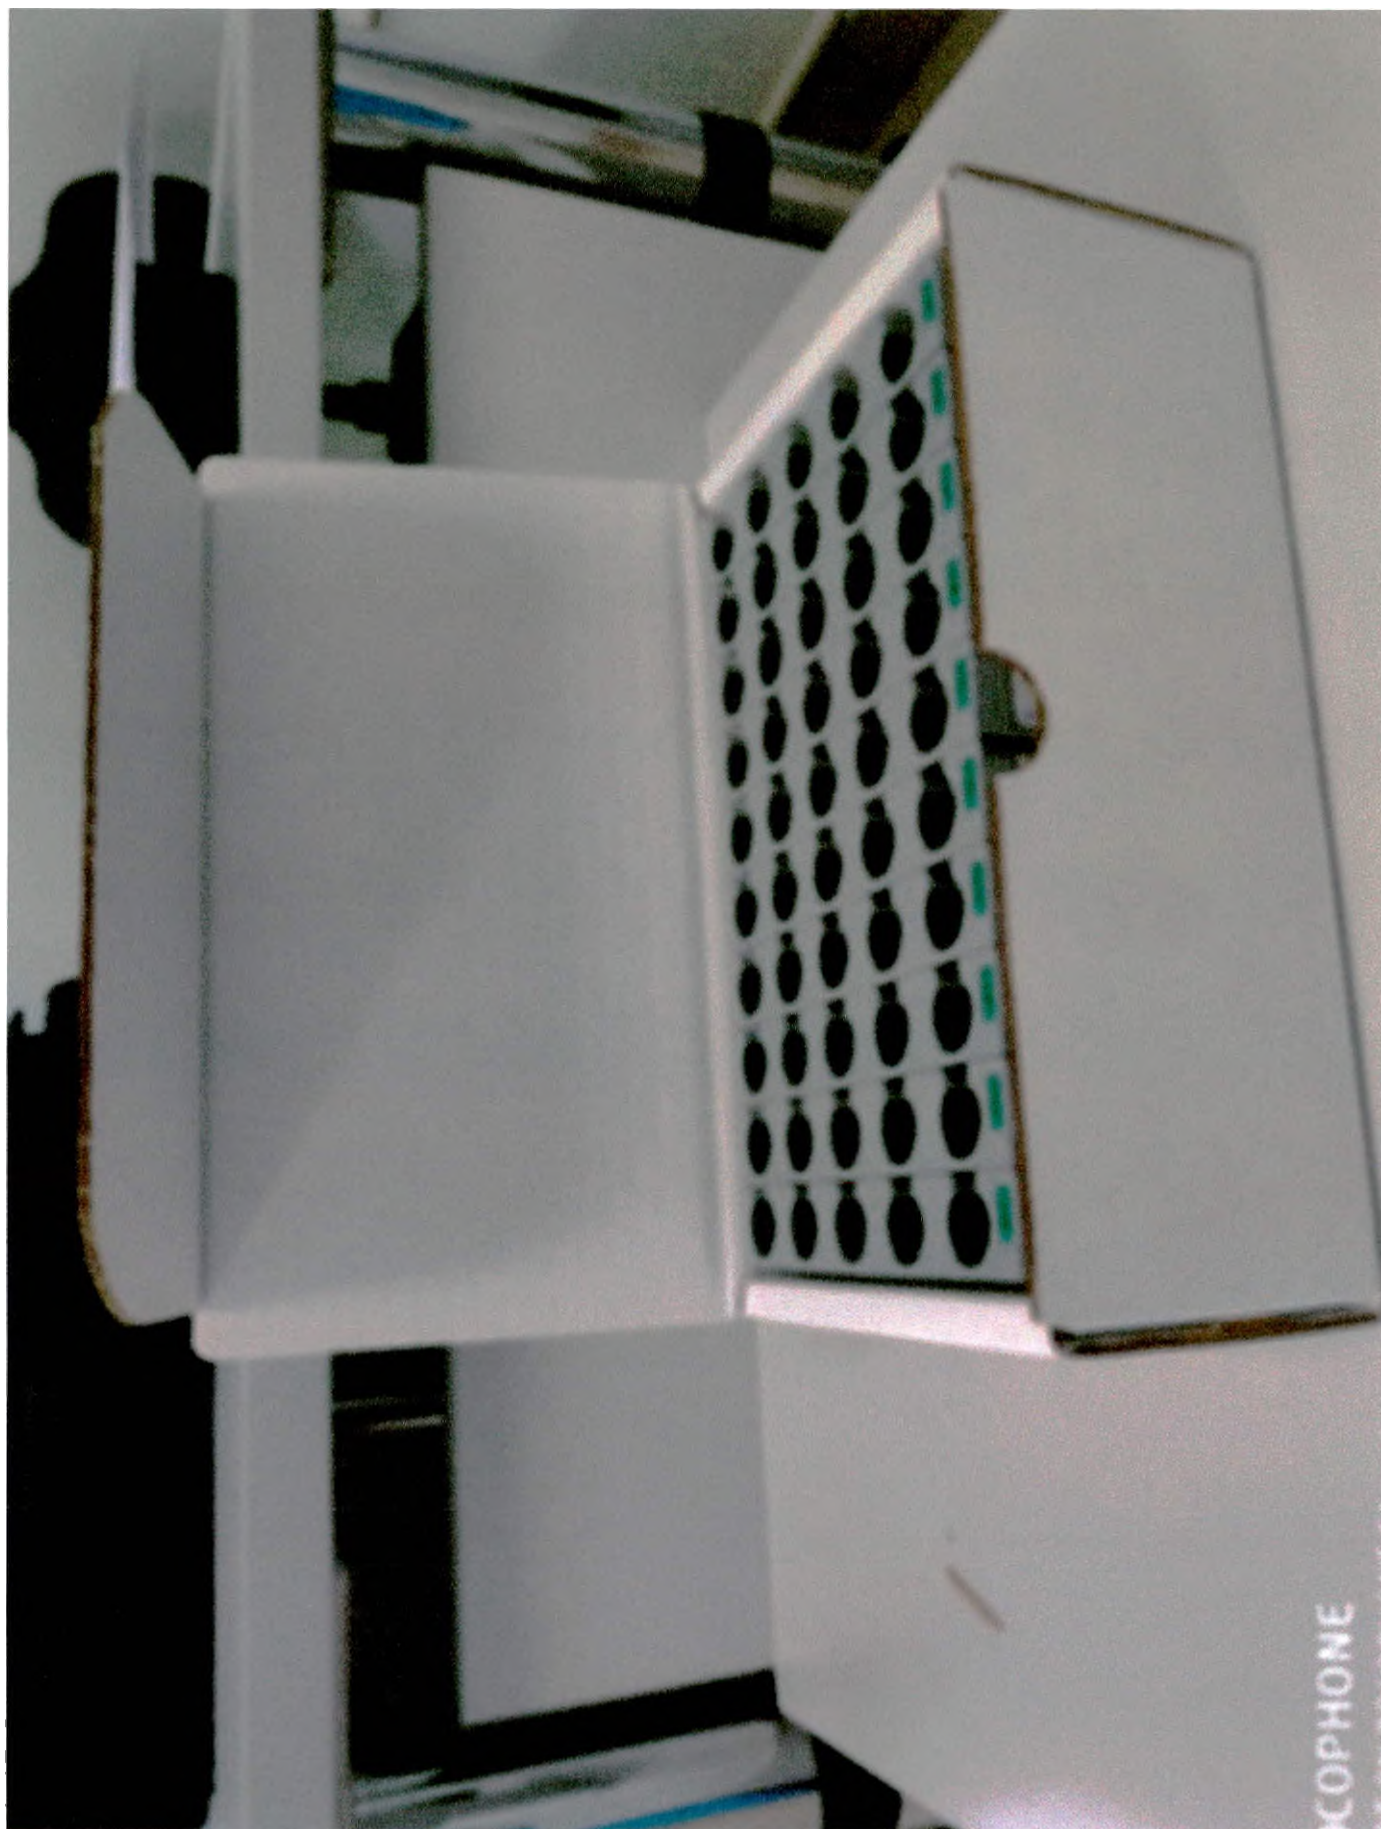


30. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M041-M050, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

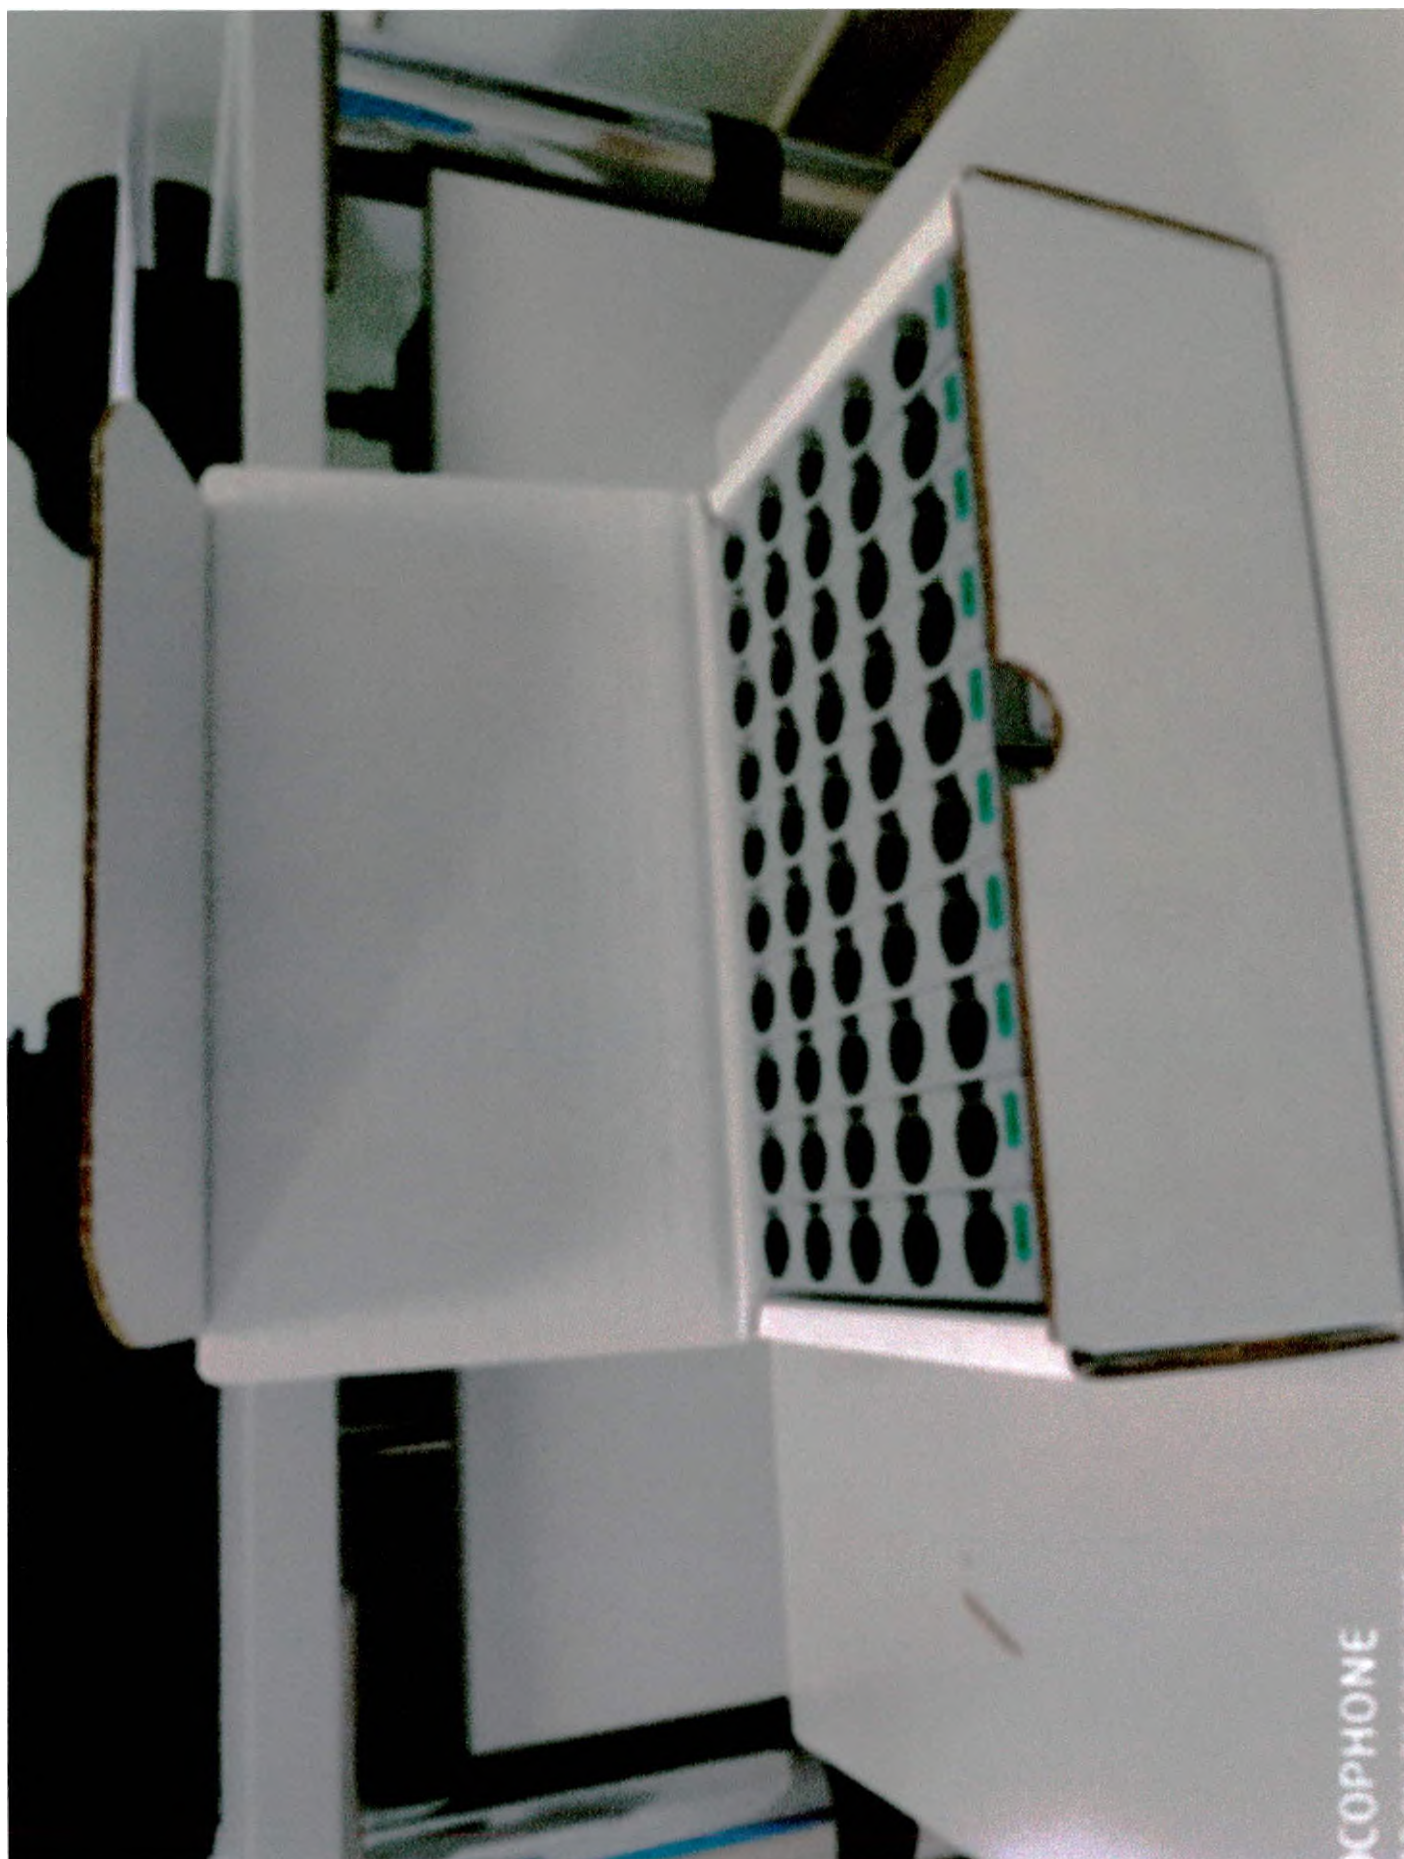


31. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M051-M060, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

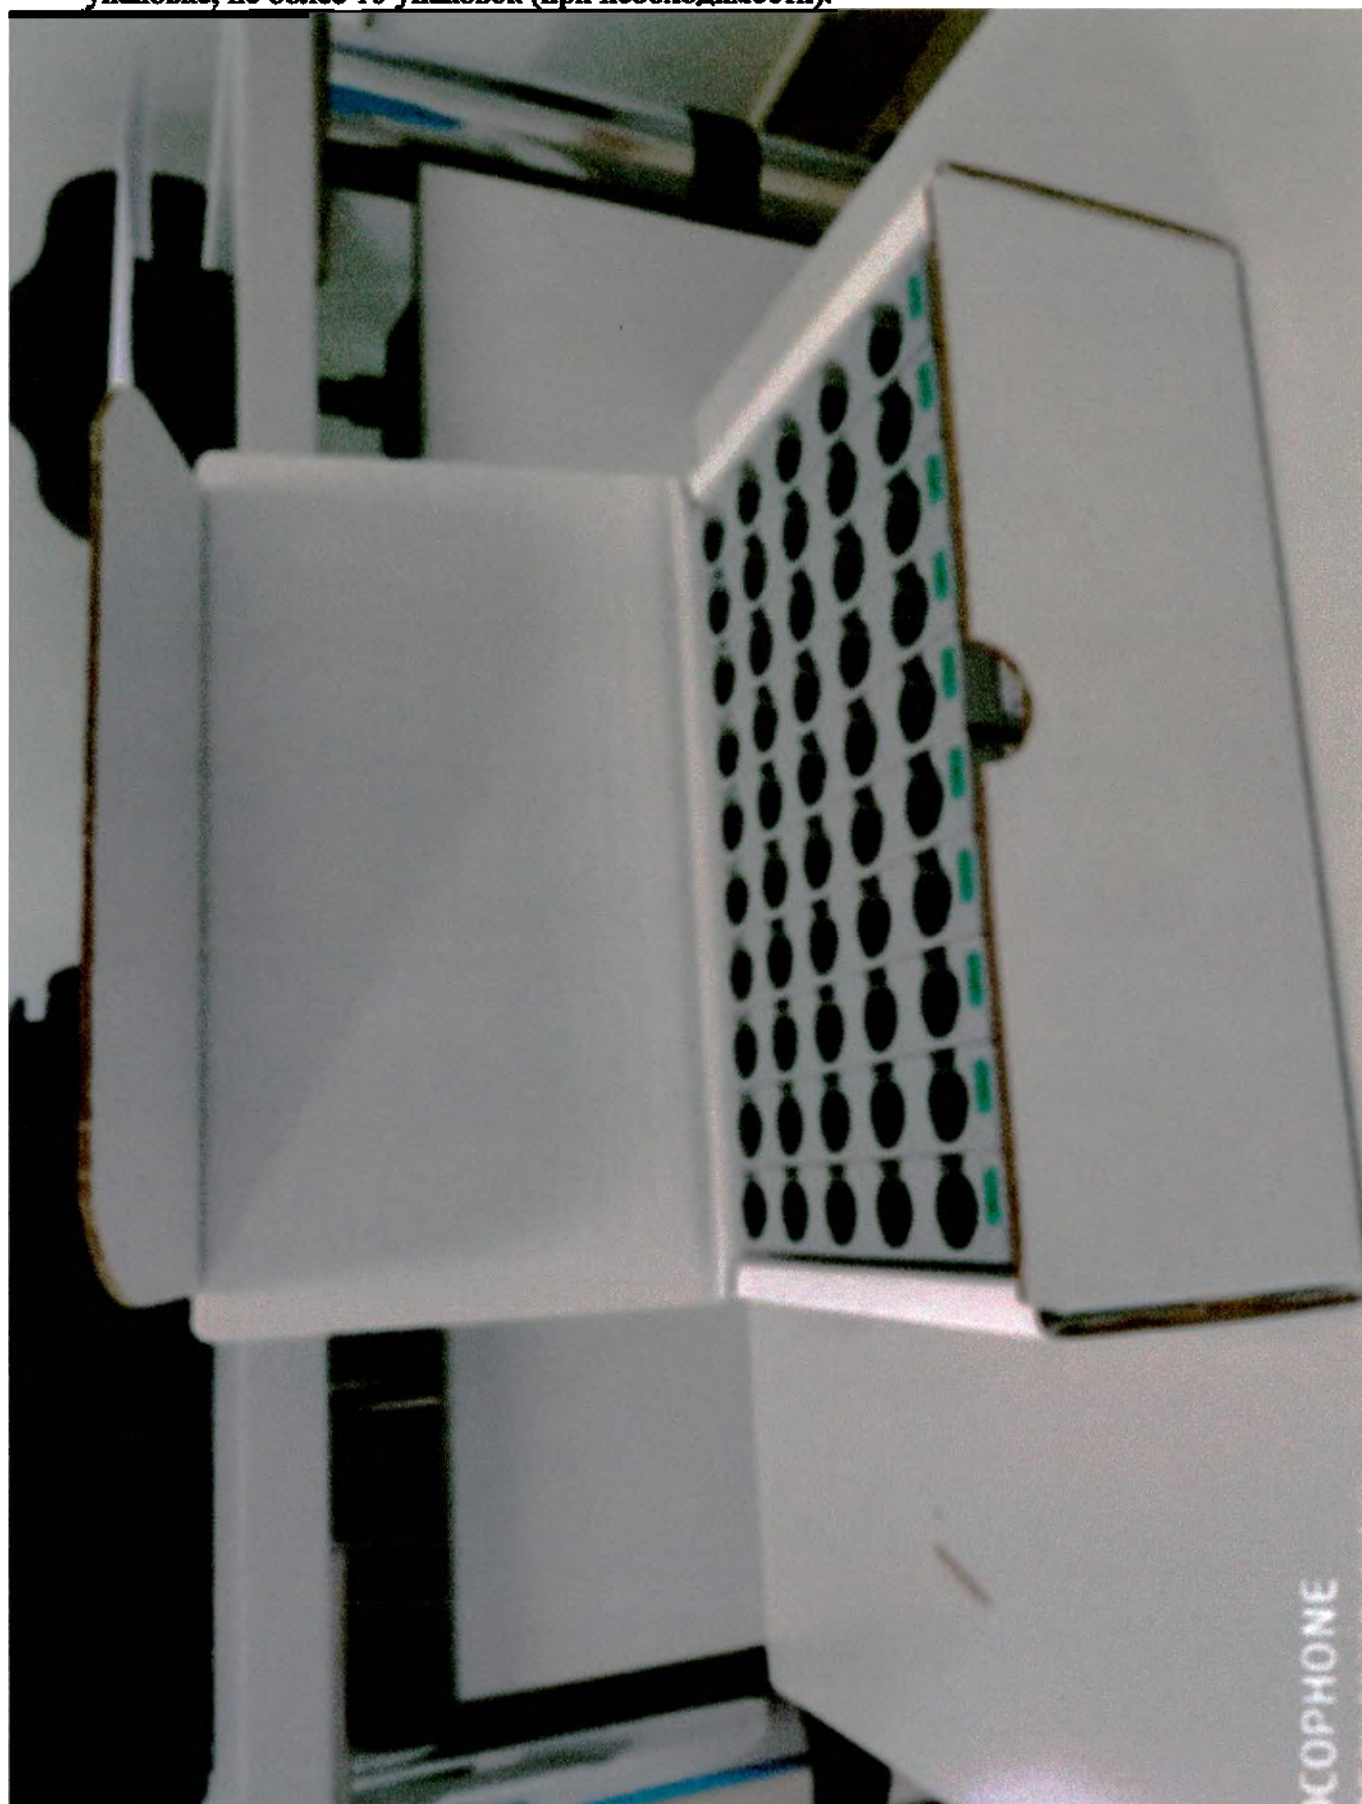


32. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M061-M070, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

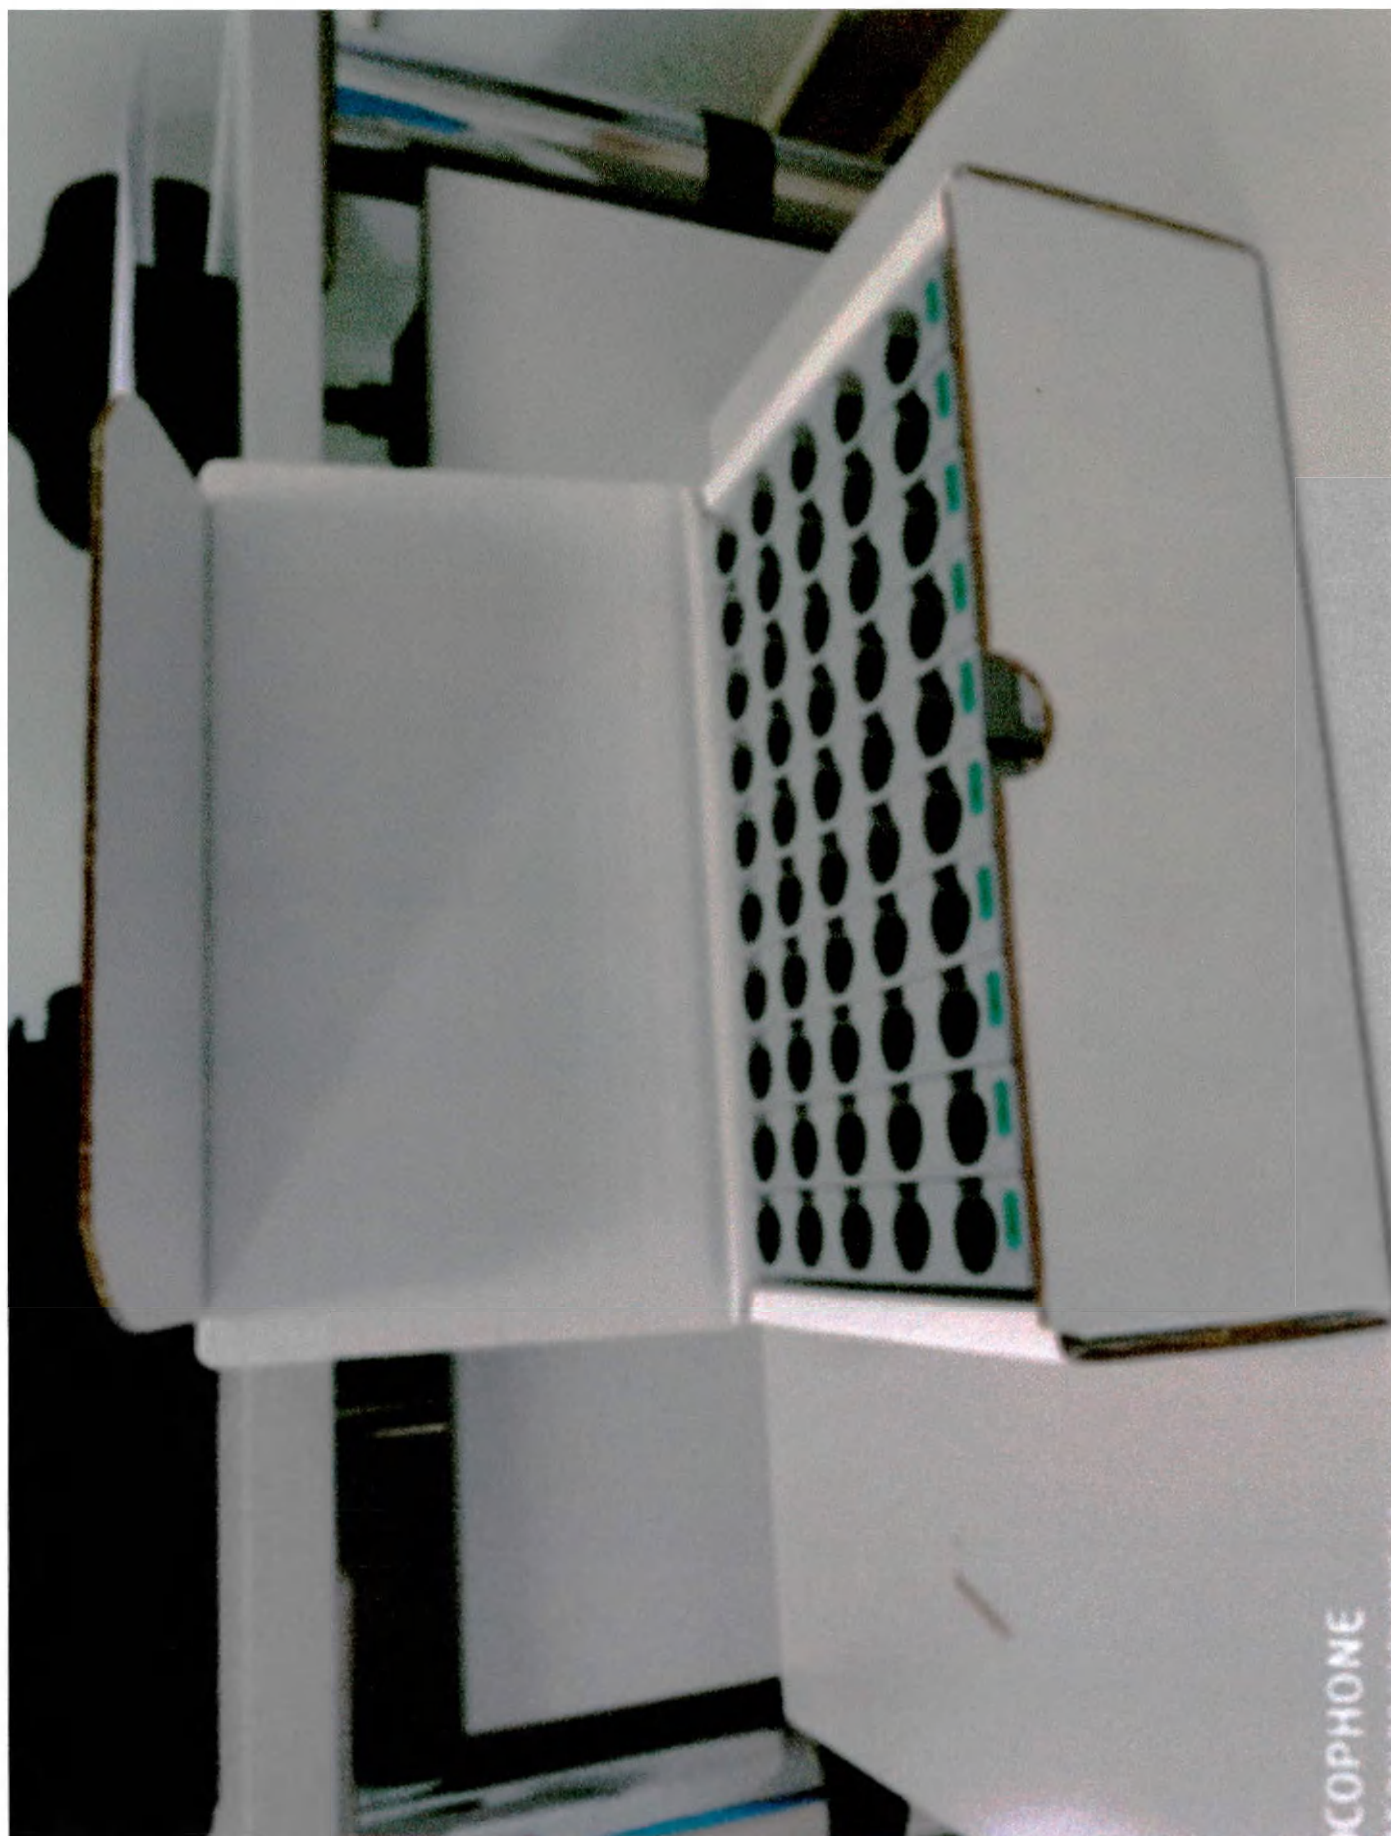


33. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M071-M080, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

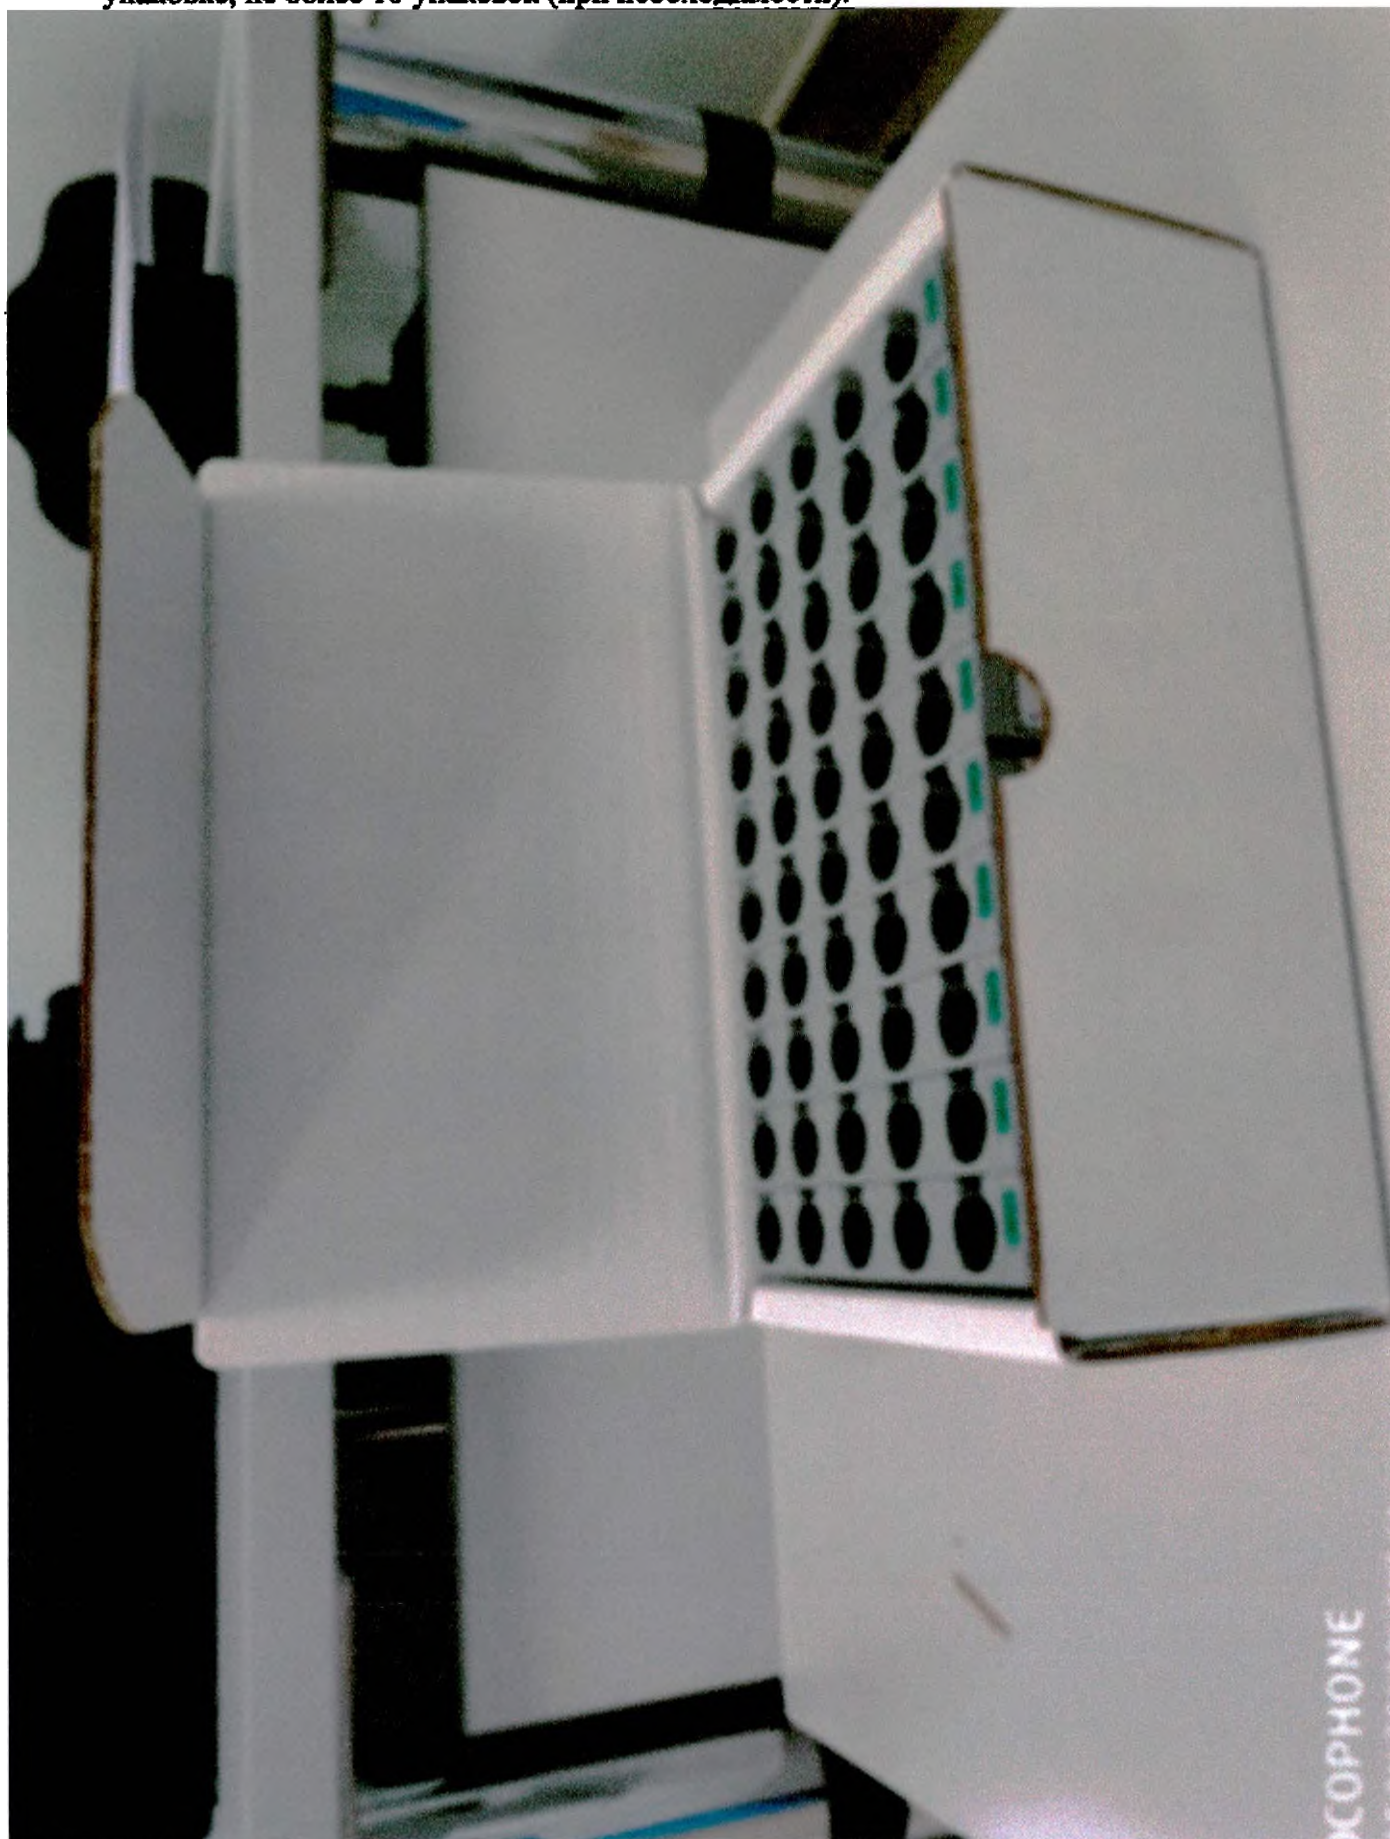


34. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M081-M090, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

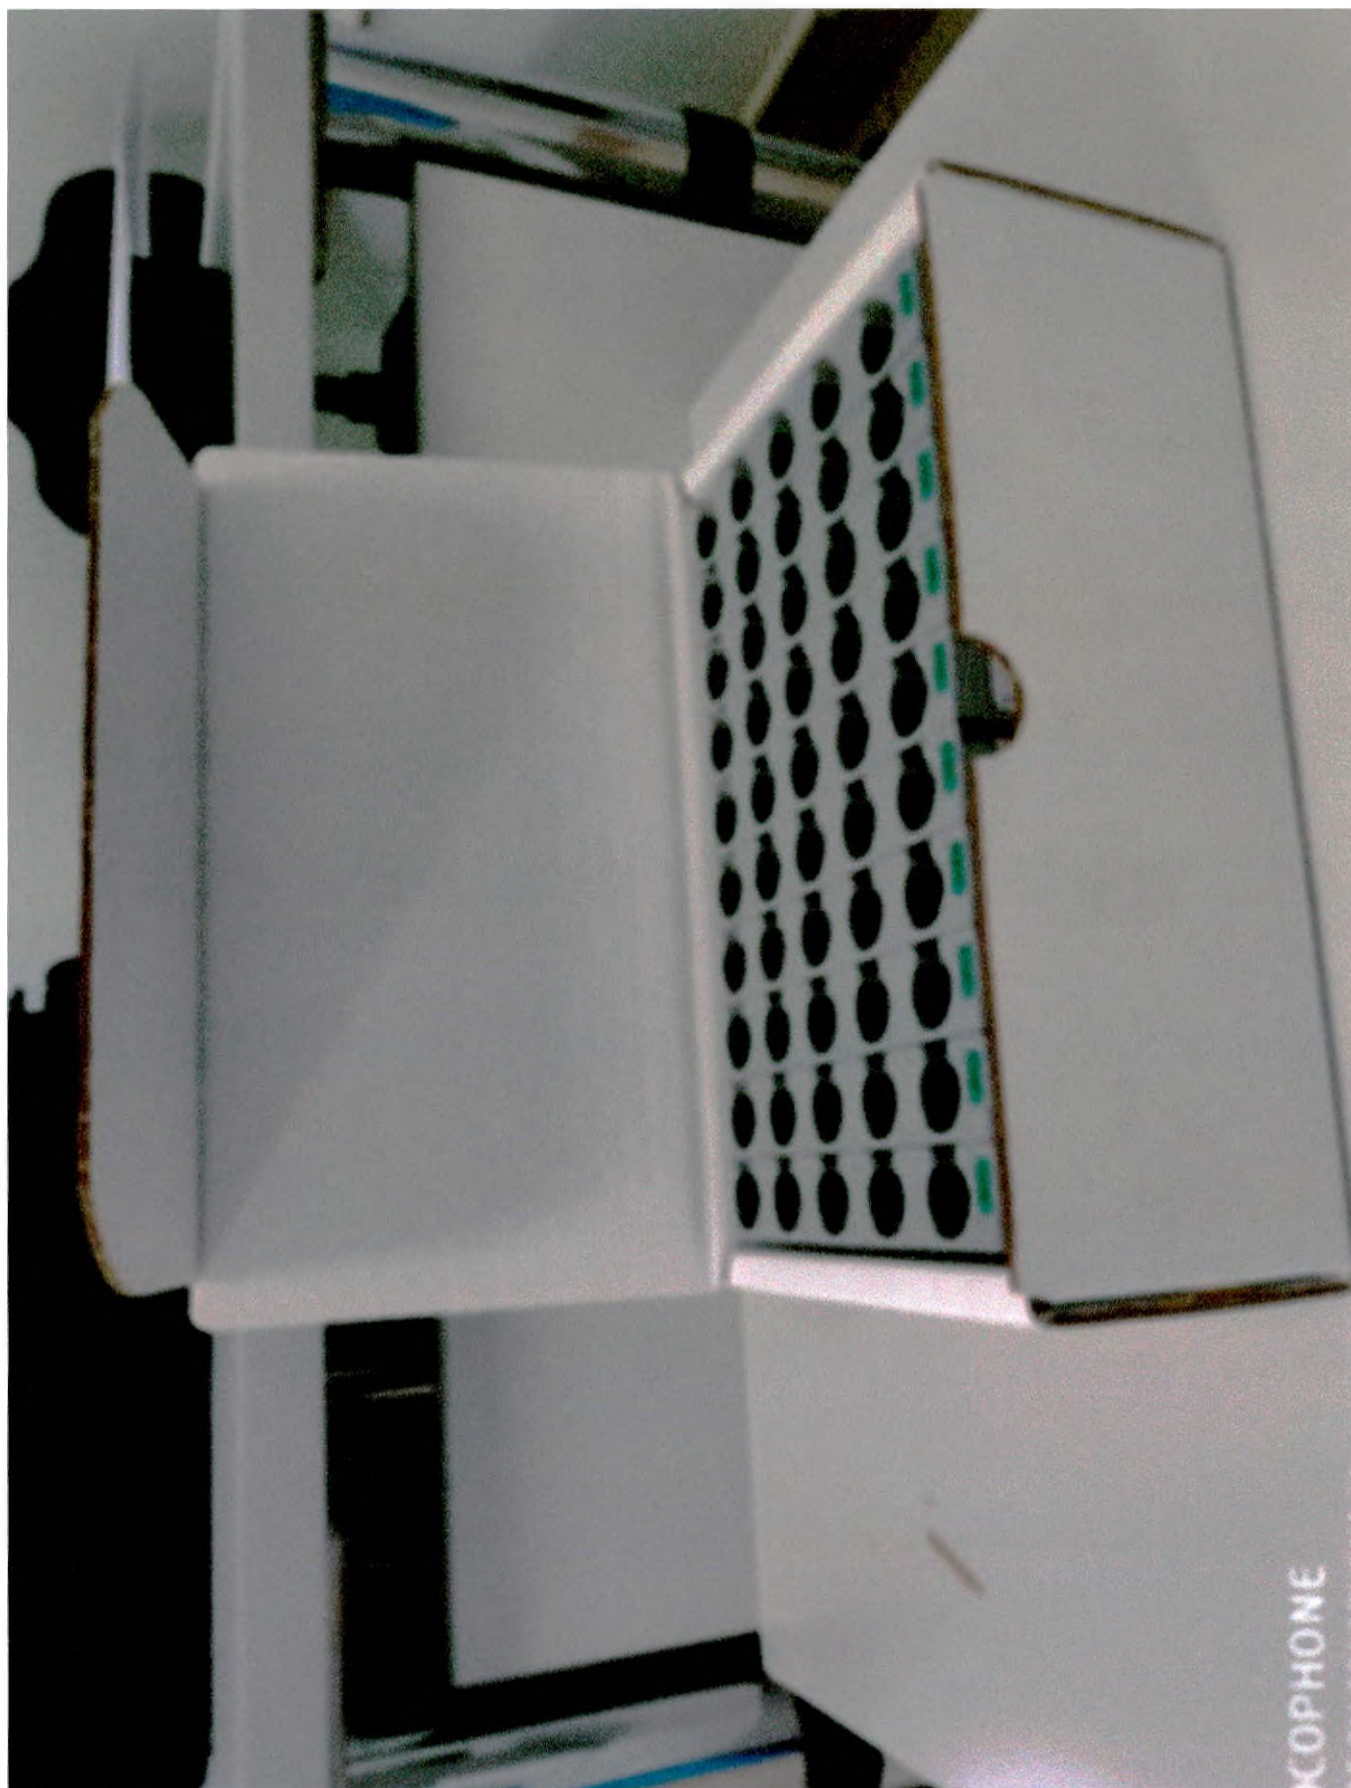


35. Набор штативов для пробирок с переходниками для гемостаза №№ M091-M100, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

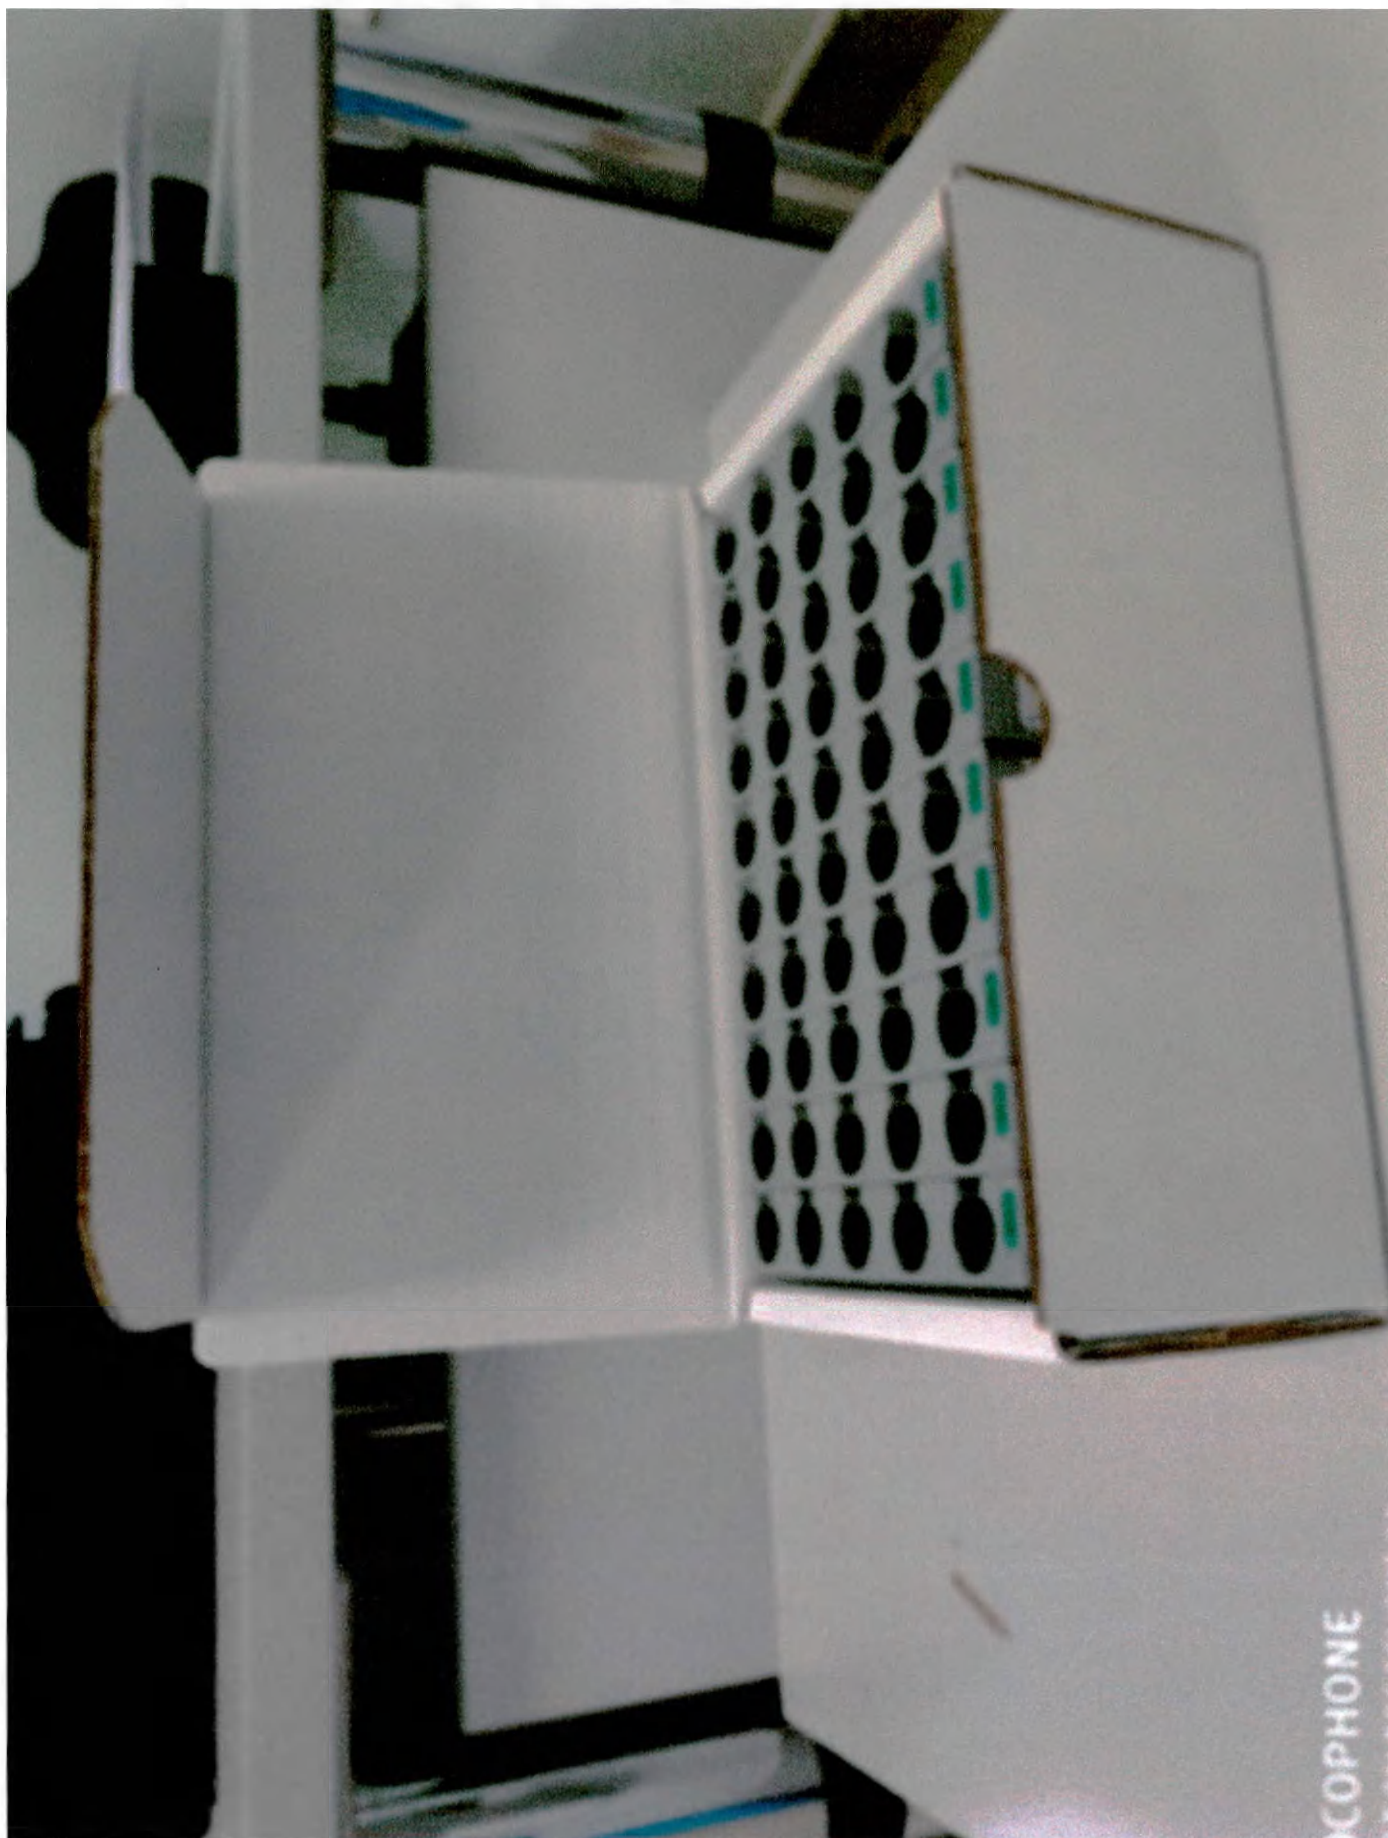


36. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0001-0050, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

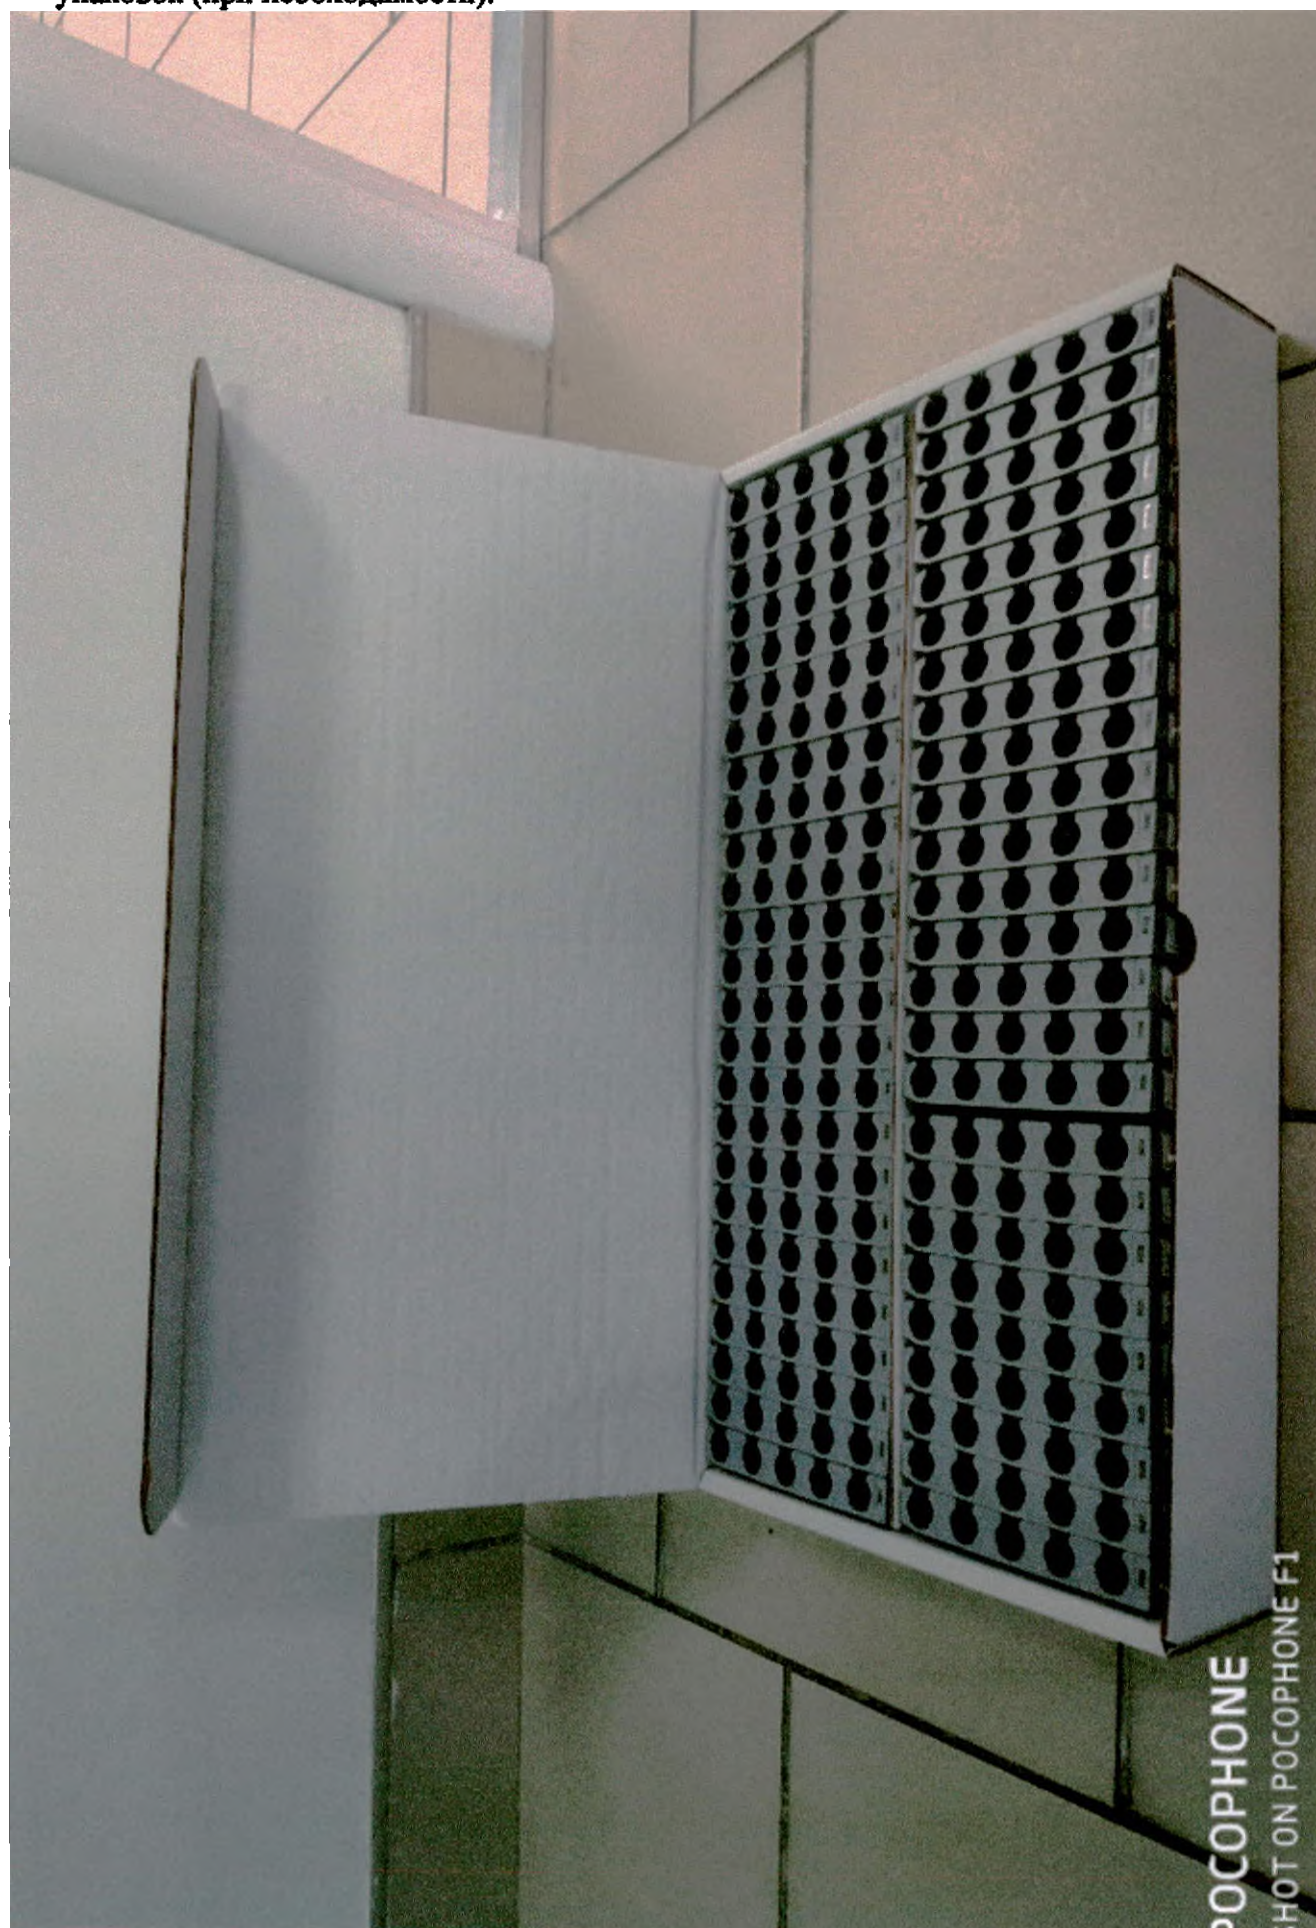


37. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0051-0100, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

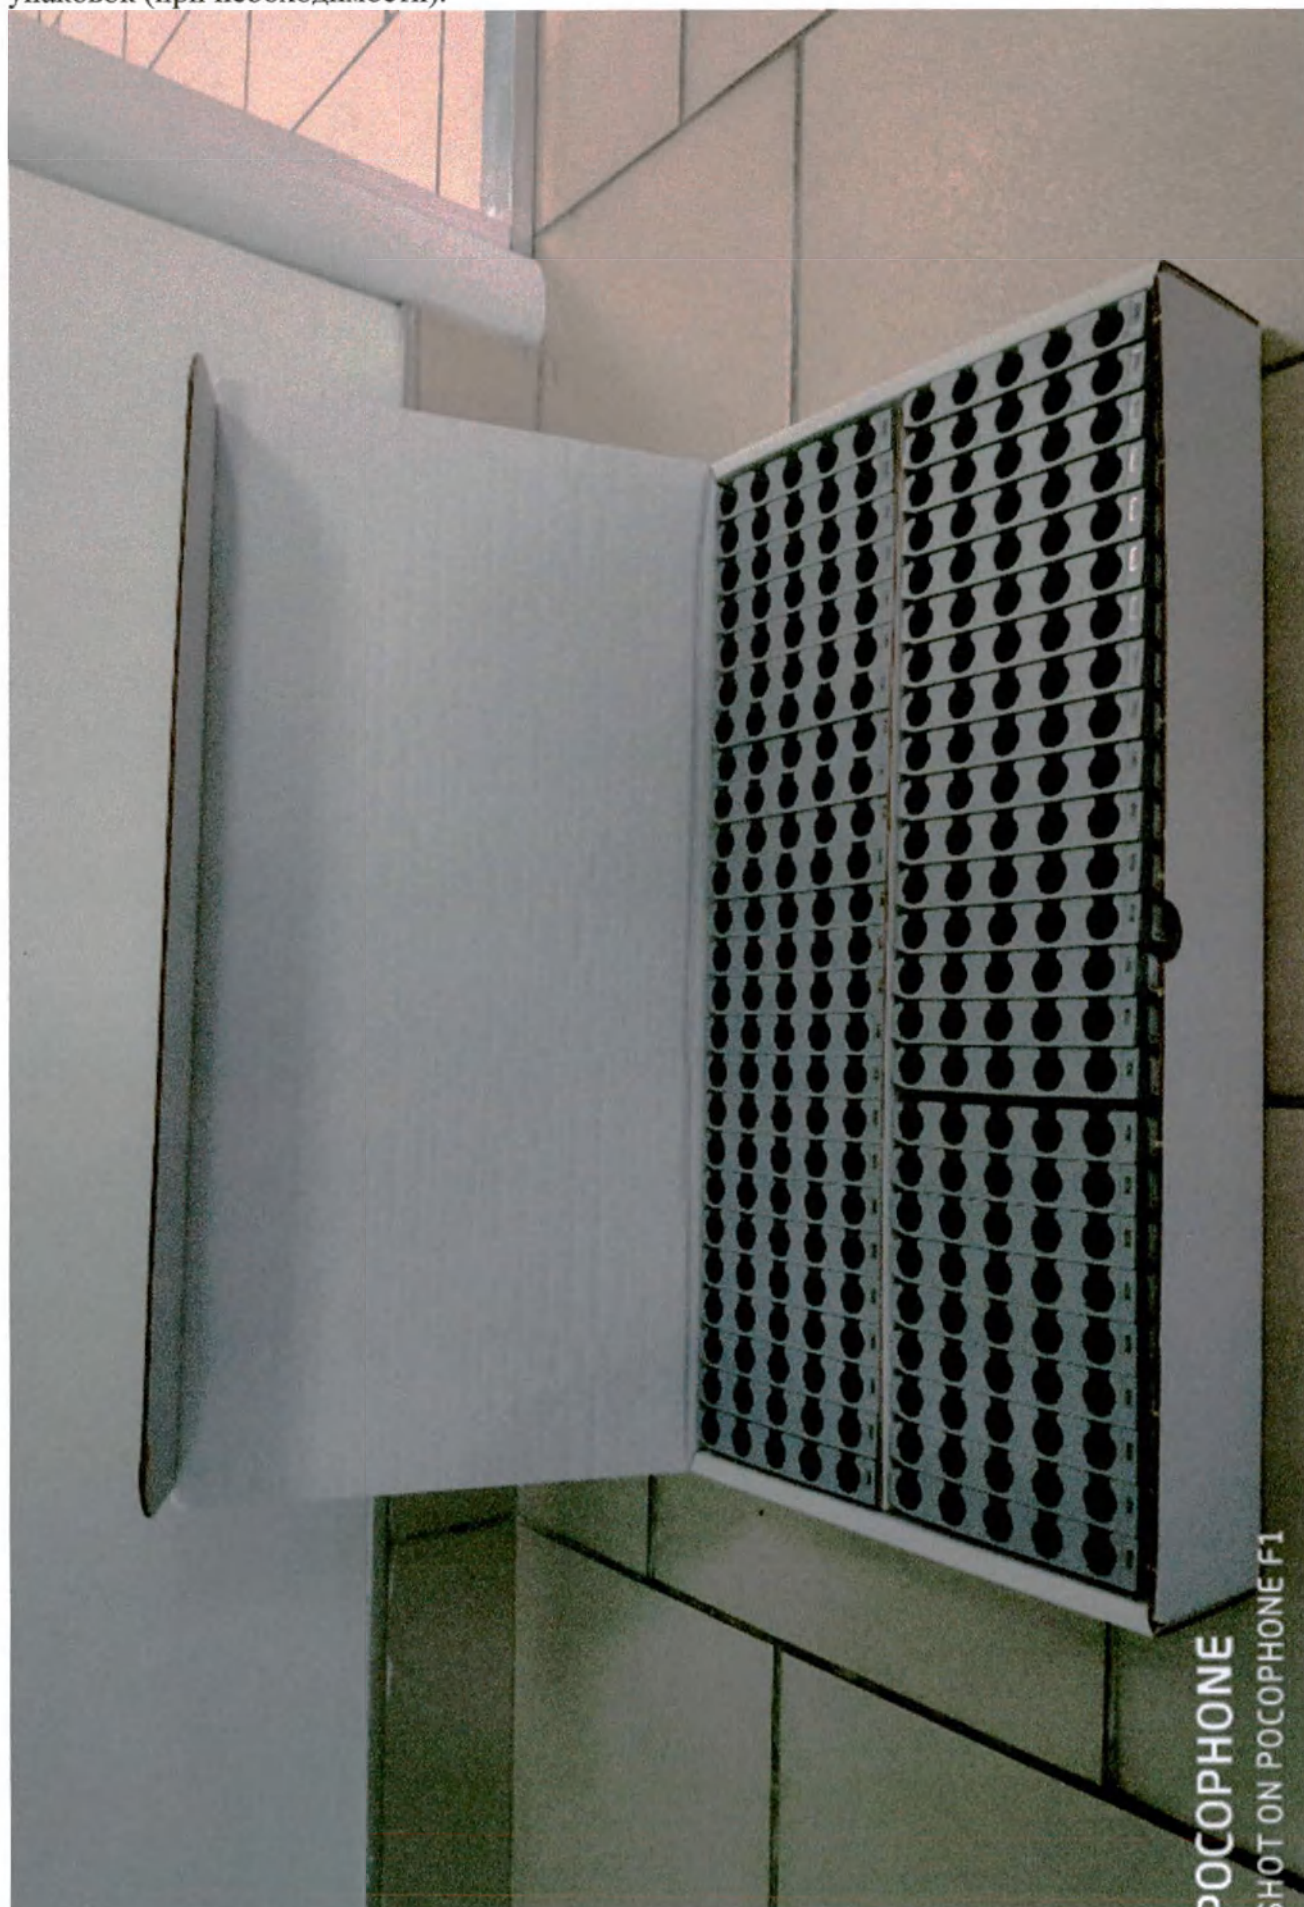


38. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0101-0150, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

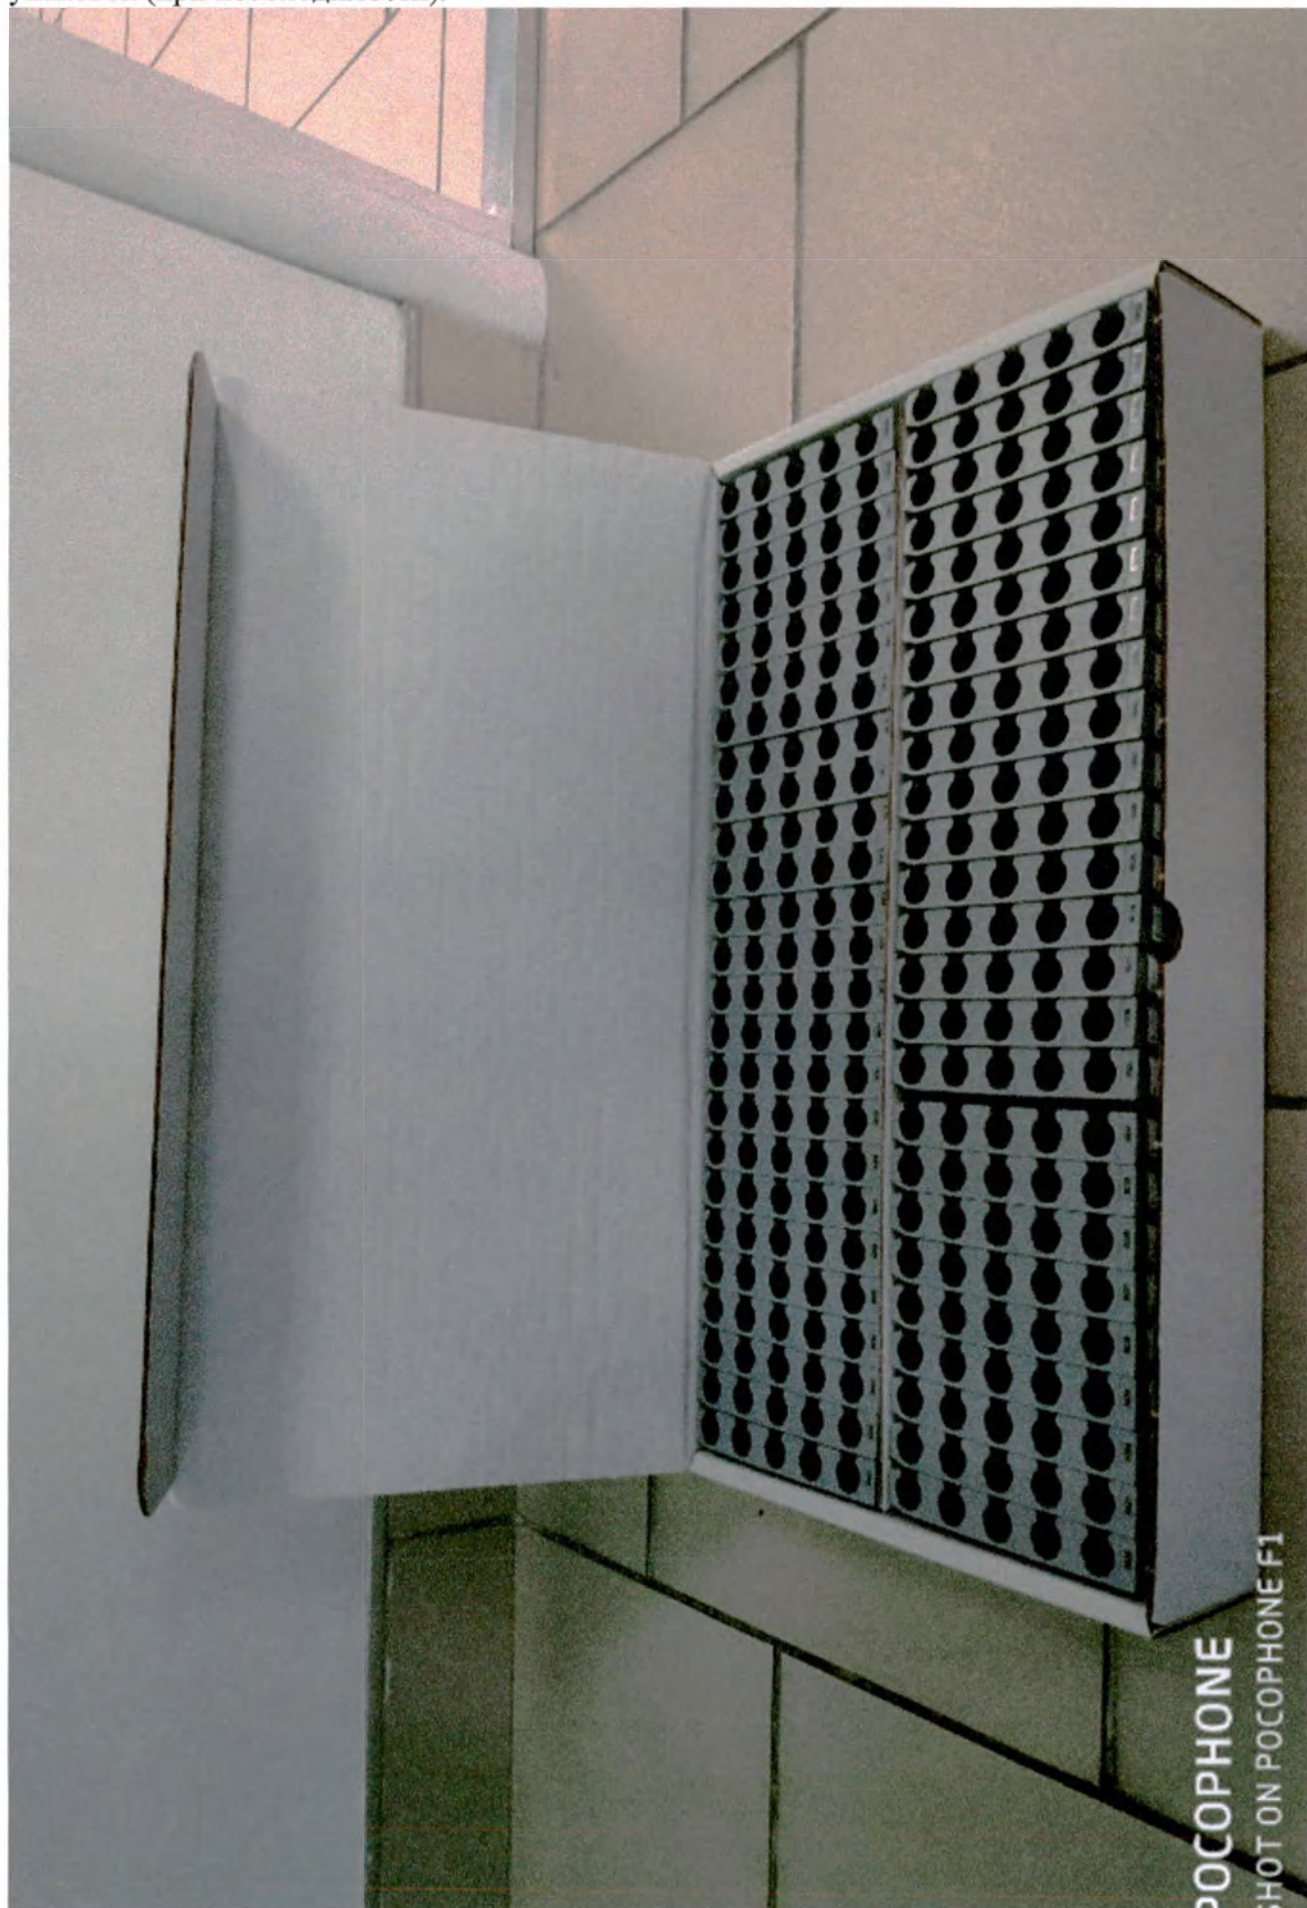

39. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0151-0200, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

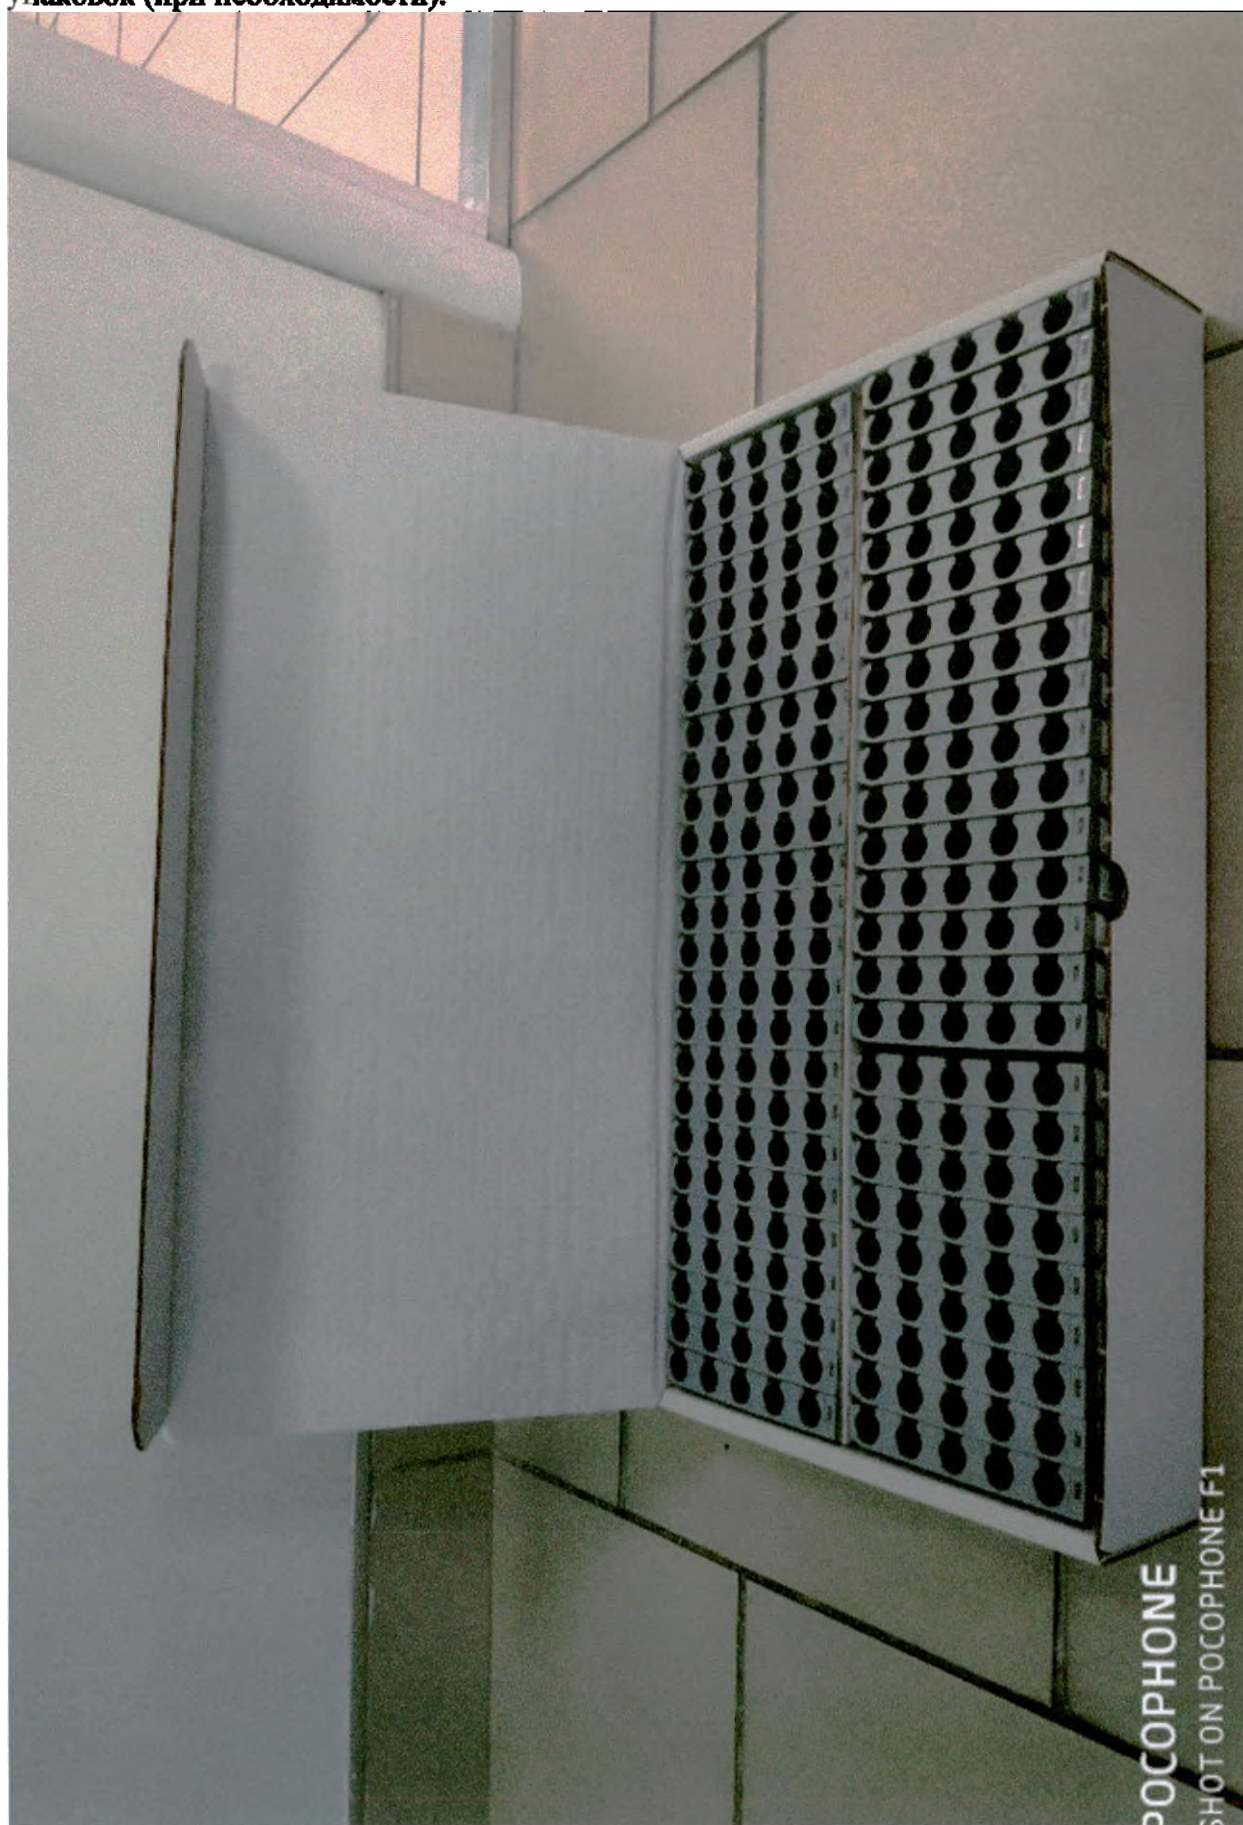

40. Набор штативов для пробирок для гемостаза №№0201-0250, 50 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

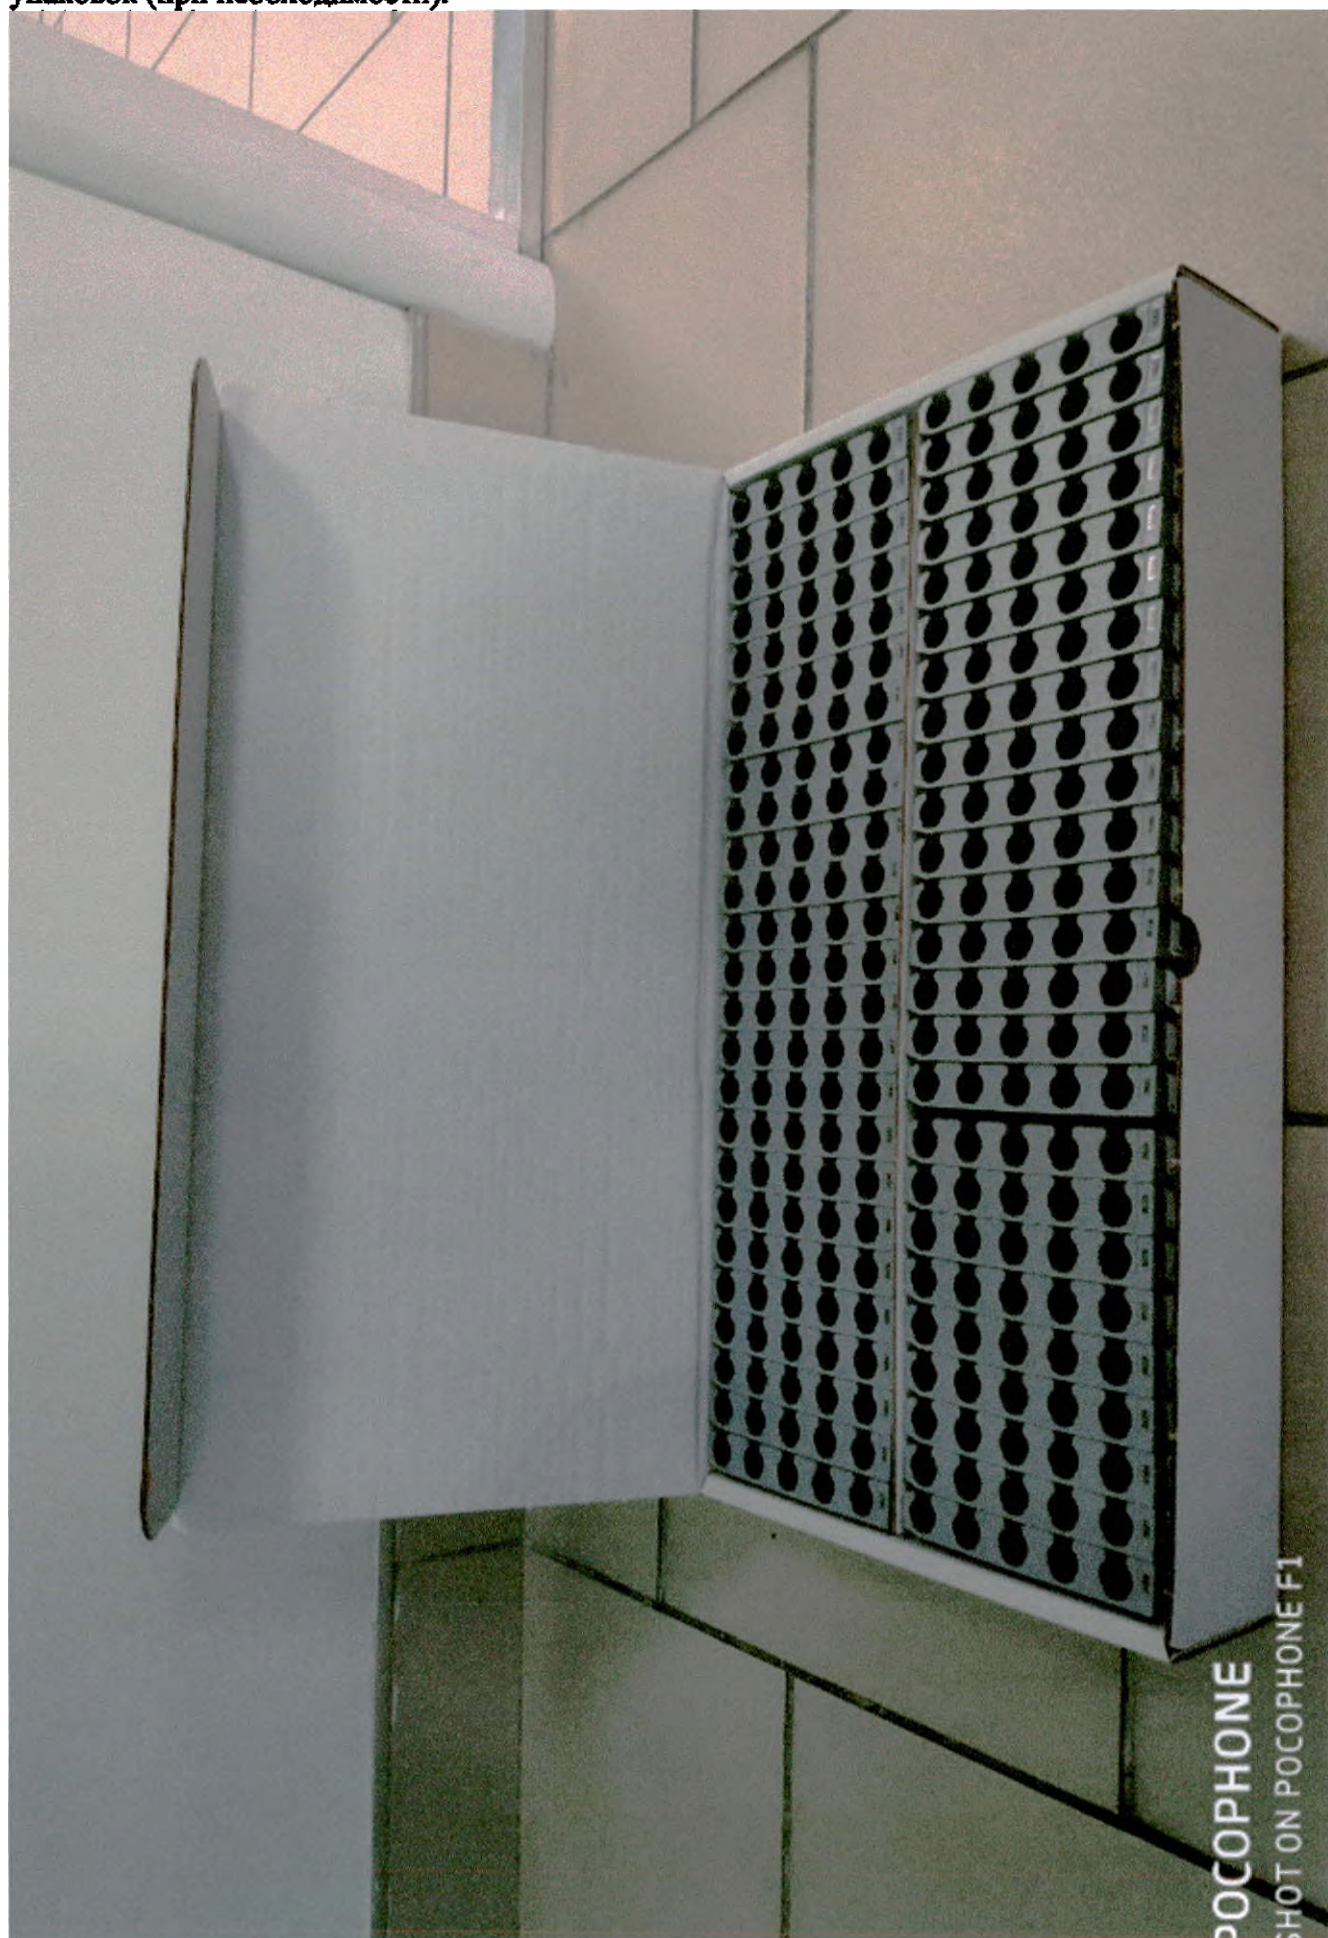

41. Набор штативов для контролей гемостаза №№Q001-Q010, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).




42. Набор штативов для контролей гемостаза №№Q011-Q020, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).




43. Набор штативов для контролей гемостаза №№Q021-Q030, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).




44. Набор штативов для калибратора для гемостаза №№С001-С010, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

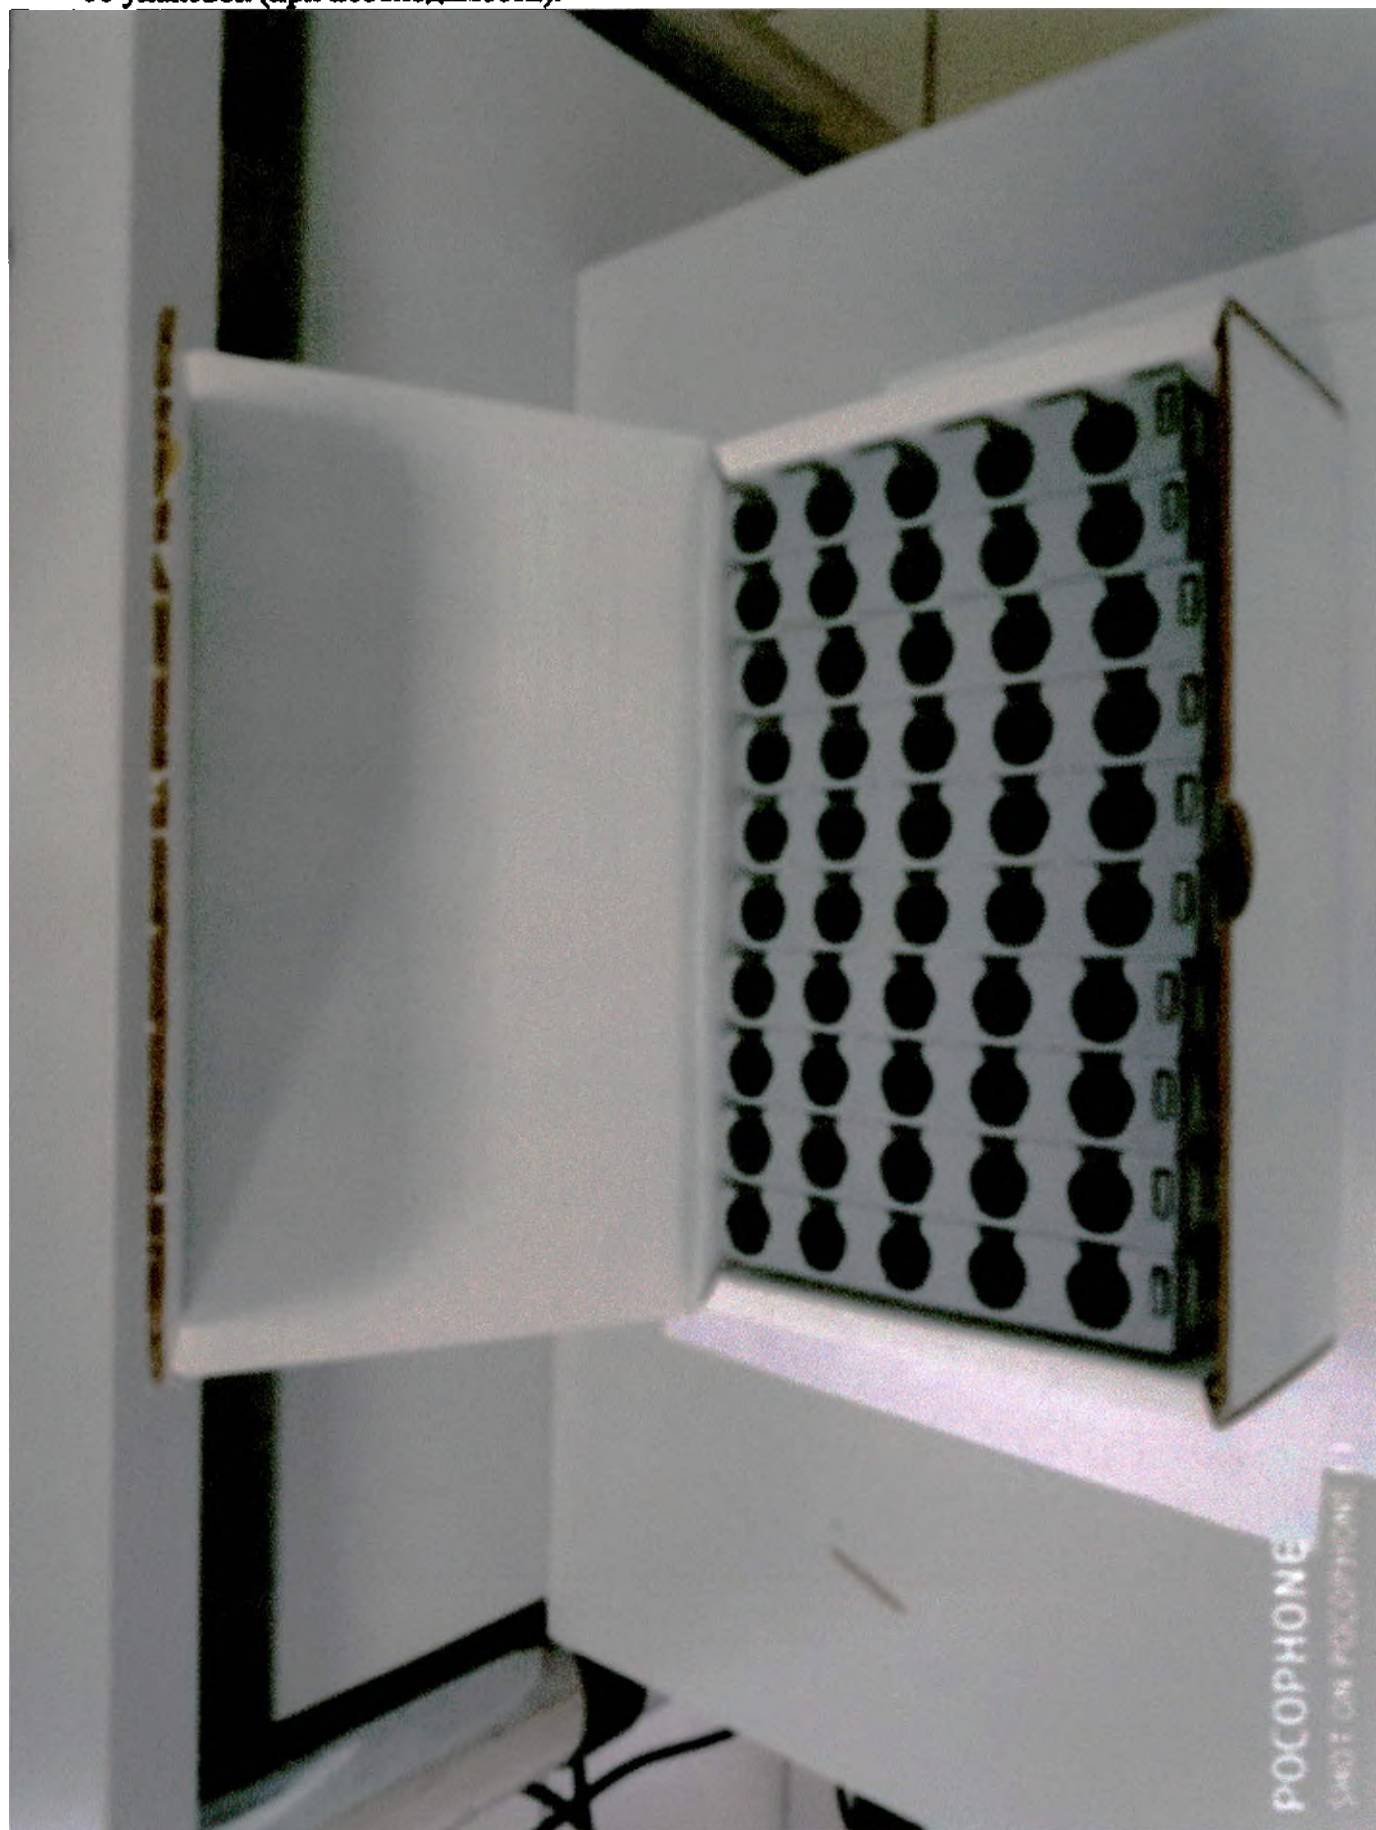

45. Набор штативов для калибратора для гемостаза №№С011-С020, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

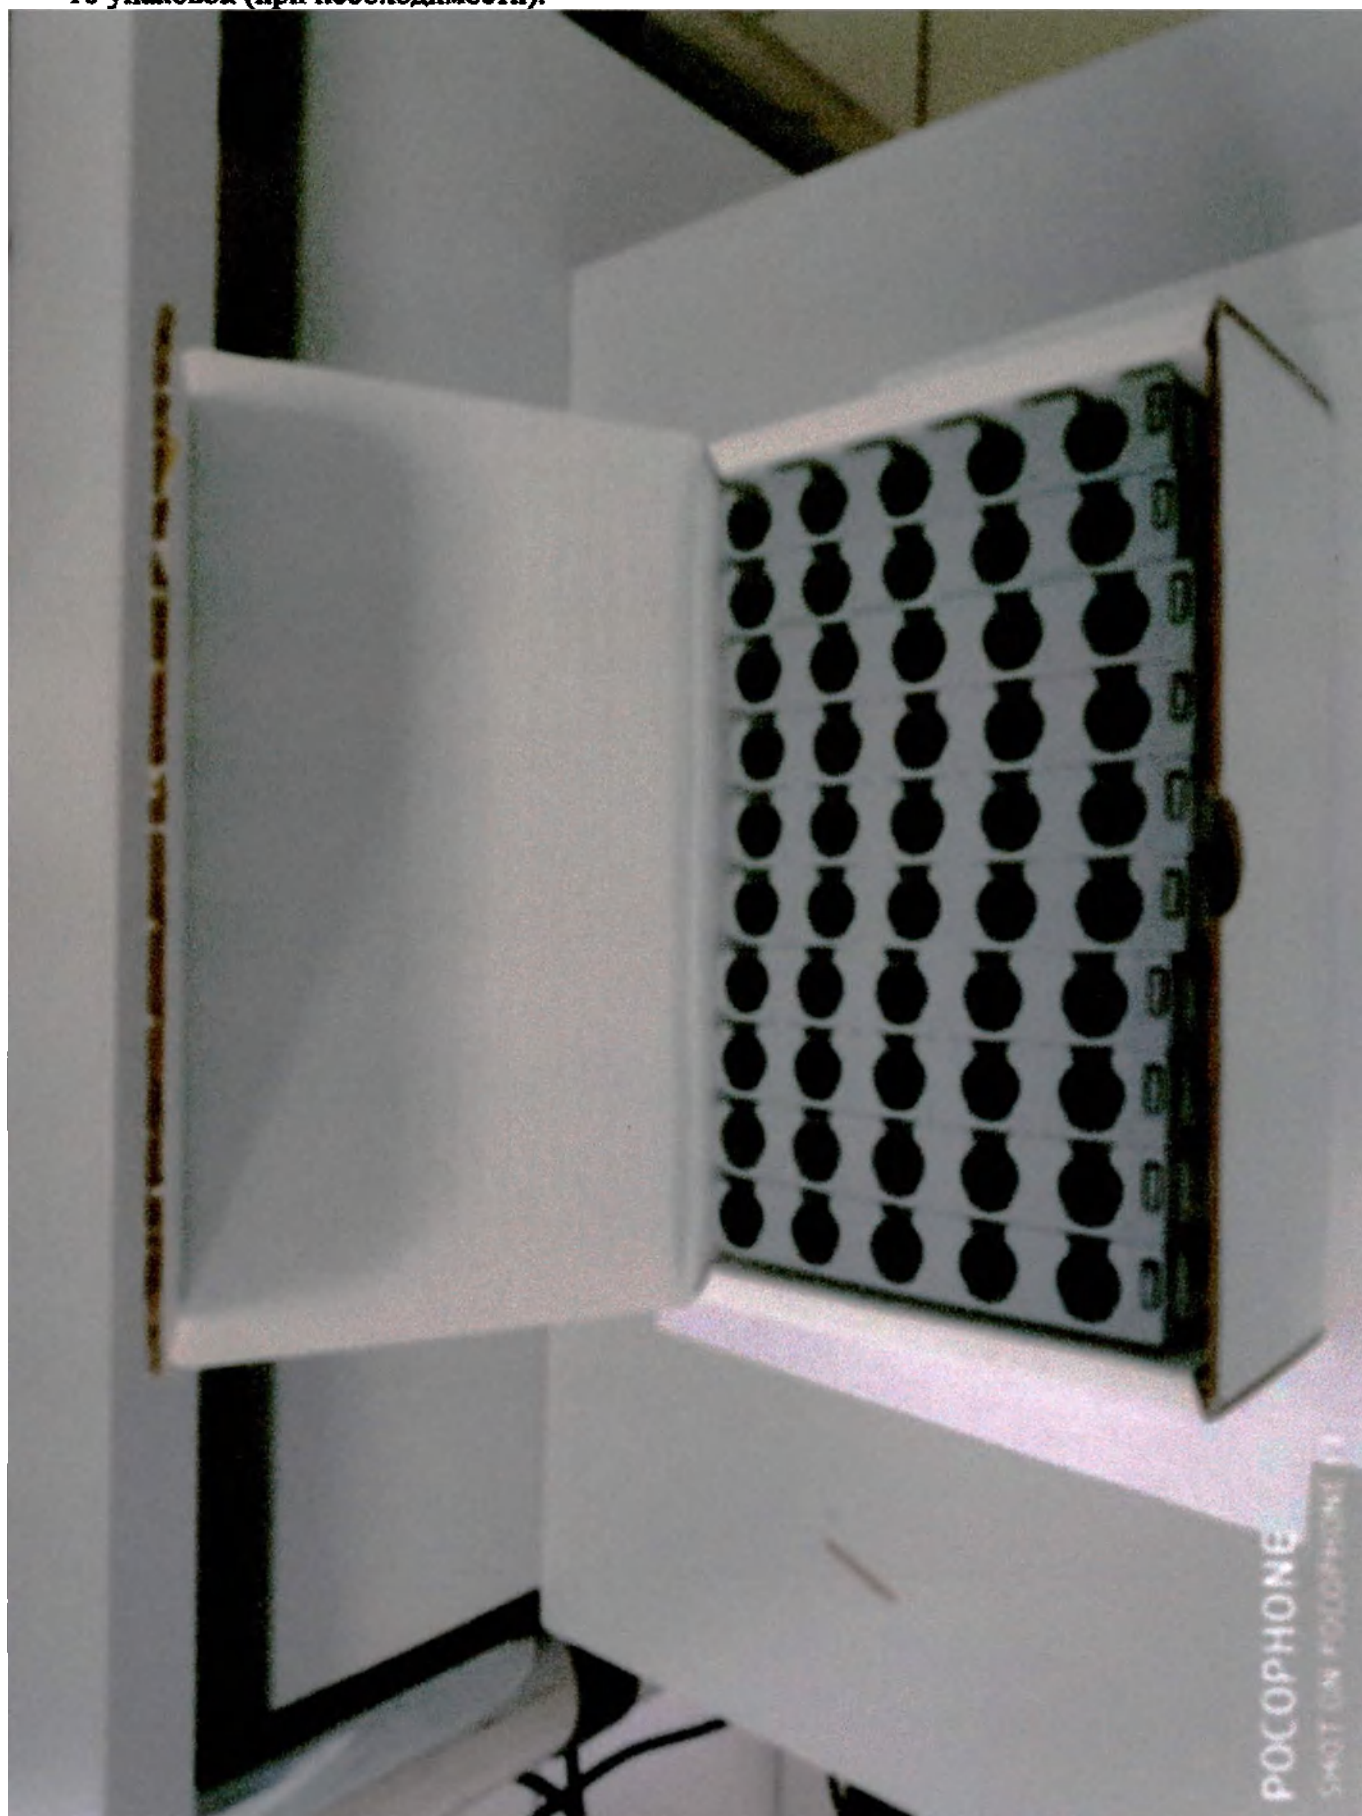

46. Набор штативов для калибратора для гемостаза №№С021-С030, 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

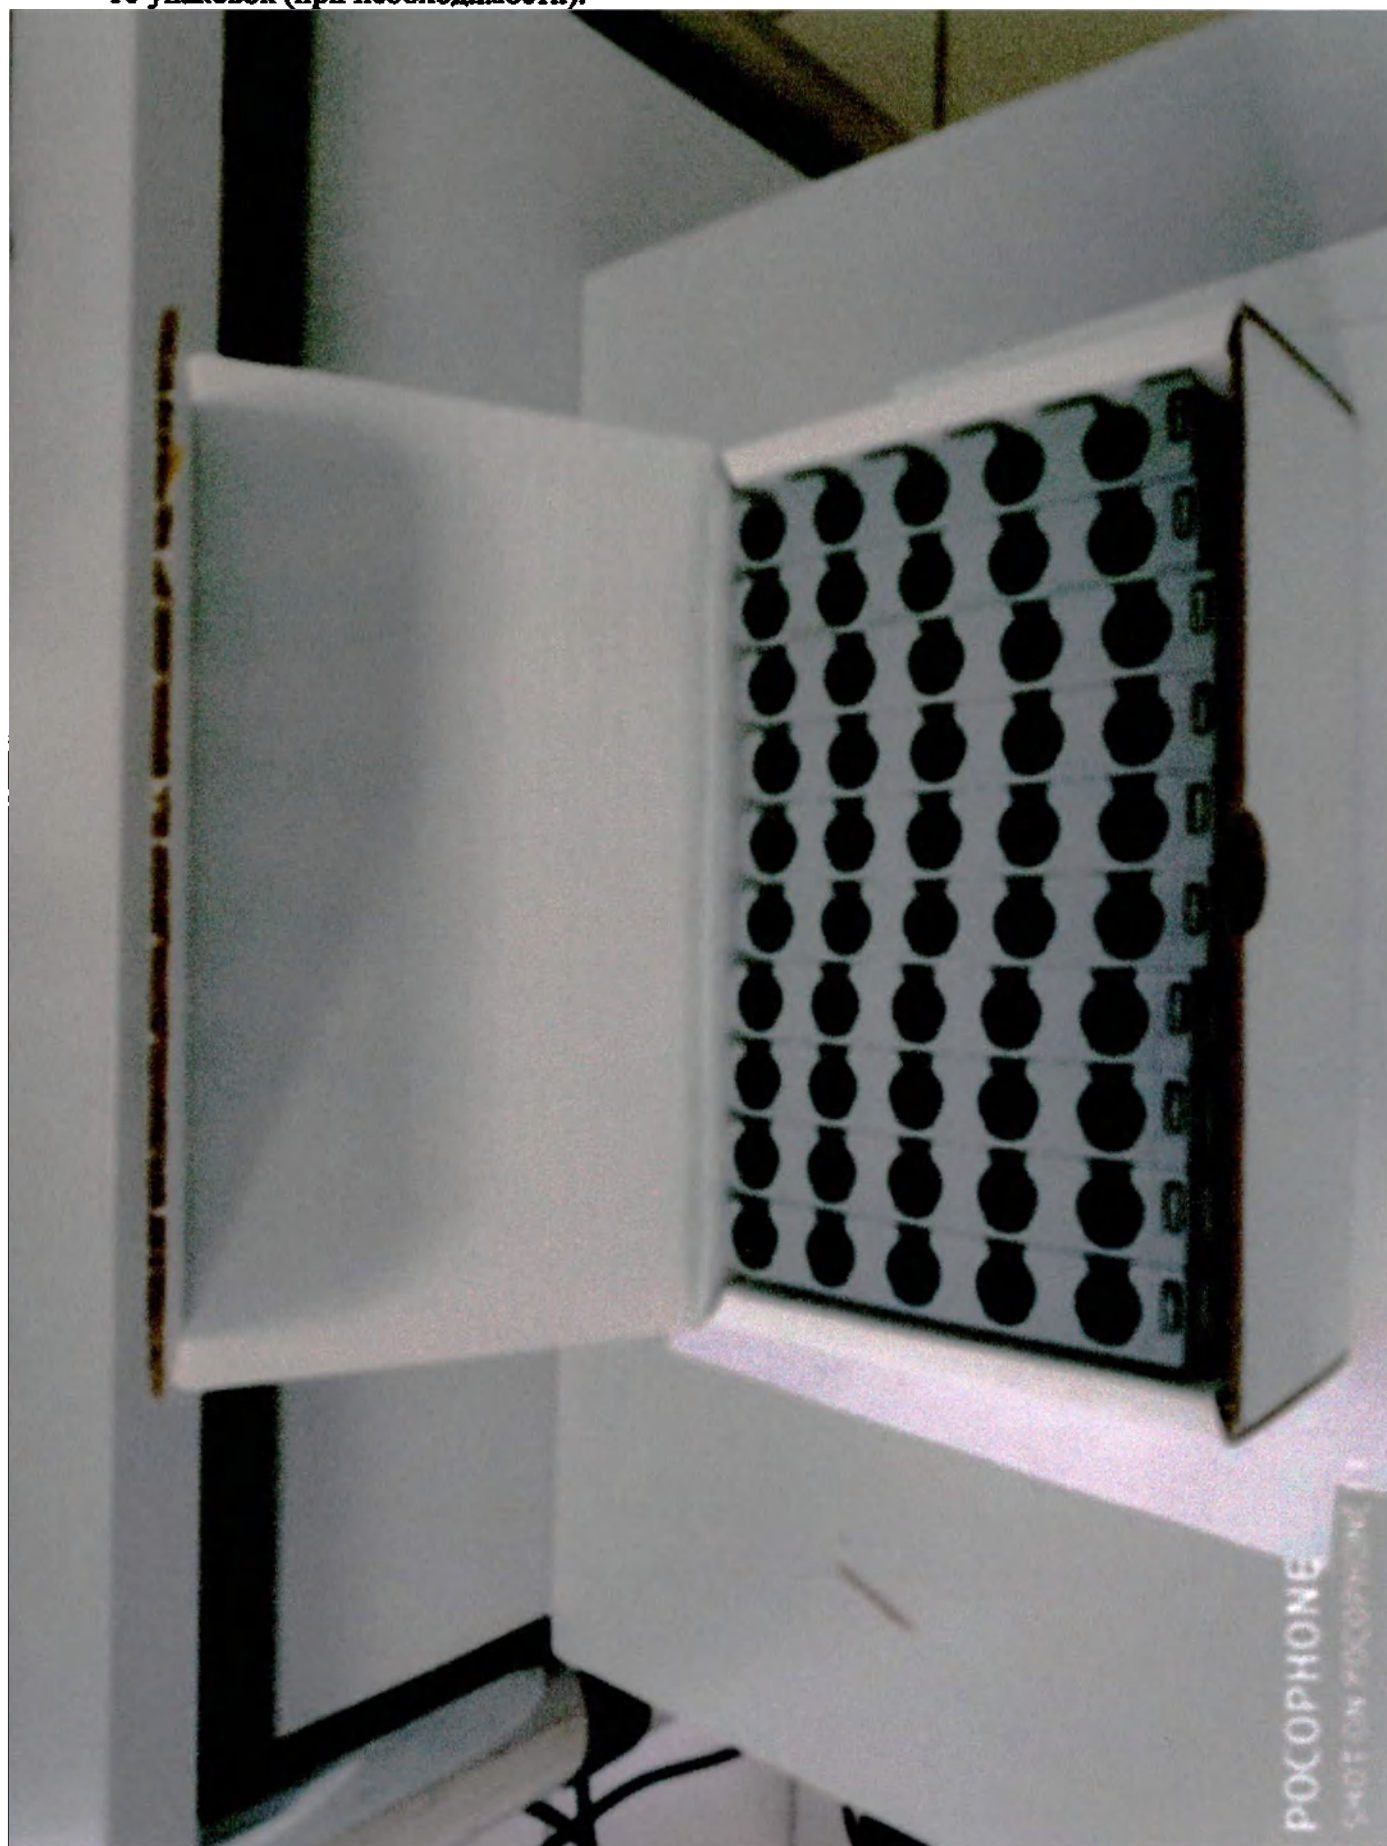

47. Модуль cobas t для соединения с автоматической линией (cobas t 711 connection module) (при необходимости).



48. Направляющая для выравнивания штативов Stago, не более 1 шт. (при необходимости).



49. Лоток для штативов для автоматической линии, не более 1 шт. (при необходимости).



50. Кассета для открытого канала, 14 шт. в упаковке, не более 1 упаковки. (при необходимости).



51. Набор флаконов sobas t для открытого канала, 50 шт. в упаковке, не более 1 упаковки. (при необходимости).



Принадлежности:

1. Поддон для штативов на 75 позиций с ручкой, не более 2 шт.



2. Контейнер пластиковый для воды 5 л, белый, не более 1 шт.



3. Контейнер пластиковый для воды 5 л, желтый, не более 1 шт.




4. Переходник для микропробирок 8 мм, 45 шт. в упаковке, не более 1 упаковки.



5. Поршень шприца 100 мкл, не более 1 шт.



6. Поршень шприца 250 мкл, не более 1 шт.

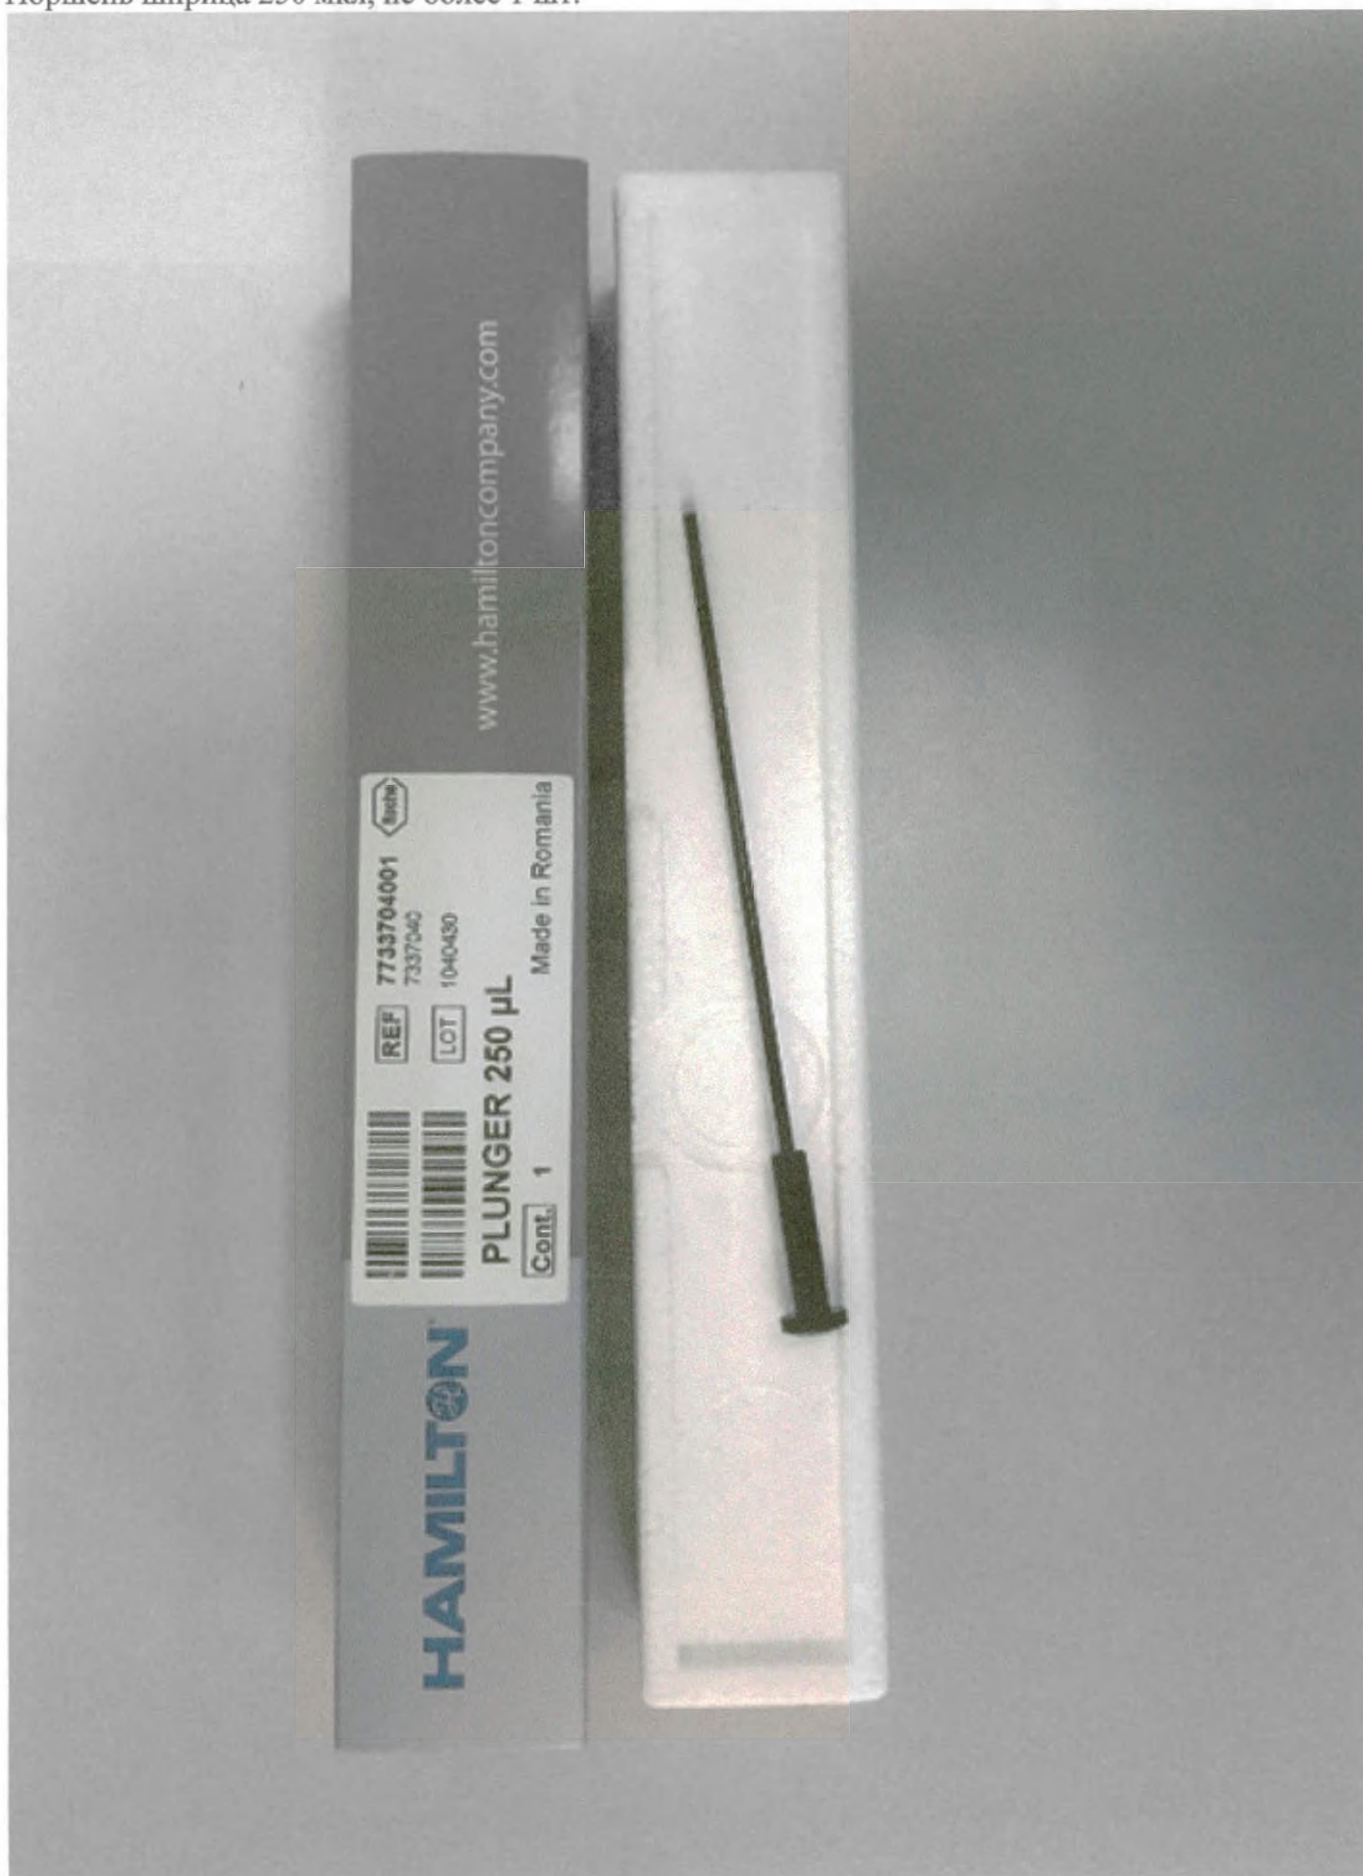

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)



02.02.2022 г.

Кочнев С.