

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева

2023 г.



Фотографические изображения

«Компонент вертлужный эндопротеза тазобедренного сустава G7»

Производства:

«Биомет Ортопедикс», США (Biomet Orthopedics), 56 East Bell Drive, P.O. Box 587, Warsaw, Indiana 46581, USA



Рис. 1. Компонент вертлужный G7 PPS бесцементный, 3 отверстия, размер 68 мм I.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 PPS бесцементный, 3 отверстия, размеры: 42 мм A, 44 мм A, 46 мм B, 48 мм C, 50 мм D, 52 мм E, 54 мм F, 56 мм F, 58 мм G, 60 мм G, 62 мм H, 64 мм H, 66 мм I, 68 мм I



Рис. 2. Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster бесцементный, 3 отверстия, размер 42 мм А.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster бесцементный, 3 отверстия,

размеры: 42 мм А, 44 мм А, 46 мм В, 48 мм С, 50 мм D, 52 мм Е, 54 мм F, 56 мм F, 58 мм G, 60 мм G, 62 мм H, 64 мм H, 66 мм I, 68 мм I



Рис. 3. Компонент вертлужный G7 OsseoTi бесцементный, 3 отверстия, размер 42 мм А.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 OsseoTi бесцементный, 3 отверстия, размеры: 42 мм А, 44 мм А, 46 мм В, 48 мм С, 50 мм D, 52 мм Е



Рис. 4. Компонент вертлужный G7 OsseoTi бесцементный, 4 отверстия, размер 54 мм F.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 OsseoTi бесцементный, 4 отверстия, размеры: 54 мм F, 56 мм F, 58 мм G, 60 мм G, 62 мм H, 64 мм H, 66 мм I, 68 мм I

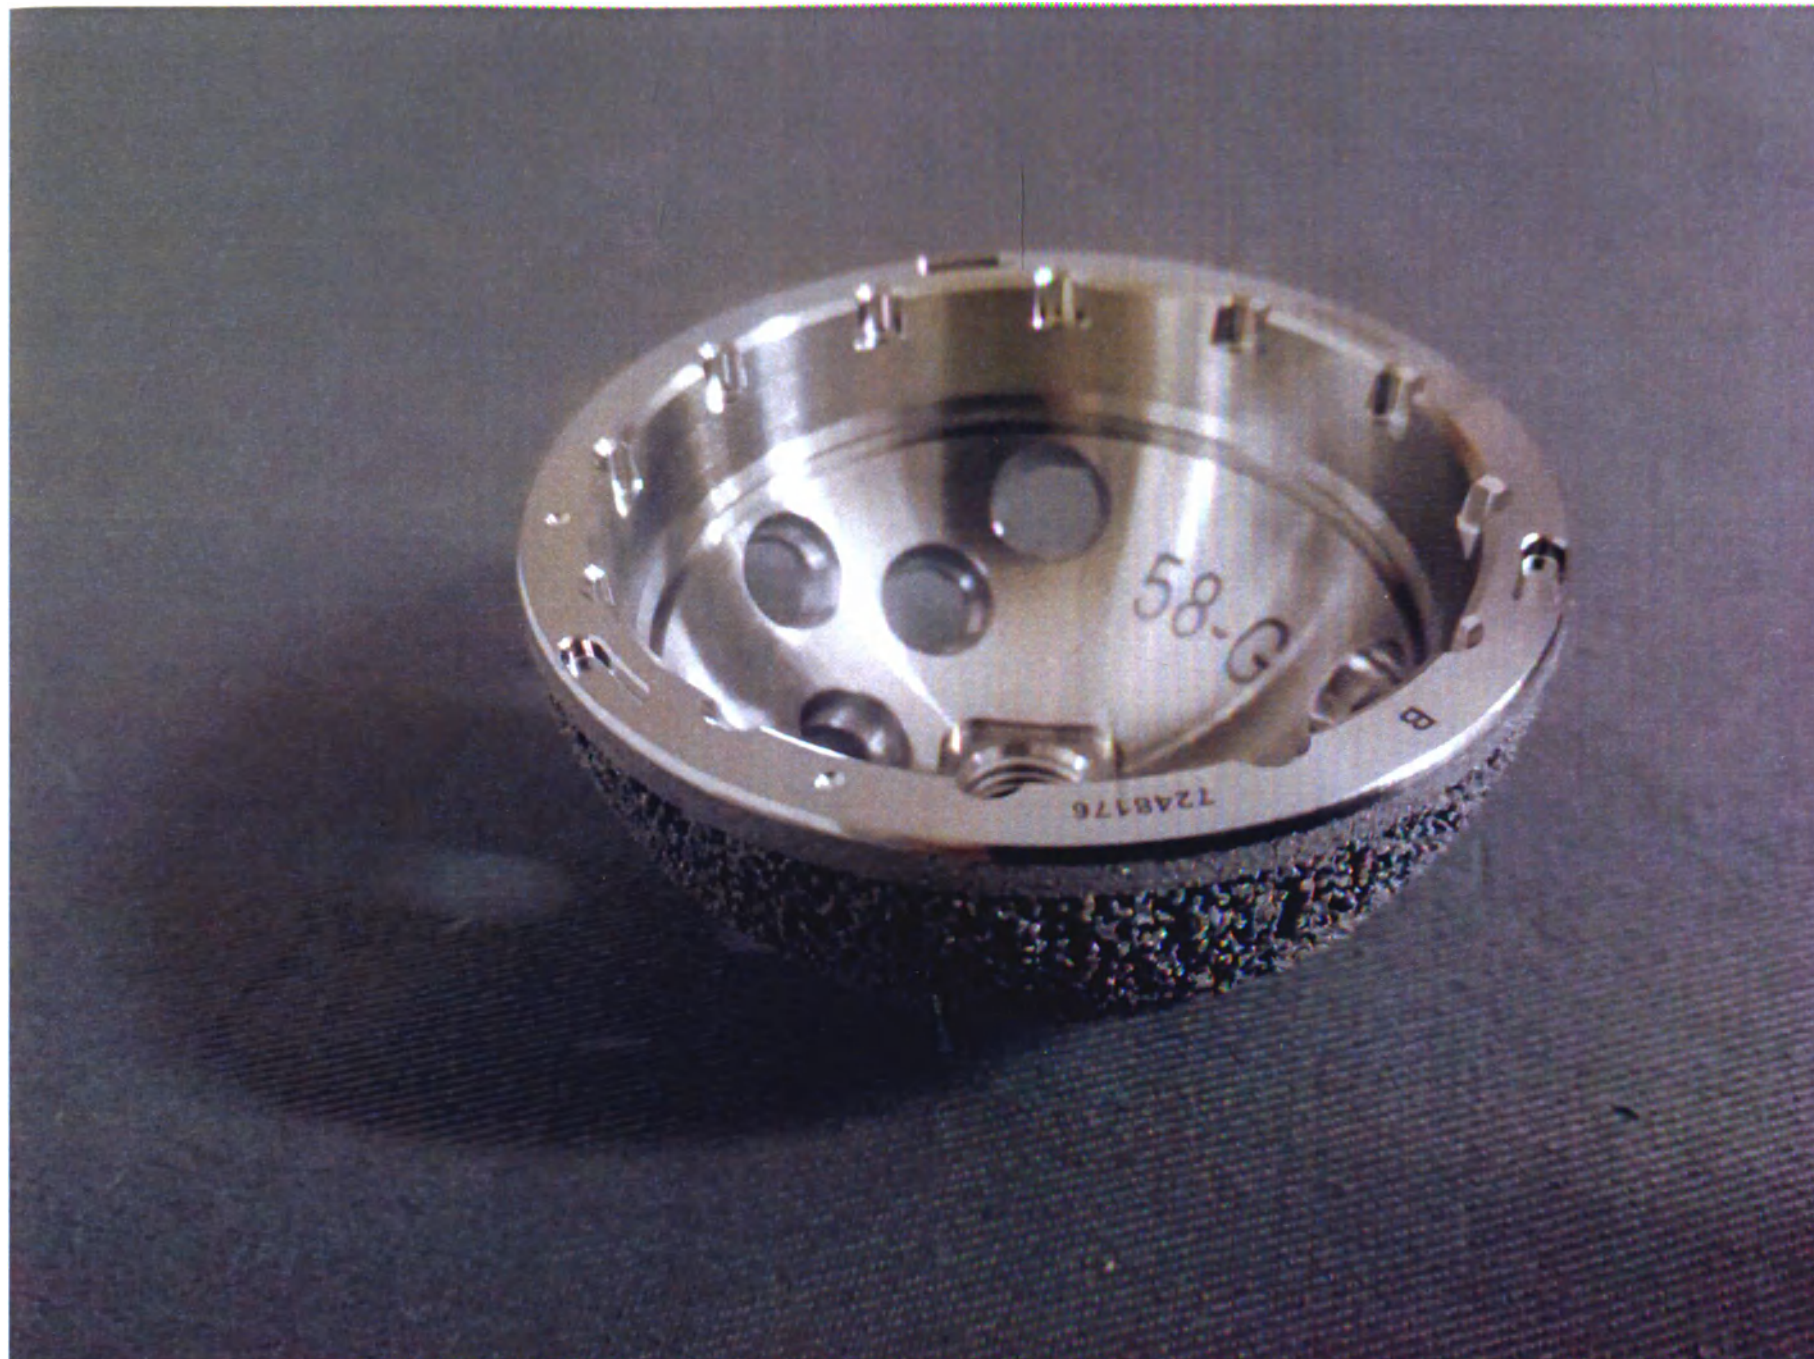


Рис. 5. Компонент вертлужный G7 OsseoTi бесцементный, многодырчатый, размер 58мм G. Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 OsseoTi бесцементный, многодырчатый, размеры: 42мм А, 44мм А, 46мм В, 48мм С, 50мм D, 52мм Е, 54мм Е, 56мм F, 58мм G, 60мм G, 62мм H, 64мм H, 66мм I, 68мм I, 70мм I, 72мм I, 74мм J, 76мм J, 78мм J, 80мм J



Рис. 6. Компонент вертлужный G7 PPS с шипами бесцементный, 3 отверстия, размер 42 мм А.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 PPS с шипами бесцементный, 3 отверстия, размеры: 42 мм А, 44 мм А, 46 мм В, 48 мм С, 50 мм D, 52 мм Е



Рис. 7. Компонент вертлужный G7 PPS с шипами бесцементный, 4 отверстия, размер 60 мм G.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 PPS с шипами бесцементный, 4 отверстия, размеры: 54 мм F, 56 мм F, 58 мм G, 60 мм G, 62 мм H, 64 мм H, 66 мм I, 68 мм I



Рис. 8. Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster с шипами бесцементный, 3 отверстия, размер 46 мм В.
Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster с шипами бесцементный, 3 отверстия, размеры: 42 мм А, 44 мм А, 46 мм В, 48 мм С, 50 мм D, 52 мм Е



Рис. 9. Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster с шипами бесцементный, 4 отверстия, размер 60 мм G.
Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster с шипами бесцементный, 4
отверстия, размеры: 54 мм F, 56 мм F, 58 мм G, 60 мм G, 62 мм H, 64 мм H, 66 мм I, 68 мм I



Рис. 10. Винт ацетабулярный G7, диаметр 6,5 мм, длина 35 мм.

Имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом: Винт ацетабулярный G7, диаметр 6,5 мм, длины: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм

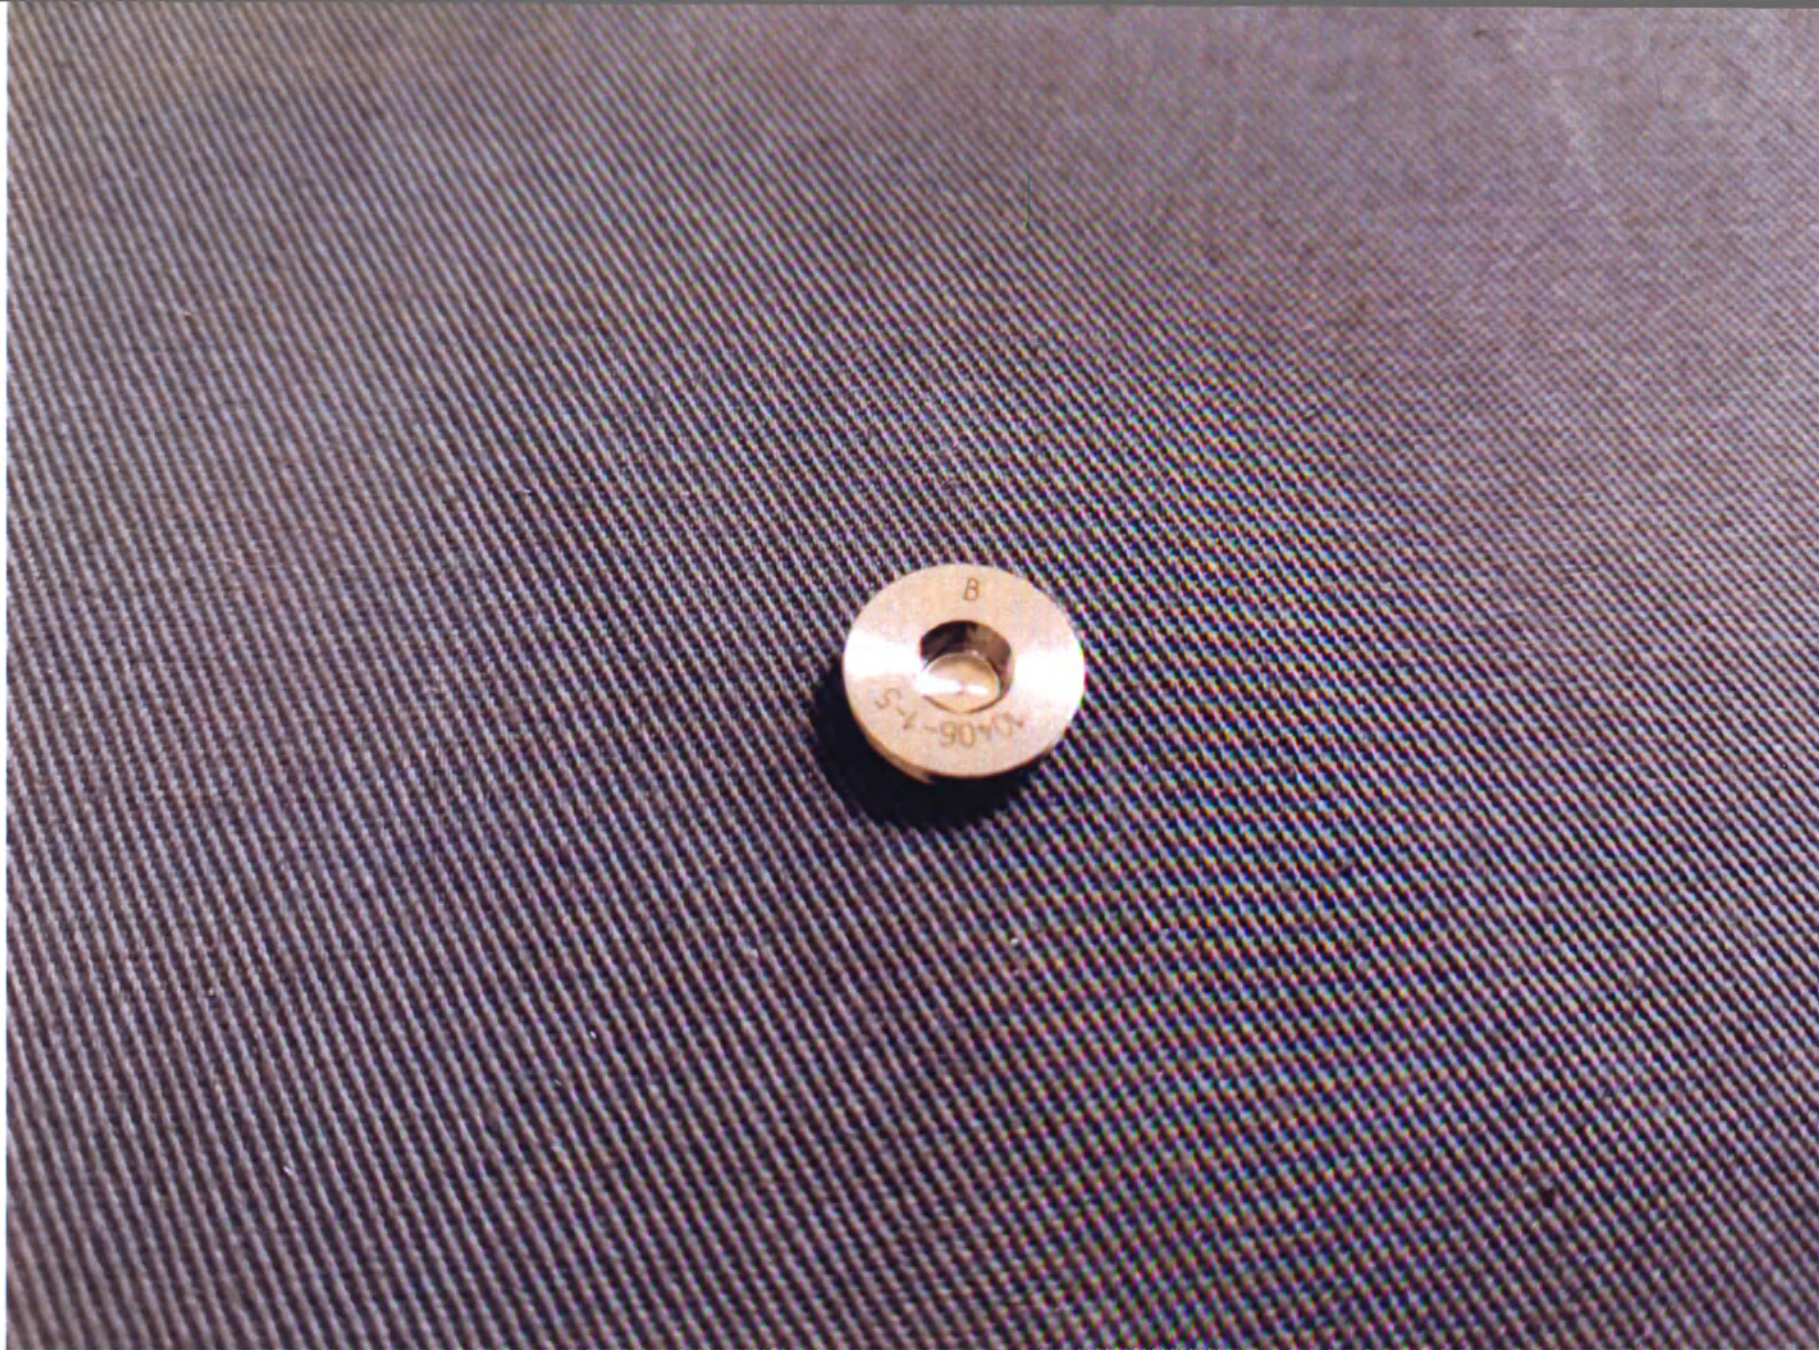


Рис. 11. Заглушка апикального отверстия G7.

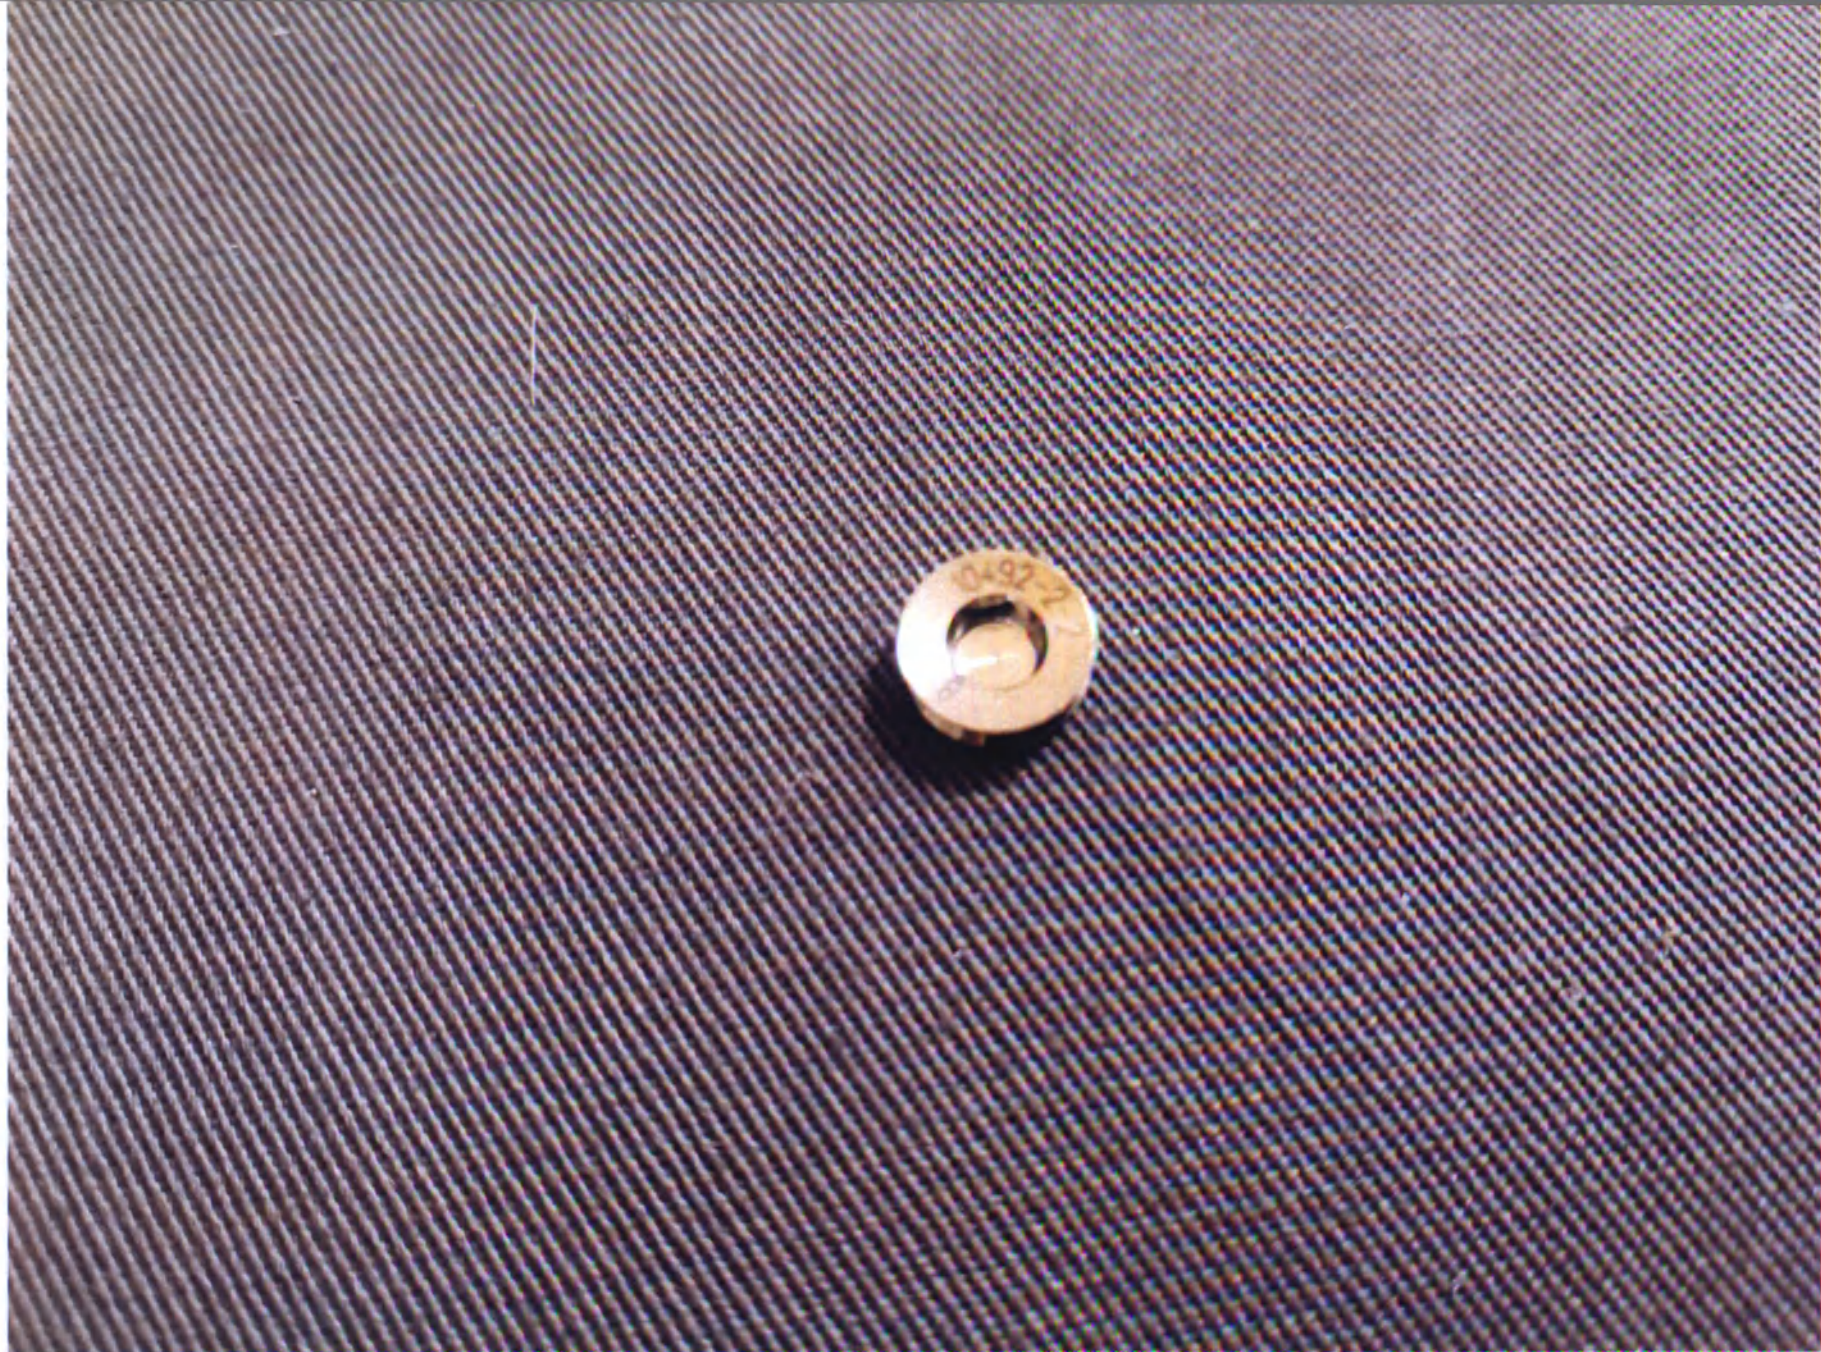


Рис. 12. Заглушка винтового отверстия G7.

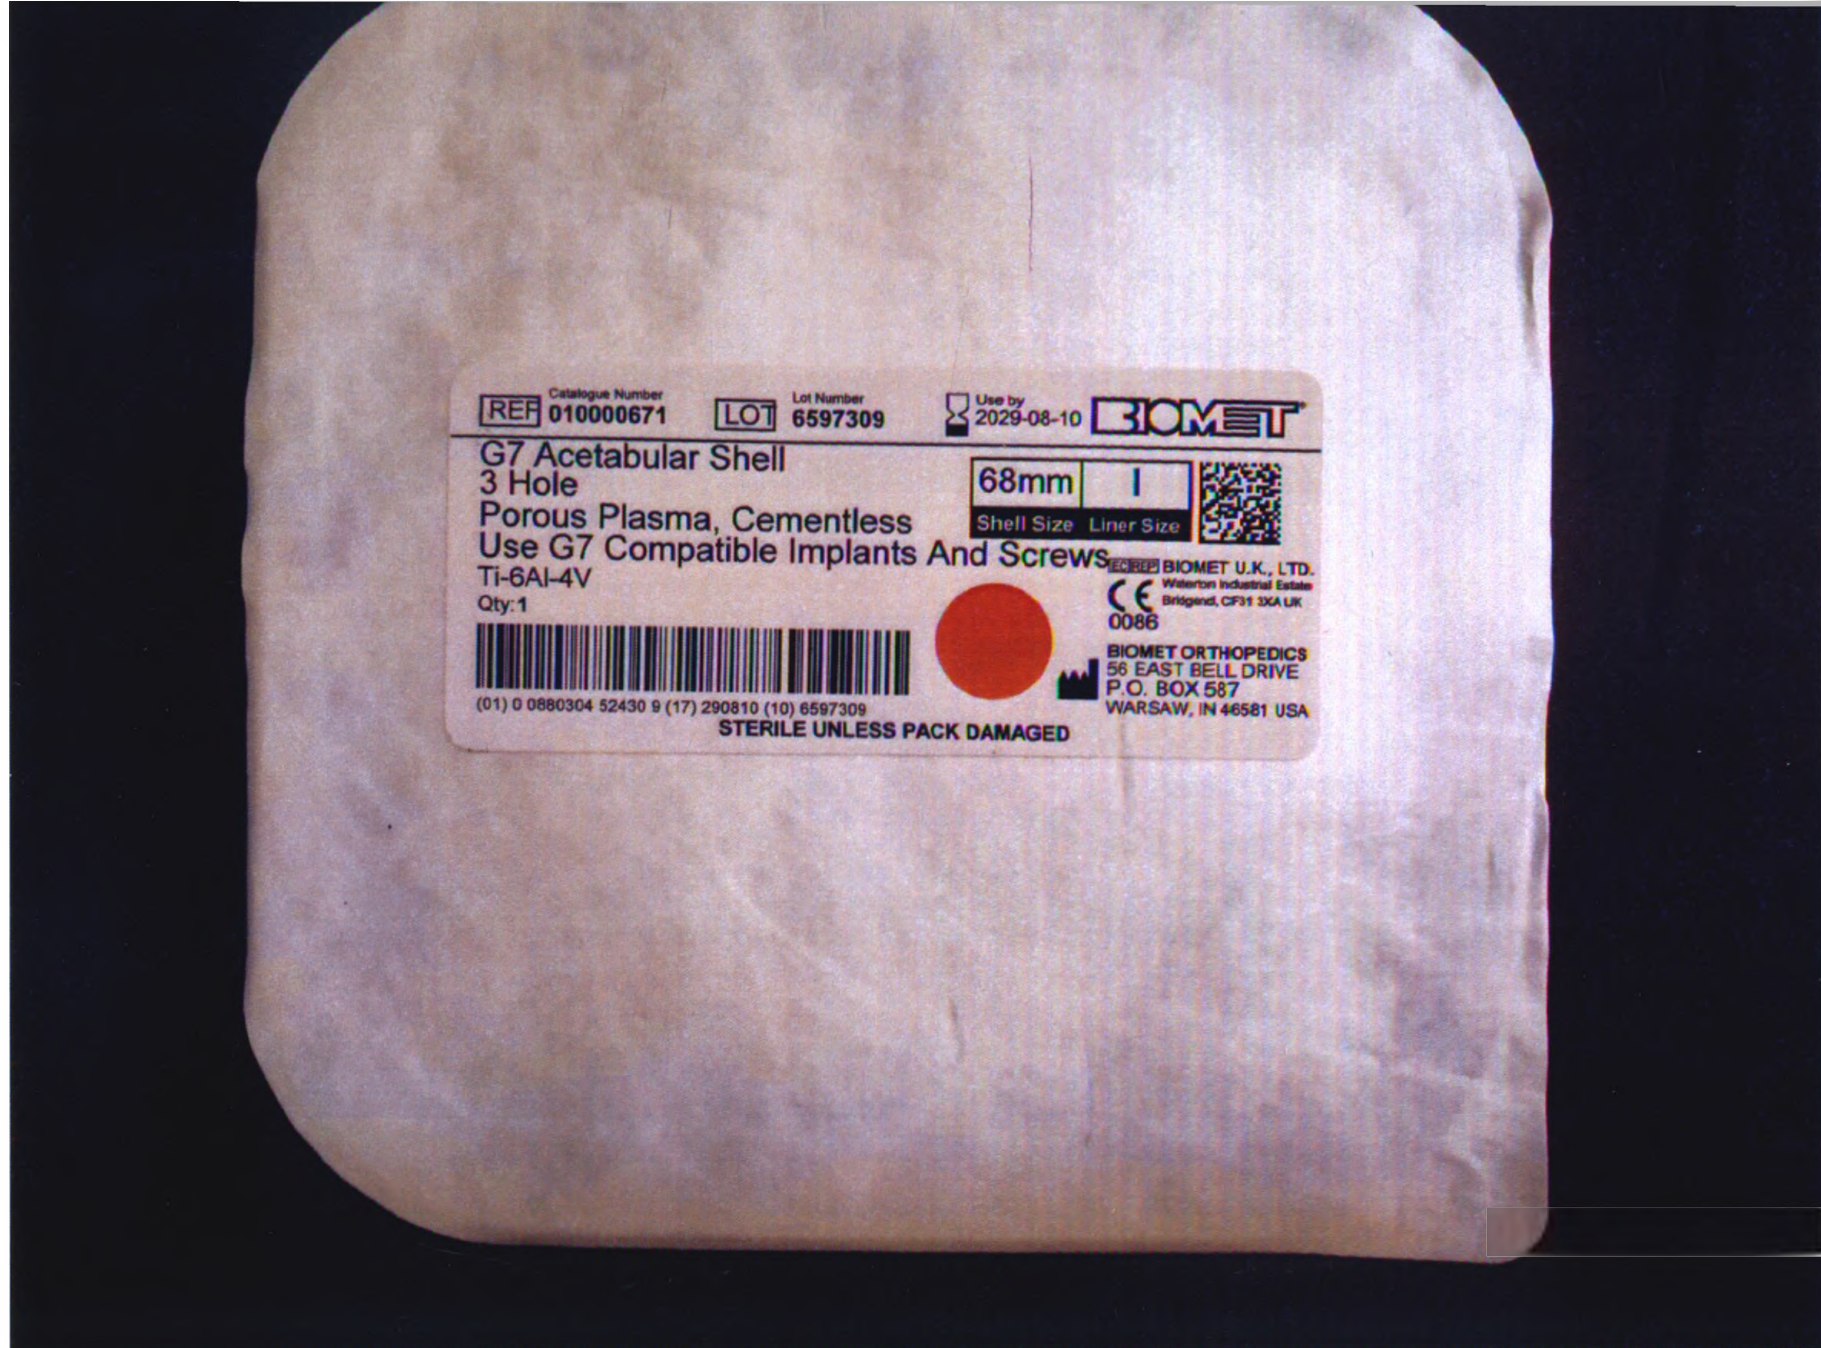


Рис. 13. Пример маркировки первичной упаковки – Компоненты вертлужные G7

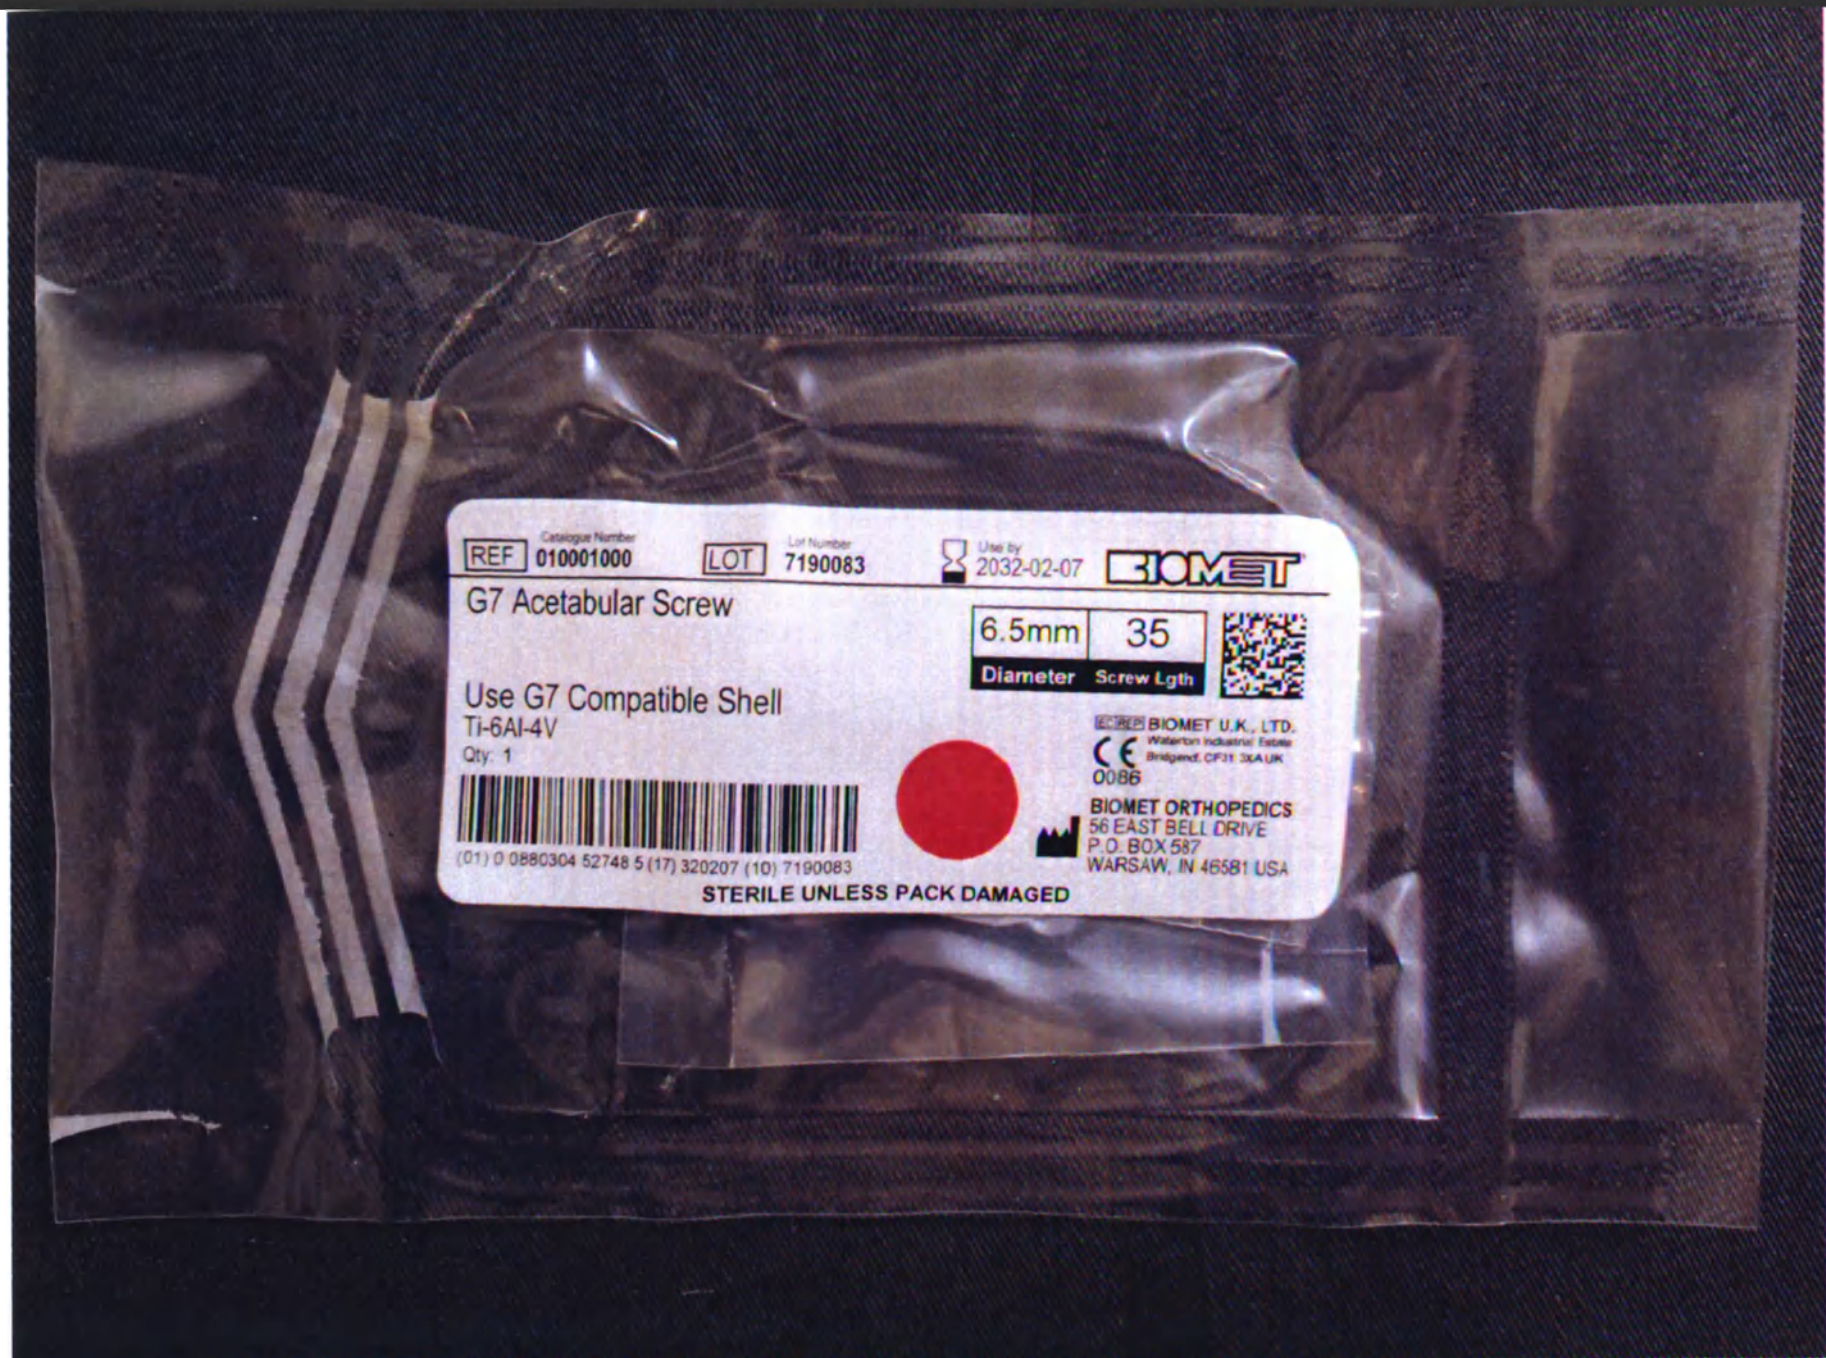


Рис. 14. Пример маркировки первичной упаковки - Винт ацетабулярный G7

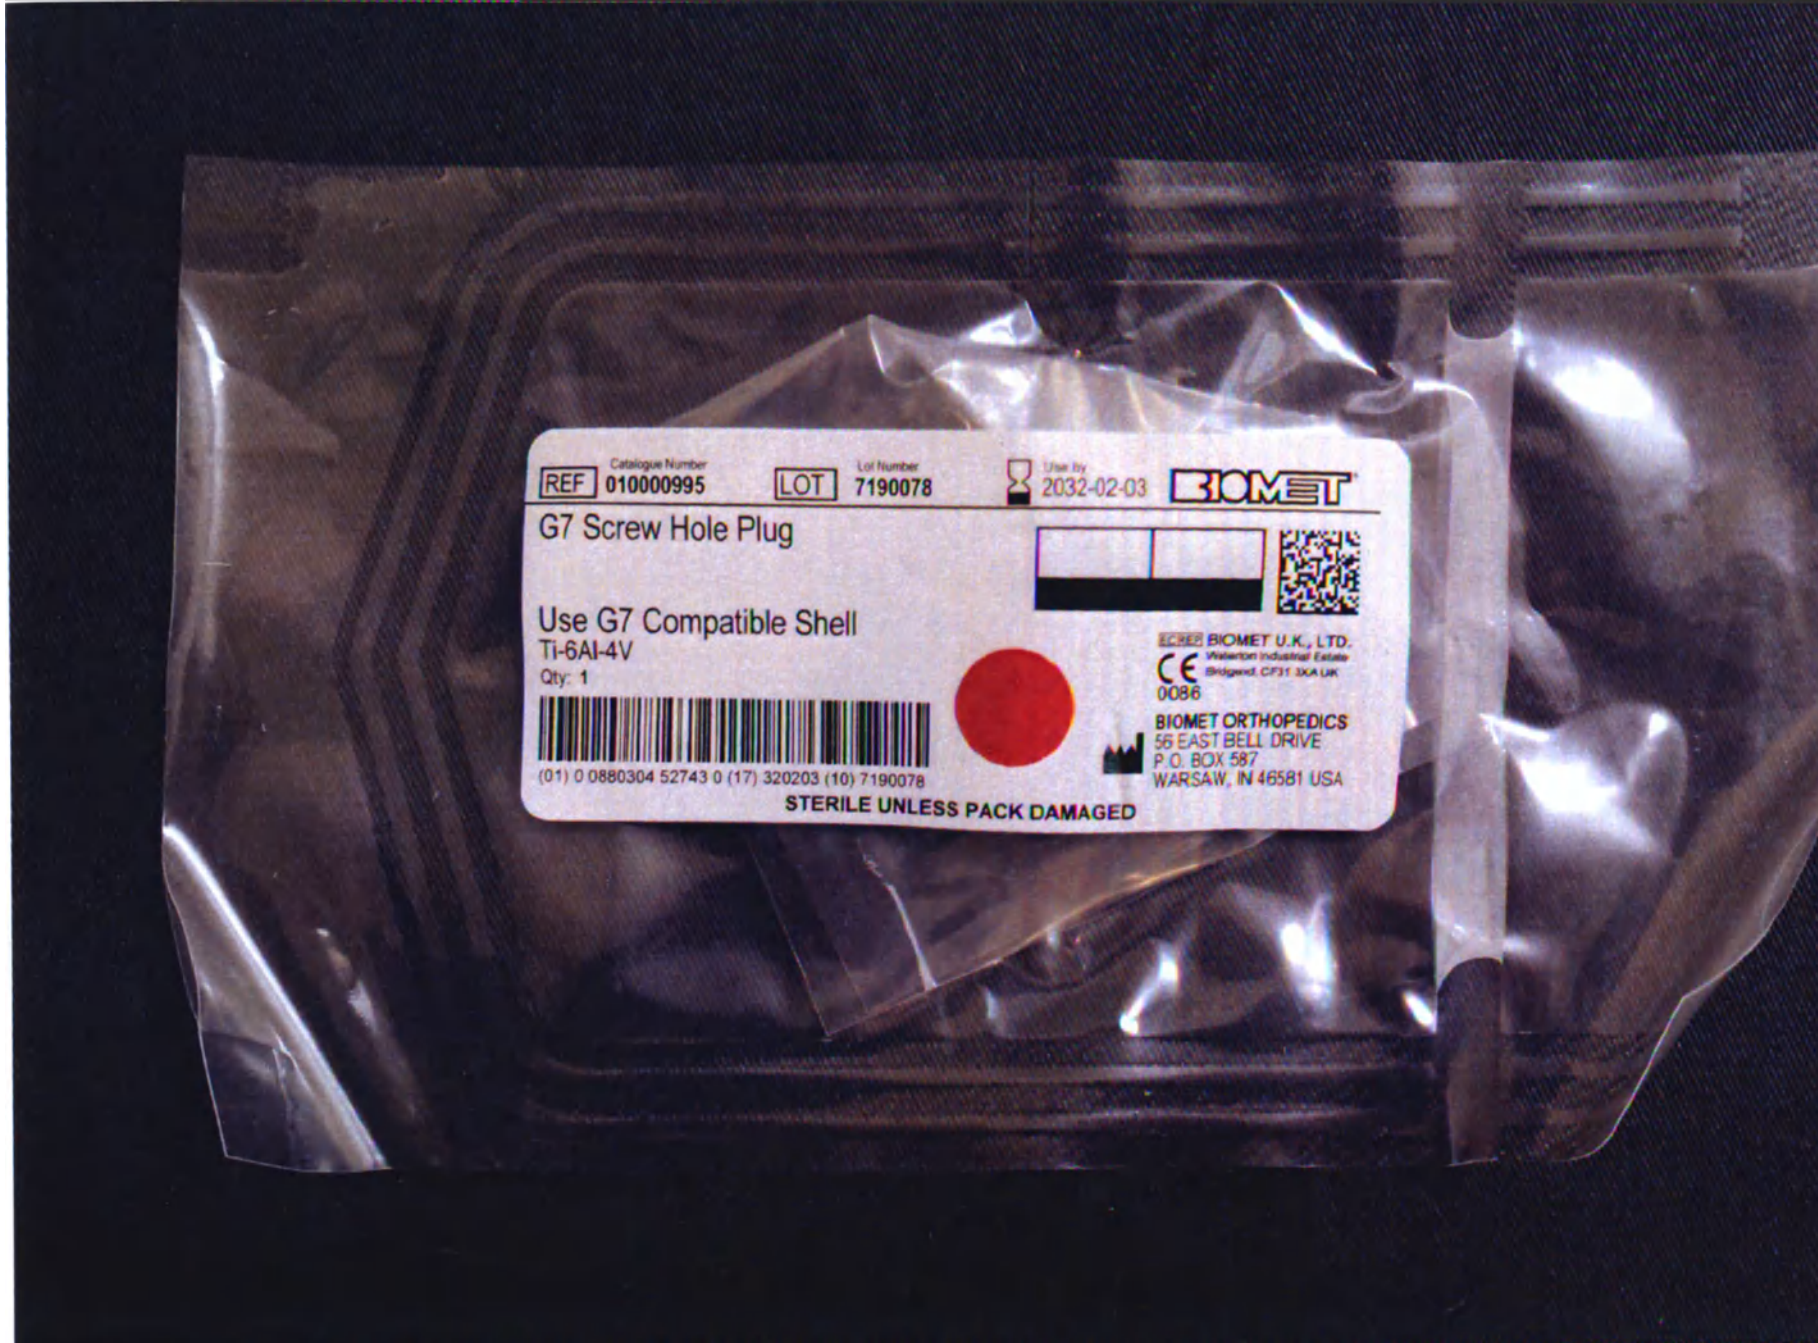


Рис. 15. Пример маркировки первичной упаковки - Заглушки G7



Рис. 16. Пример маркировки вторичной упаковки

Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster с шипами бесцементный, 4 отверстия, размер 68 мм I			
Производитель:	«Биомет Ортопедикс»	США	XXXXXX
Представитель производителя в РФ:		ООО «Зиммер СНГ»	
119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;			
Тел: (495) 980 08 95			
Регистрационное удостоверение №	XXX	от	ЧЧ.ММ.ГГГГ
Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до:		см. упаковку	
АПИРОГЕННО		см. инструкцию	
		см. символы на упаковке	
Описание:	Компонент вертлужный G7 PPS BoneMaster с шипами бесцементный, 4 отверстия, размер 68 мм I		

Рис. 17. Макет русскоязычной маркировки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 18 листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И.

«06» июня 2023 г.
«Зиммерман»
для документов
Отдел Регистрации
и качества
МОСКВА