



POLYOMED MEDITERRANEAN GROUP

ООО «Айно-М»

Общество с ограниченной ответственностью

109028, г. Москва, ул. Ямская, д. 5, оф. 107-108
ИНН 77/050522/КПП 770601001
+7 (495) 797 9118, 797 1343
info@polyomed.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Айно-М»

Габриэлов И. Б.



29 » декабря 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии
с подогревом LEVEL 1[®] с принадлежностями**

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.
(маркировка изделия)



**Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями. Изделие в сборе.
(вид спереди)**




**Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1* с принадлежностями. Изделие в сборе.
(вид сбоку)**



**Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1[®] с принадлежностями. Изделие в сборе.
(вид сбоку)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями. Изделие в сборе.
(вид сзади)

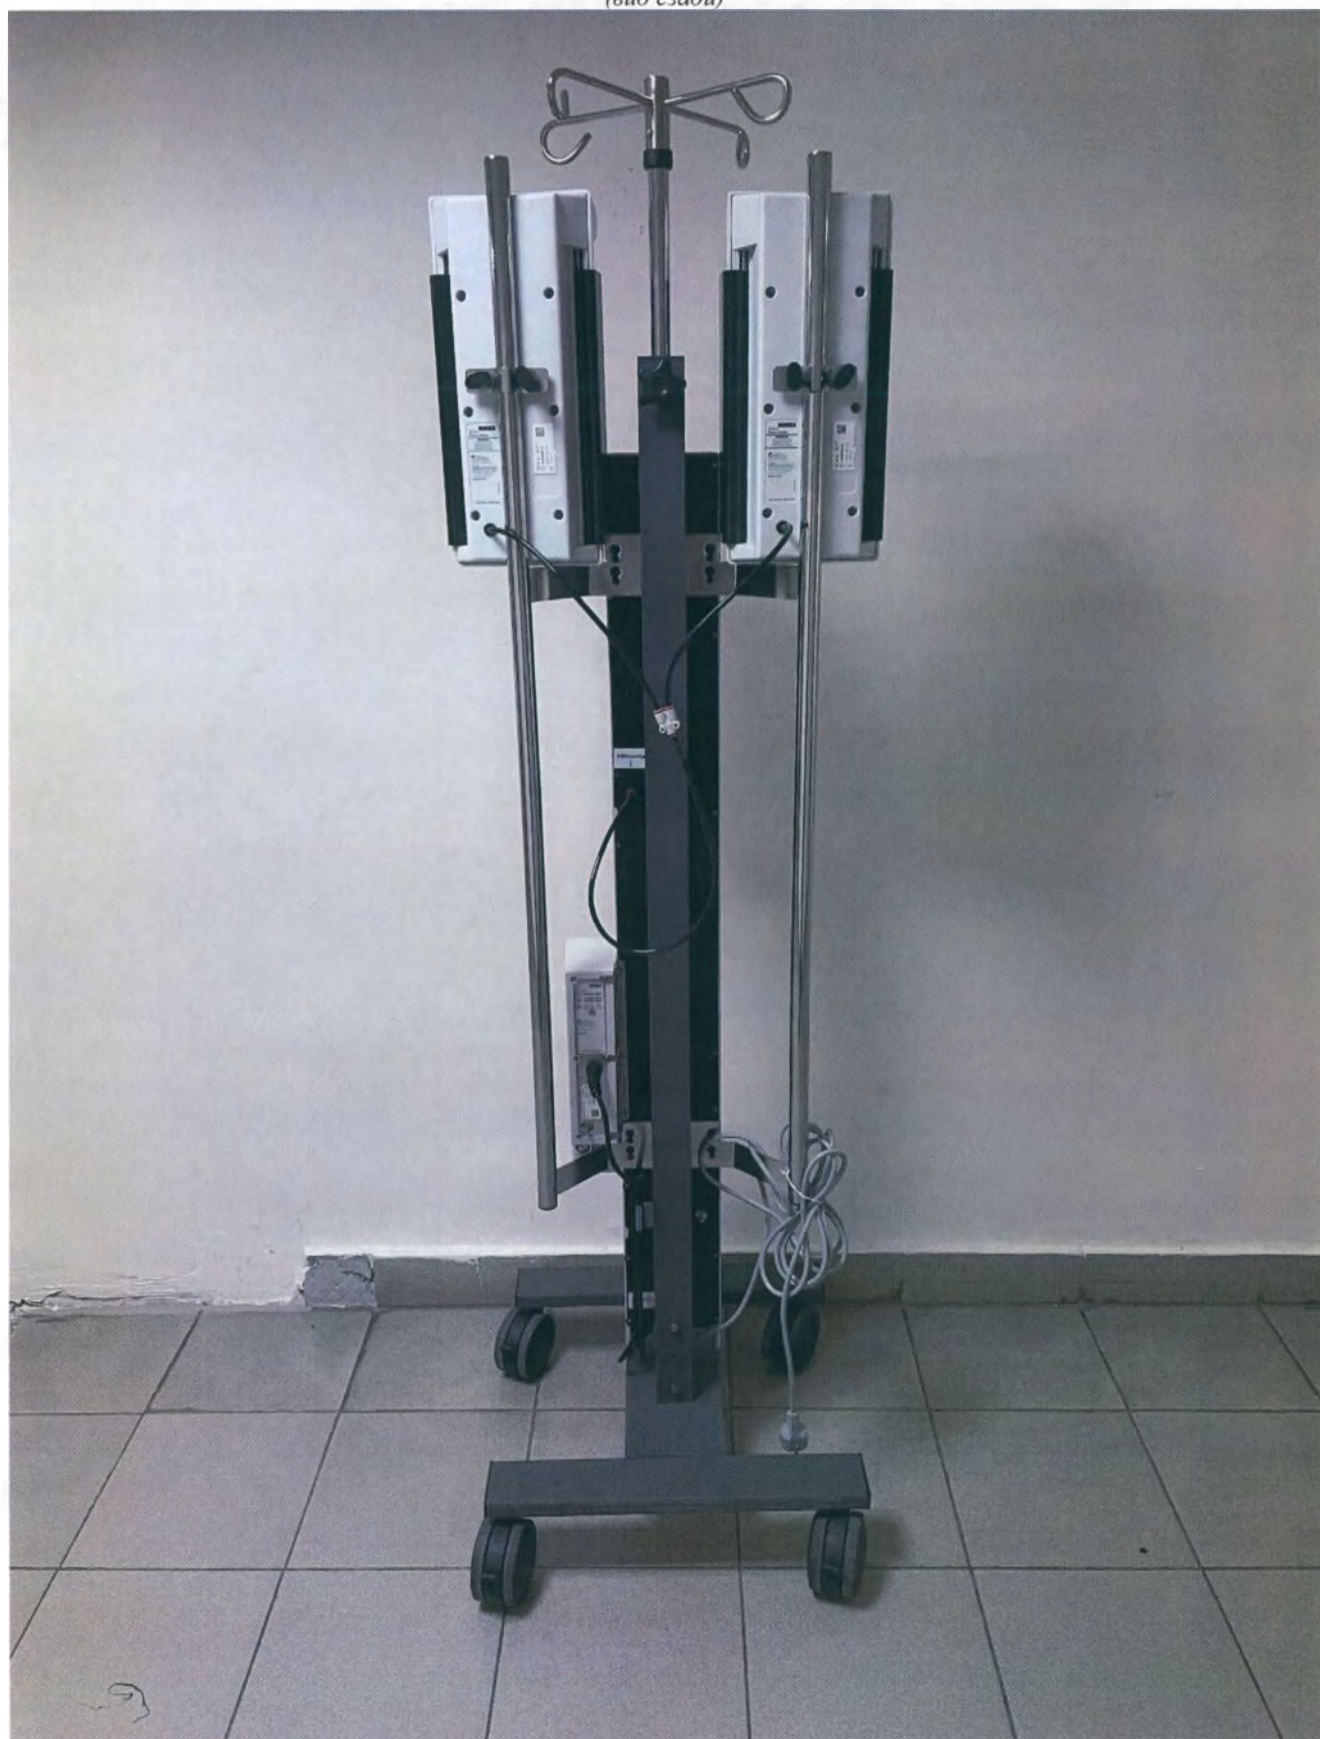

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.

(маркировка транспортной упаковки основного блока с крепежом и электрического шнура)

REF H-1000 230V **LEVEL 1®**

Level 1® Fast Flow Fluid Warmer

en Fast Flow Fluid Warmer
fr Réchauffeur de soluté à débit rapide
de Fast-Flow Flüssigkeitserwärmer
it Scaldafuidi a flusso veloce
es Calentador de fluidos de flujo rápido
pt Aquecedor de fluidos de fluxo rápido
nl Vloeistofverwarmer met snelle flow
sv Snabbflödesvätskevärmare
da Væskevarmer med hurtigt flow
no Hurtigflytende væskevarmer
fi Nopeavirtauksinen -nesteenlämmitin
el Θερμαντήρας υγρού ταχείας ροής
cs Ohříváč kapalin s vysokým průtokem
sk Rýchloprietokový ohrievač tekutín
hu Gyors áramlású folyadékmelegítő
pl Szybko przepływowy podgrzewacz płynów
sl Grelnik tekočine s hitrim pretokom
et Kiirevooluline vedelikusoojendi
lt Greitos infuzijos skysčių šildytuvas
tr Hızlı Akış Sıvı Isıtıcı
bg Нагревател за течности с висок дебит
ro Încălzitorul de lichid cu flux rapid
hr Brzoprotokni uređaj za zagrijavanje tekućina

Refer to Instruction Manual

CE
0086

For export only

SN Serial Number: **33002540**

Manufacturing Date: **2020-01-28**


(01) 50 695085870010 (11) 200128 (21) 33002540

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com

EC REP European Representative:
Smiths Medical International Ltd.
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, UK

MADE IN USA

PC10011260-001

PN H-1000-INT-230V **smiths medical**

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(общий вид)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(маркировка изделия)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(маркировка изделия)




Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(маркировка изделия)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(маркировка изделия)

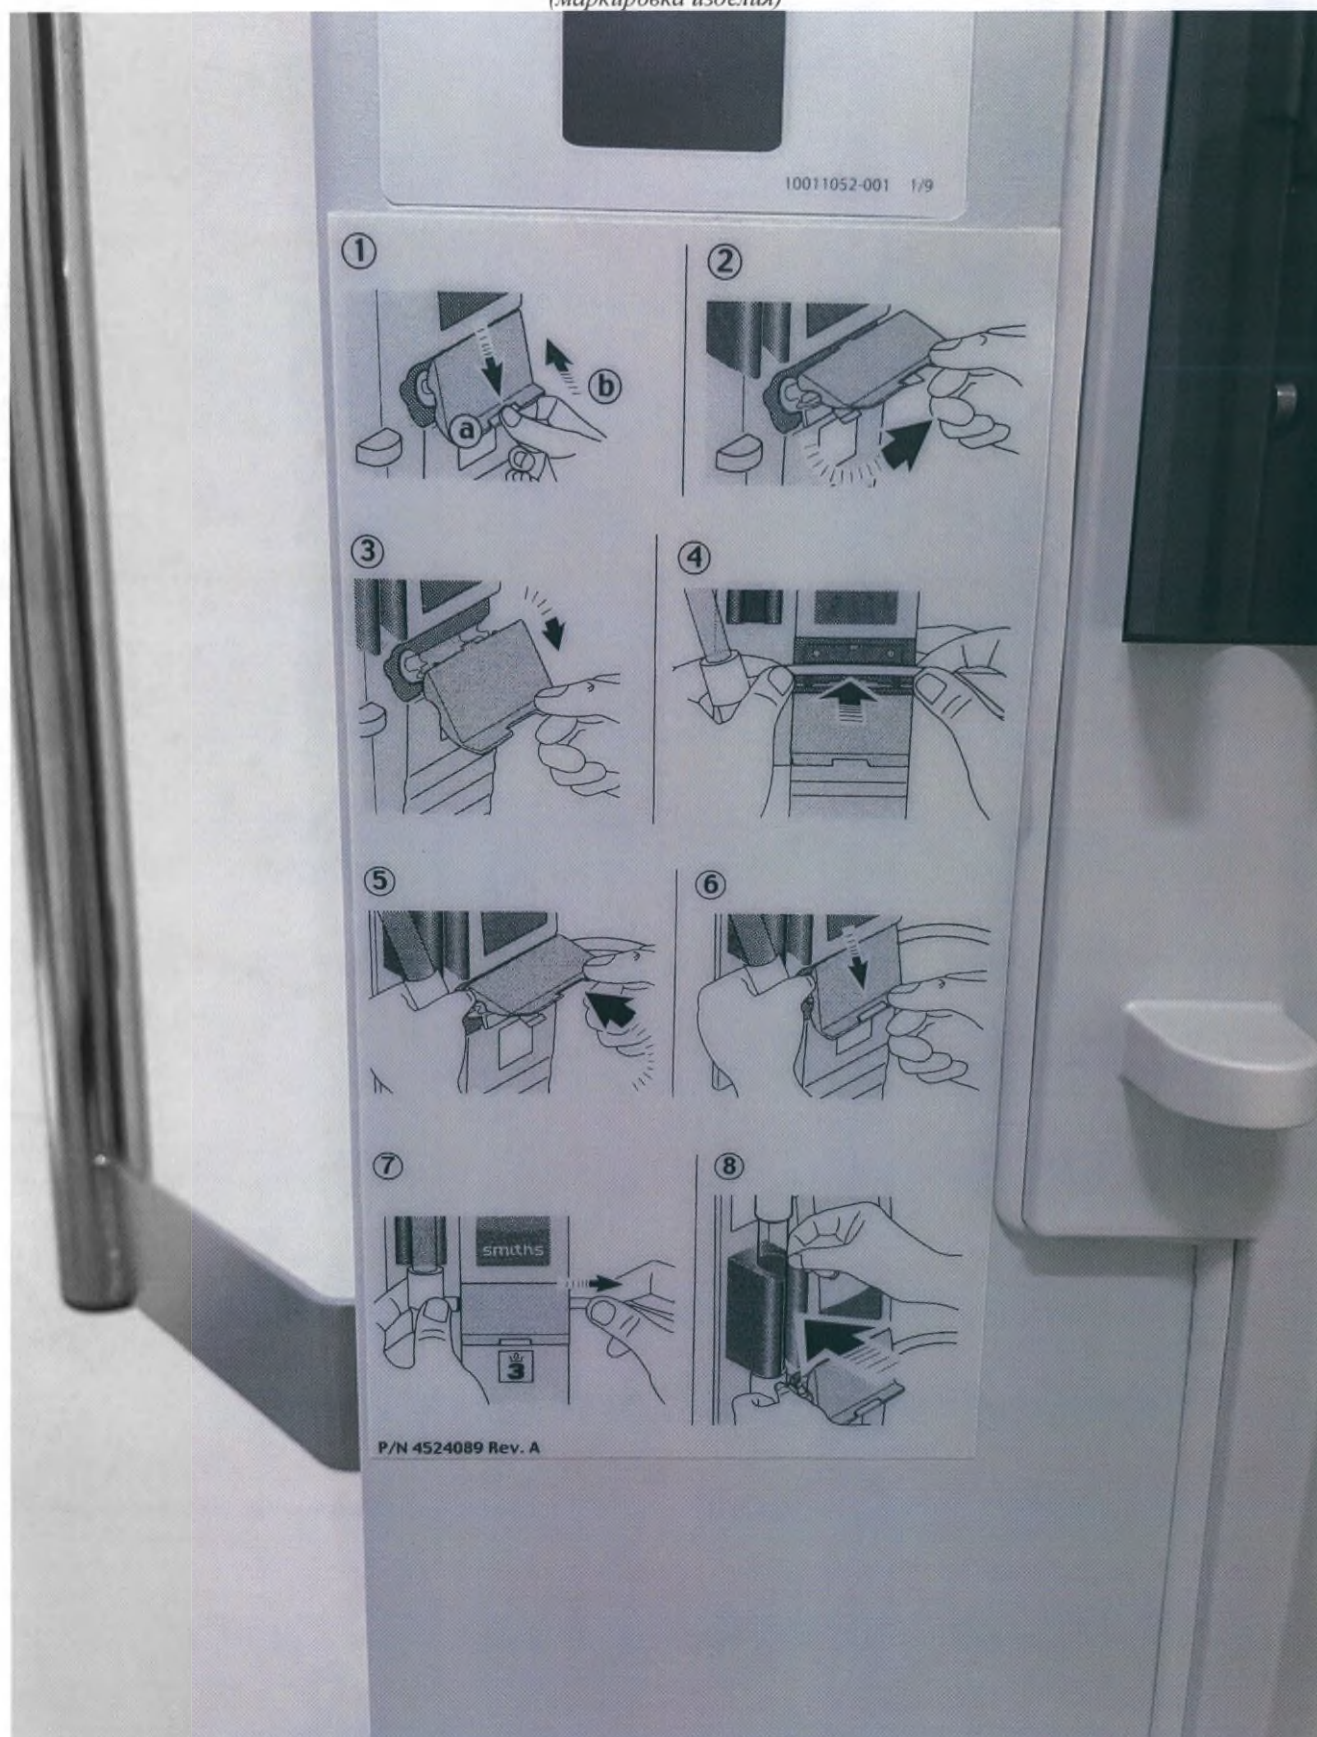

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(маркировка изделия)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(маркировка изделия)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 1. Основной блок с крепежом – 1 шт.
(маркировка изделия)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**1. Основной состав: 2. Стойка для устройства с ручками – 1 шт.
(маркировка транспортной упаковки)**

PN 6404008
LEVEL 1®

Level 1® I.V. Pole with Flanking Brackets

en I.V. Pole with Flanking Brackets fr Potence I.V. avec supports latéraux de Infusionsständer mit flankierenden Halterungen es Soporte para fluido intravenoso con barras laterales it Asta per flebotisi con supporti laterali nl Infuusstandaard met flankerende beugels pt Suporte de soros com braços laterais sv Infusionsstativ med sidofästen da Dropstativ med nabobeslag fi i.v.-teline ja sivukiinnittimet no Infusjonsstativ med sidefester el Στατόν ορού με παράπλευρους βραχίονες στήριξης	cs I.v. stojan s postranními konzolami sk I.v. stojan s bočnými konzolami hu I.V. állvány oldalkonzolokkal pl Stojak do wlewów dożylnych ze wspornikami boczny sl Infuzijsko stojalo z bočnimi konzolami et Intravenoosne stativ küljetoenditega lt Intraveninių infuzijų stovas su flanginiais rėmais tr Yan Dirseklerle I.V. Çubuğu bg Стойка за интравенозна инфузия със странични скоби ro Stativ de perfuzie cu suporturi de flanc hr Stalak za infuziju s poprečnim nosačima
---	--

-18°C / 0°F +60°C / 140°F 5% 95% 70 kPa / 10.2 psi 106 kPa / 15.4 psi

Symbol Glossary located in Instructions for Use

2020-04-27

(01)50695085(00851(11)200427

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
ASSEMBLED IN USA

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic


Rx CE
ONLY 2797

smiths medical

10004291-005

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1* с принадлежностями.

**I. Основной состав: 2. Стойка для устройства с ручками – 1 шт.
(общий вид)**

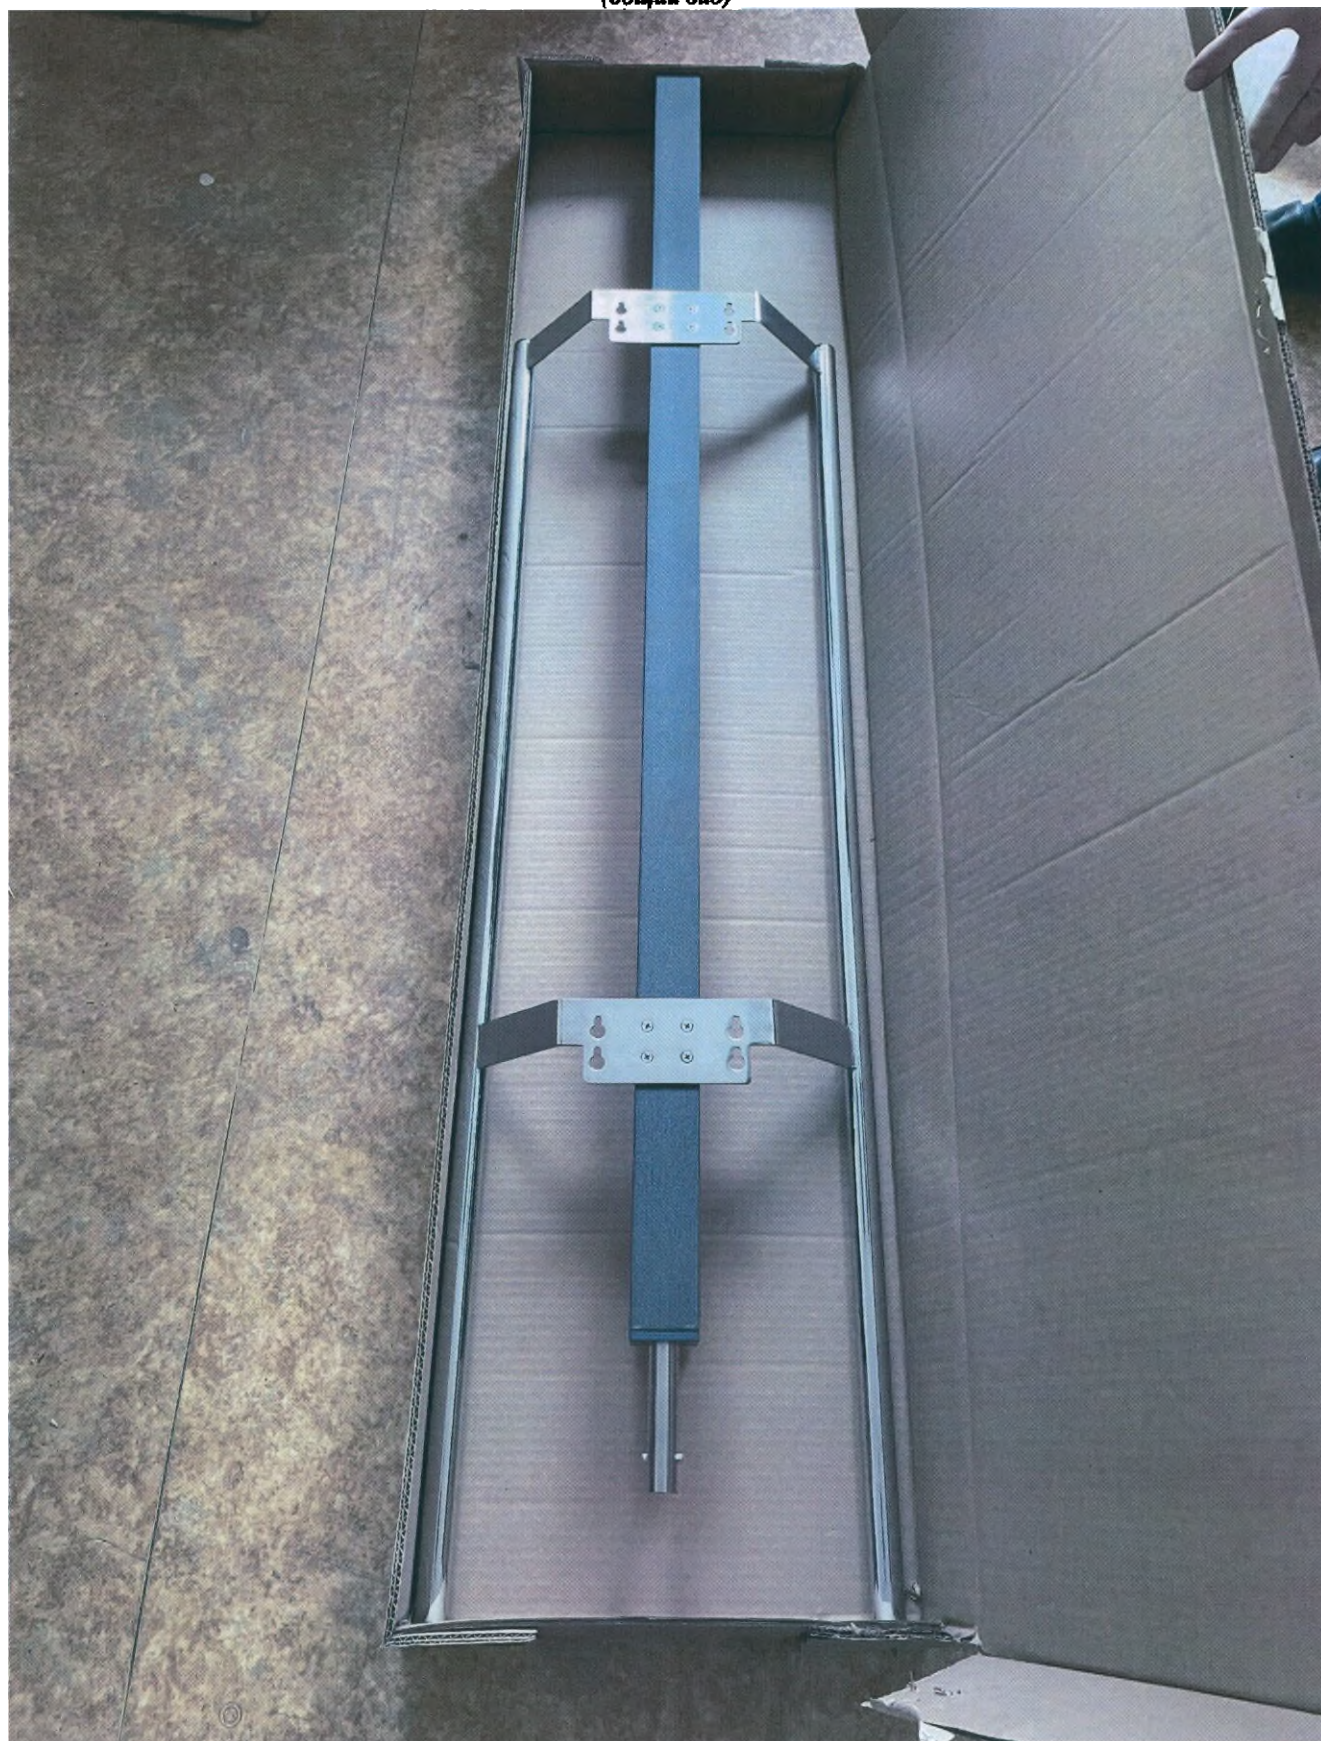

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 3. Мобильное основание стойки – 1 шт.

(маркировка транспортной упаковки мобильного основания стойки и крюков для инфузионных пакетов)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 3. Мобильное основание стойки – 1 шт.
(общий вид)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 4. Крюки для инфузионных пакетов – 1 шт.
(общий вид)






Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 5. Детектор воздуха с зажимом с крепежом – не более 5 шт. (при необходимости)
(маркировка транспортной упаковки)

REF **H-31**

LEVEL 1[®]

Level 1[®] Air Detector/Clamp



Symbol Glossary located in Instructions for Use

SN 55000136

 2020-12-29


(01) 50695085829261 (11) 201229 (21) 55000136

 Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
ASSEMBLED IN USA

**Rx
ONLY**

PC10010371-003

PN H-31-EN

smiths medical

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 5. Детектор воздуха с зажимом с крепёжом — не более 5 шт. (при необходимости)
(общий вид)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 5. Детектор воздуха с зажимом – не более 5 шт. (при необходимости) (маркировка изделия)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 5. Детектор воздуха с зажимом – не более 5 шт. (при необходимости)
(маркировка изделия)





Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1* с принадлежностями.

1. Основной состав: 6. Компрессионные камеры с крепежом – 2 шт.
(маркировка транспортной упаковки)

REF H-2 **LEVEL 1[®]**

en Level 1[®] Pressure Chamber

Symbol Glossary located in Instructions for Use

SN 44006816  **2021-02-18**


(01) 50695085800208 (11) 210218 (21) 44006816

 **Manufacturer:**
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
ASSEMBLED IN USA

EC REP **European Representative:**
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

Rx CE
ONLY 2797

PC10010286-003

PN 7204012 **smiths medical**

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 6. Компрессионные камеры с крепежом – 2 шт.
(общий вид)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 6. Компрессорные камеры с крепежом – 2 шт.
(маркировка изделия)**




Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 6. Компрессионные камеры с крепежом – 2 шт.
(маркировка изделия)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1* с принадлежностями.

**1. Основной состав: 7. Электрический шнур – 1 шт.
(общий вид)**

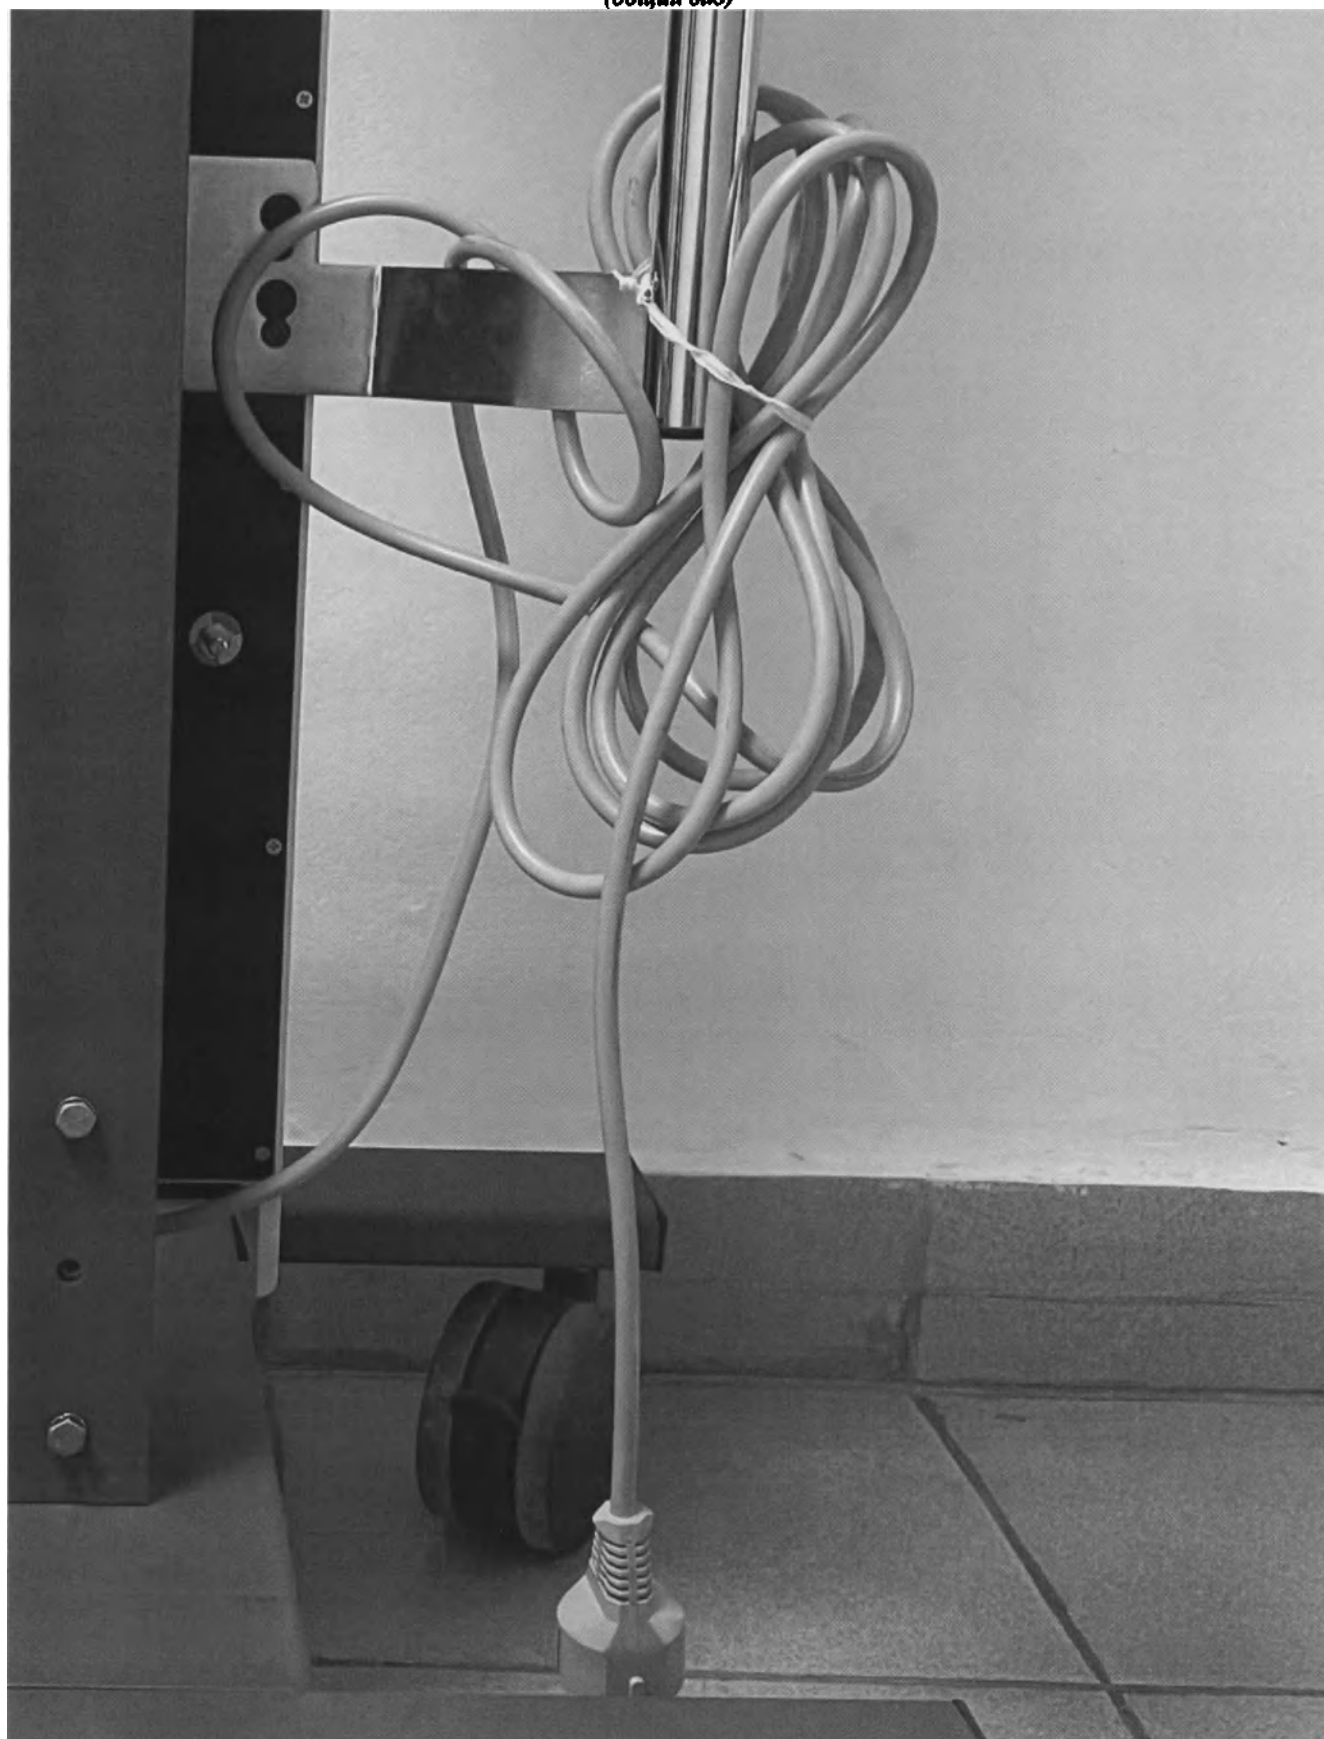

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

1. Основной состав: 8. Магистрала для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 40 мл/мин до 400 мл/мин – не более 5 ул., по 20 шт./ул. (при необходимости)
(магистровка транскрипционной упаковки)

REF **DI-50**

LEVEL 1

**Level 1® Normothermic
I.V. Fluid Administration Set**

- en** Normothermic I.V. Fluid Administration Set
- fr** Kit d'administration IV de soluté normothermique
- de** Normothermes Infusionsset
- es** Equipo de administración de fluidos intravenosos normotérmicos
- it** Set per somministrazione endovenosa di fluidi normotermici
- nl** Normotherme infuusvloei-toedieningsset
- pt** Conjunto normotérmico de administração de fluidos intravenosos
- sv** Administreringsset för normoterm iv-vätska
- da** Normotermisk iv-administrationsæt til væske
- no** Normotermisk intravenøst sett for væskeadministrering
- fi** Normaaliämpöinen i.v.-nesteantosetti
- el** Νορμοθερμικό σετ ΕΦ χορήγησης υγρών



Caution




Do not reuse



Not made with natural rubber latex



Do not use if package is damaged



Sterile Fluid Path.
Ethylene oxide
gas sterilized



Keep away from sunlight



Keep dry



Contains or Presence of
Phthalate: bis(2-ethylhexyl)
phthalate (DEHP)



For export only



4068107



Date of Manufacture:
2020-10-20



Use By:
2024-10-20



(01) 50695085405014 (11) 201020 (17) 241020 (10) 4068107

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic s. r. o.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Mlýnský
753 01 Hranice, Czech Republic

MADE IN MEXICO

PC1 0012021-002


smiths medical

- en** Helium Leak Tested
- fr** Soumis à un contrôle d'étanchéité à l'hélium
- de** Mit Helium leckgeprüft
- es** Comprobado mediante la prueba de fugas de helio
- it** Sottoposto a ricerca delle perdite ad elio
- el** Υποβλήθηκε σε δοκιμές διαρροής με ήλιο
- nl** Op dichtheid getest met helium
- pt** Testado contra fugas com hélio
- sv** Läckagetestad med helium
- da** Tæthedstest med helium udført
- fi** Vuototestattu heliumilla
- no** Lekkasjetestet med helium

4321394 Rev. 000 (7/07)


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**1. Основной состав: 8. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 40 мл/мин до 400 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**

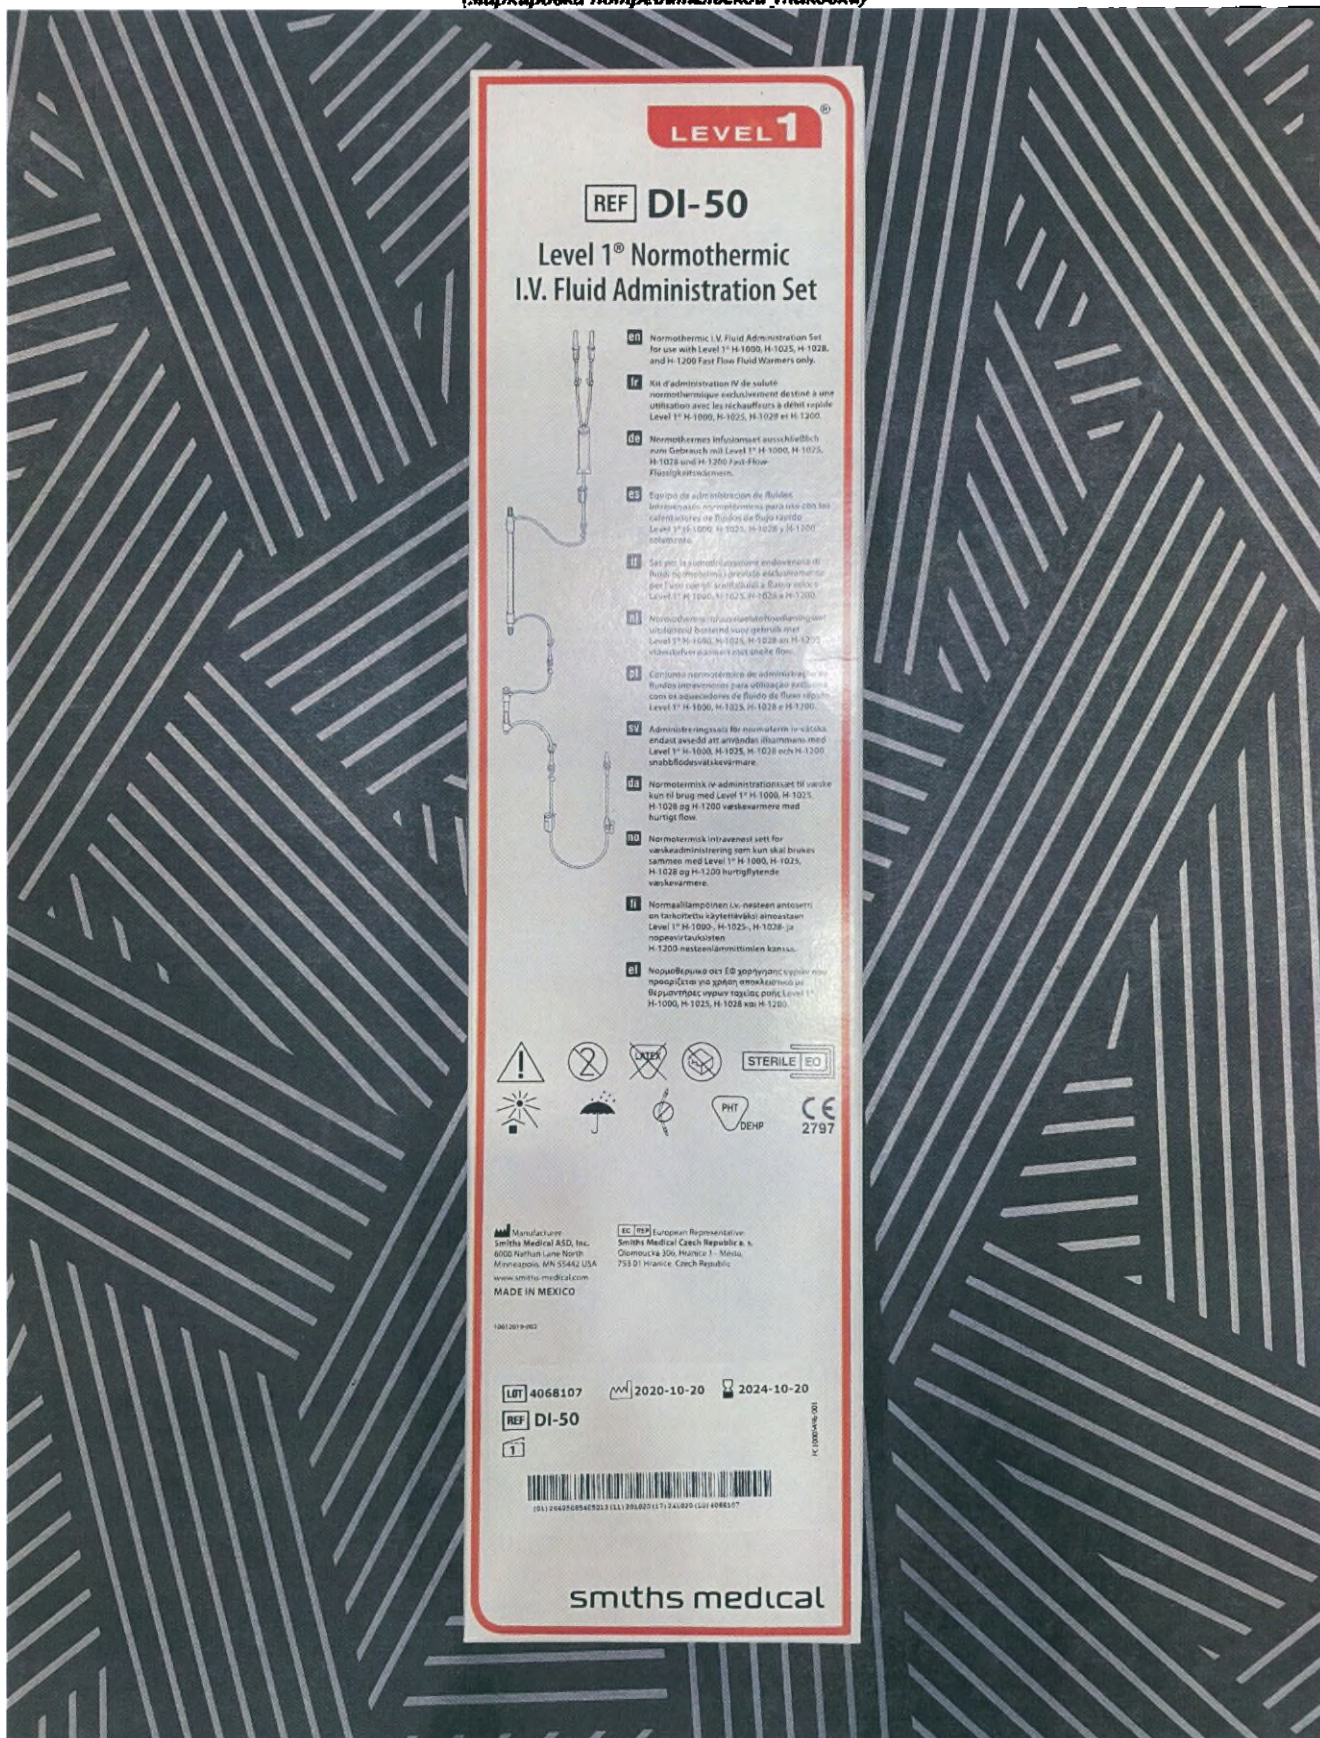

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 8. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 40 мл/мин до 400 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**

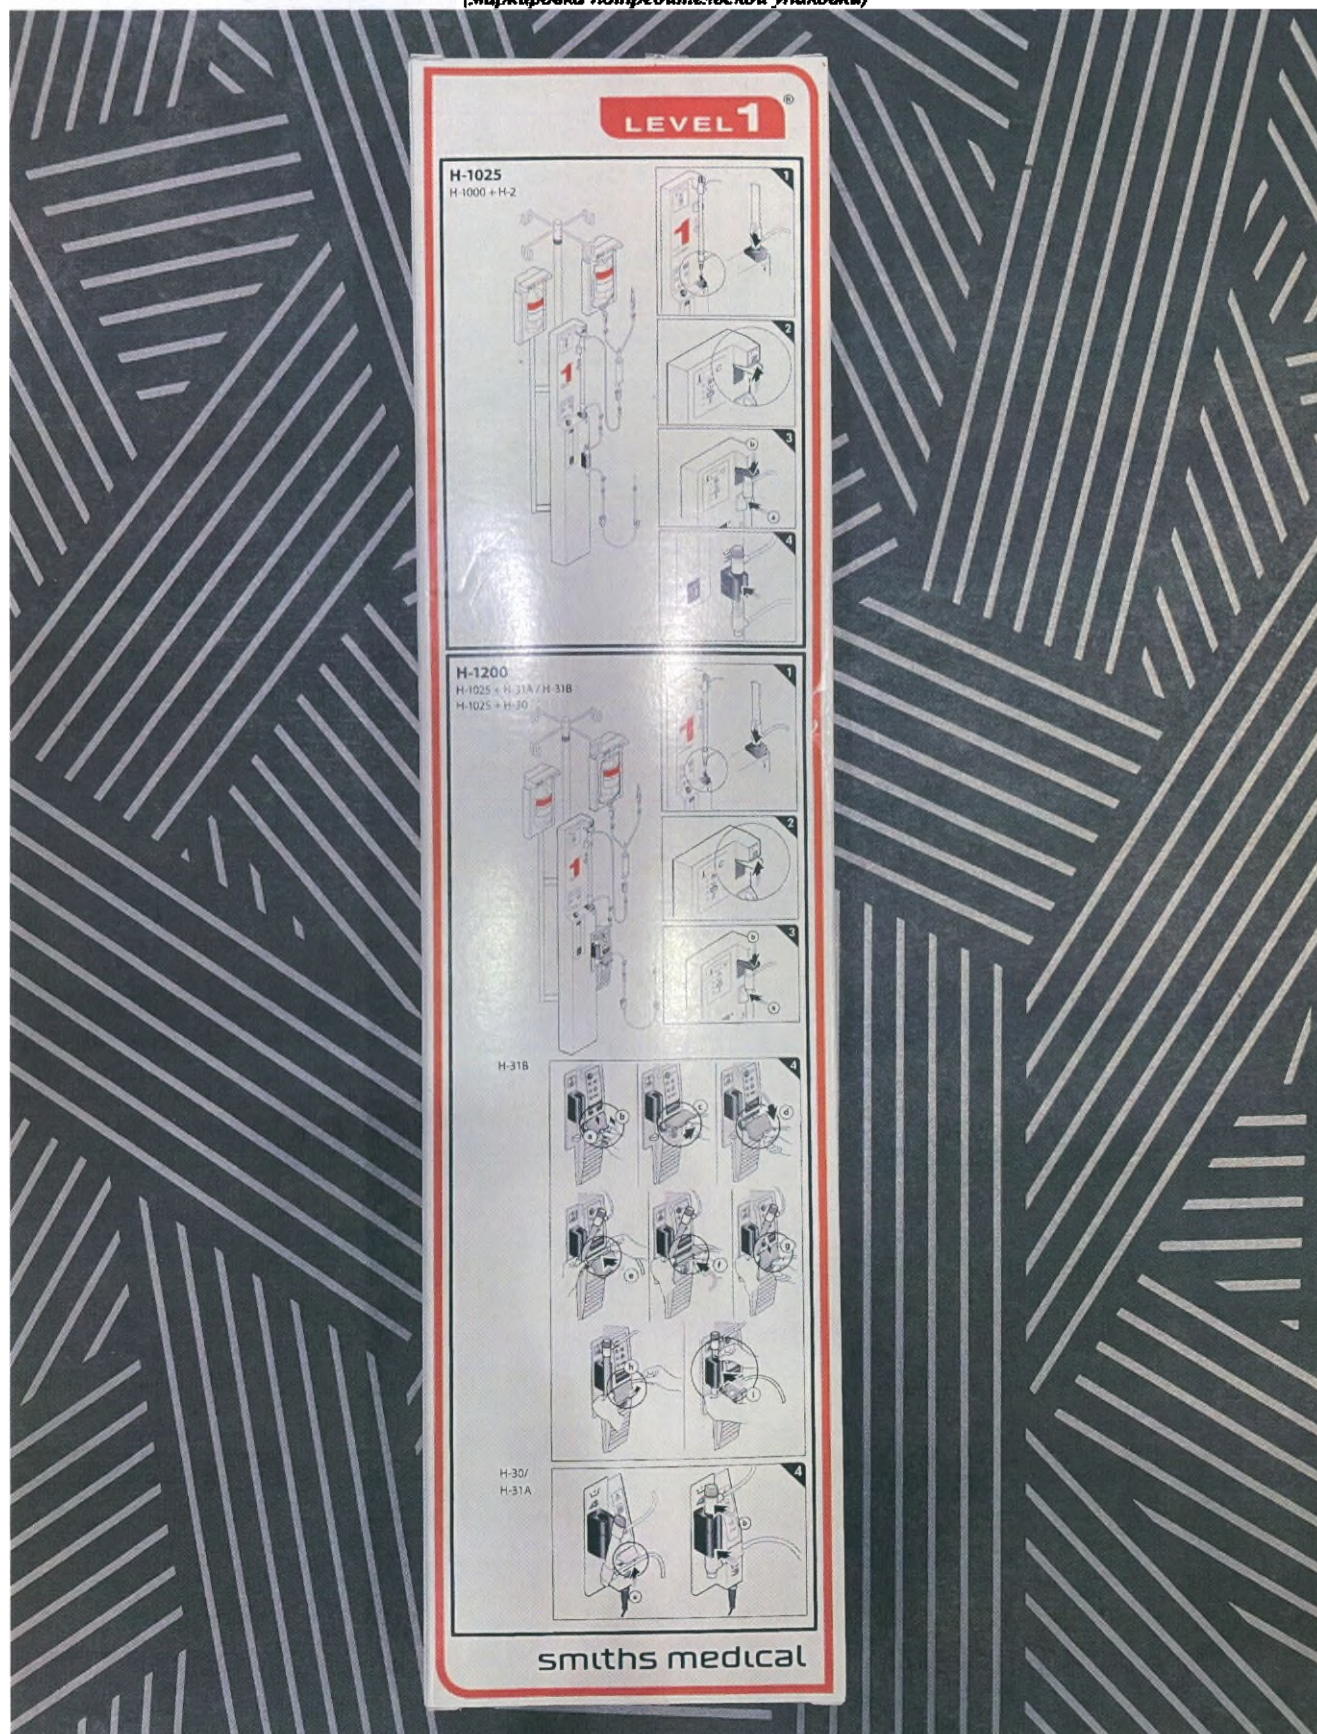

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 8. Магистралей для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 40 мл/мин до 400 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**




Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 8. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 40 мл/мин до 400 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(изделие в индивидуальной упаковке)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1* с принадлежностями.

**I. Основной состав: 8. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1[®], скорость потока от 40 мл/мин до 400 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(общий вид)**

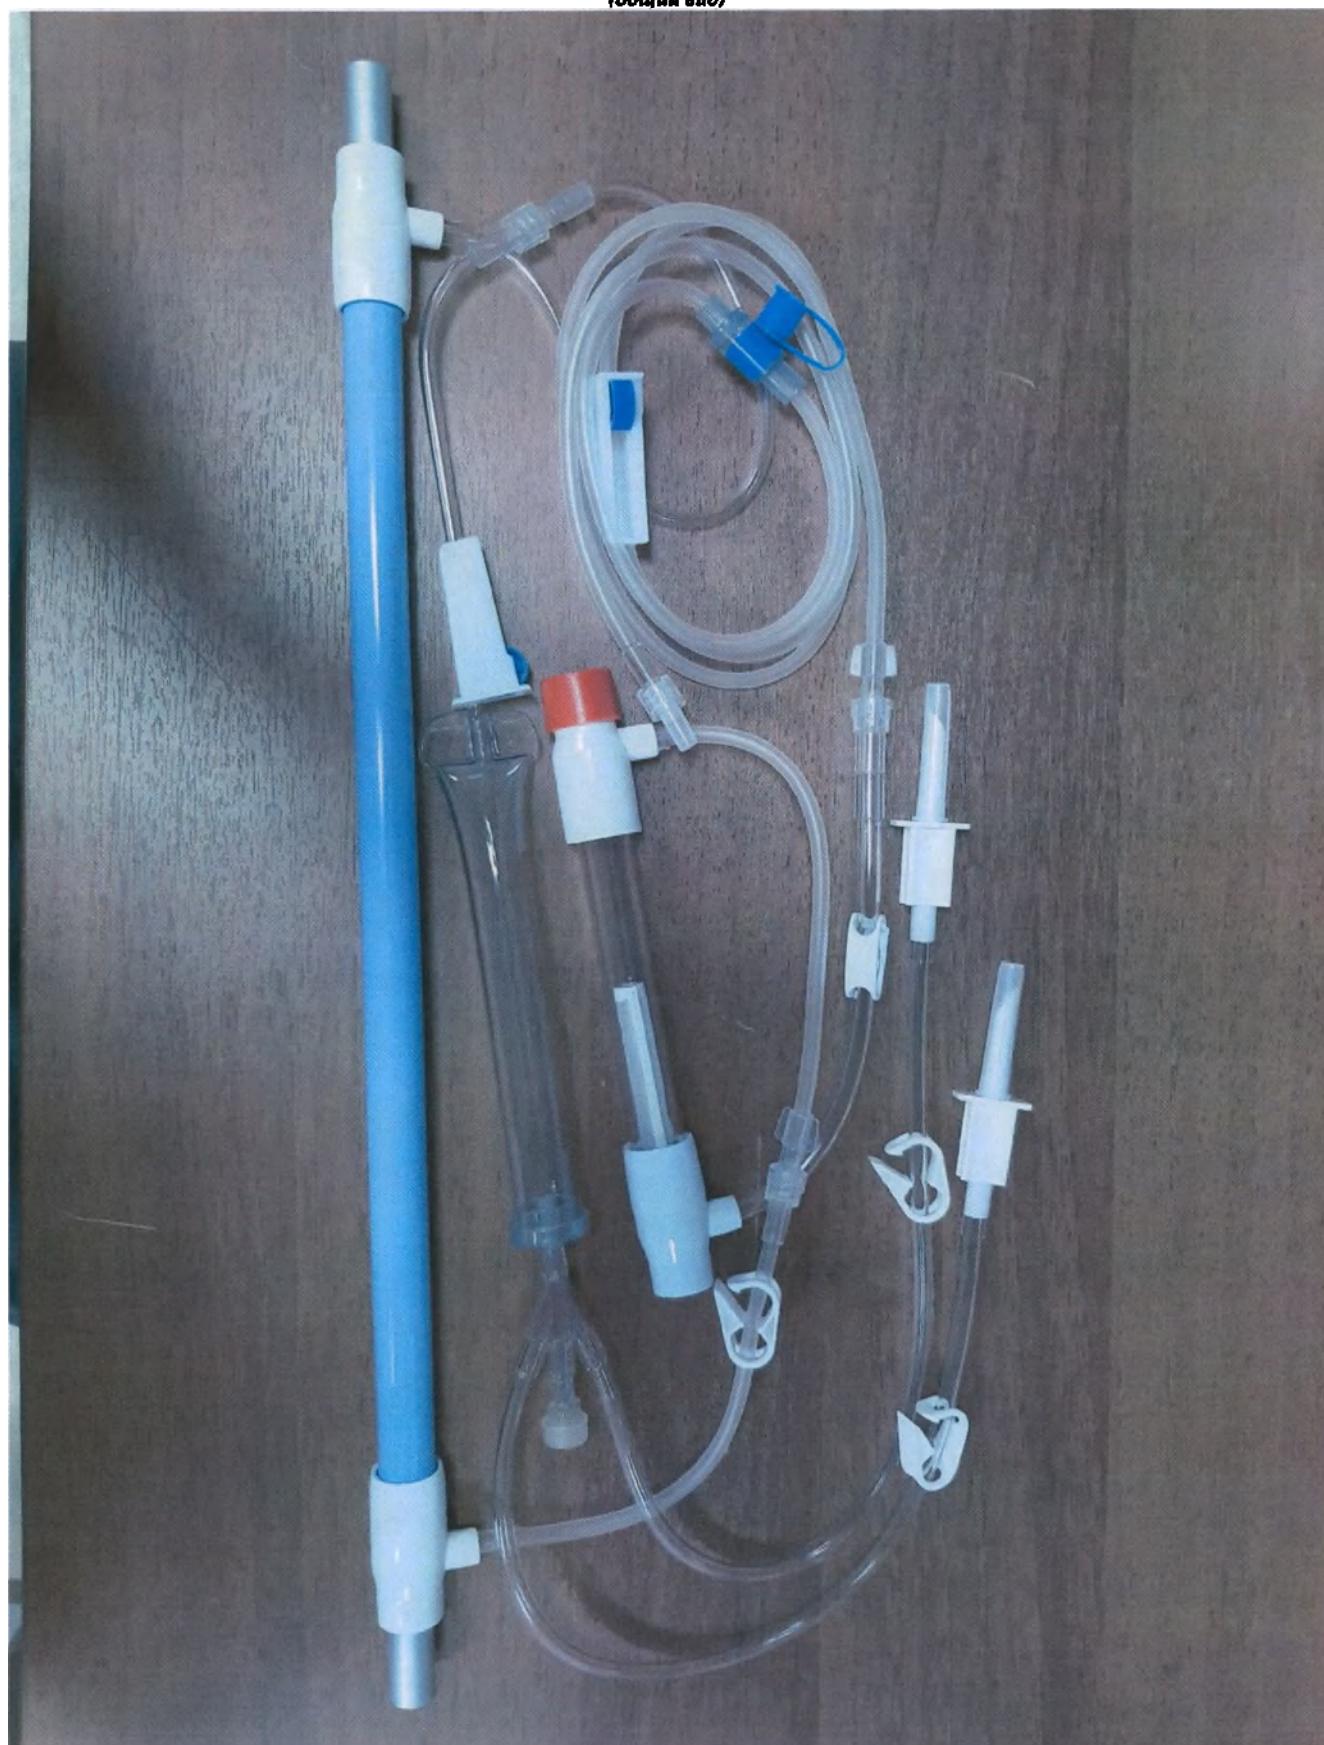

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

1. Основной состав: 9. Магистрала для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 675 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка транскрипционной этикетки)

REF **DI-70**

LEVEL 1®

**Level 1® Normothermic
I.V. Fluid Administration Set**

- en** Normothermic I.V. Fluid Administration Set
- fr** Kit d'administration IV de soluté normothermique
- de** Normothermes Infusionsset
- es** Equipo de administración de fluidos intravenosos normotérmicos
- it** Set per somministrazione endovenosa di fluidi normotermici
- nl** Normotherme infuusvloeistoftoedieningsset
- pt** Conjunto normotérmico de administração de fluidos intravenosos
- sv** Administreringsssats för normoterm iv-vätska
- da** Normotermisk iv-administrationsæt til væske
- no** Normotermisk intravenøst sett for væskeadministrering
- fi** Normaaliämpöinen i.v.-nestein antosetti
- el** Νορμοθερμικό σετ ΕΦ χορήγησης υγρών



Caution



Do not reuse




Not made with natural rubber latex



Do not use if package is damaged



Sterile Fluid Path,
Ethylene oxide
gas sterilized



Keep away from
sunlight



Keep dry



Contains or Presence of
Phthalate: bis(2-ethylhexyl)
phthalate (DEHP)



For export only



4049028



Date of Manufacture:
2020-09-17



Use By:
2024-09-17



(01) 10695085001836 (11) 200917 (17) 240917 (10) 4049028

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55412 USA
www.smiths-medical.com

MADE IN MEXICO

PC10012027-002

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic s. r. o.
Okrouhák 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

smiths medical


- en** Helium Leak Tested
- fr** Soumis à un contrôle d'étanchéité à l'hélium
- de** Mit Helium leckgeprüft
- es** Comprobado mediante la prueba de fugas de helio
- it** Sottoposto a ricerca delle perdite ad elio
- el** Υποβλήθηκε σε δοκιμές διαρροής με ήλιο
- nl** Op dichtheid getest met helium
- pt** Testado contra fugas com hélio
- sv** Läckagetestad med helium
- da** Tæthedstest med helium udført
- fi** Vuototestattu heliumilla
- no** Lekkasetestet med helium

4321394 Rev. 000 (7/07)




Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 9. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 675 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**

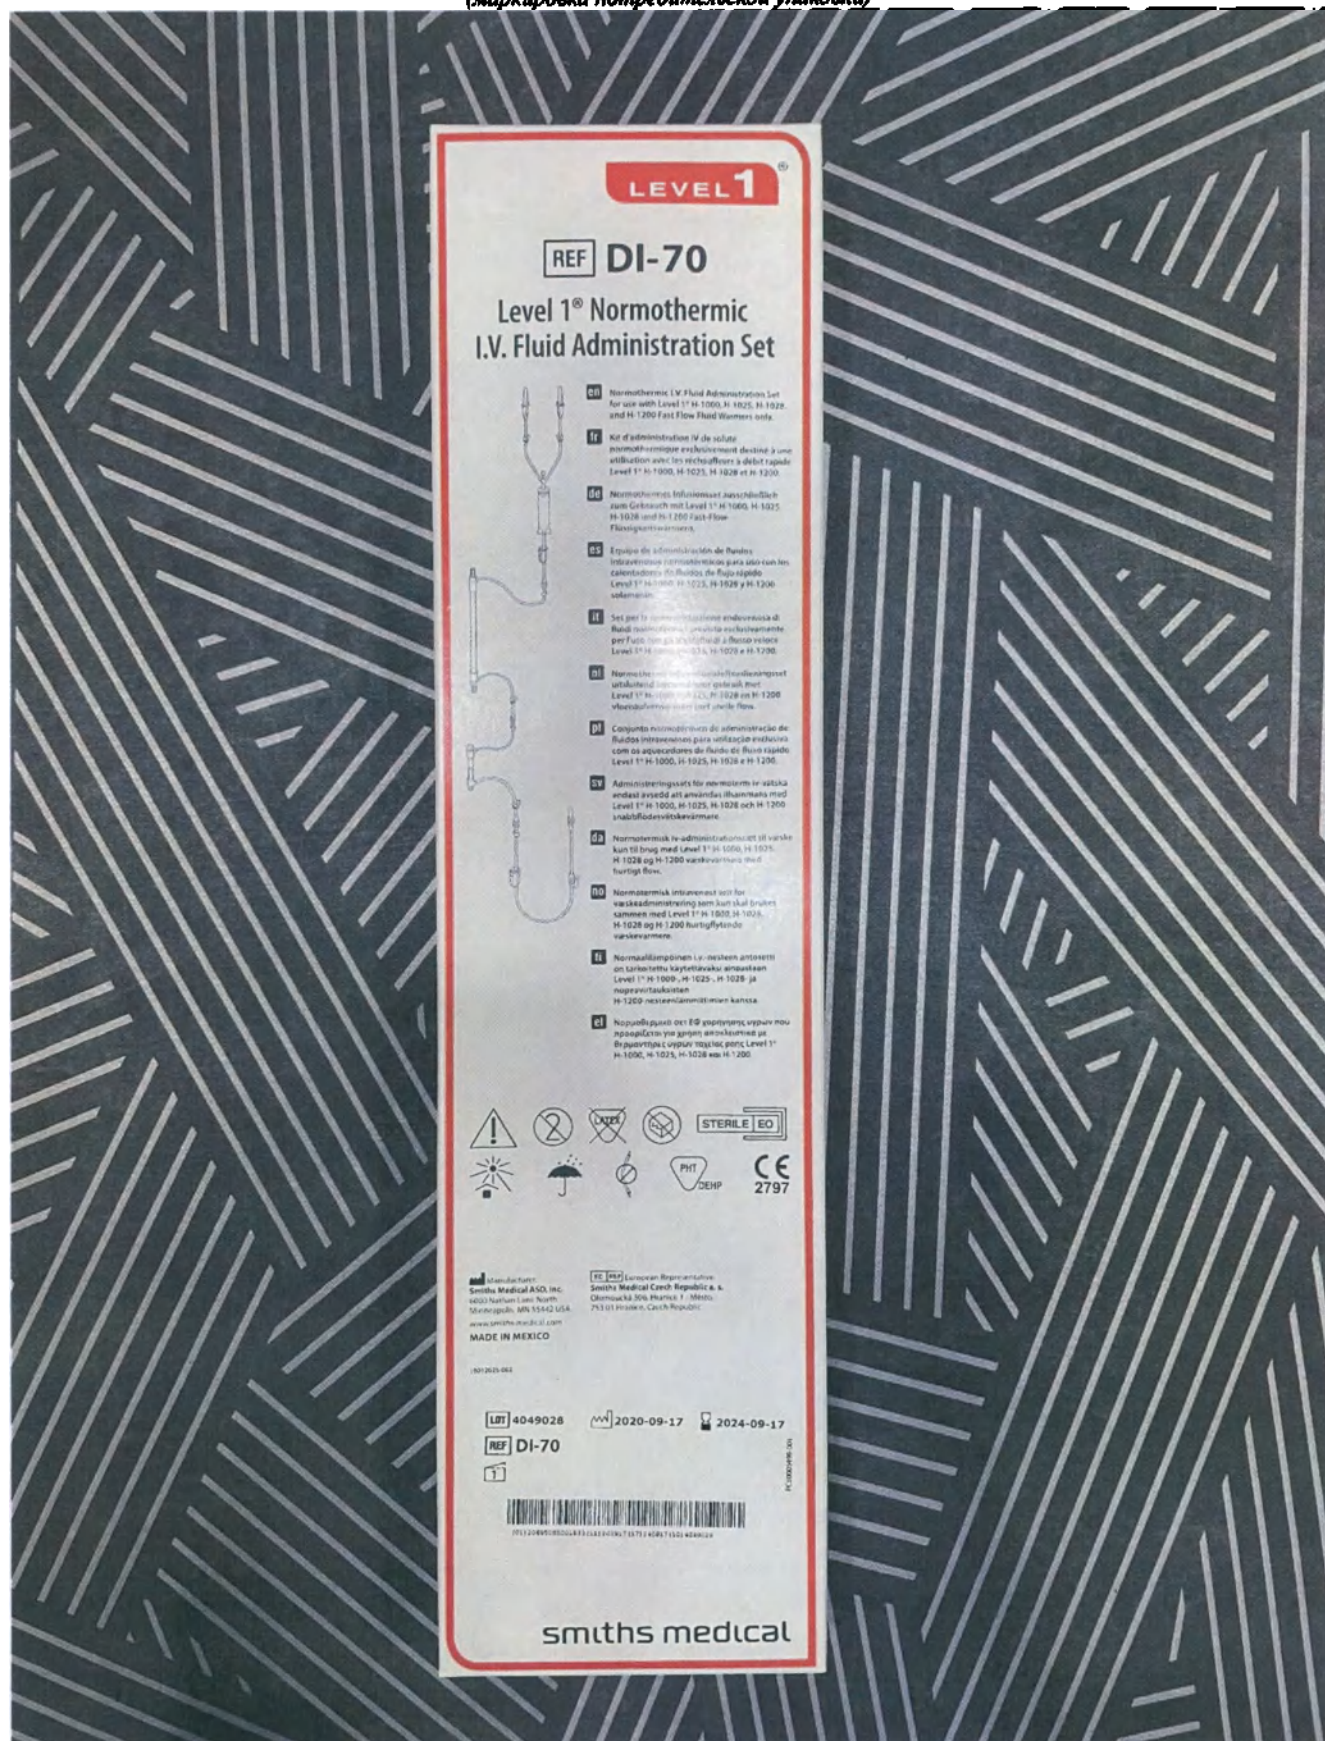


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 9. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 675 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)

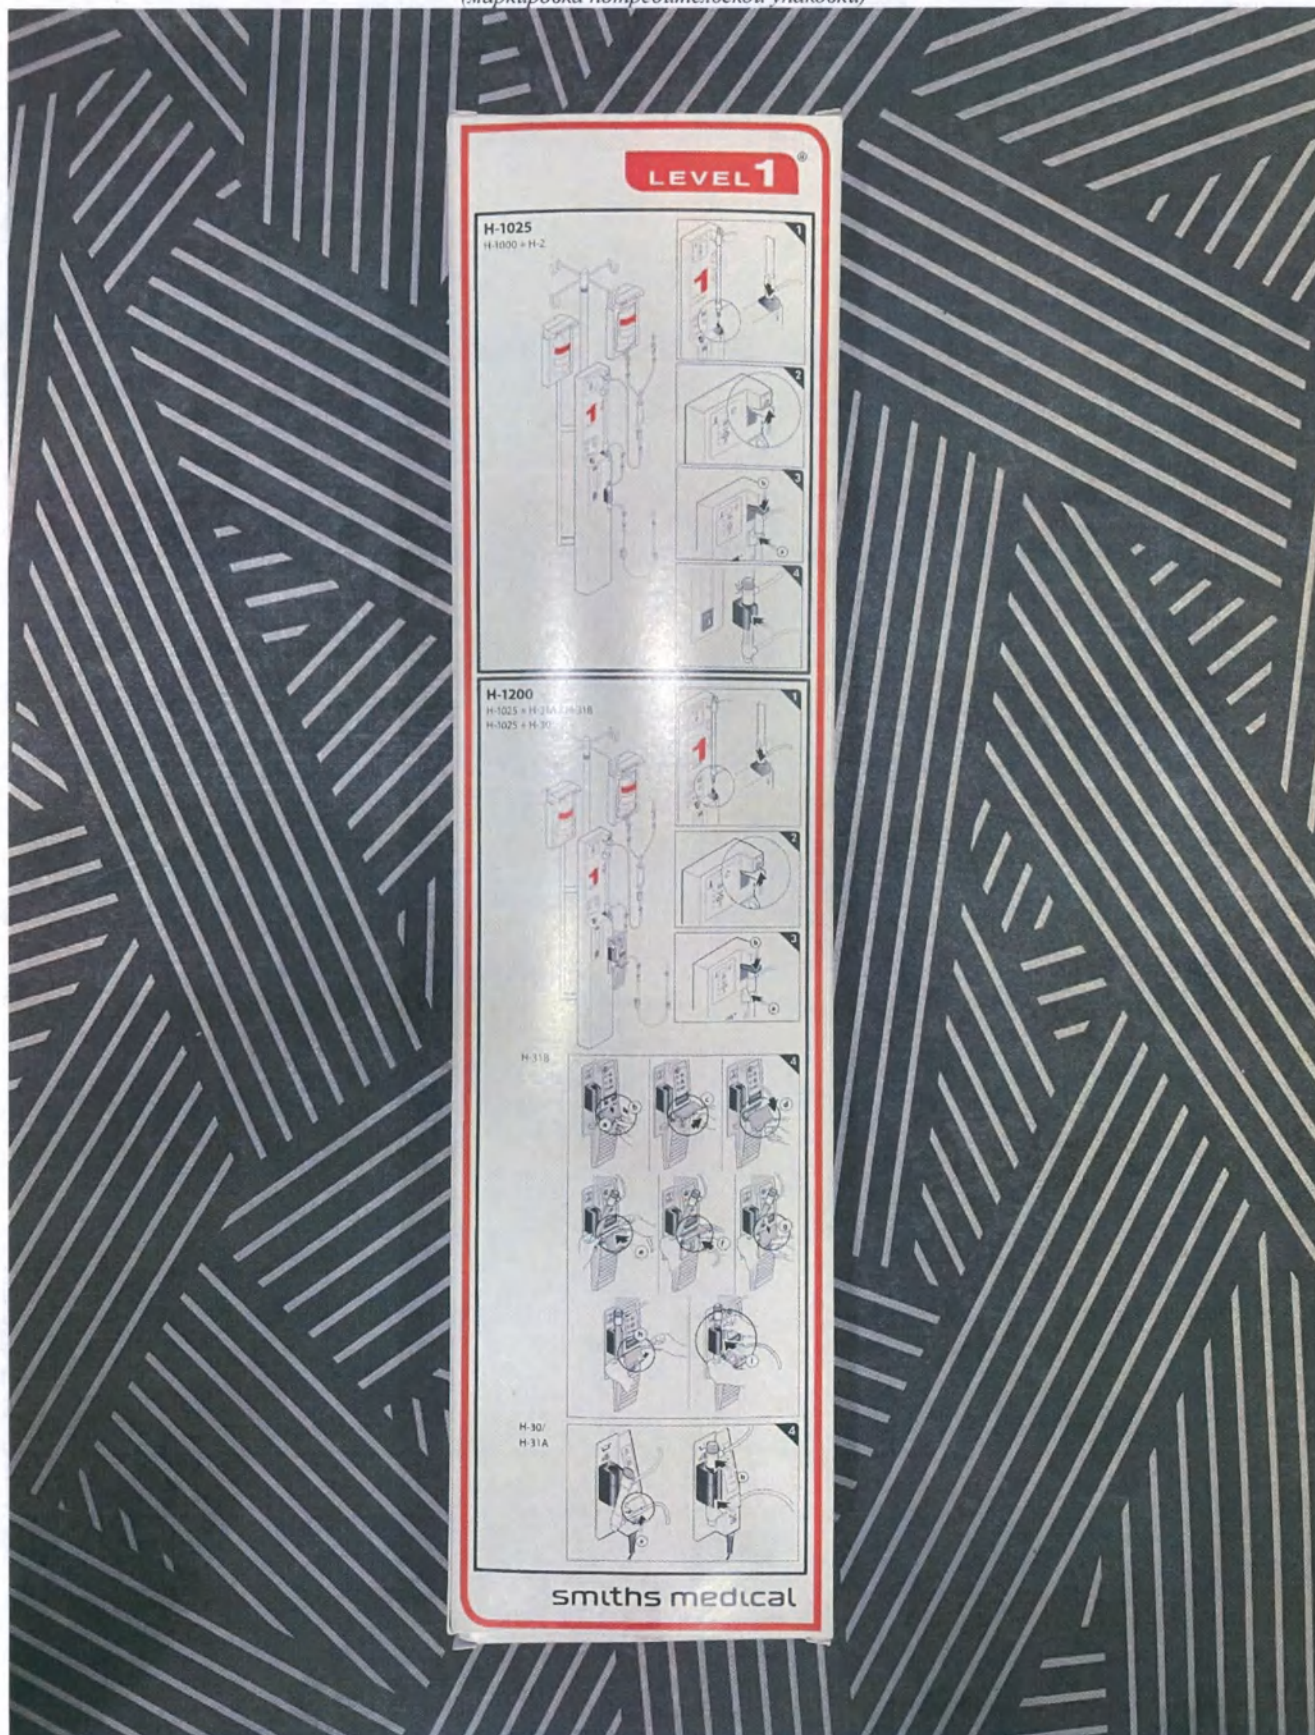

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 9. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 675 мл/мин — не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)

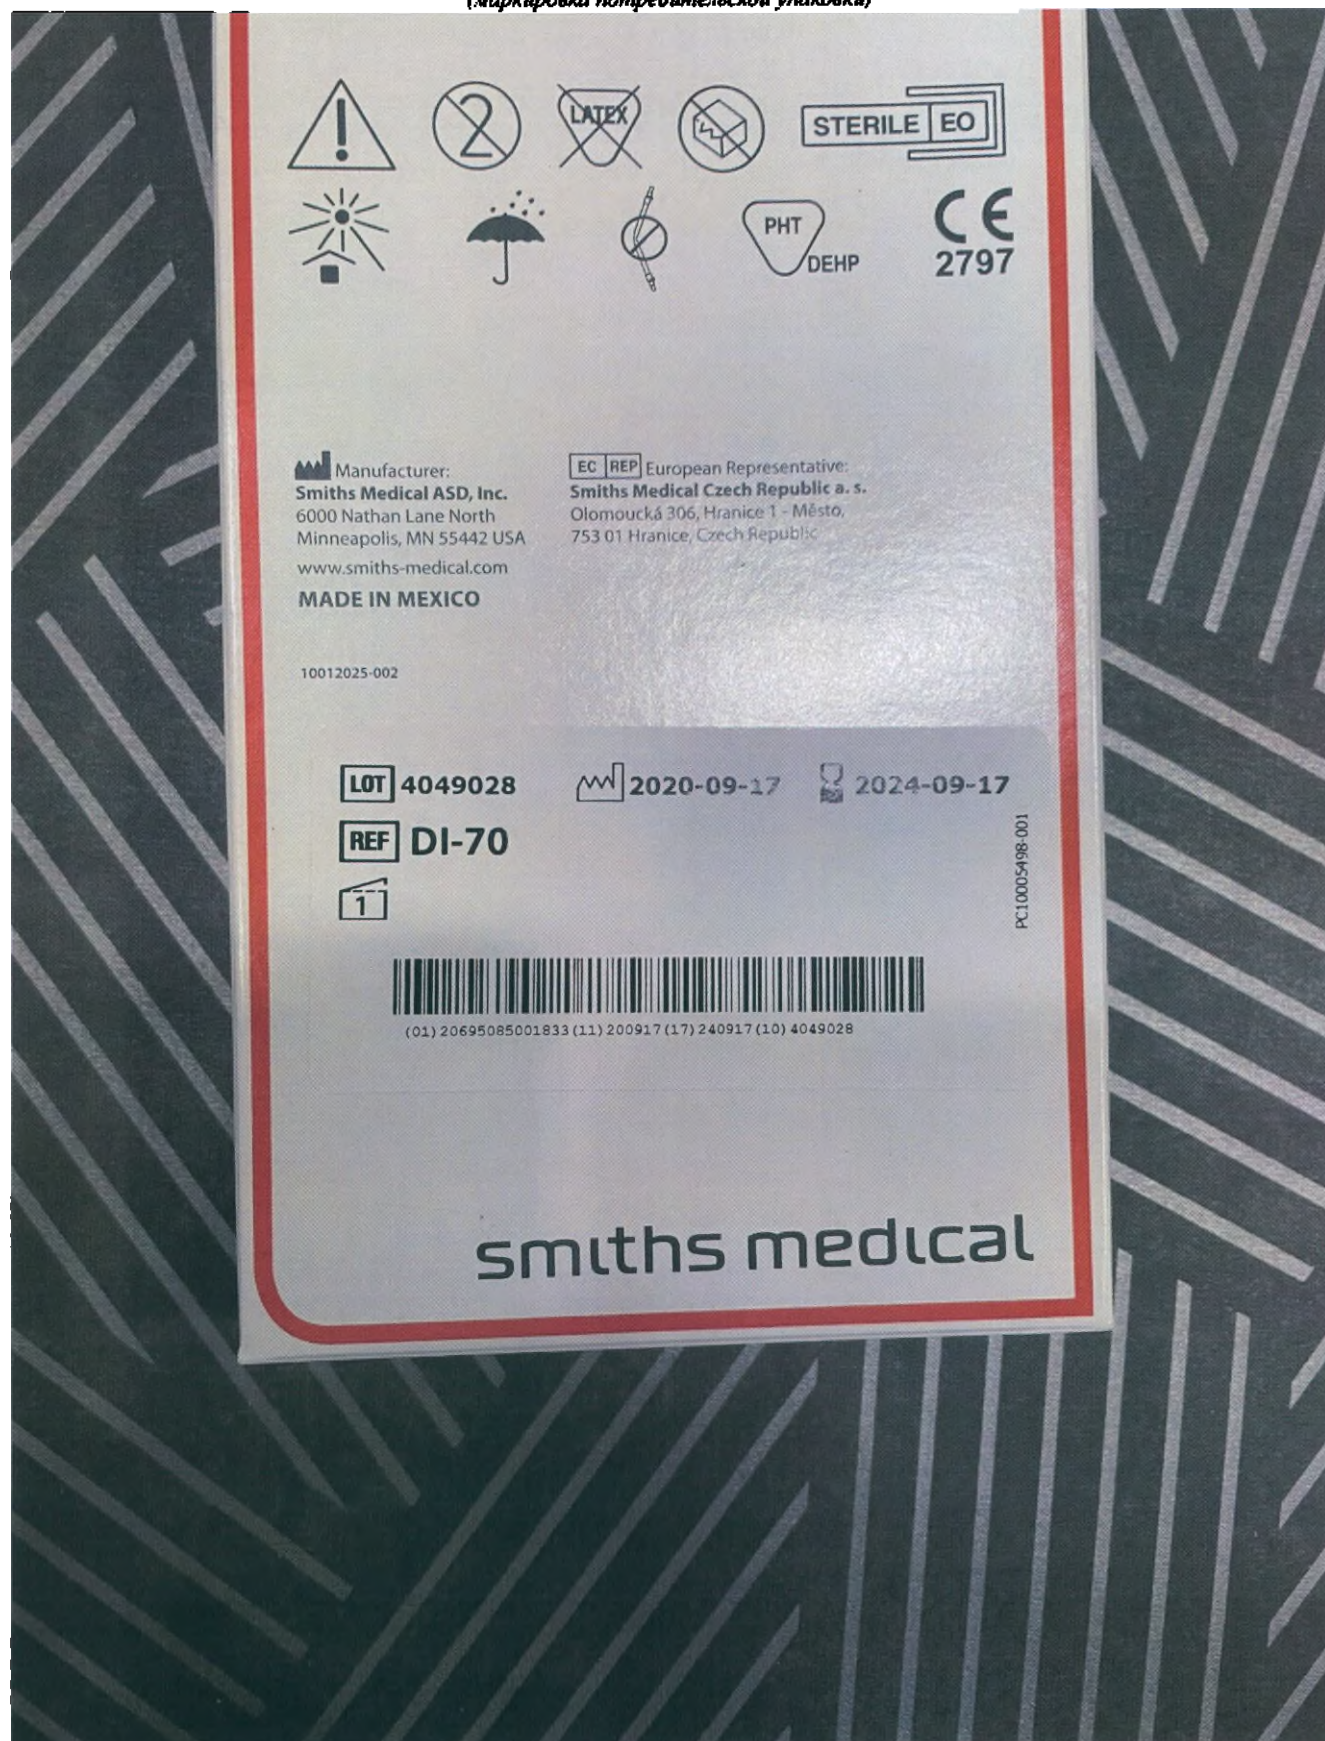


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1* с принадлежностями.

I. Основной состав: 9. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1*. скорость потока от 30 мл/мин до 675 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(изделие в индивидуальной упаковке)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 9. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 675 мл/мин – не более 5 уп., по 20 шт./уп. (при необходимости)
(общий вид)

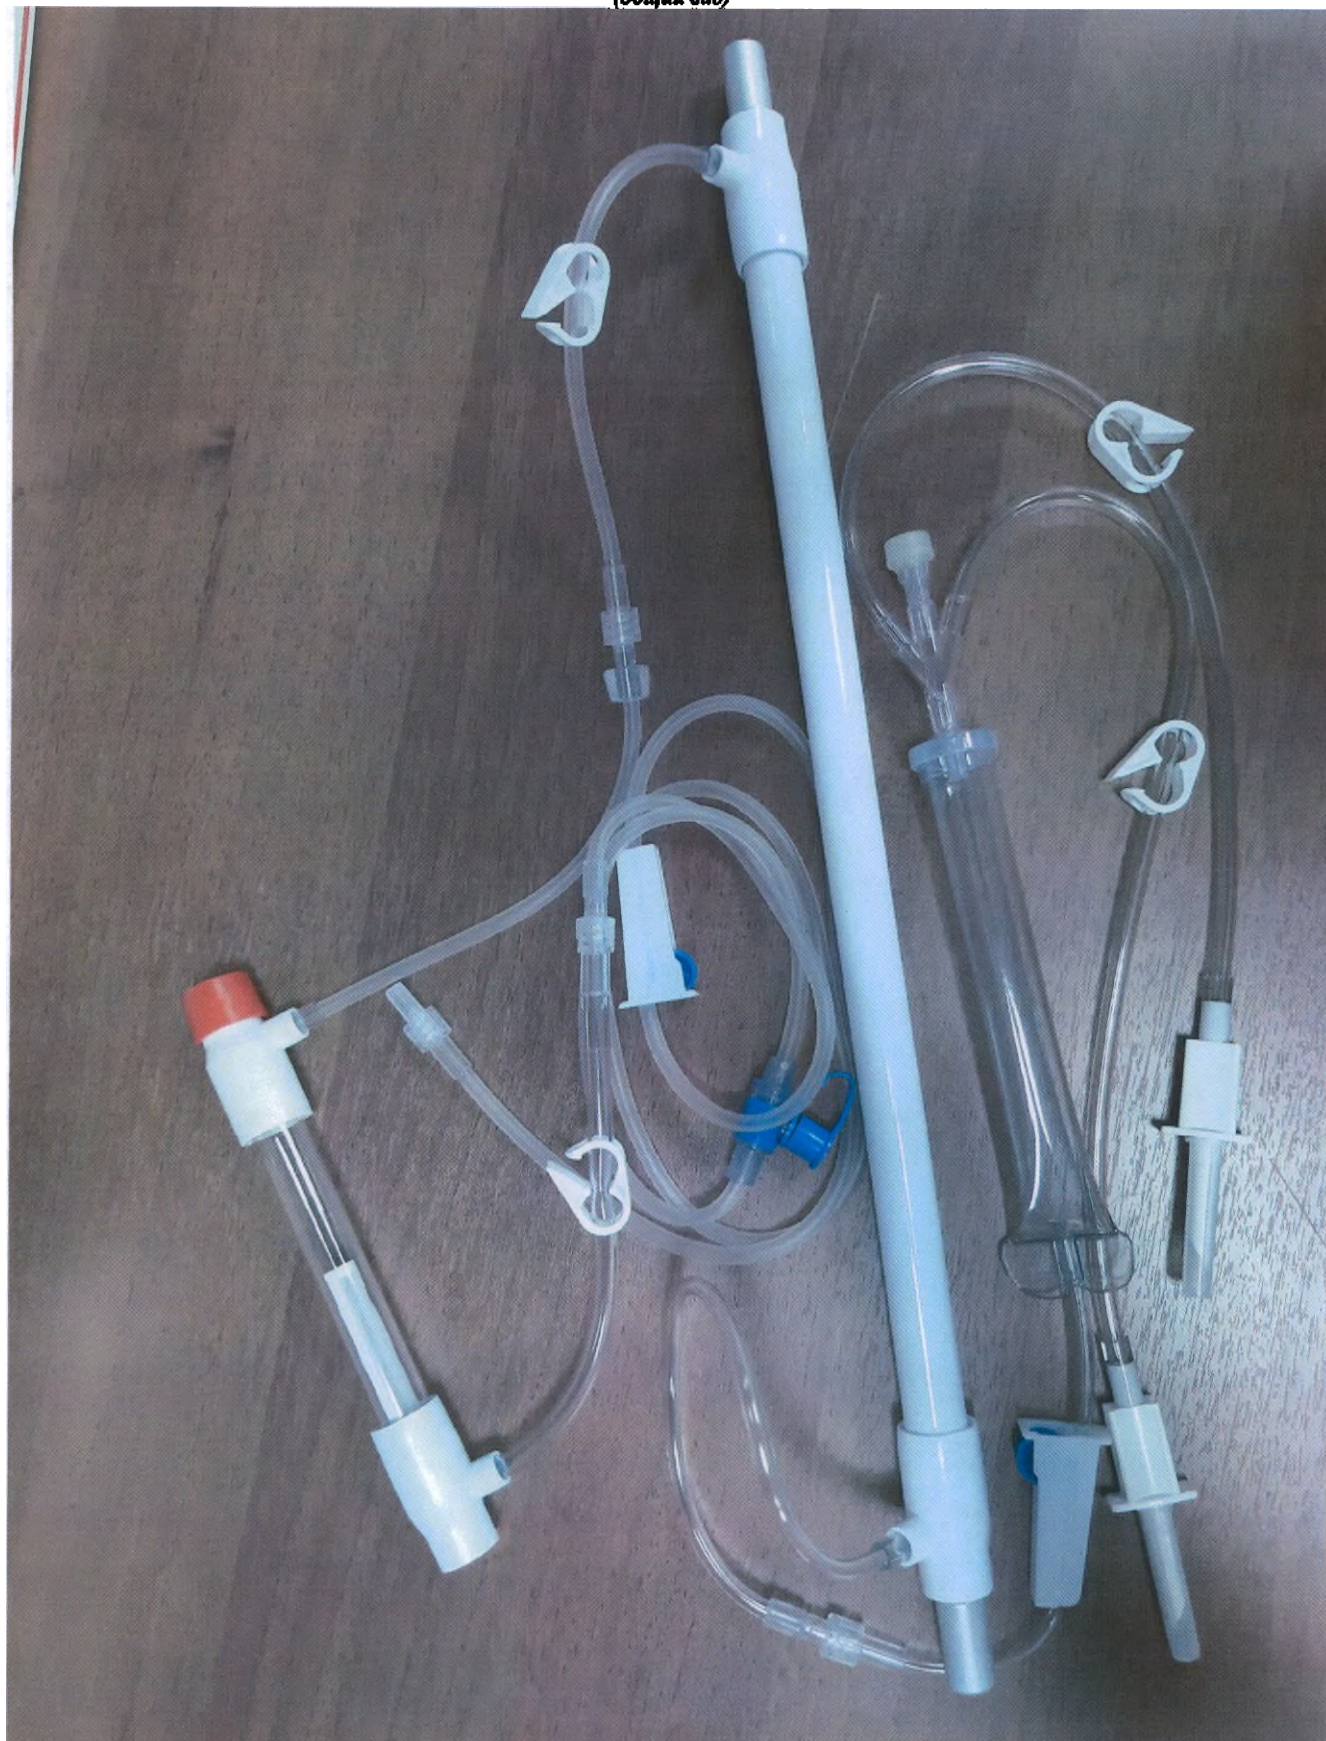

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

1. Основной состав: 10. Магистрала для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 950 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка транспортной упаковки)

REF DI-100

LEVEL 1

Level 1® Normothermic I.V. Fluid Administration Set

en Normothermic I.V. Fluid Administration Set
fr Kit d'administration IV de soluté normothermique
de Normothermes Infusionsset
es Equipo de administración de fluidos intravenosos normotérmicos
it Set per somministrazione endovenosa di fluidi normotermici
nl Normotherme infuusvloei-toedieningsset
pt Conjunto normotérmico de administração de fluidos intravenosos
sv Administreringsset för normoterm iv-vätska
da Normotermisk iv-administrationssæt til væske
no Normotermisk intravenøst sett for væskeadministrering
fi Normaaliämpöinen i.v.-nesteen antosetti
el Νορμοθερμικό σετ ΕΦ χορήγησης υγρών



Caution




Do not reuse



Not made with natural rubber latex



Do not use if package is damaged



Sterile Fluid Path, Ethylene oxide gas sterilized



Keep away from sunlight



Keep dry



Contains or Presence of Phthalate: bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)



For export only



4086176



Date of Manufacture: 2020-12-11



Use By: 2024-12-11



(01) 50695085410018 (11) 201211 (17) 241211 (10) 4086176

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic s. r. o.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

PC10012235-002


smiths medical

en Helium Leak Tested
fr Soumis à un contrôle d'étanchéité à l'hélium
de Mit Helium leckgeprüft
es Comprobado mediante la prueba de fugas de helio
it Sottoposto a ricerca delle perdite ad elio
el Υποβλήθηκε σε δοκιμές διαρροής με ήλιο
nl Op dichtheid getest met helium
pt Testado contra fugas com hélio
sv Läckagetestad med helium
da Tæthedspøve med helium udført
fi Vuototestattu heliumilla
no Lekkasjetestet med helium

4521394 Rev. 008 (7/07)

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 10. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 950 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)

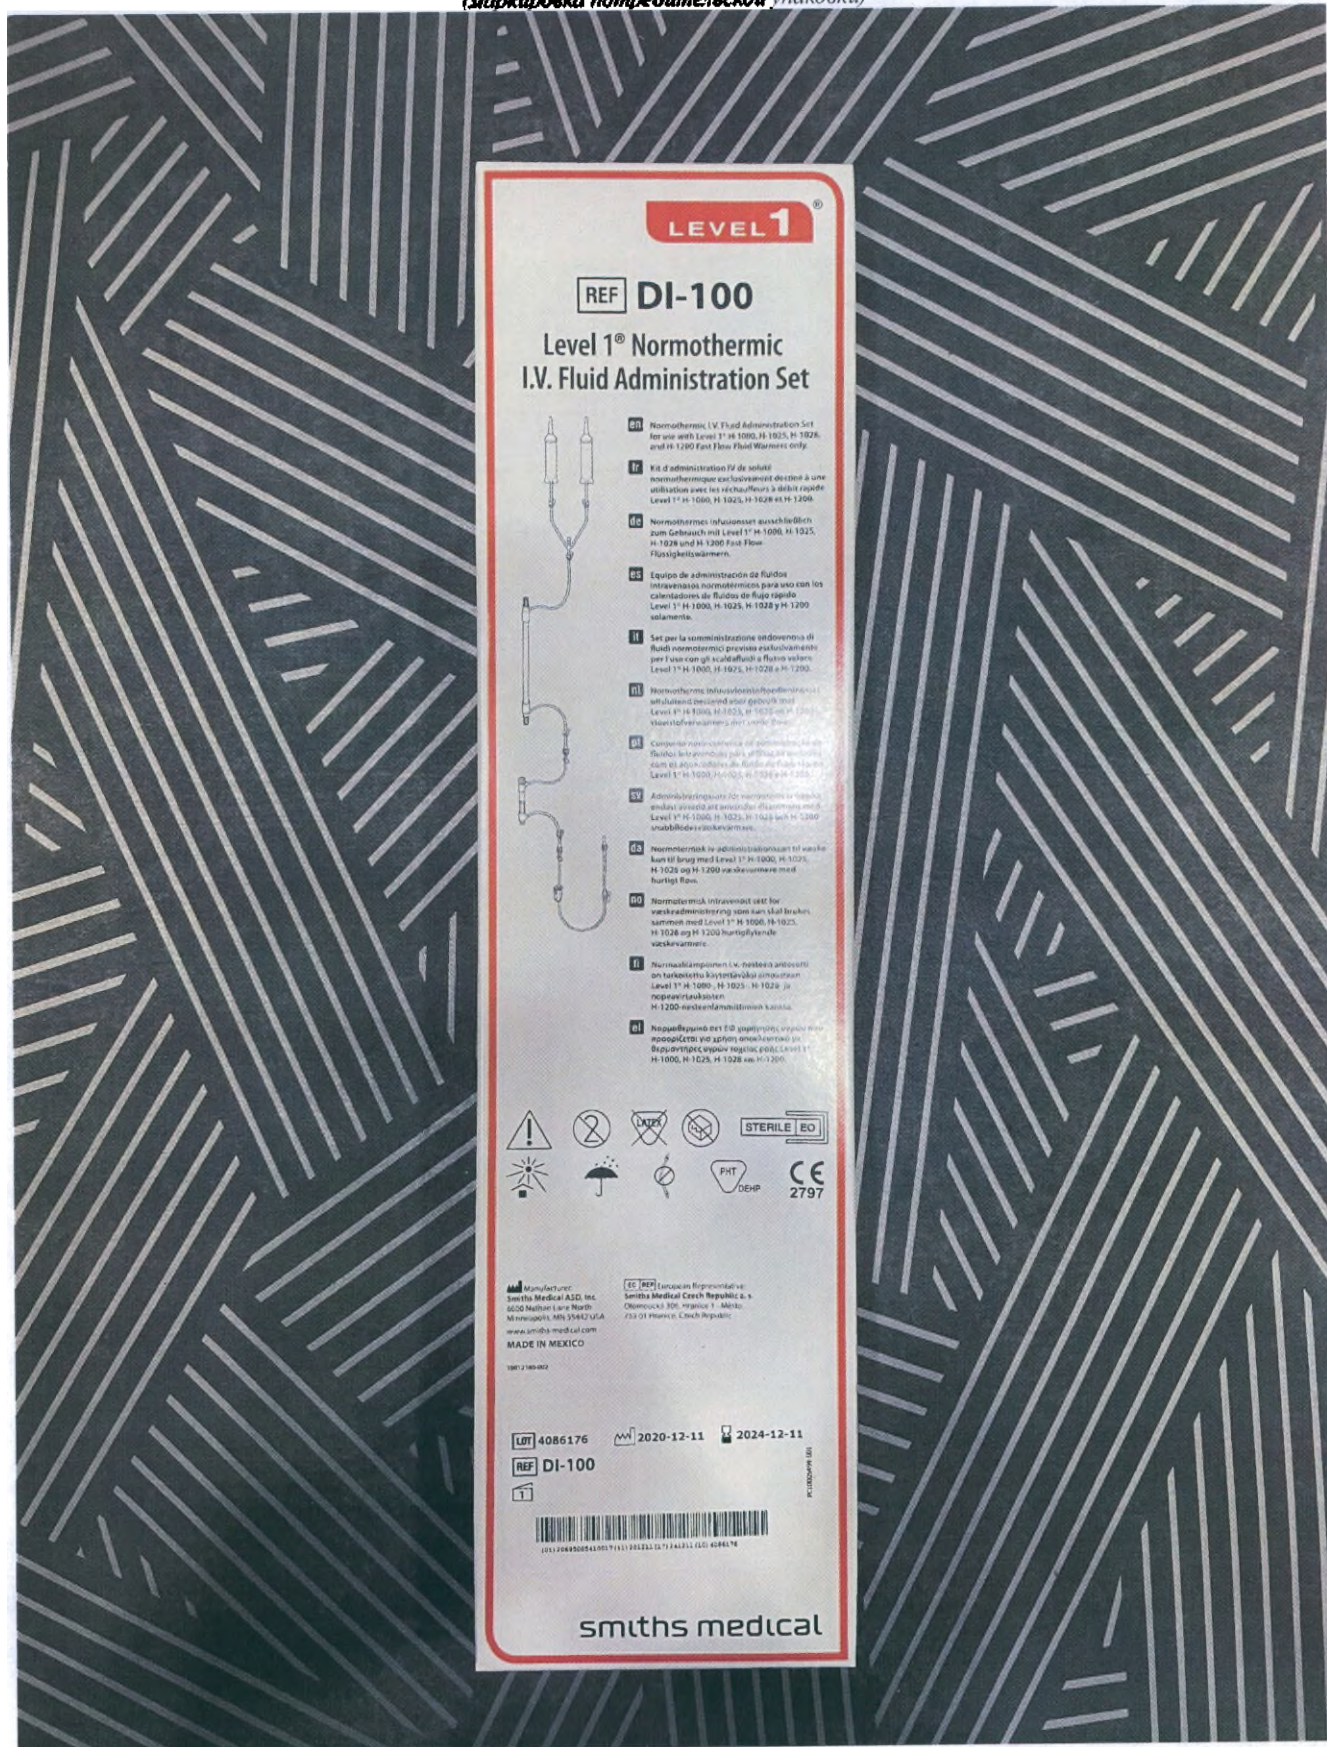

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.


I. Основной состав: 10. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 950 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)

(маркировка потребительской упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 10. Магистралей для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 950 мл/мин — не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**

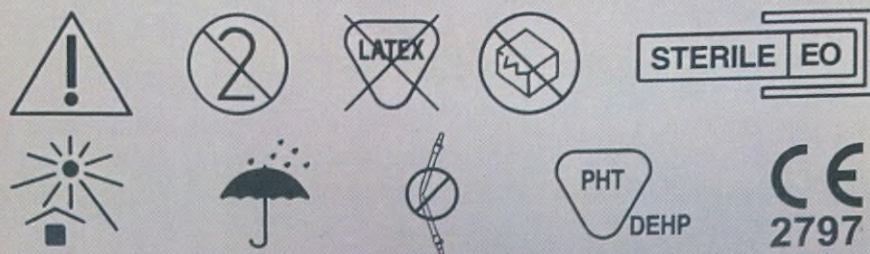

 **Manufacturer:**
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP European Representative
Smiths Medical Czech Republic a.s.
Olomoucká 306, Hranice 1 – Město
753 01 Hranice, Czech Republic

10012180-002

LOT 4086176

 2020-12-11

 2024-12-11

REF DI-100



PC10005494-001



(01) 20695085410017 (11) 201211 (17) 241211 (10) 4086176

smiths medical


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 10. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 950 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(изделие в индивидуальной упаковке)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 10. Магистралы для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 950 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(общий вид)**

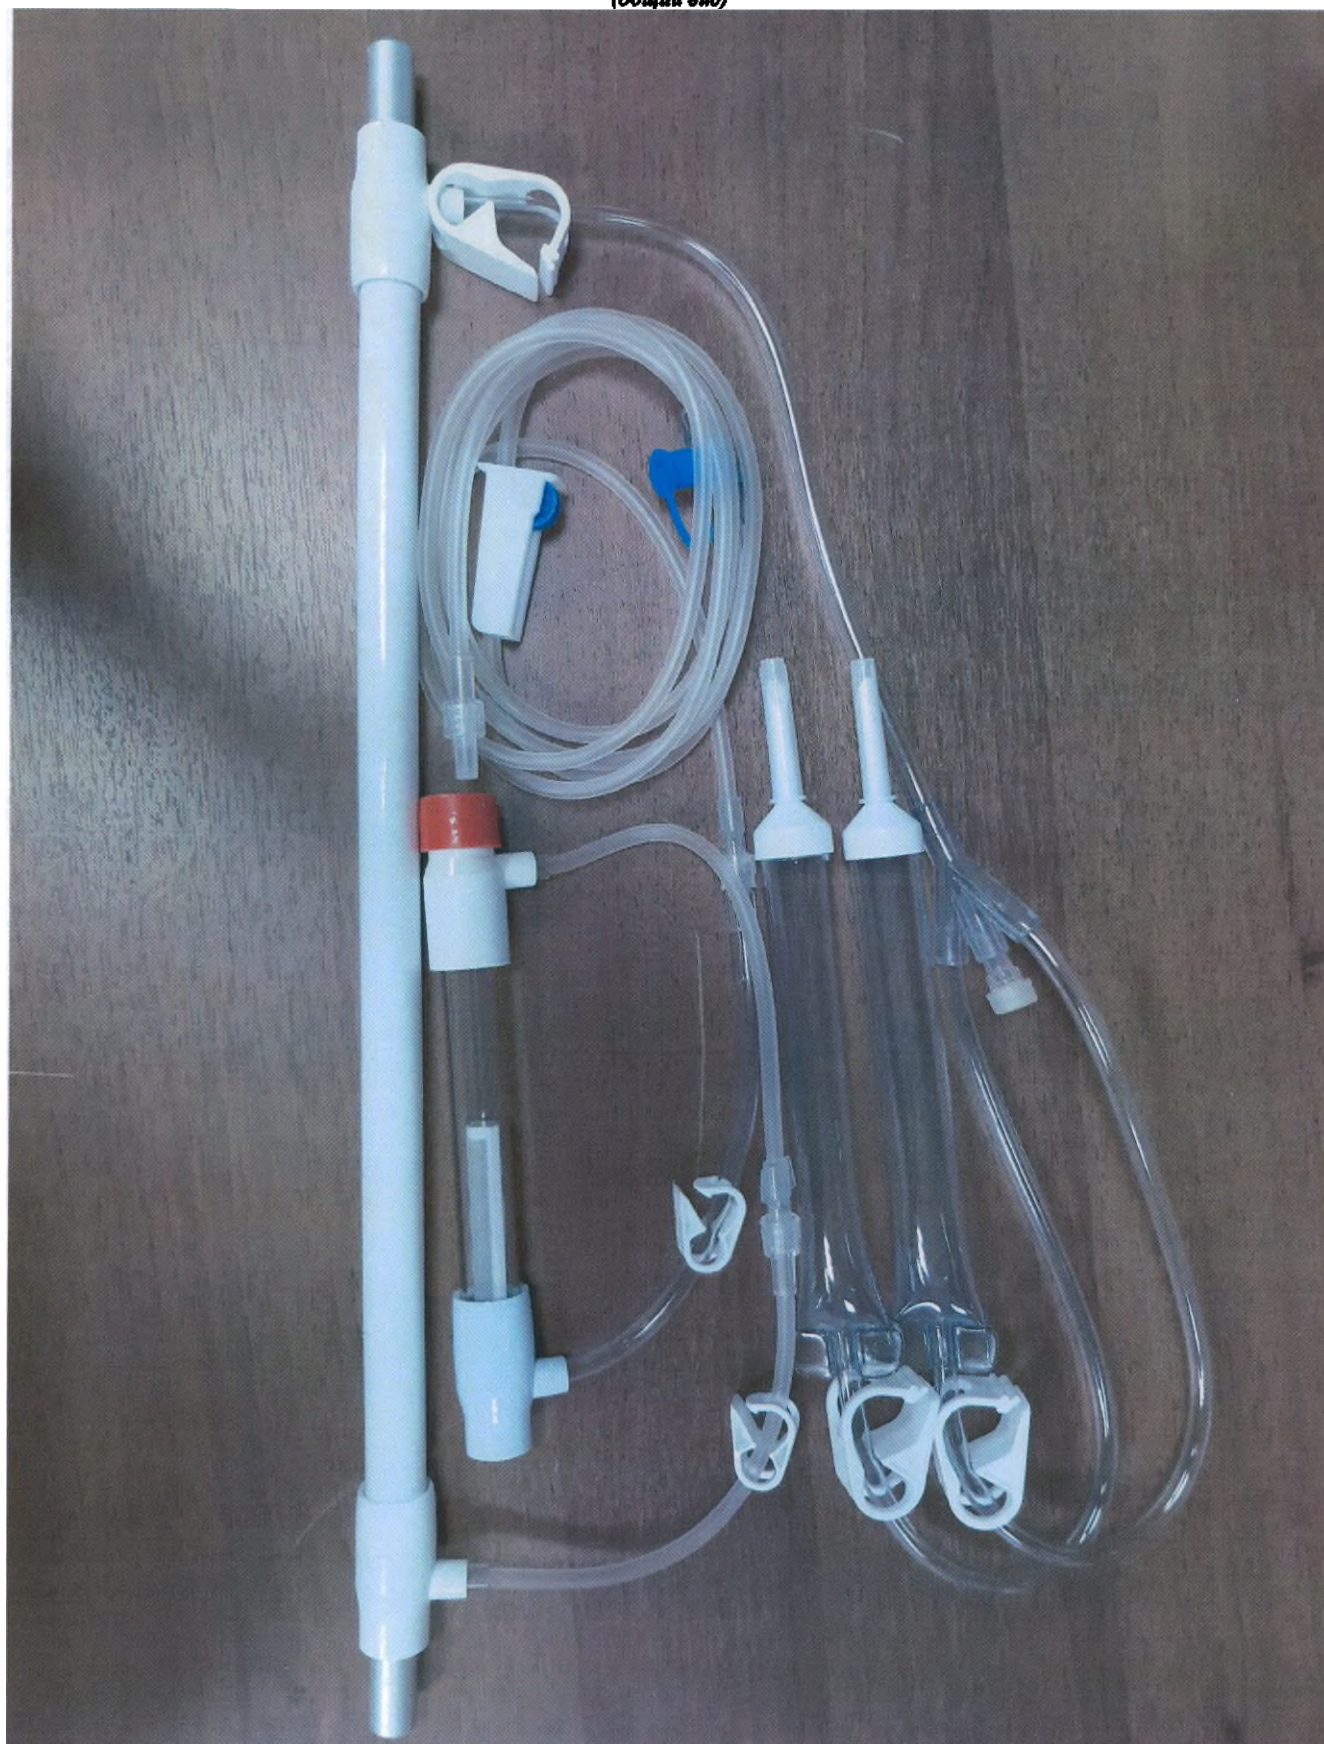

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

1. Основной состав: 11. Магистрала для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1® , скорость потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка транспортной упаковки)

REF **DI-300**

LEVEL 1

Level 1® Normothermic I.V. Fluid Administration Set


- en** Normothermic I.V. Fluid Administration Set
- fr** Kit d'administration IV de soluté normothermique
- de** Normothermes Infusionsset
- es** Equipo de administración de fluidos intravenosos normotérmicos
- it** Set per somministrazione endovenosa di fluidi normotermici
- nl** Normotherme infuusvloeistoftoedieningsset
- pt** Conjunto normotérmico de administração de fluidos intravenosos
- sv** Administreringsset för normoterm iv-vätska
- da** Normotermisk iv-administrationssæt til væske
- no** Normotermisk intravenøst sett for væskeadministrering
- fi** Normaaliämpöinen i.v.-nesteantosetti
- el** Νορμοθερμικό σετ ΕΦ χορήγησης υγρών




Caution



Do not reuse



Not made with natural rubber latex



Do not use if package is damaged



Sterile Fluid Path, Ethylene oxide gas sterilized



Keep away from sunlight



Keep dry



Contains or Presence of Phthalate: bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

CE 2797

For export only

LOT 4018863

10

Date of Manufacture: 2020-07-13

Use By: 2024-07-13



(01) 50695085430016 (11) 200713 (17) 240713 (10) 4018863

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6050 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a.s.
Olomoucká 306, Pátek 1 - Mlýnský
753 01 Hezlová, Czech Republic

smiths medical

- en** Helium Leak Tested
- fr** Soumis à un contrôle d'étanchéité à l'hélium
- de** Mit Helium leckgeprüft
- es** Comprobado mediante la prueba de fugas de helio
- it** Sottoposto a ricerca delle perdite ad elio
- el** Υποβλήθηκε σε δοκιμές διαρροής με ήλιο
- nl** Op dichtheid getest met helium
- pt** Testado contra fugas com hélio
- sv** Läckagetestad med helium
- da** Tæthedstest med helium udført
- fi** Vuototestattu heliumilla
- no** Lekkasjetestet med helium

4521394 Rev. 000 (7/07)


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**1. Основной состав: 11. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**

LEVEL 1®

REF DI-300

**Level 1® Normothermic
I.V. Fluid Administration Set**

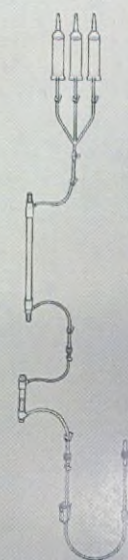

- en** Normothermic I.V. Fluid Administration Set for use with Level 1® H-1000, H-1025, H-1028, and H-1200 Fast Flow Fluid Warmers only.
- fr** Kit d'administration IV de solution normothermique exclusivement destiné à une utilisation avec les réchauffeurs à débit rapide Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 et H-1200.
- de** Normothermie Infusionsset ausschließlich zum Gebrauch mit Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 und H-1200 Fast-Flow Flüssigkeitswärmern.
- es** Equipo de administración de fluidos intravenosos normotérmicos para uso con los calentadores de fluidos de flujo rápido Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 y H-1200 solamente.
- it** Set per la somministrazione endovenosa di fluidi normotermici previsto esclusivamente per l'uso con gli scaldafluidi a flusso veloce Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 e H-1200.
- nl** Normothermie Infusievoetstofvoedingsset uitsluitend bestemd voor gebruik met Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 en H-1200 voestofverwarmers met snelle flow.
- pt** Conjunto normotérmico de administração de fluidos intravenosos para utilização exclusiva com os aquecedores de fluido de fluxo rápido Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 e H-1200.
- sv** Administreringssett för normotermisk vätska endast avsett att användas tillsammans med Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 och H-1200 snabbflödesvätskavärmare.
- da** Normotermisk iv-administrationsset til væske kun til brug med Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 og H-1200 hurtigflydende væskevarmere.
- no** Normotermisk infusjonssett for væskeadministrasjon, som kun skal brukes sammen med Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 og H-1200 hurtigflytende væskevarmere.
- fi** Normotermiämpöinen I.V.-nesteen ainevienti on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Level 1® H-1000-, H-1025-, H-1028- ja nopeavirtauksien H-1200-estepumputtimien kanssa.
- ru** Набор для инф. терапии с подогревом предназначен для использования только с приборами для инф. терапии с подогревом, пор. Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 и H-1200.



Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6900 Nuthan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a.s.
Otomácká 306, Hranice 1 – Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

10012166-002

LOT 4018863

REF DI-300

1

2020-07-13

2024-07-13

PC1000495-001




(01)2069508430023 (31)299773 (17)240713 (10)4018863

smiths medical

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 11. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**

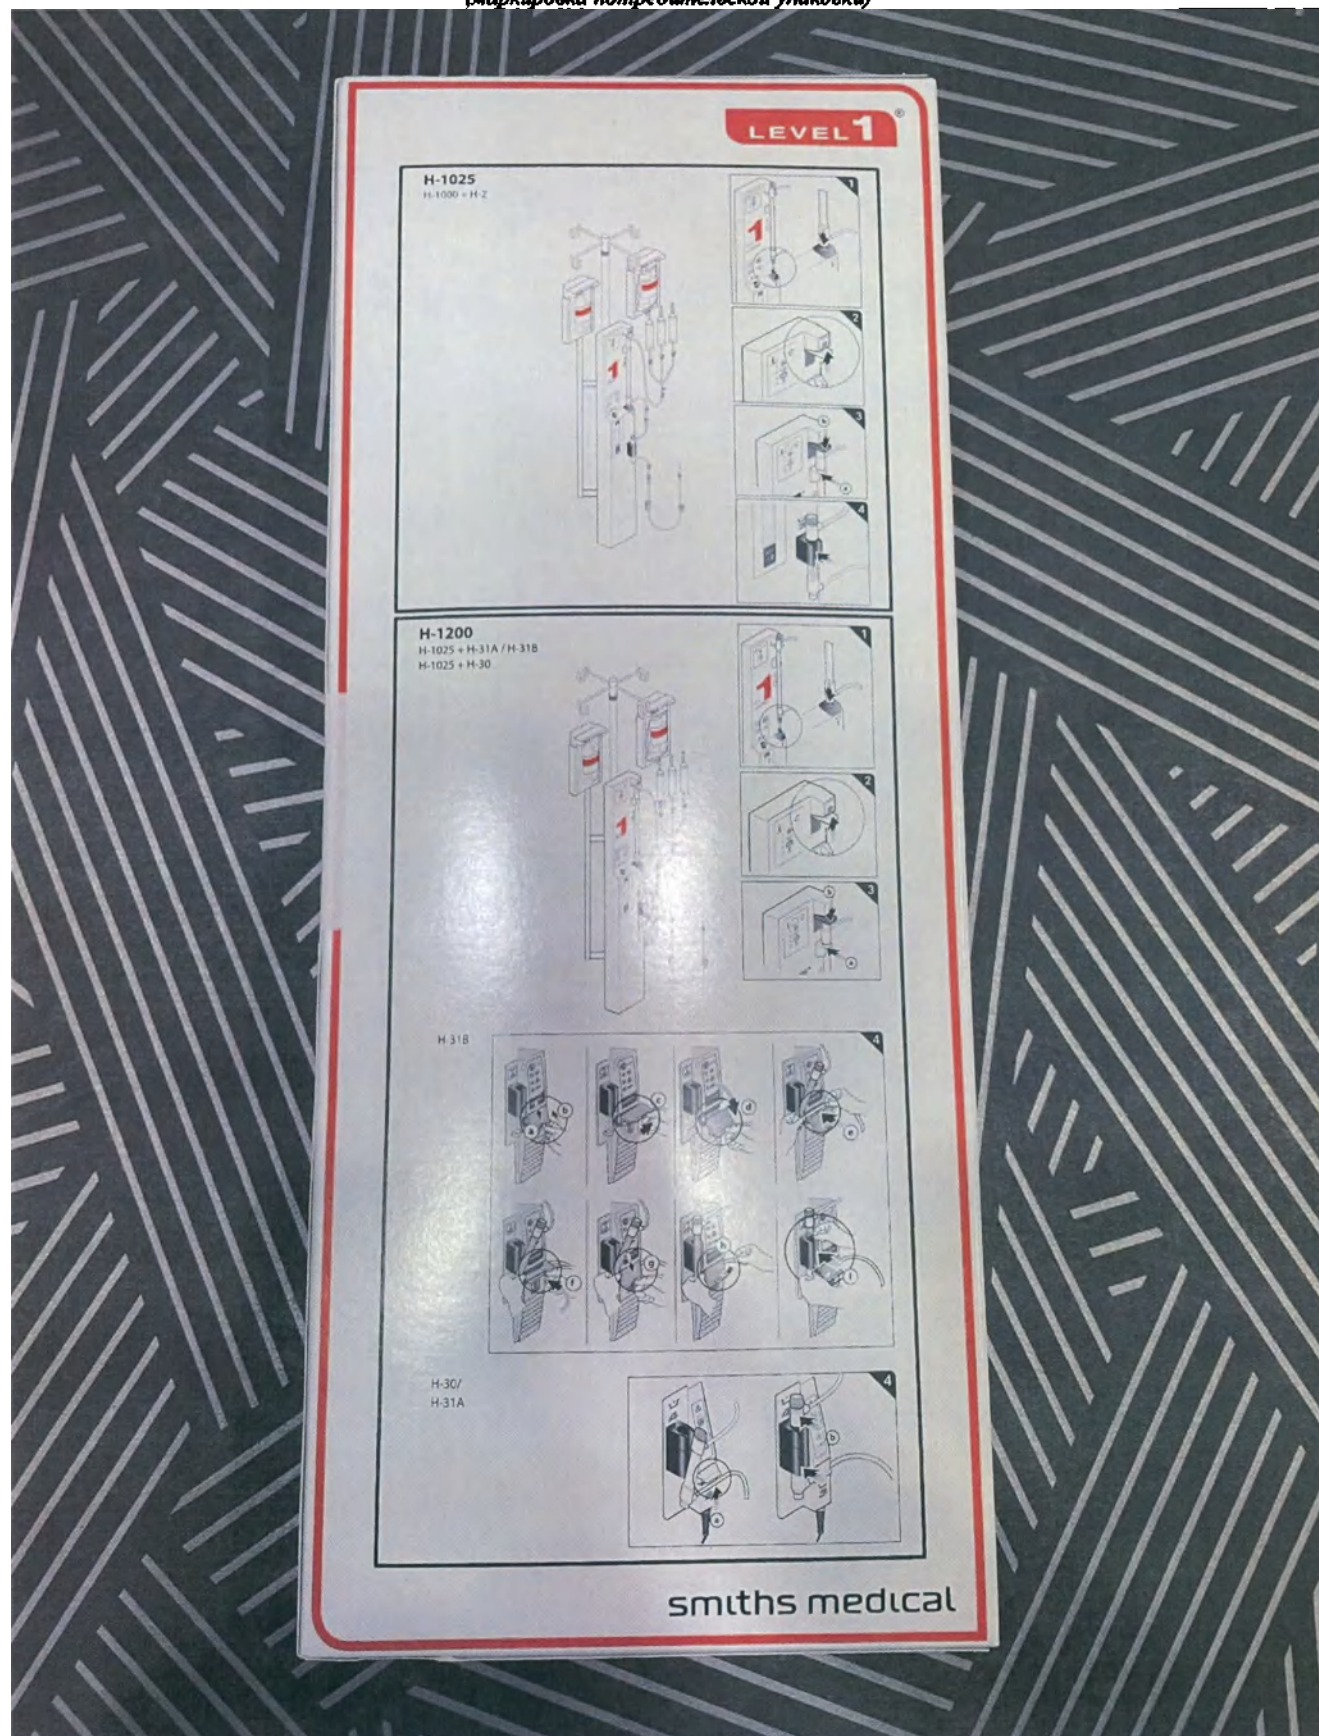

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 11. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)

Ε Normothermικό σέτ ΕΦ χορήγησης υγρών που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με θερμαντήρες υγρών ταχείας ροής Level 1® H-1000, H-1025, H-1028 και H-1200.



Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

10012166-002

LOT 4018863

2020-07-13

2024-07-13

REF DI-300

1

PC10005495-001



(01) 20695085430015 (11) 200713 (17) 240713 (10) 4018863

smiths medical

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**I. Основной состав: 11. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(изделие в индивидуальной упаковке)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 11. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(общий вид)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

1. Основной состав: 12. Магистралы для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 75 мл/час до 530 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(магистралы транспортной упаковки)

REF DI-60HL

LEVEL 1®

Level 1® Normothermic I.V. Fluid Administration Set

- en Normothermic I.V. Fluid Administration Set
- fr Kit d'administration IV de soluté normothermique
- de Normothermes Infusionsset
- es Equipo de administración de fluidos intravenosos normotérmicos
- it Set per somministrazione endovenosa di fluidi normotermici
- nl Normotherme infuusvloei-toedieningsset
- pt Conjunto normotérmico de administração de fluidos intravenosos
- sv Administreringssats för normoterm iv-vätska
- da Normotermisk iv-administrationssæt til væske
- no Normotermisk intravenøst sett for væskeadministrering
- fi Normaallilämpöinen i.v.-nesteen antosetti
- el Νορμοθερμικό σέτ ΕΦ χορήγησης υγρών



Caution



Do not reuse



Not made with natural rubber latex



Do not use if package is damaged



Sterile Fluid Path, Ethylene oxide gas sterilized



Keep away from sunlight



Keep dry



Contains or Presence of Phthalate: bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)



For export only



4025982



Date of Manufacture: 2020-07-29



Use By: 2024-07-29



(01) 10695085406013 (11) 200729 (17) 240729 (10) 4025982

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a.s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

PC10012024-002


smiths medical

- en Helium Leak Tested
- fr Soumis à un contrôle d'étanchéité à l'hélium
- de Mit Helium leckgeprüft
- es Comprobado mediante la prueba de fugas de helio
- it Sottoposto a ricerca delle perdite ad elio
- el Υποβλήθηκε σε δοκιμές διαρροής με ήλιο
- nl Op dichtheid getest met helium
- pt Testado contra fugas com hélio
- sv Läckagetestad med helium
- da Tæthedstest med helium udført
- fi Vuototestattu heliumilla
- no Lekkasjetestet med helium

4021304 Rev. 000 (1/02)


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**1. Основной состав: 12. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 75 мл/час до 530 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)**

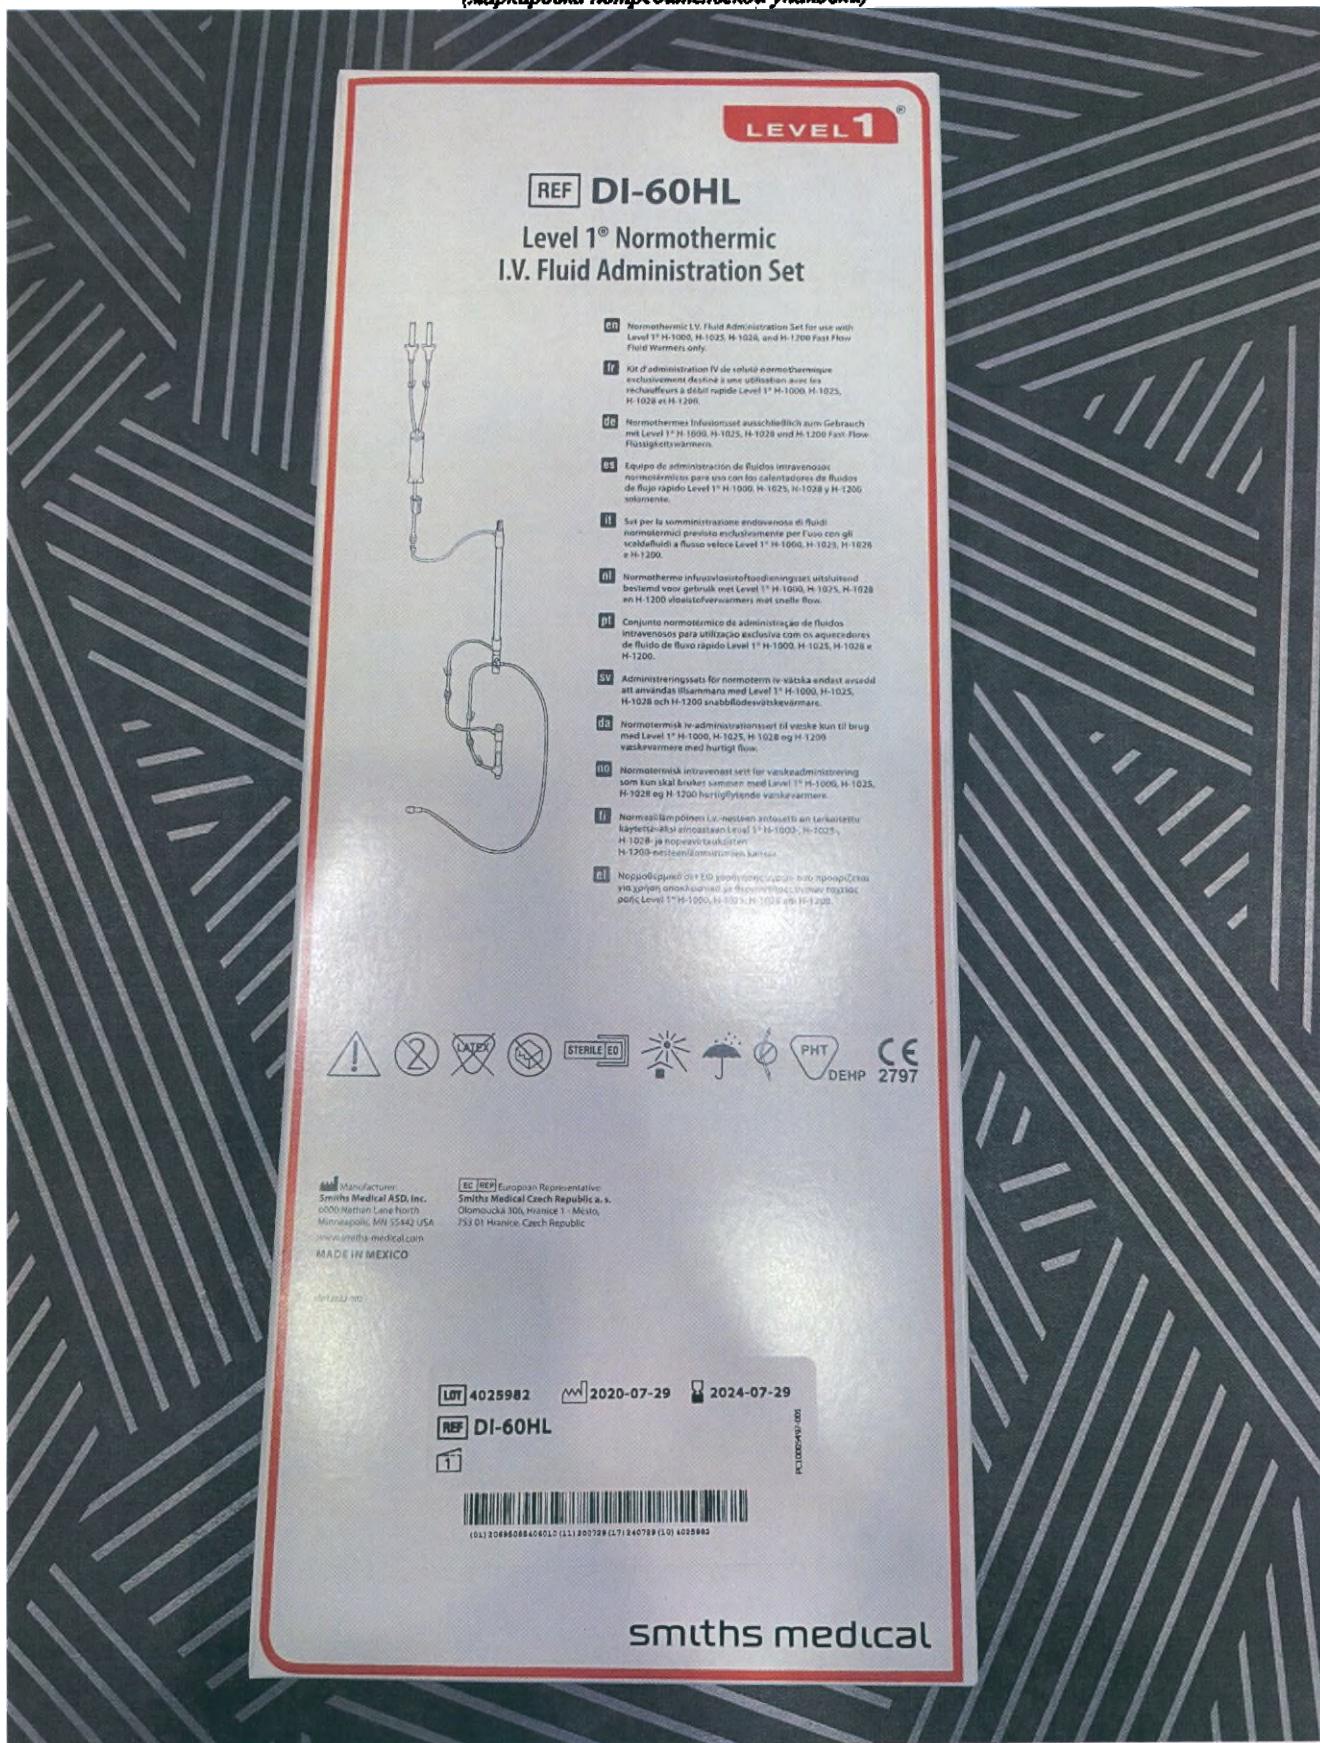

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

1. Основной состав: 12. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®. скорость потока от 75 мл/час до 530 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)

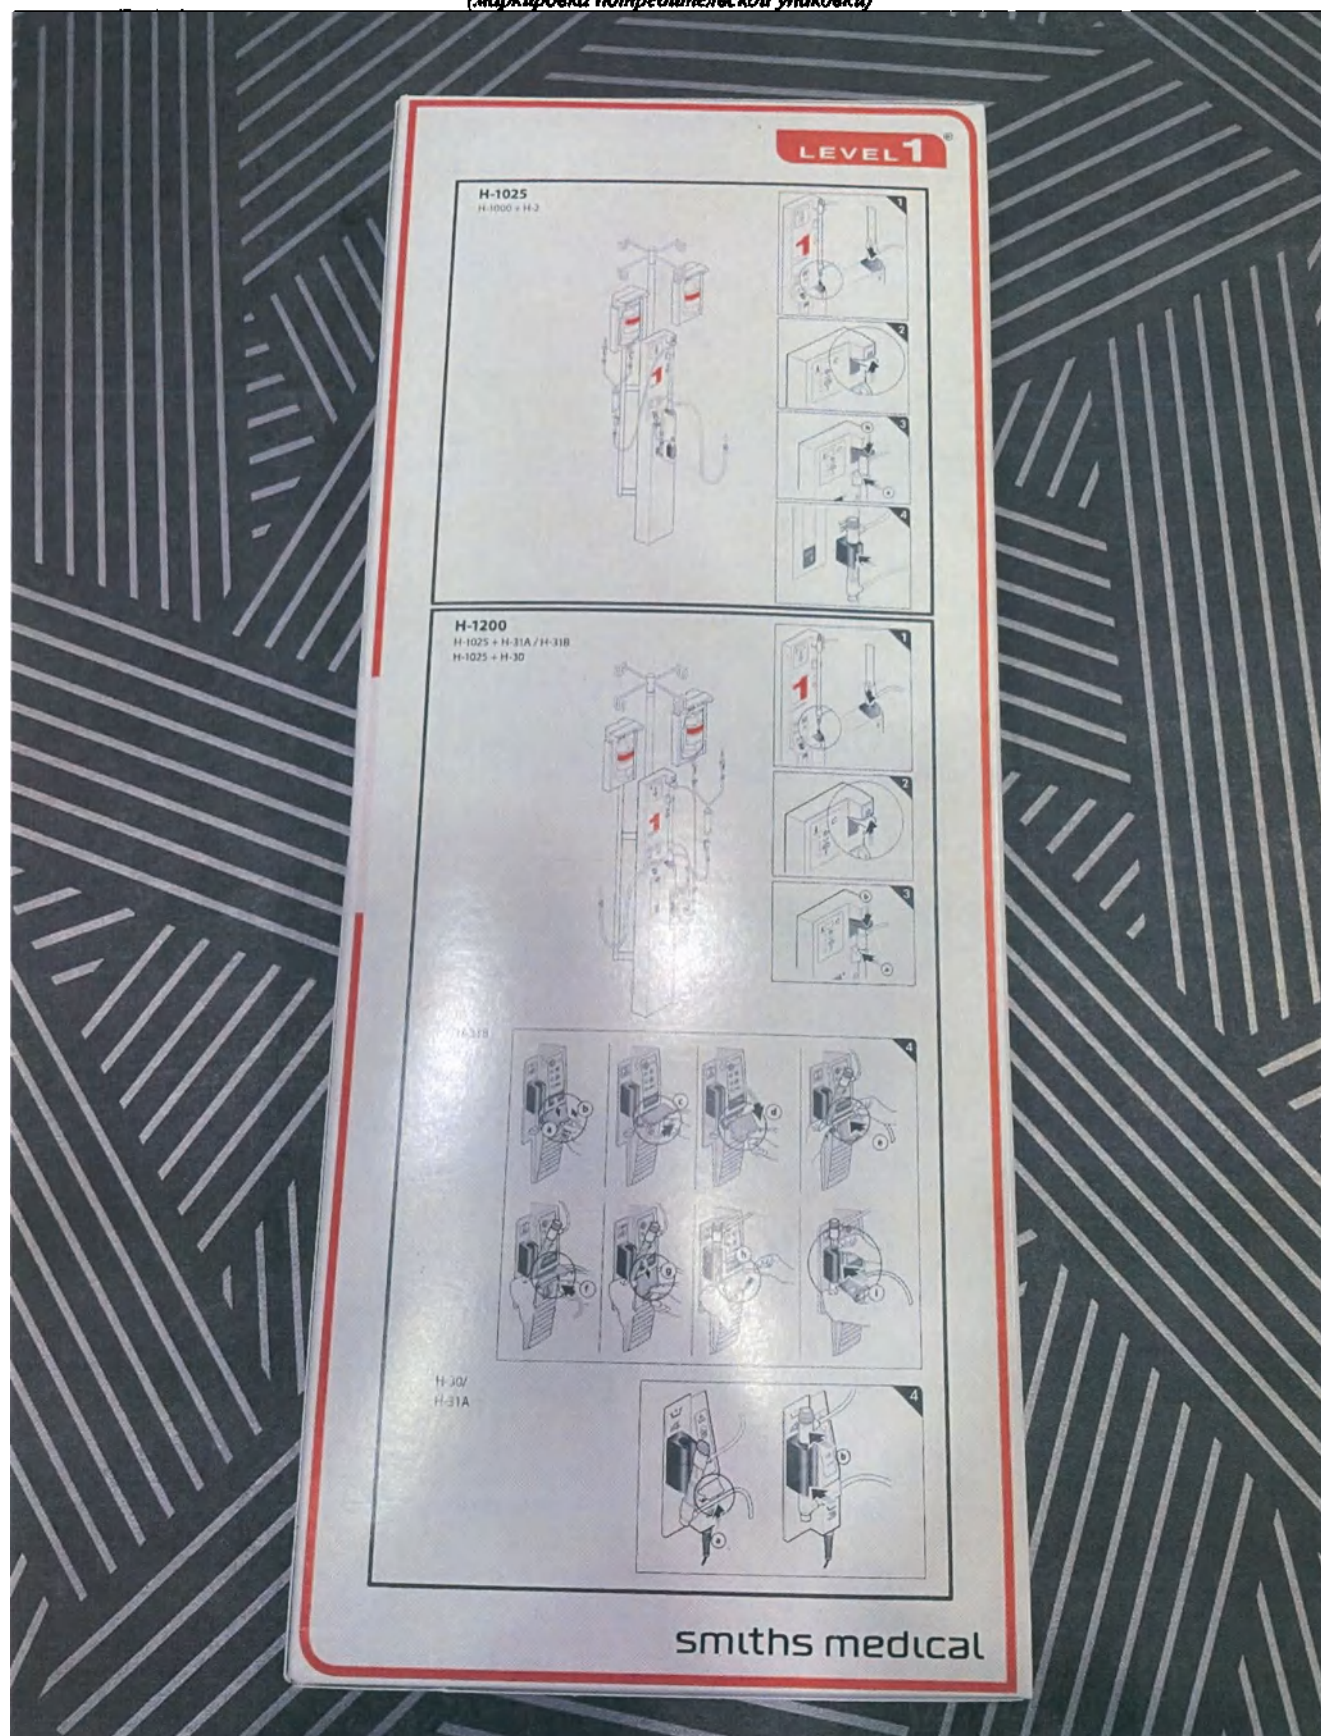

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 12. Магистралы для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 75 мл/час до 530 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./ уп. (при необходимости)
(маркировка потребительской упаковки)



Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

10012022-002

LOT 4025982 2020-07-29 2024-07-29
REF DI-60HL
1

PC10005497-001



(01) 20695085406010 (11) 200729 (17) 240729 (10) 4025982

smiths medical

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

1. Основной состав: 12. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 75 мл/час до 530 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)
(изделие в индивидуальной упаковке)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

I. Основной состав: 12. Магистраль для нормотермической инфузионной терапии LEVEL 1®, скорость потока от 75 мл/час до 530 мл/мин – не более 5 уп., по 10 шт./уп. (при необходимости)

(общий вид)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 1. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 1. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: I. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)

20

LOT 4008399



Date of Manufacture:

2020-06-16



Use By:

2024-06-16



(01) 10695085411000 (11) 200616 (17) 240616 (10) 4008399



Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com

MADE IN MEXICO



European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**II. Принадлежности: 1. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(изделие в индивидуальной упаковке)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 1. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(общий вид)

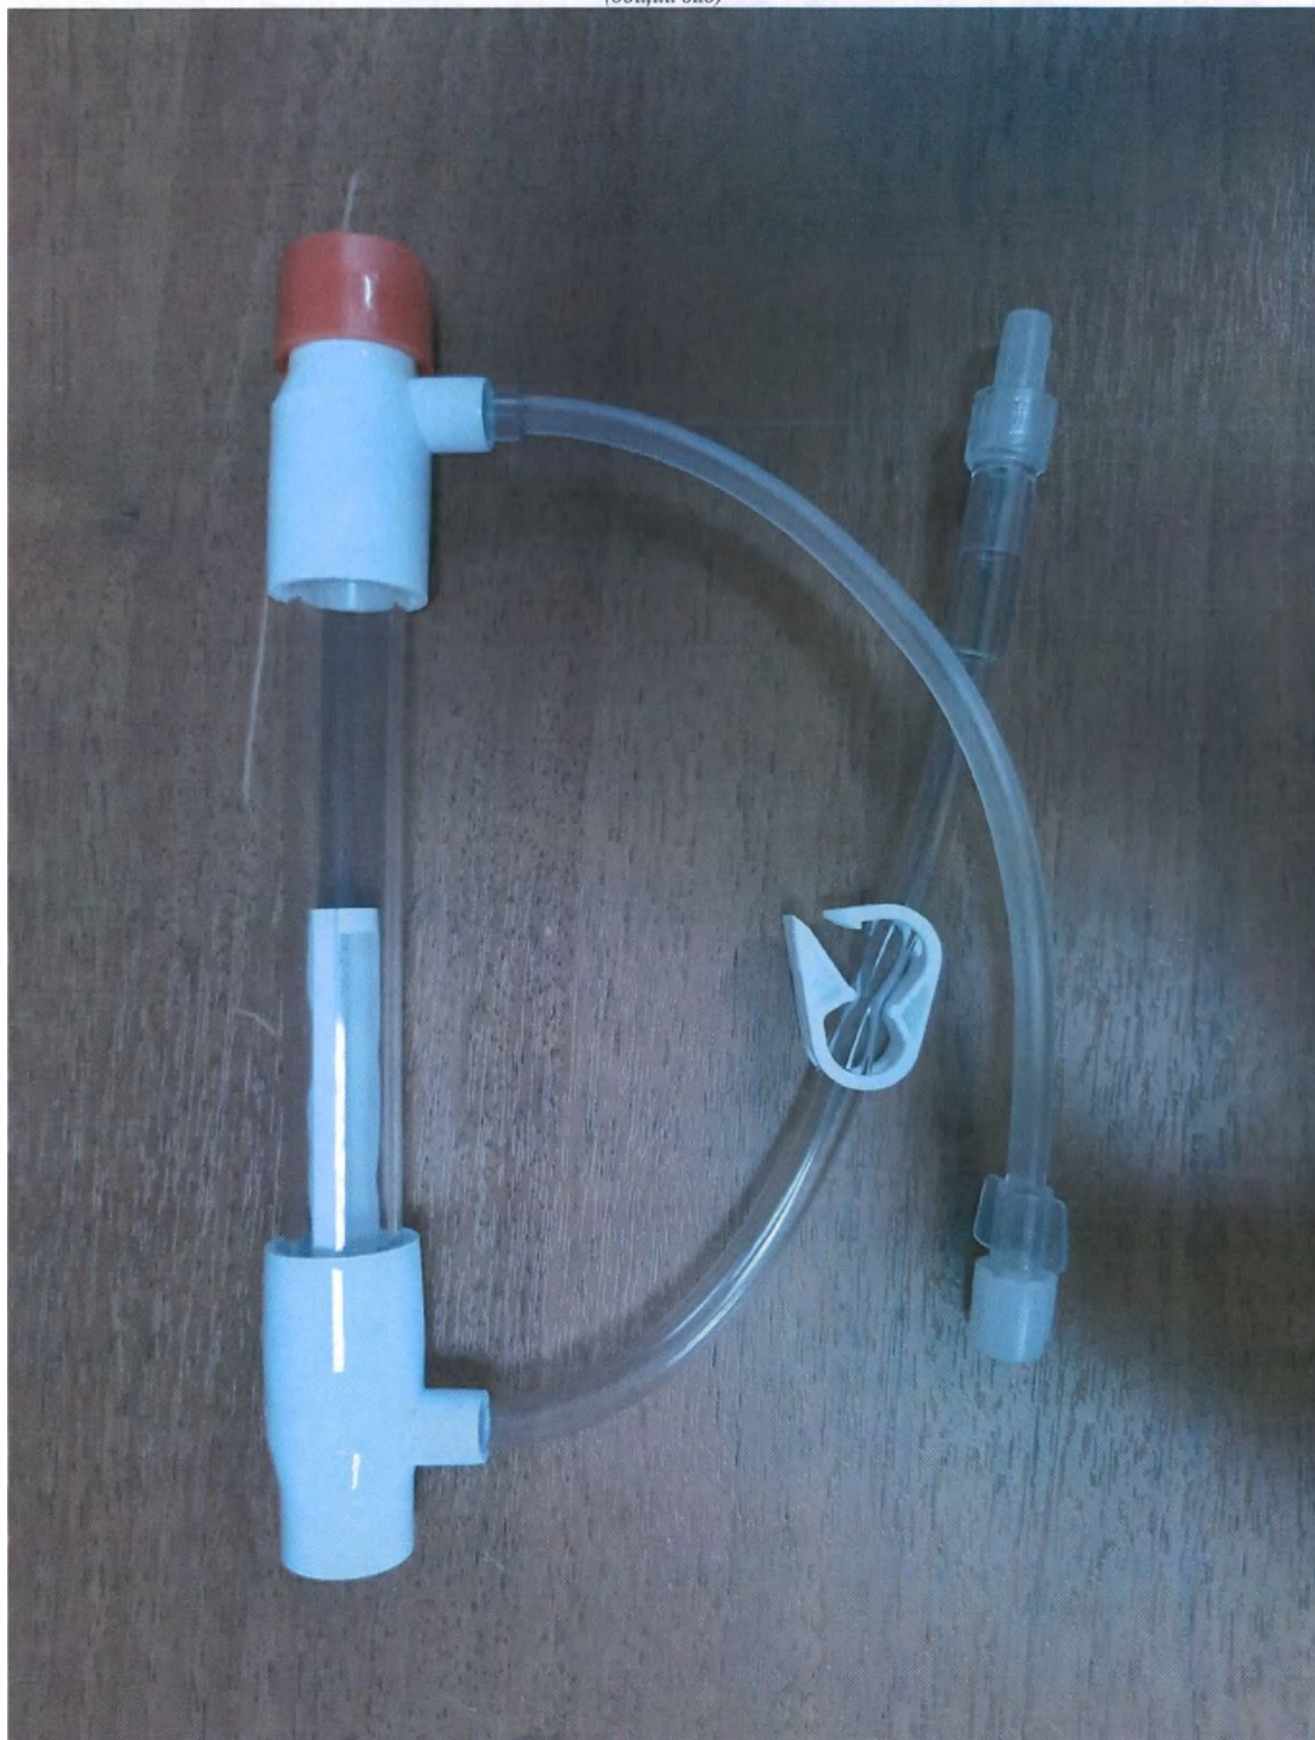

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**II. Принадлежности: 2. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1® для магистралей для нормотермической инфузионной терапии со скоростью потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин. по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 2. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1® для магистралей для нормотермической инфузионной терапии со скоростью потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин, по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)

REF

F-30

LEVEL 1®

Level 1® Gas Vent/Filter Assembly Replacement

en	Gas Vent/Filter Assembly Replacement
fr	Remplacement de l'ensemble dégazeur/filtre
de	Austausch der Entgasungs-/Filterbaugruppe
es	Cambio del conjunto de filtro y línea de descarga de gases
it	Sostituzione del gruppo valvola di degassamento/filtro
nl	Vervangende ontgasser/filterkit
pt	Substituição do conjunto de filtro e saída de gases
sv	Byte av gasventilfilterenheter

Caution

Do not reuse

Not made with natural rubber latex

Do not use if package is damaged

STERILE EO

Sterile Fluid Path,
Ethylene oxide
gas sterilized

PHT DEHP

Contains or Presence of
Phthalate: bis(2-ethylhexyl)
phthalate (DEHP)

+60° C
-18° C

Rx ONLY

CE 2797

Caution: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

PC10012032-002

smiths medical


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 2. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1® для магистралей для нормотермической инфузионной терапии со скоростью потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин, по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)




Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**II. Принадлежности: 2. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1® для магистралей для нормотермической инфузионной терапии со скоростью потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин. по 20 шт./уп.
(изделие в индивидуальной упаковке)**

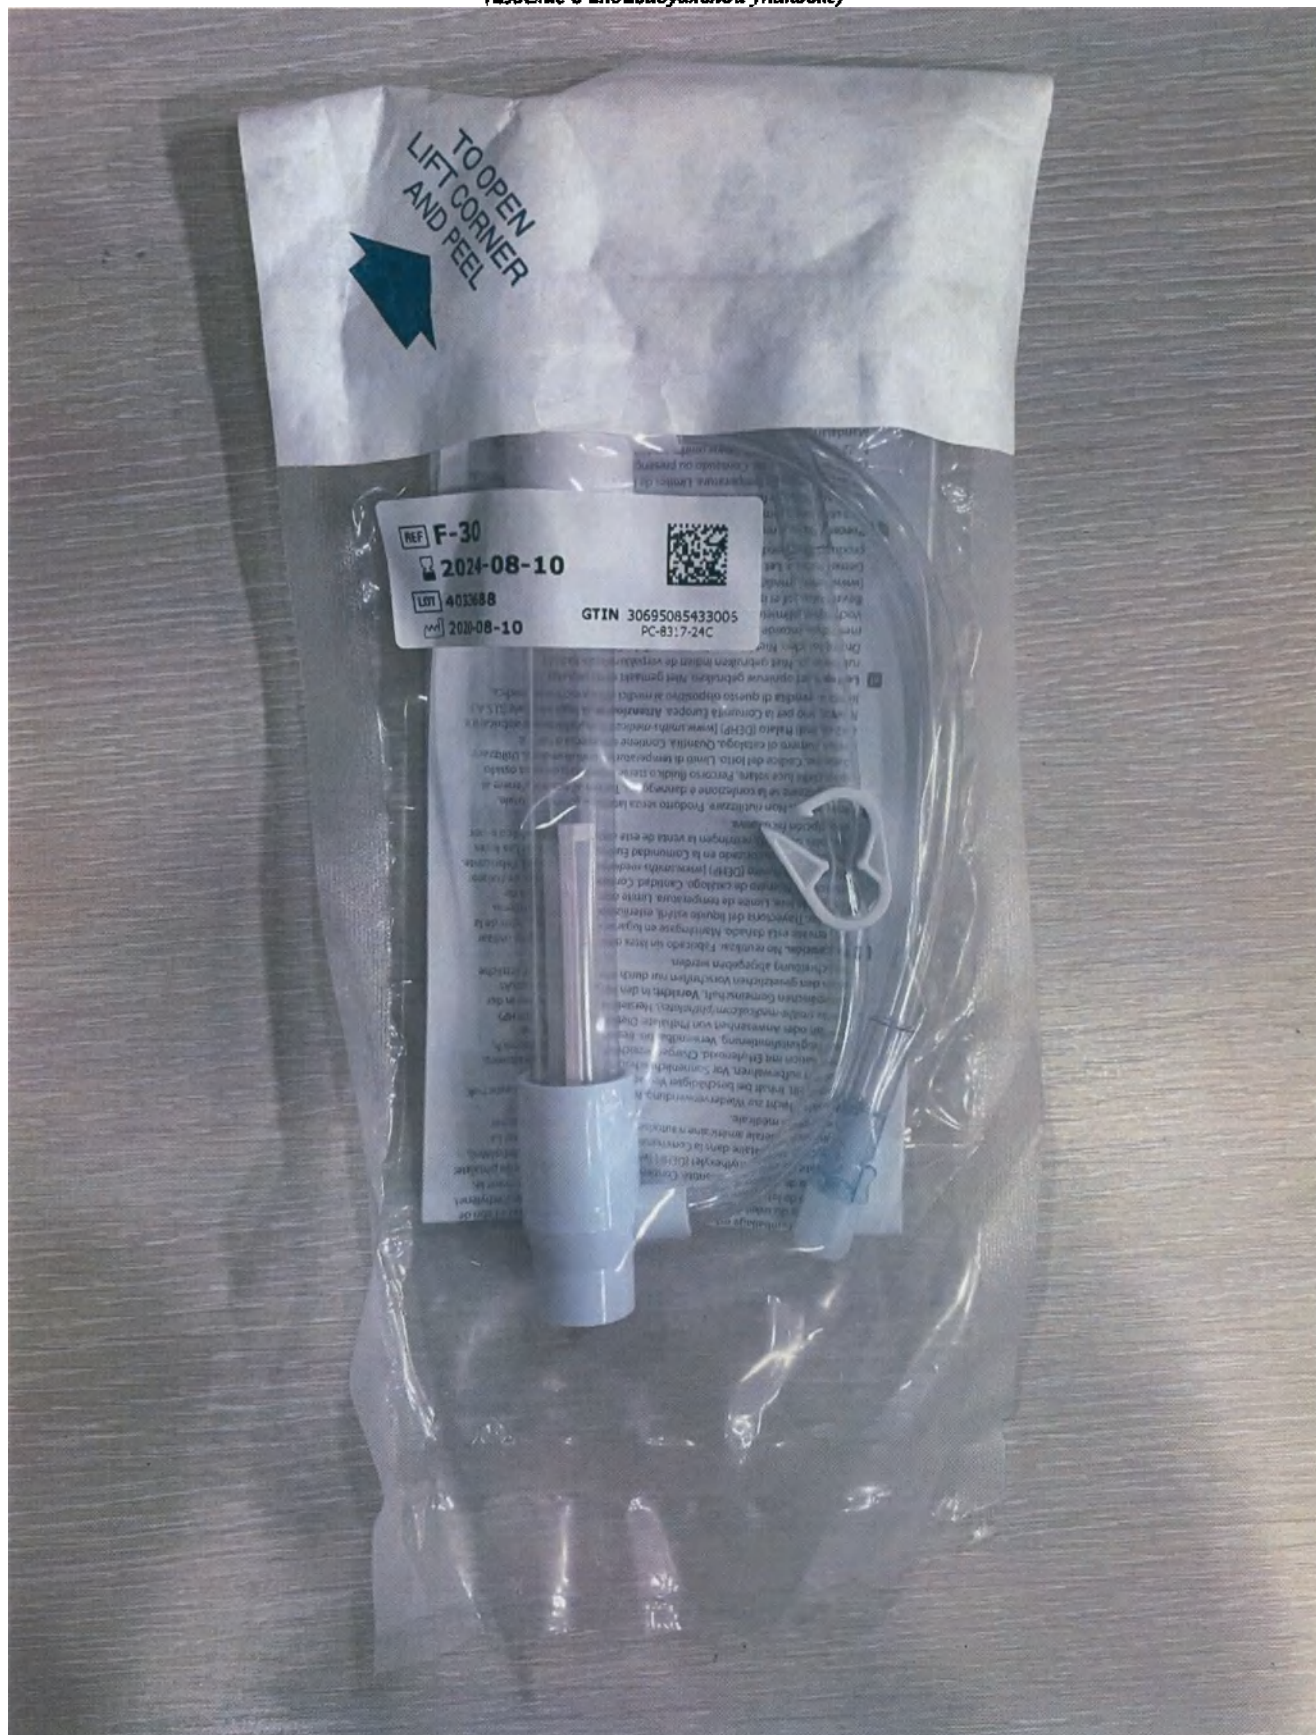

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 2. Сменные блоки фильтра-дегазатора LEVEL 1® для магистралей для нормотермической инфузионной терапии со скоростью потока от 30 мл/мин до 1100 мл/мин, по 20 шт./уп.
(общий вид)

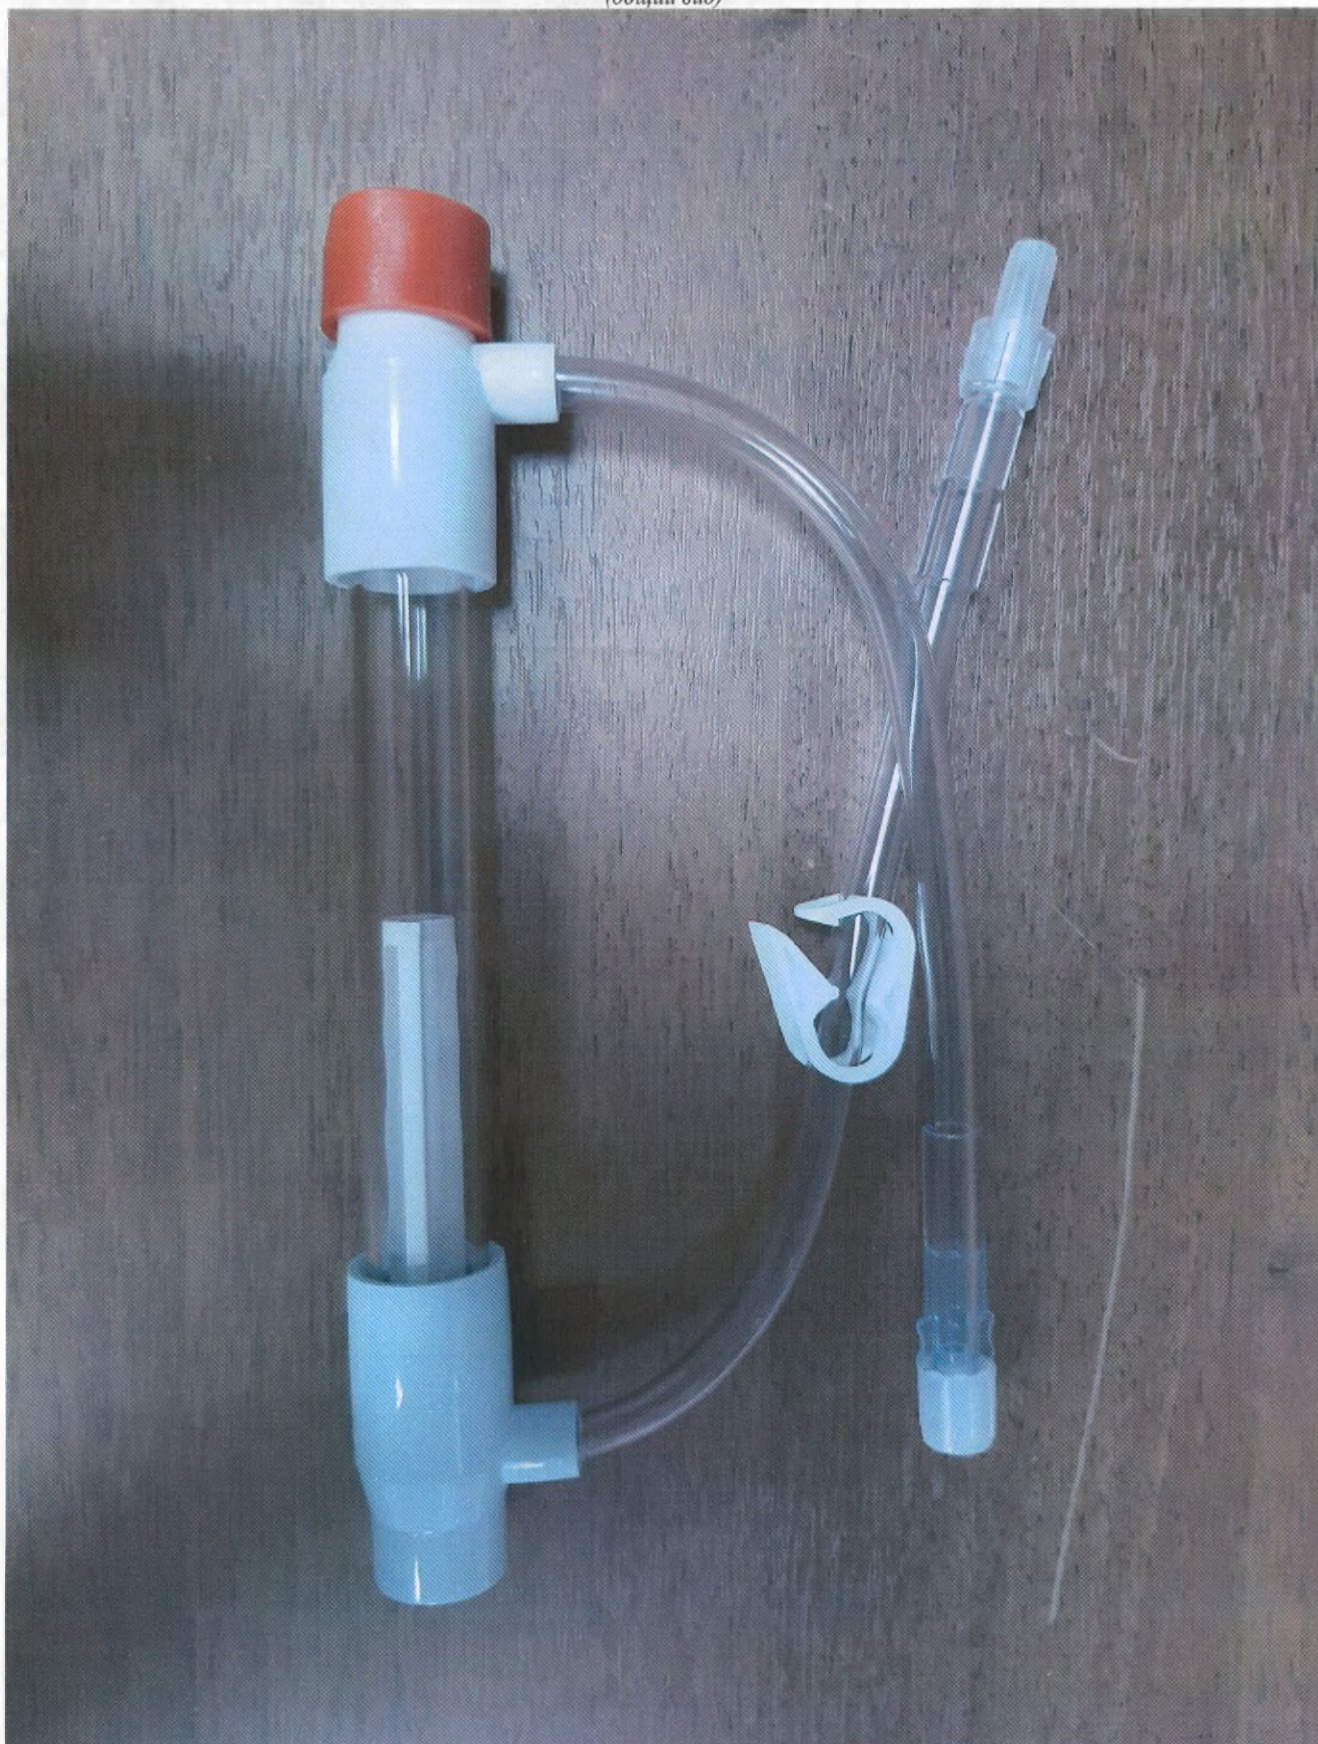

II. Принадлежности: 3. Высокопоточные фильтры предварительной очистки LEVEL 1[®], по 60 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.
 II. Принадлежности: 3. Высокоточные фильтры предварительной очистки LEVEL 1®, по 60 шт./уп.
 (маркировка транспортной упаковки)

REF

PF-1

LEVEL 1®

Level 1® High Flow Pre-Filter

en

High Flow Pre-Filter

fr

Pré-filtre à grand débit

de

Vorfilter für hohes Fließvolumen

es

Prefiltro de alto flujo

it

Pre-filtro per flussi elevati

nl

High flow voorfilter

sv

Förfilter för högt flöde

Caution

Do not reuse

Not made with natural rubber latex

Do not use if package is damaged

STERILE EO

Sterile Fluid Path, Ethylene oxide gas sterilized

PHT

DEHP

Contains or Presence of Phthalate: bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

-18° C

+60° C

5%

95%

Rx ONLY

CE 2797

Caution: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

PC10012057-002

smiths medical


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 3. Высокопоточные фильтры предварительной очистки LEVEL 1®, по 60 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 3. Высокопоточные фильтры предварительной очистки LEVEL 1®, по 60 шт./уп.
(изделие в индивидуальной упаковке)

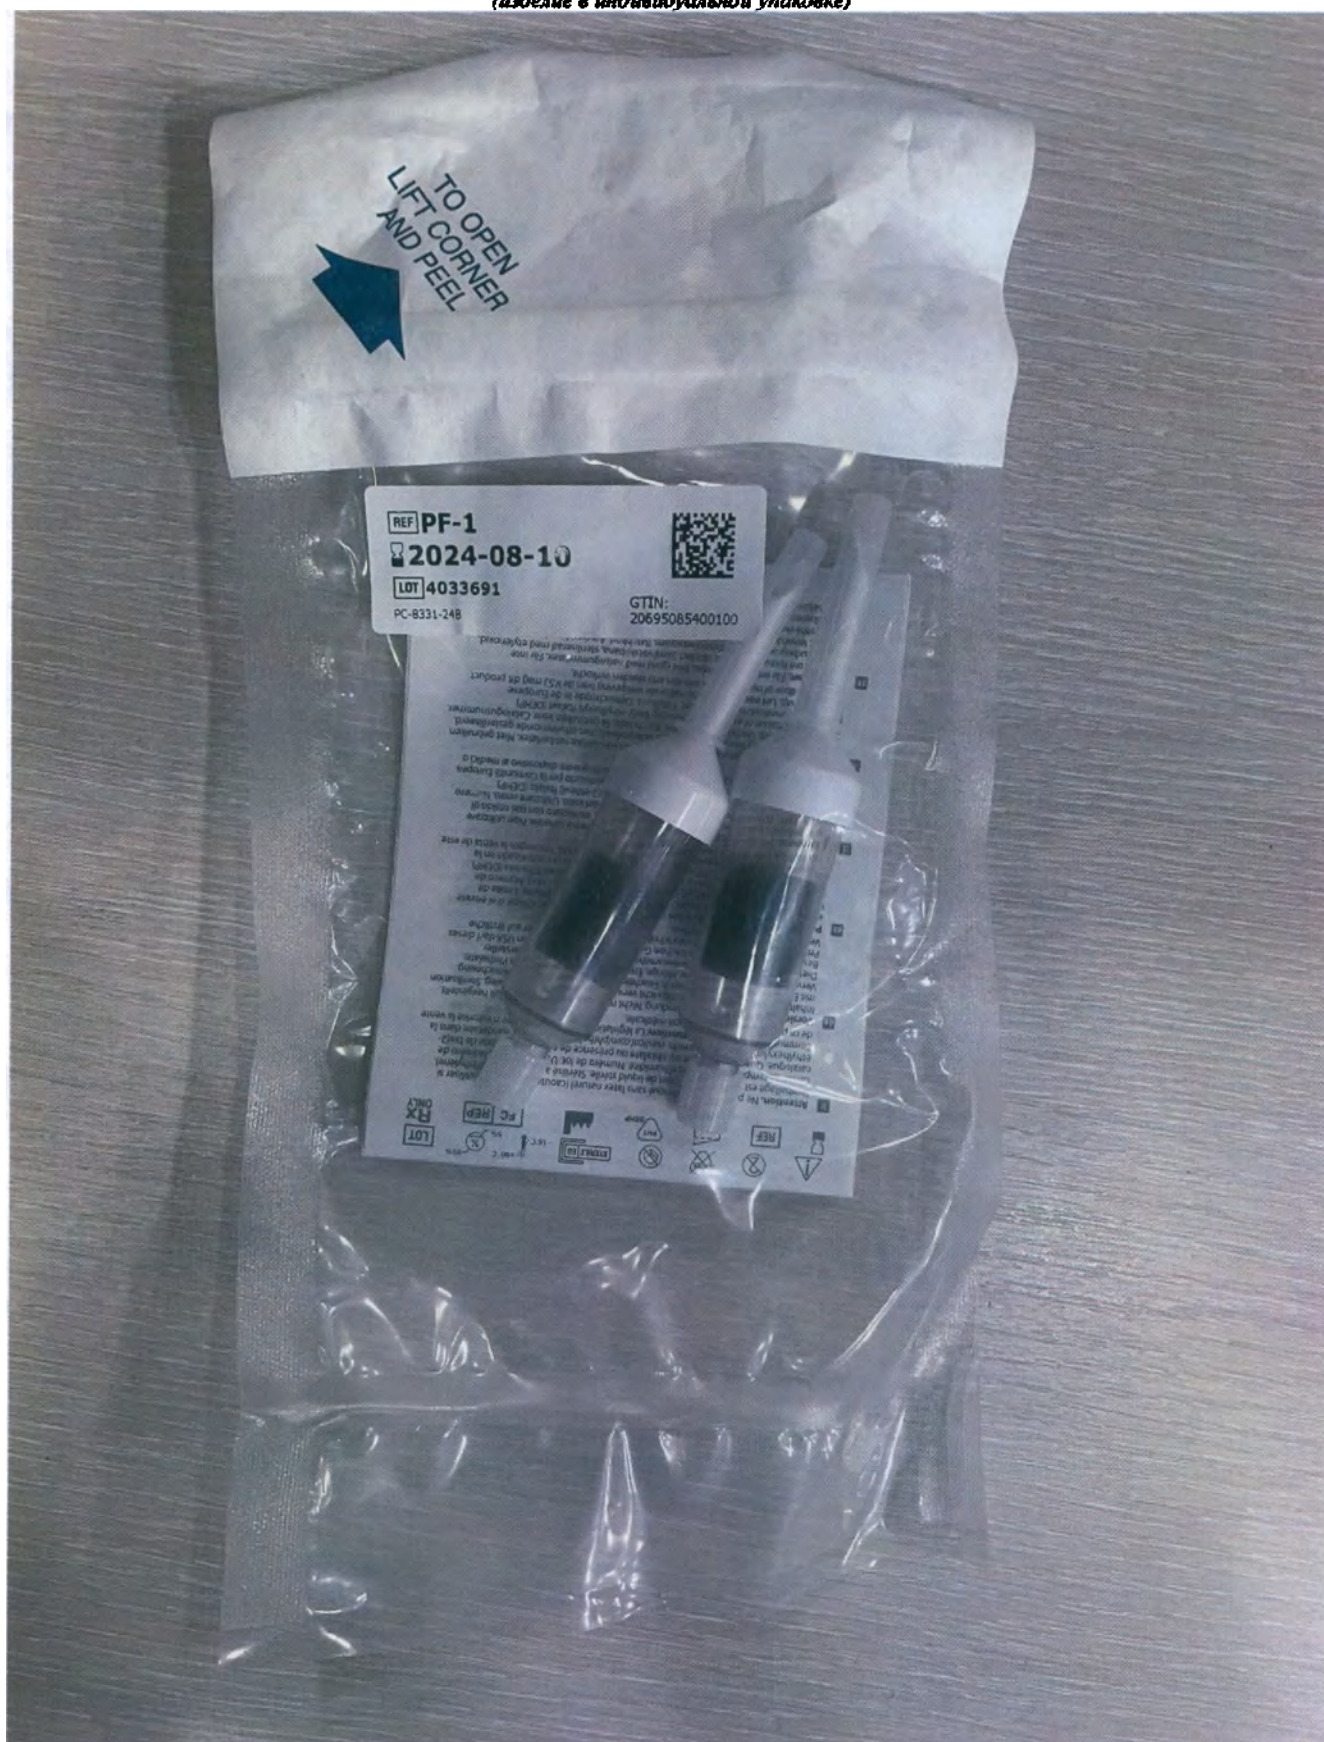

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1* с принадлежностями.

**II. Принадлежности: 3. Высокопоточные фильтры предварительной очистки LEVEL 1*, по 60 шт./уп.
(общий вид)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)

LOT 4006073

 **Use By:**
2024-06-08

40



(01) 2Q695085400308 (17) 240608 (10) 4006073

 **Manufacturer:**
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP **European Representative:**
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка потребительской упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка потребительской упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка потребительской упаковки)

LOT 4006073

Use By:
2024-06-08

20




(01) 10695085400301 (17) 240608 (10) 4006073

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(изделие в индивидуальной упаковке)

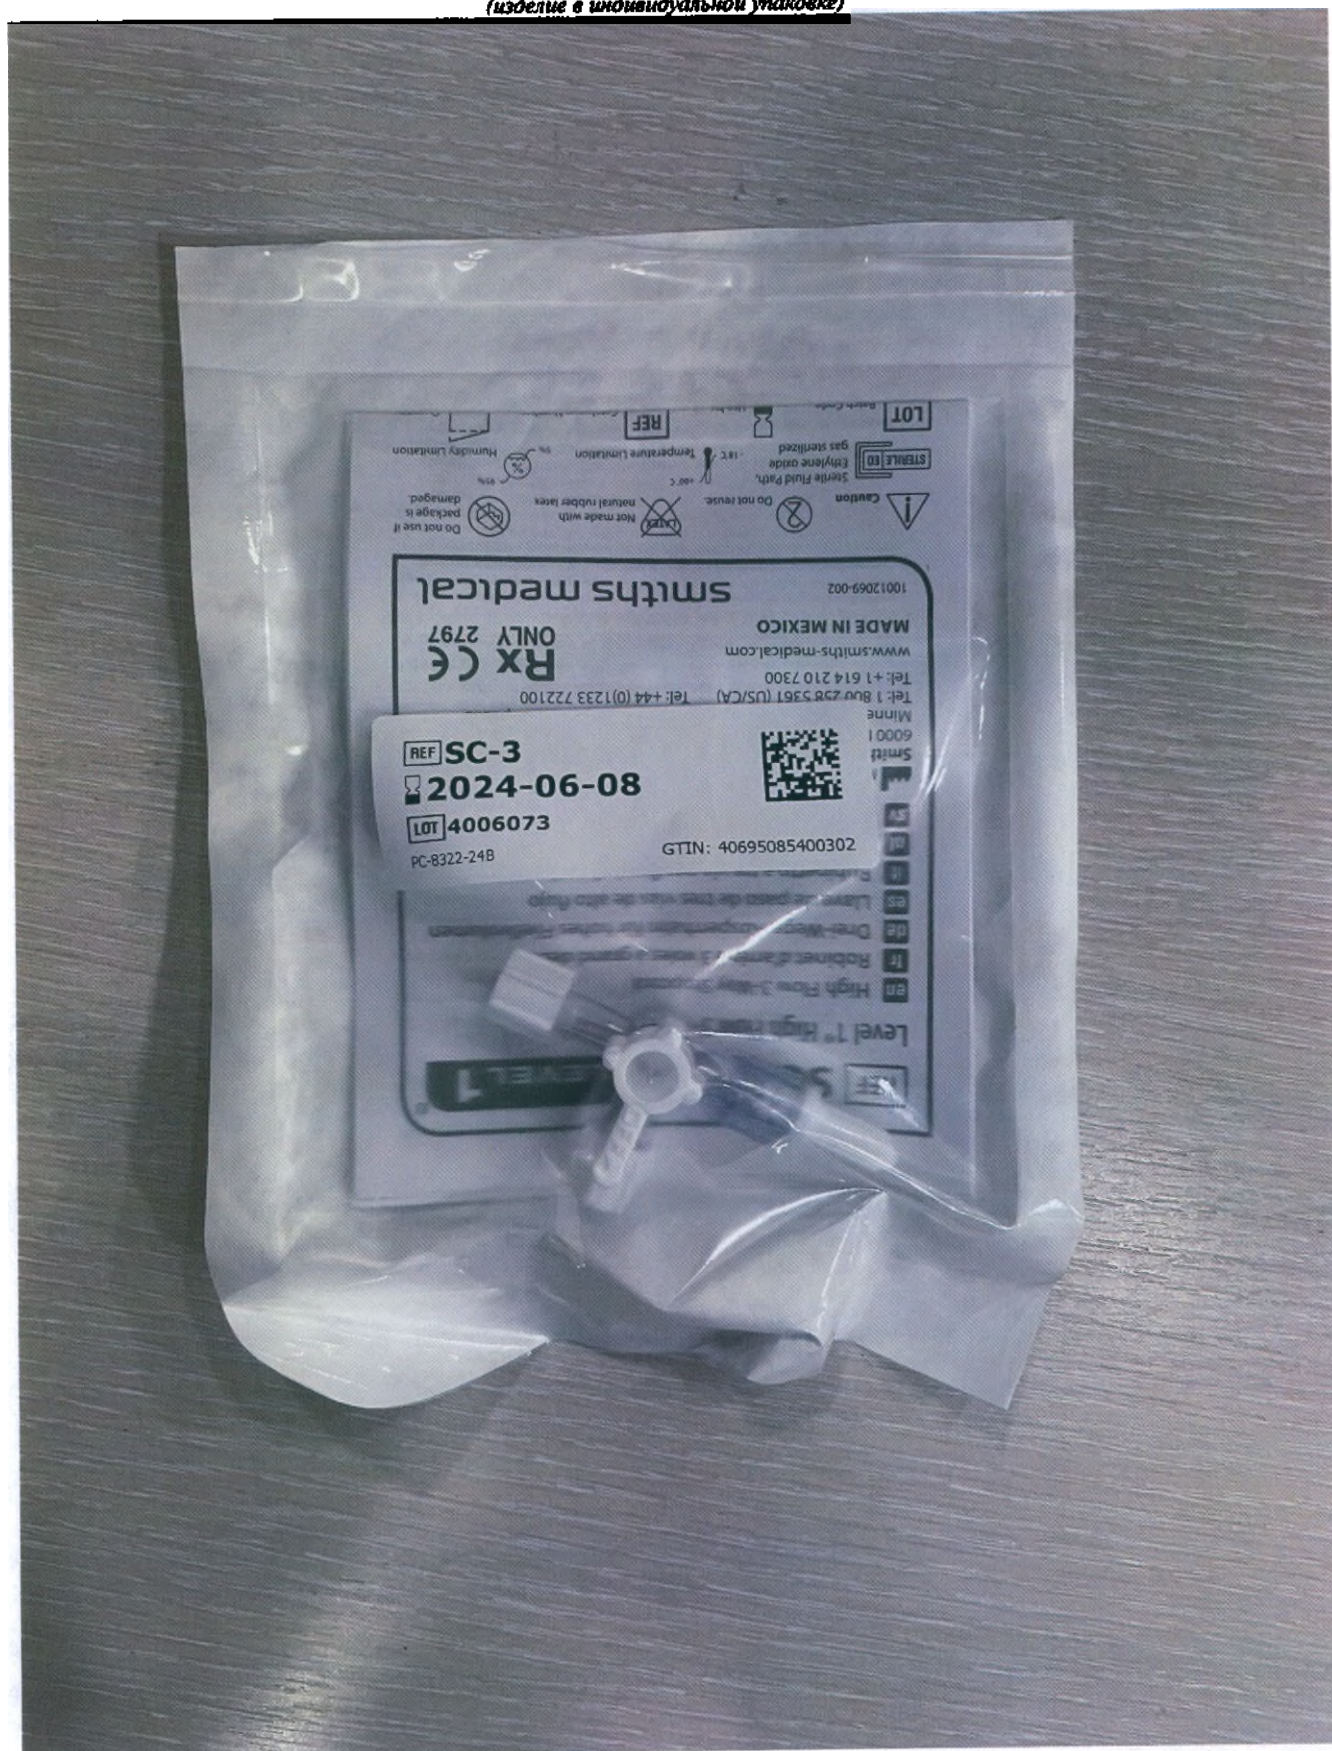

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 4. Трехходовые краны высокой скорости потока LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(общий вид)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 5. Высокопоточные удлинительные линии LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)




Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 5. Высокопоточные удлинительные линии LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**II. Принадлежности: 5. Высокоточные удлинительные линии LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(изделие в индивидуальной упаковке)**

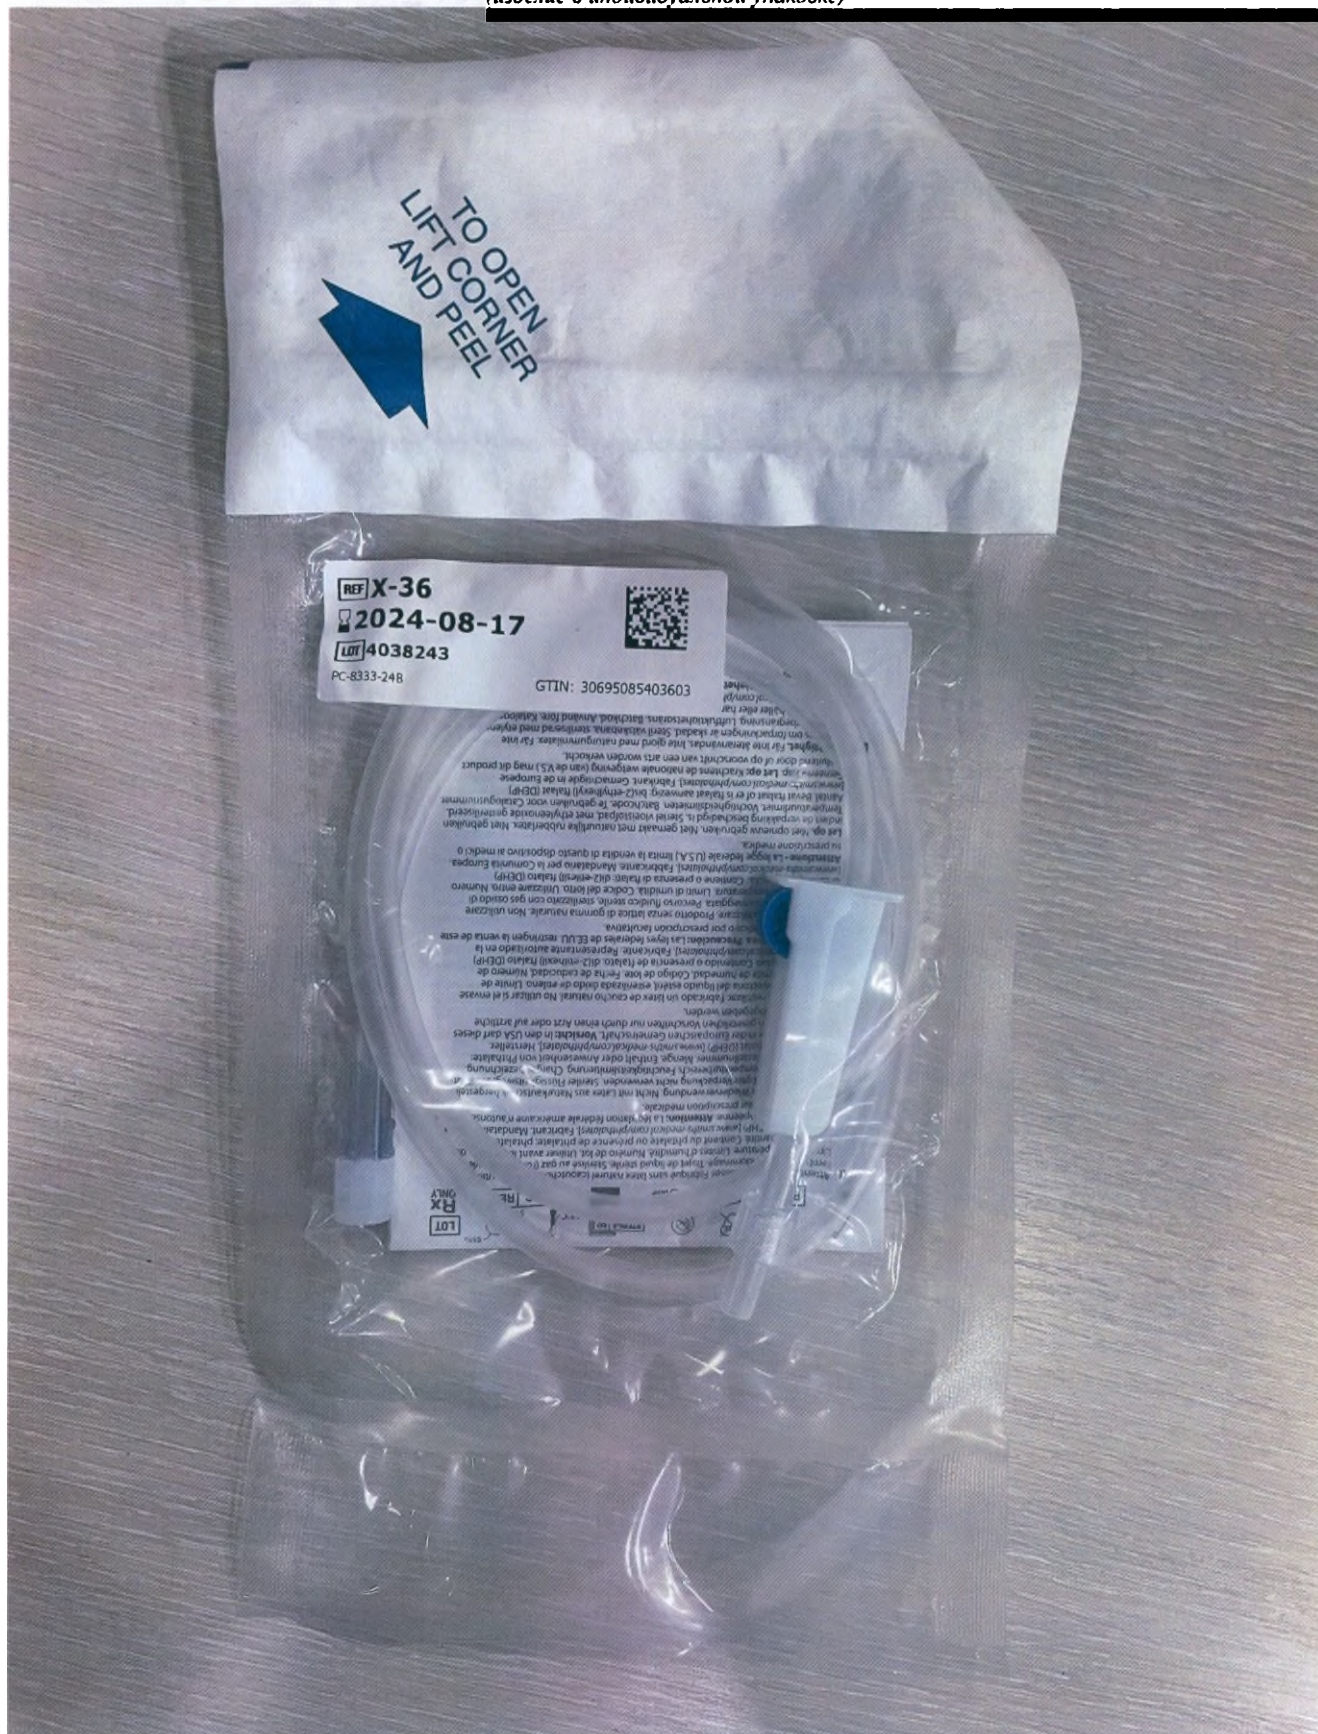

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**II. Принадлежности: 5. Высокопоточные удлинительные линии LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(общий вид)**



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 6. Высокопоточные удлинительные линии Y-образные LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



REF **Y-30**


LEVEL 1

Level 1® High Flow Y-Type Extension


- en** High Flow Y-Type Extension
- fr** Extension en étoile à grand débit
- de** Y-Verlängerungsleitung für hohes Fließvolumen
- es** Extensión Y de alto flujo
- it** Prolunga di tipo a stella per flussi elevati
- nl** High flow Y-extensie
- sv** Förlängningsslang av Y-typ för högt flöde




Caution




Do not reuse



Not made with natural rubber latex




Do not use if package is damaged




Sterile Fluid Path,
Ethylene oxide
gas sterilized



Contains or Presence of
Phthalate: bis(2-ethylhexyl)
phthalate (DEHP)



**Rx
ONLY**



**CE
2797**


Caution: Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

PC10012110-002

smiths medical


Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 6. Высокопоточные удлинительные линии Y-образные LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)

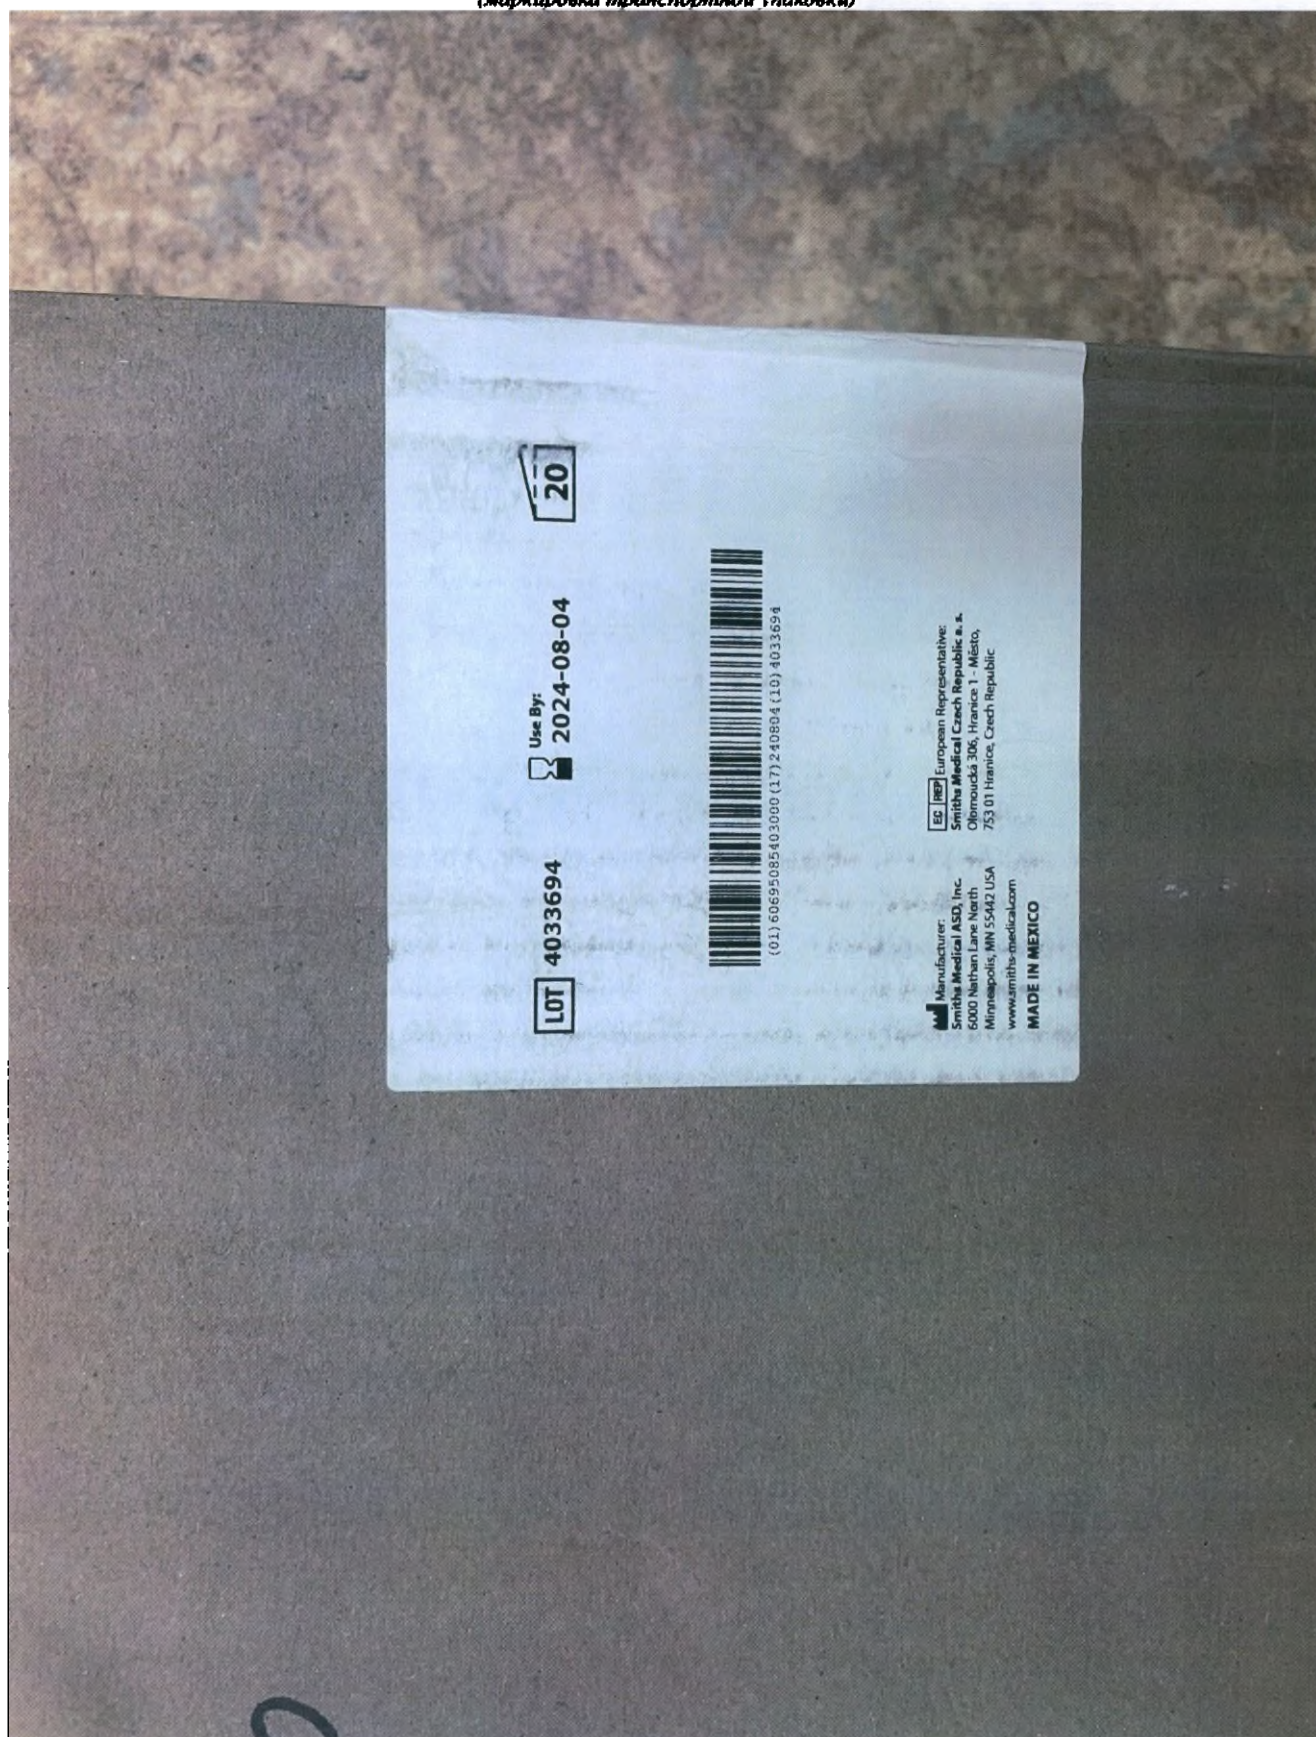

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

**II. Принадлежности: 6. Высокоточные удлинительные линии Y-образные LEVEL 1®, по 20 шт./уп.
(изделие в индивидуальной упаковке)**

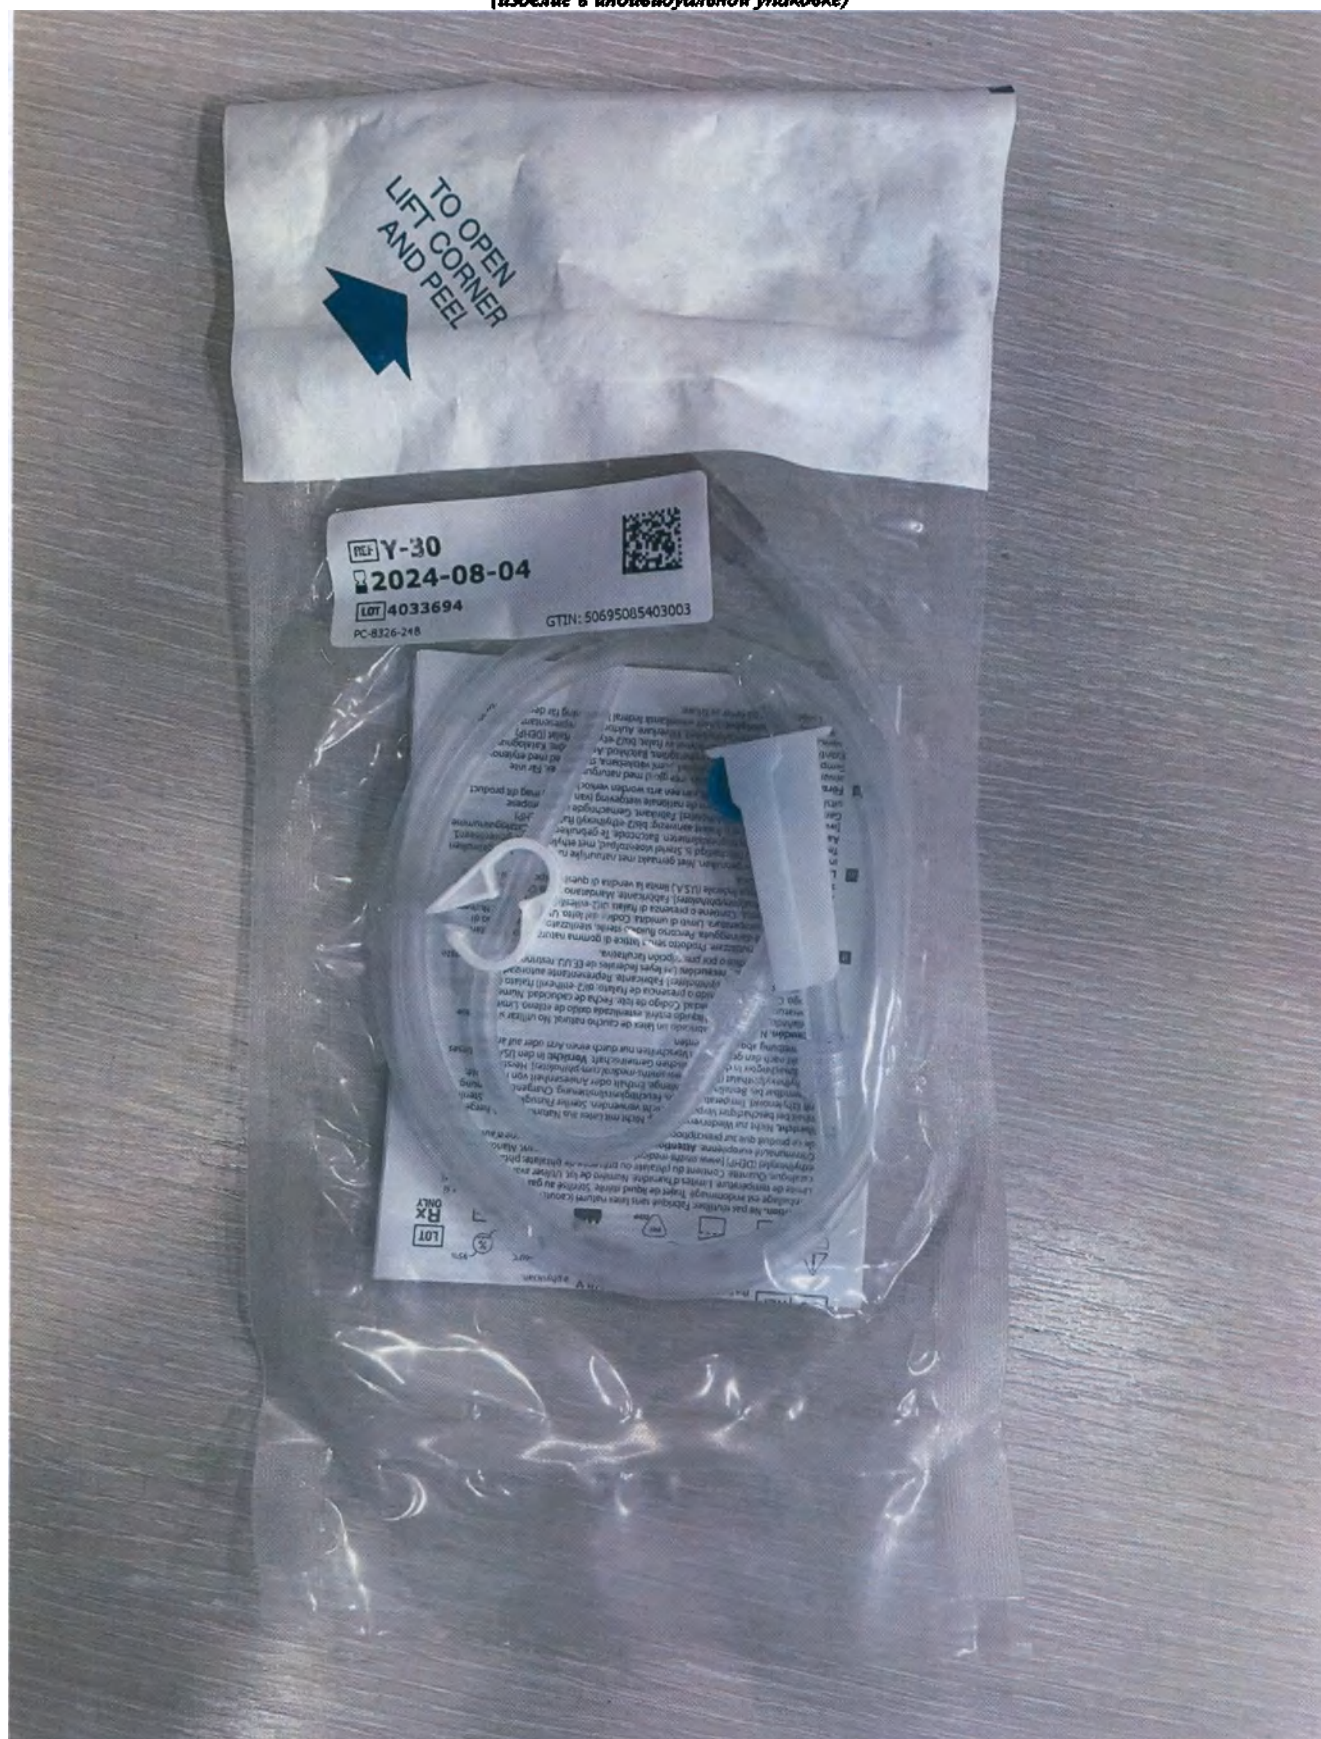

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 6. Высокопоточные удлинительные линии Y-образные LEVEL 1®, по 20 шт./уп.

(общий вид)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 7. Высокопоточные удлинительные линии с портом для инъекций LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 7. Высокопоточные удлинительные линии с портом для инъекций LEVEL 1®, по 40 шт./уп. (маркировка транспортной упаковки)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 7. Высокопоточные удлинительные линии с портом для инъекций LEVEL 1®, по 40 шт./уп.
(маркировка транспортной упаковки)

LOT 4002562

Use By:
2024-06-01

40



(01) 10695085403104 (17) 240601 (10) 4002562

Manufacturer:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
www.smiths-medical.com
MADE IN MEXICO

EC REP European Representative:
Smiths Medical Czech Republic a. s.
Olomoucká 306, Hranice 1 - Město,
753 01 Hranice, Czech Republic

Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 7. Высокопоточные удлинительные линии с портом для инъекций LEVEL 1®, по 40 шт./уп. (изделие в индивидуальной упаковке)



Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом LEVEL 1® с принадлежностями.

II. Принадлежности: 7. Высокопоточные удлинительные линии с портом для инъекций LEVEL 1®, по 40 шт./уп. (общий вид)



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

49 (сорок девять) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Айно-М»

 Габриэлов И. Б.

